

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"


Тест-система иммуноферментная для количественного определения
СА19-9 в сыворотке крови человека

ИФА-СА19-9

Набор рассчитан на исследование
48 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	12 стрипов
Калибровочные пробы (КП1)	1 фл. (1,0 мл)
(КП2-6)	5 фл. (по 0,4 мл)
K+, инактивированный	1 фл. (0,4 мл)
Конъюгат	1 фл. (15 мл)
ОР(x40)	1 фл. (25 мл)
РИ	1 фл. (15 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (15 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
2020 г.

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-СА19-9


ТУ 9398-243-70423725-2016 с изм. №1,2,3
РУ № РЗН 2018/7104 от 28.04.2018

Каталожный № 61.04

Серия ** Контрольный № ***

Дата изготовления: XXXX.XX.XX

Годен до: XXXX.XX.XX



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"




ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ОР(x40)








с. ** 25 мл
Годен до: XXXX.XX

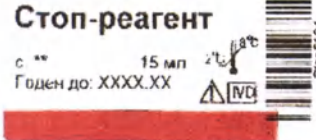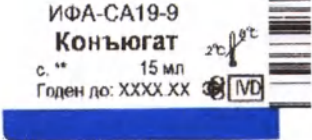

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-СА19-9
Иммуносорбент

с. **
Годен до: XXXX.XX



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес,
телефоны, условия хранения, надпись "только для in vitro диагностики"
указаны непосредственно на коробке

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК


Осинская А.Д.


Юрина Т.В.

Юрина Т.В.
В.Ю. Борисов



Серия 01 от 01.2020 г.

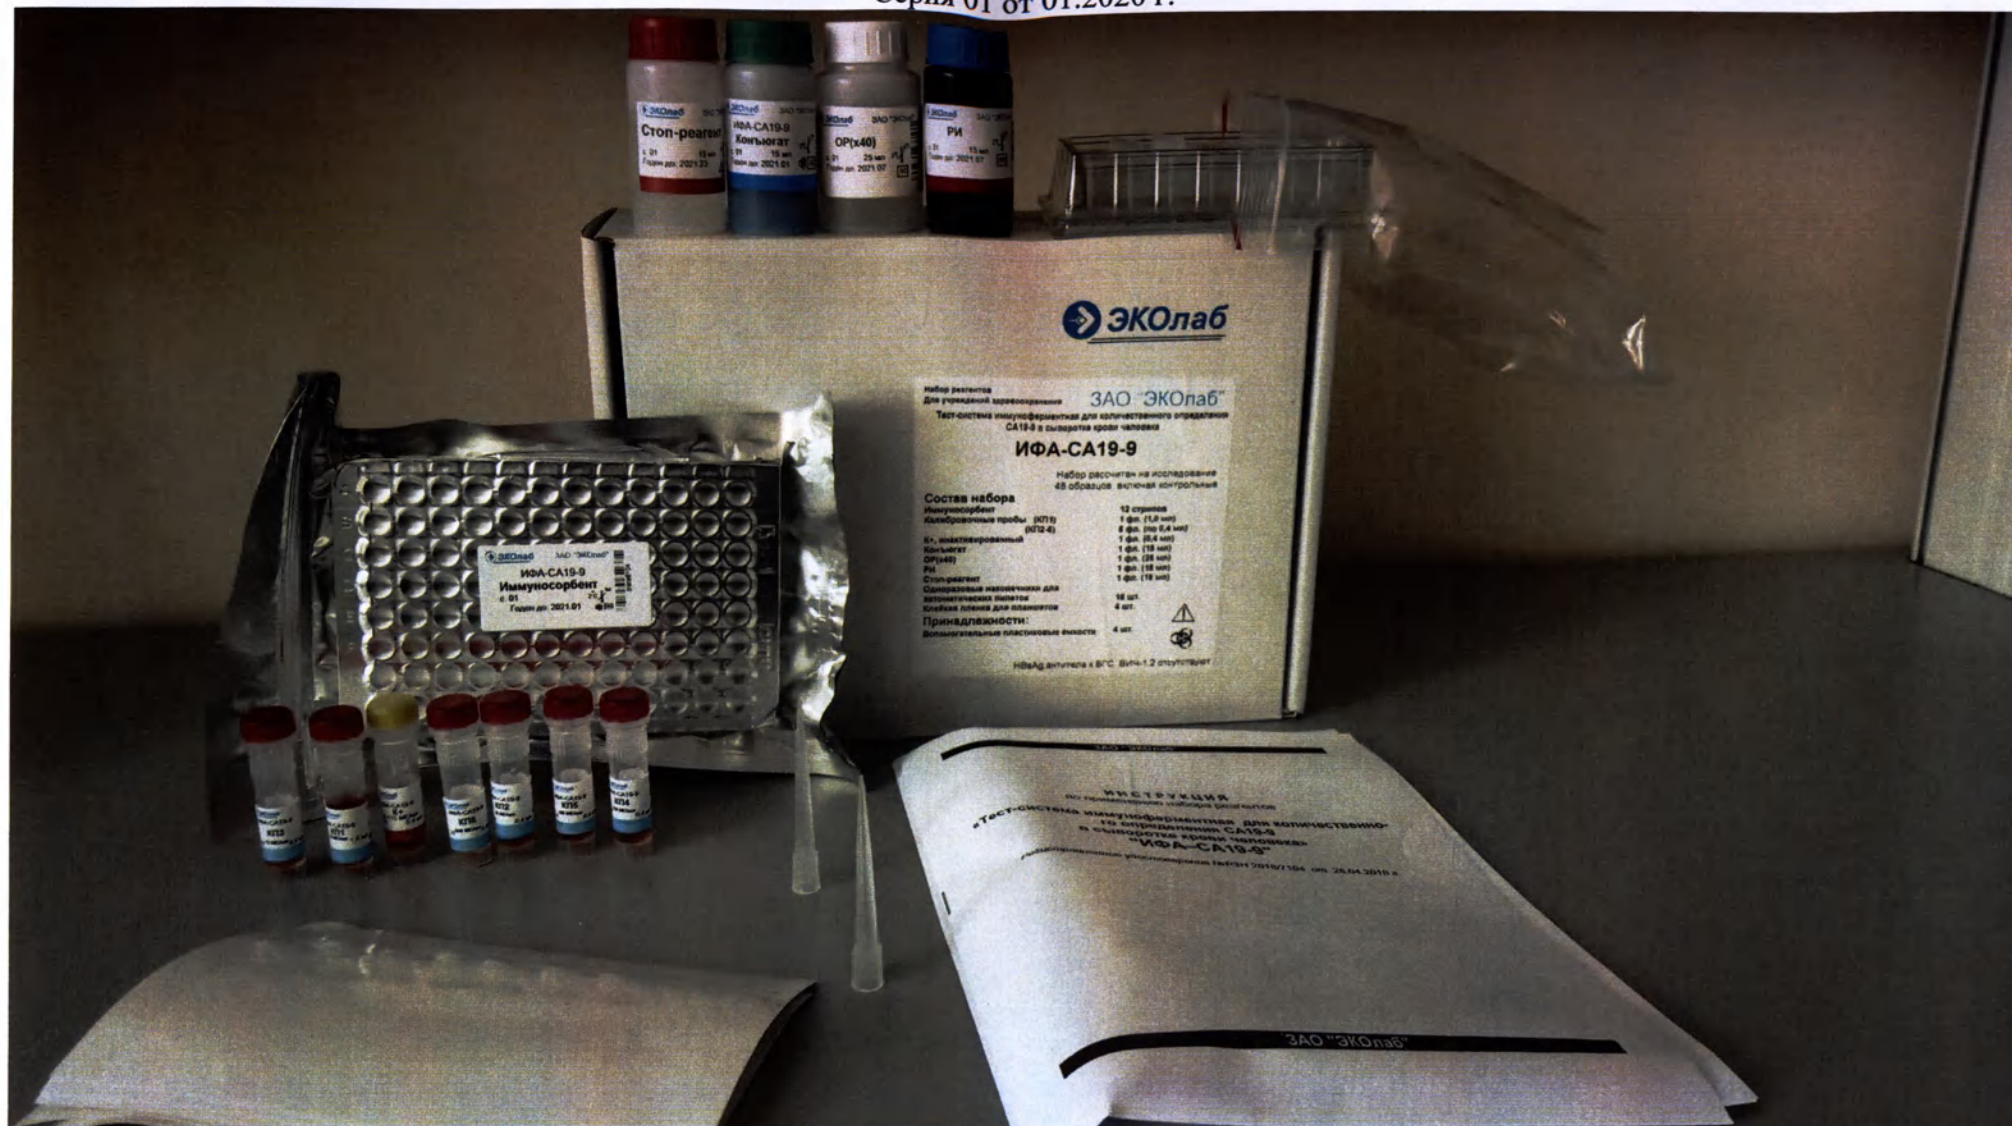

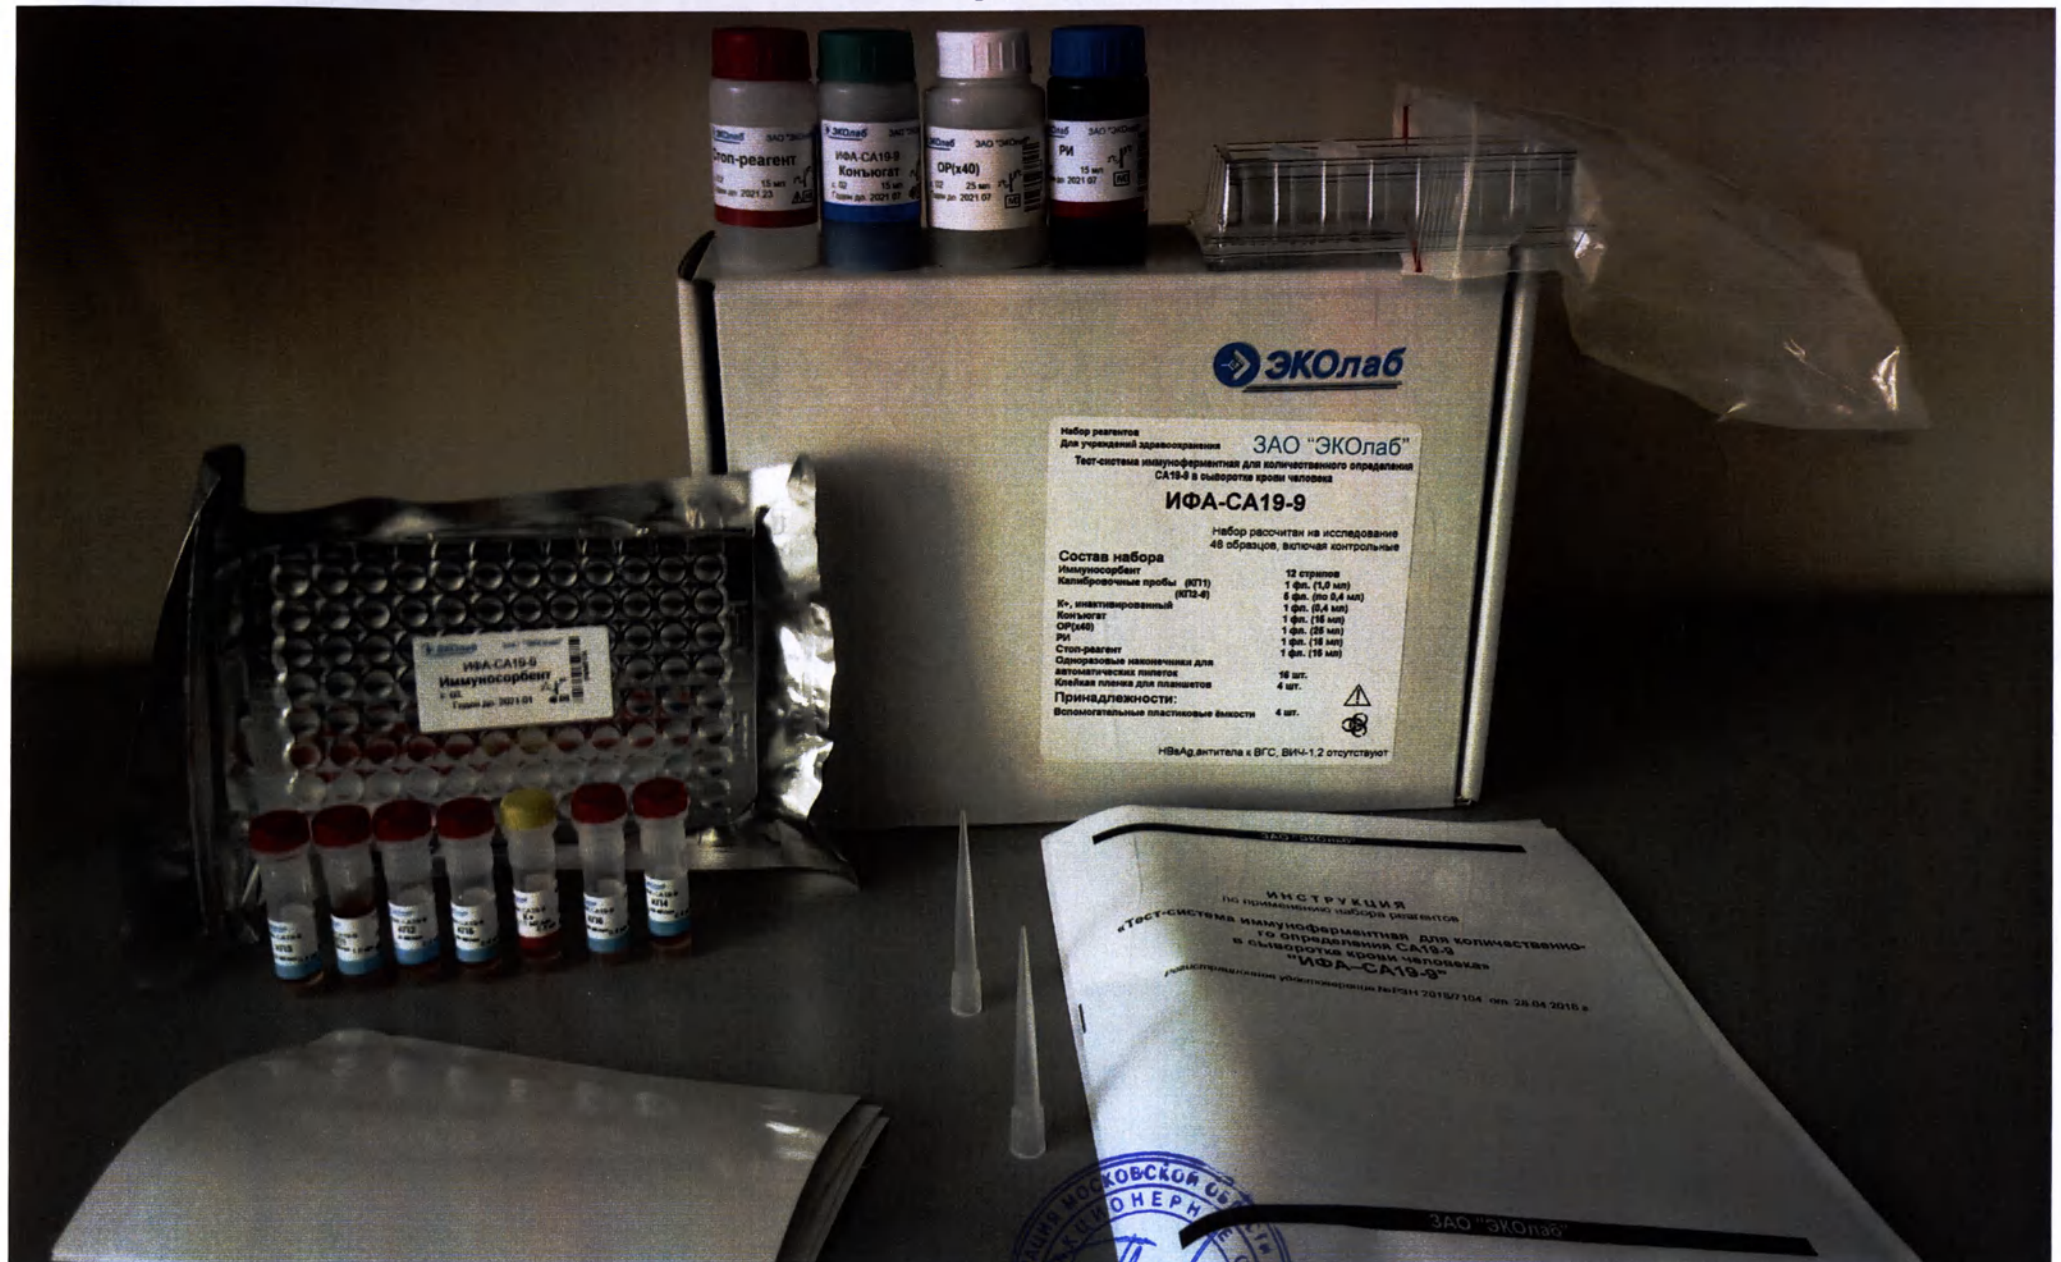



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 лист 1

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Борисов В.Ю.

"19" 10 2020 г.