



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Аппарат флюорографический цифровой ФЦ - "МАКСИМА" по ТУ 9442-023-11150760-2007 в составе »

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ЗАО «НИПК «Электрон»

А. М. Элинсон


« 18 » 03 2016 г.



Аппарат флюорографический цифровой ФЦ - "МАКСИМА" по ТУ 9442-023-11150760-2007 в составе:





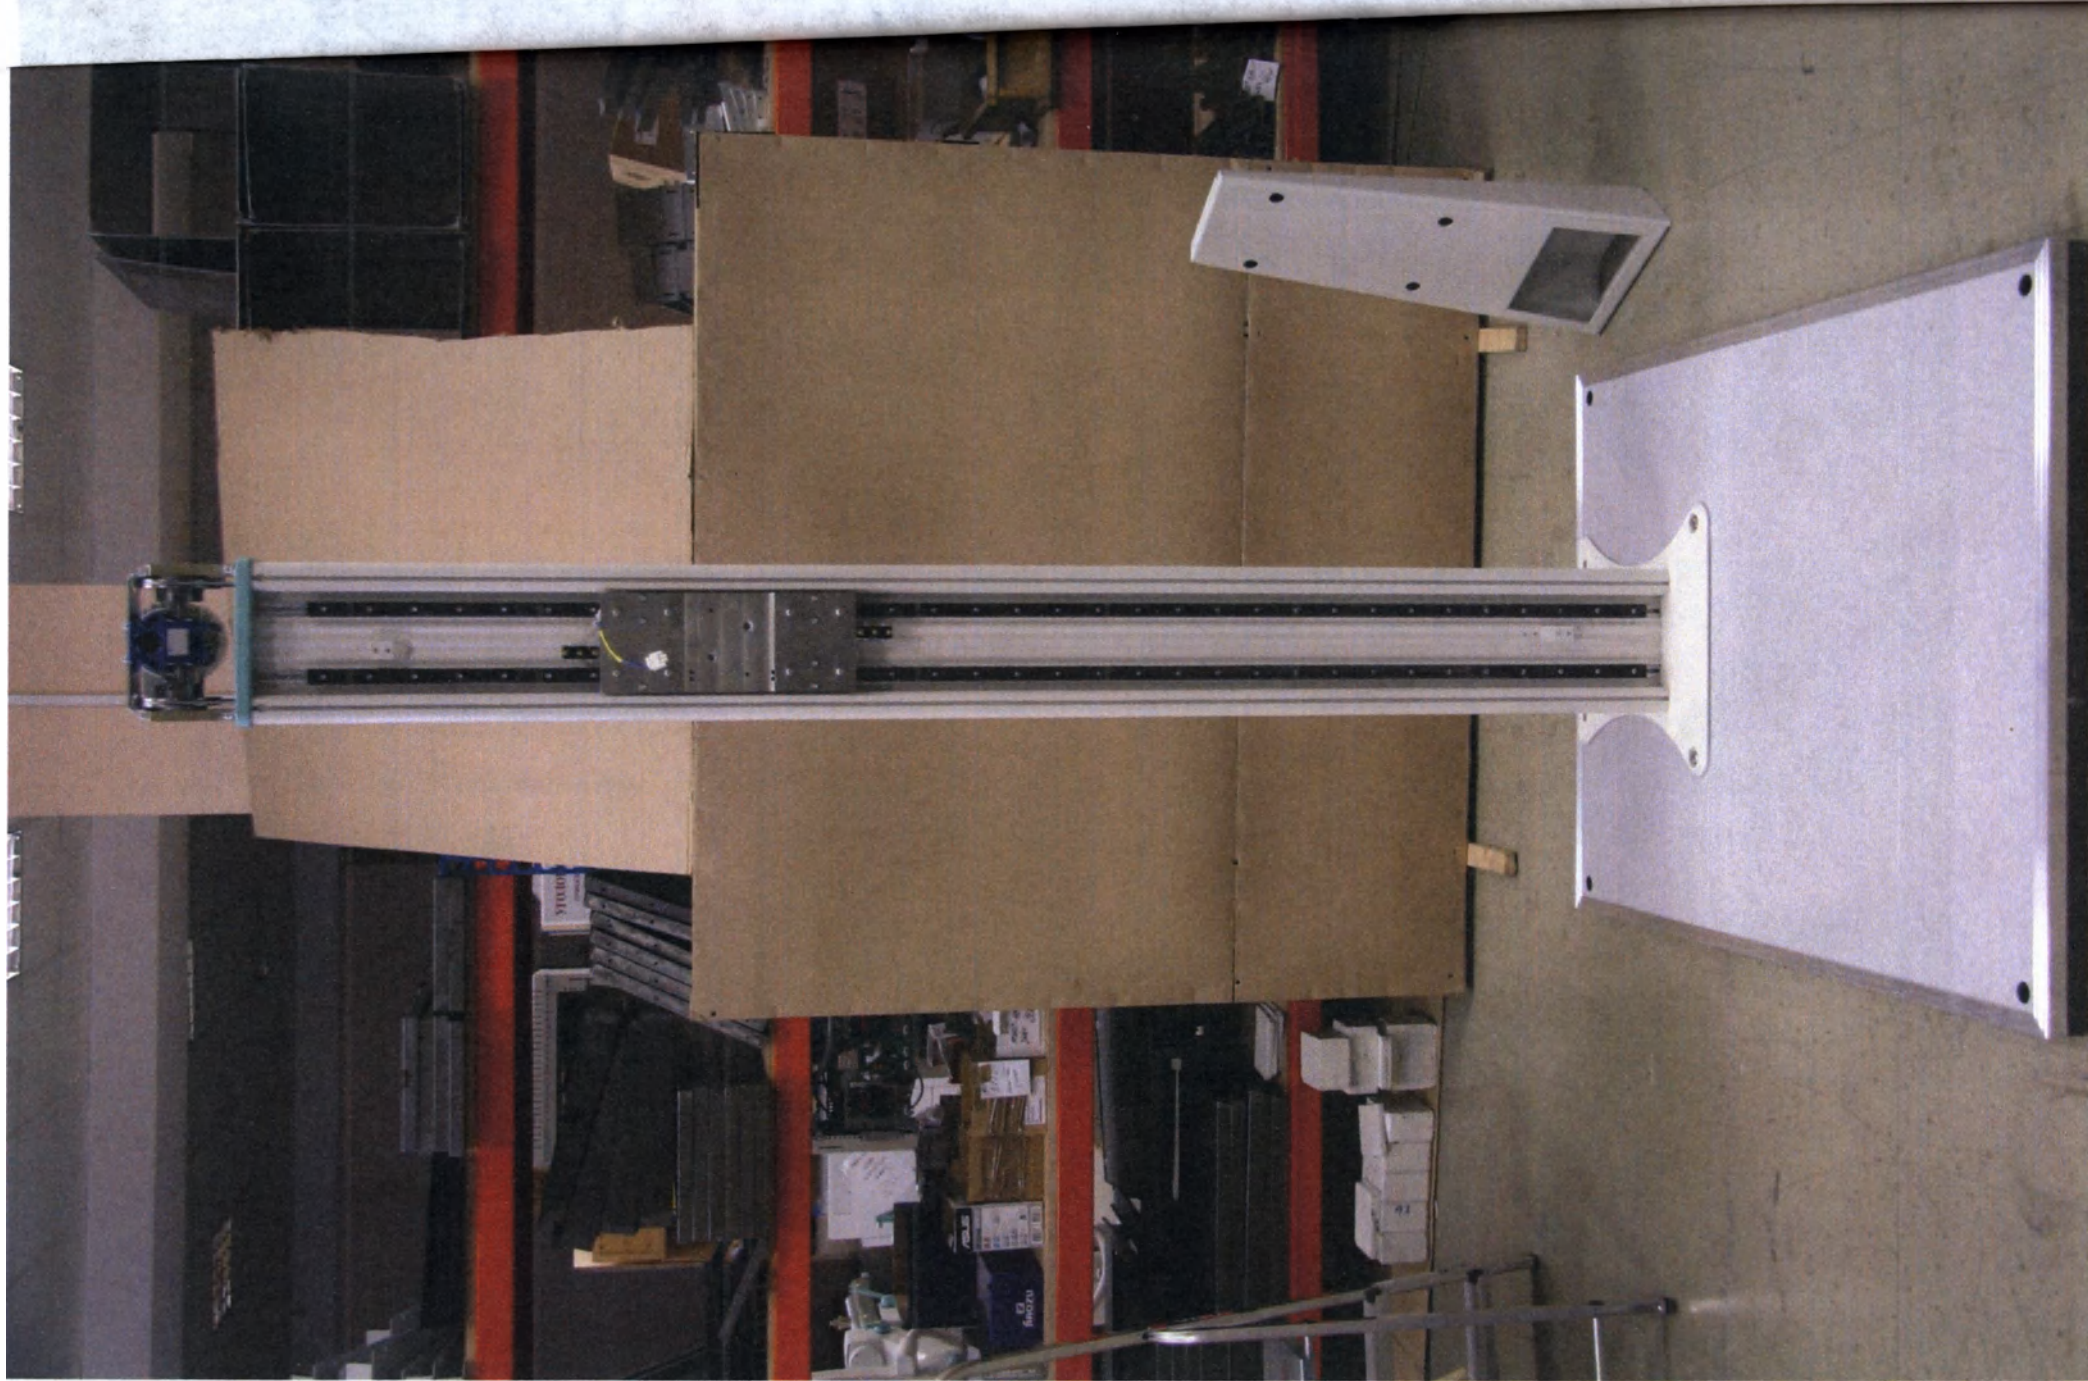








5. Система позиционирования рентгеновская




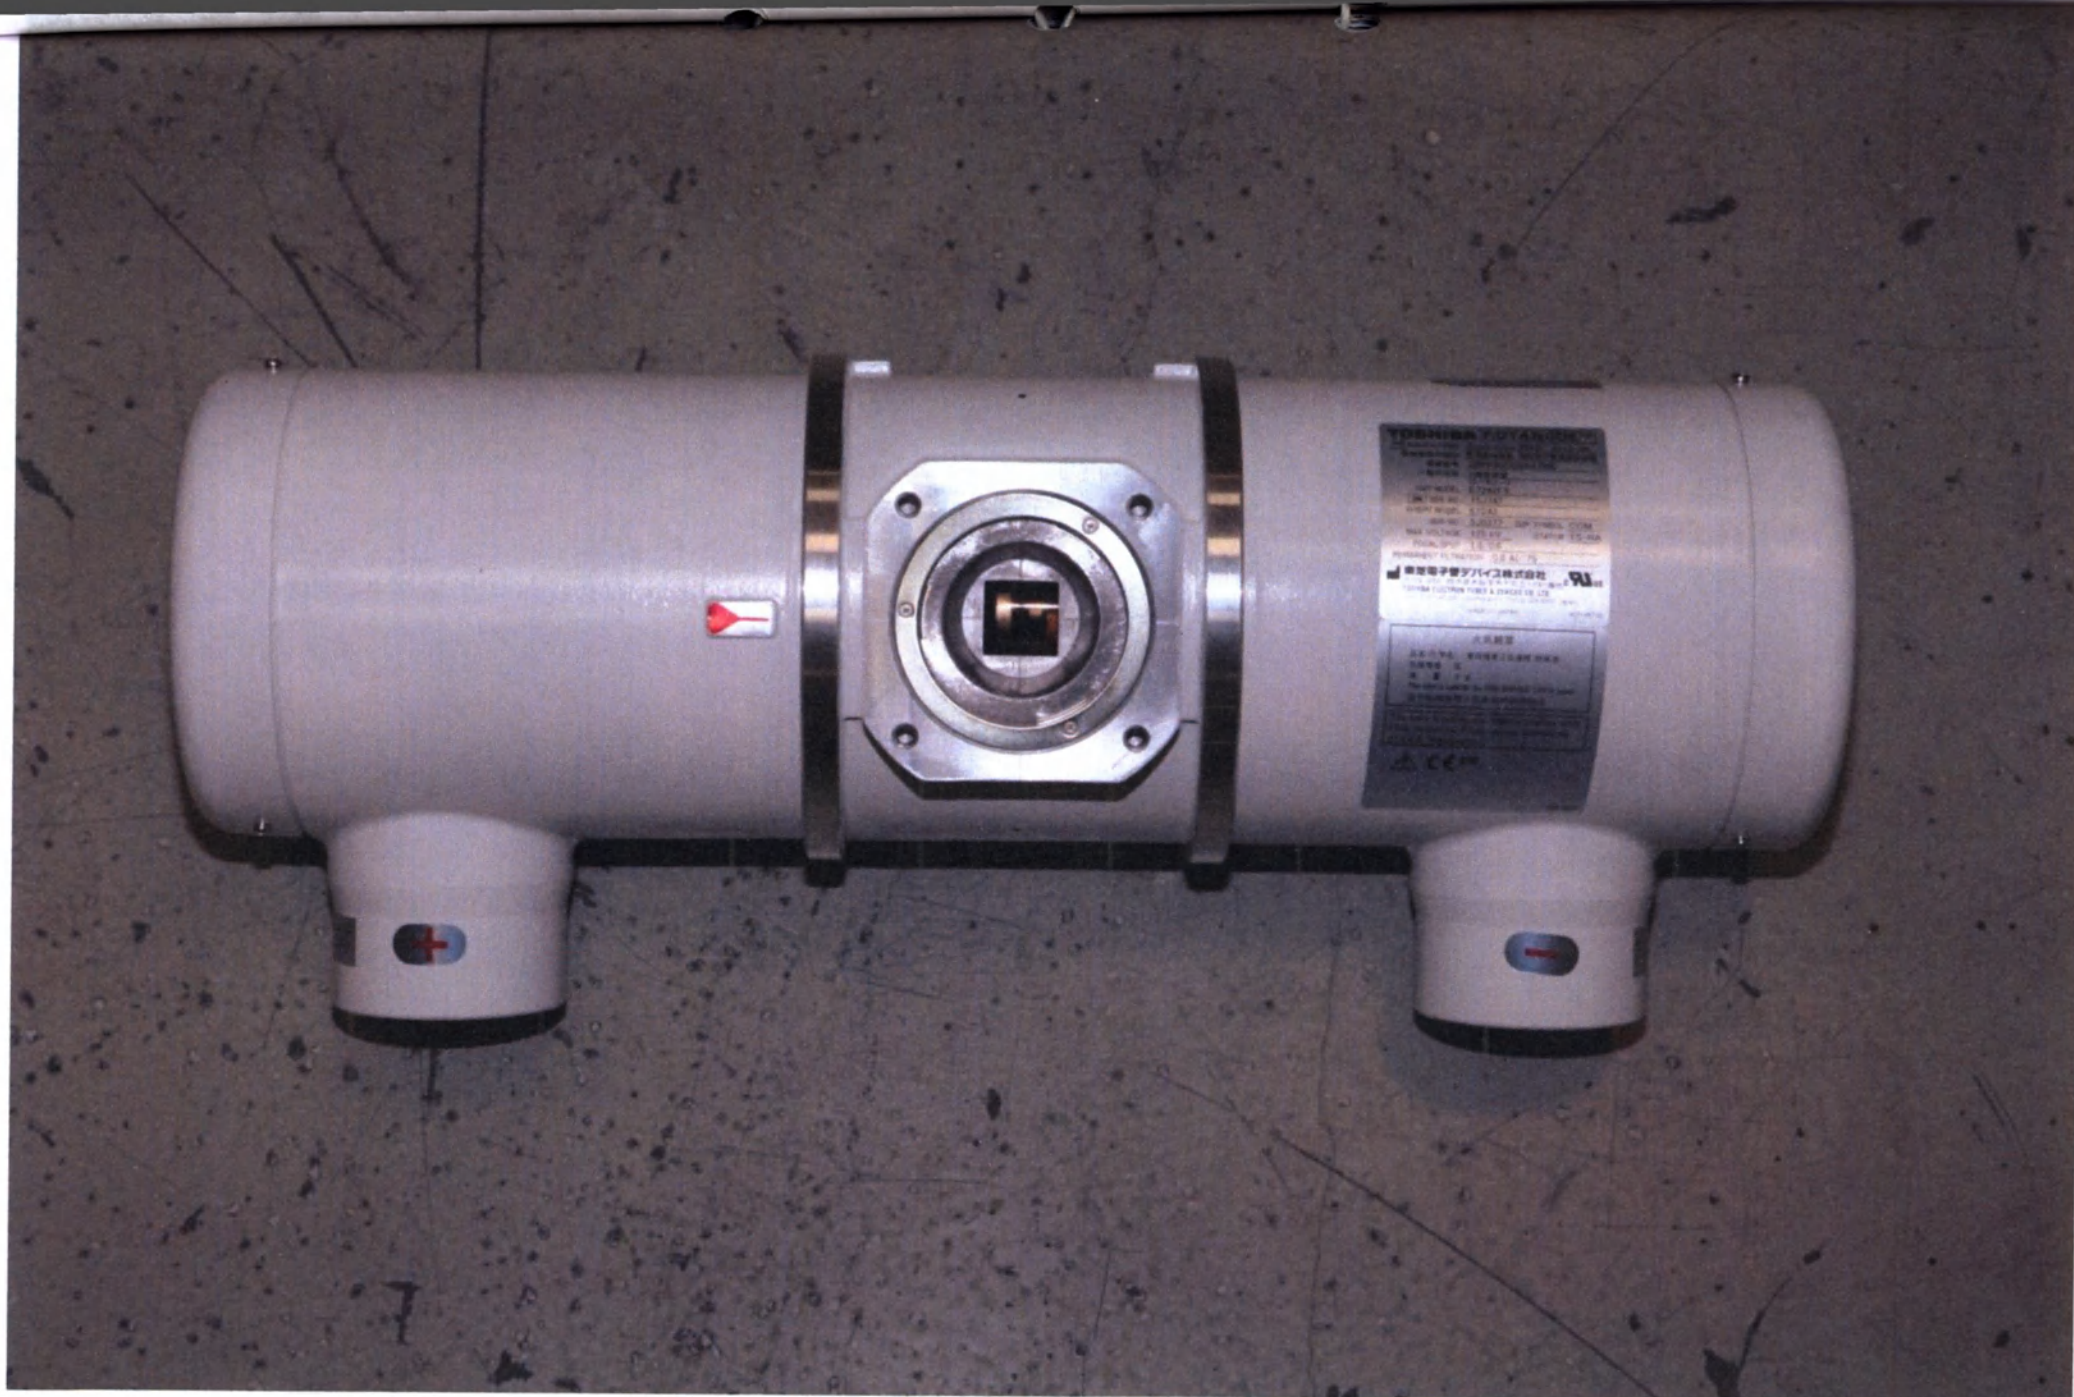

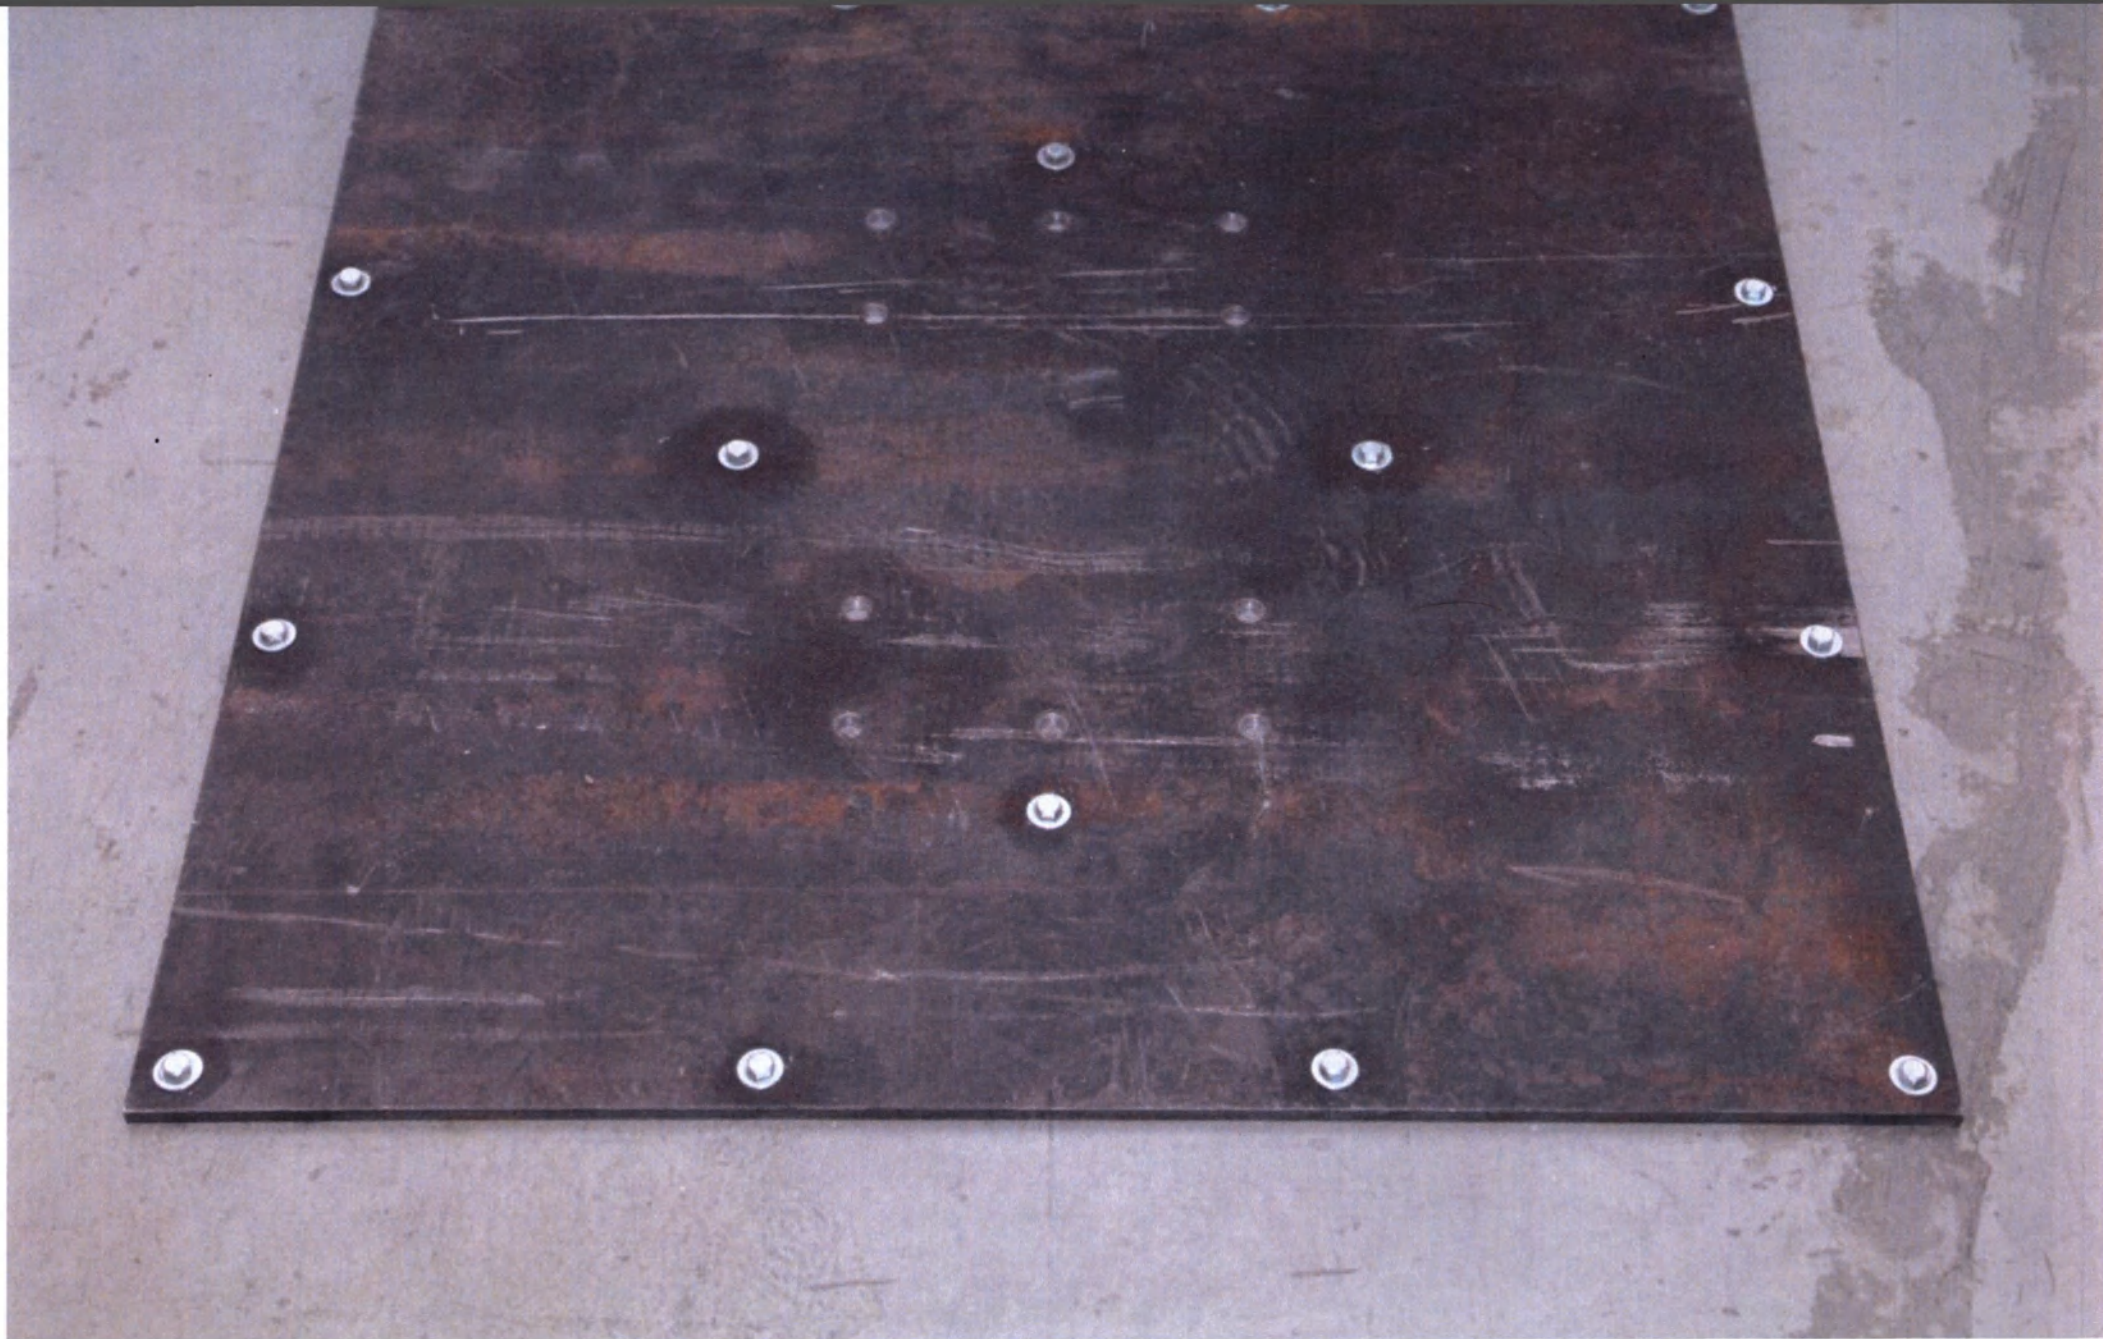

8. Плита

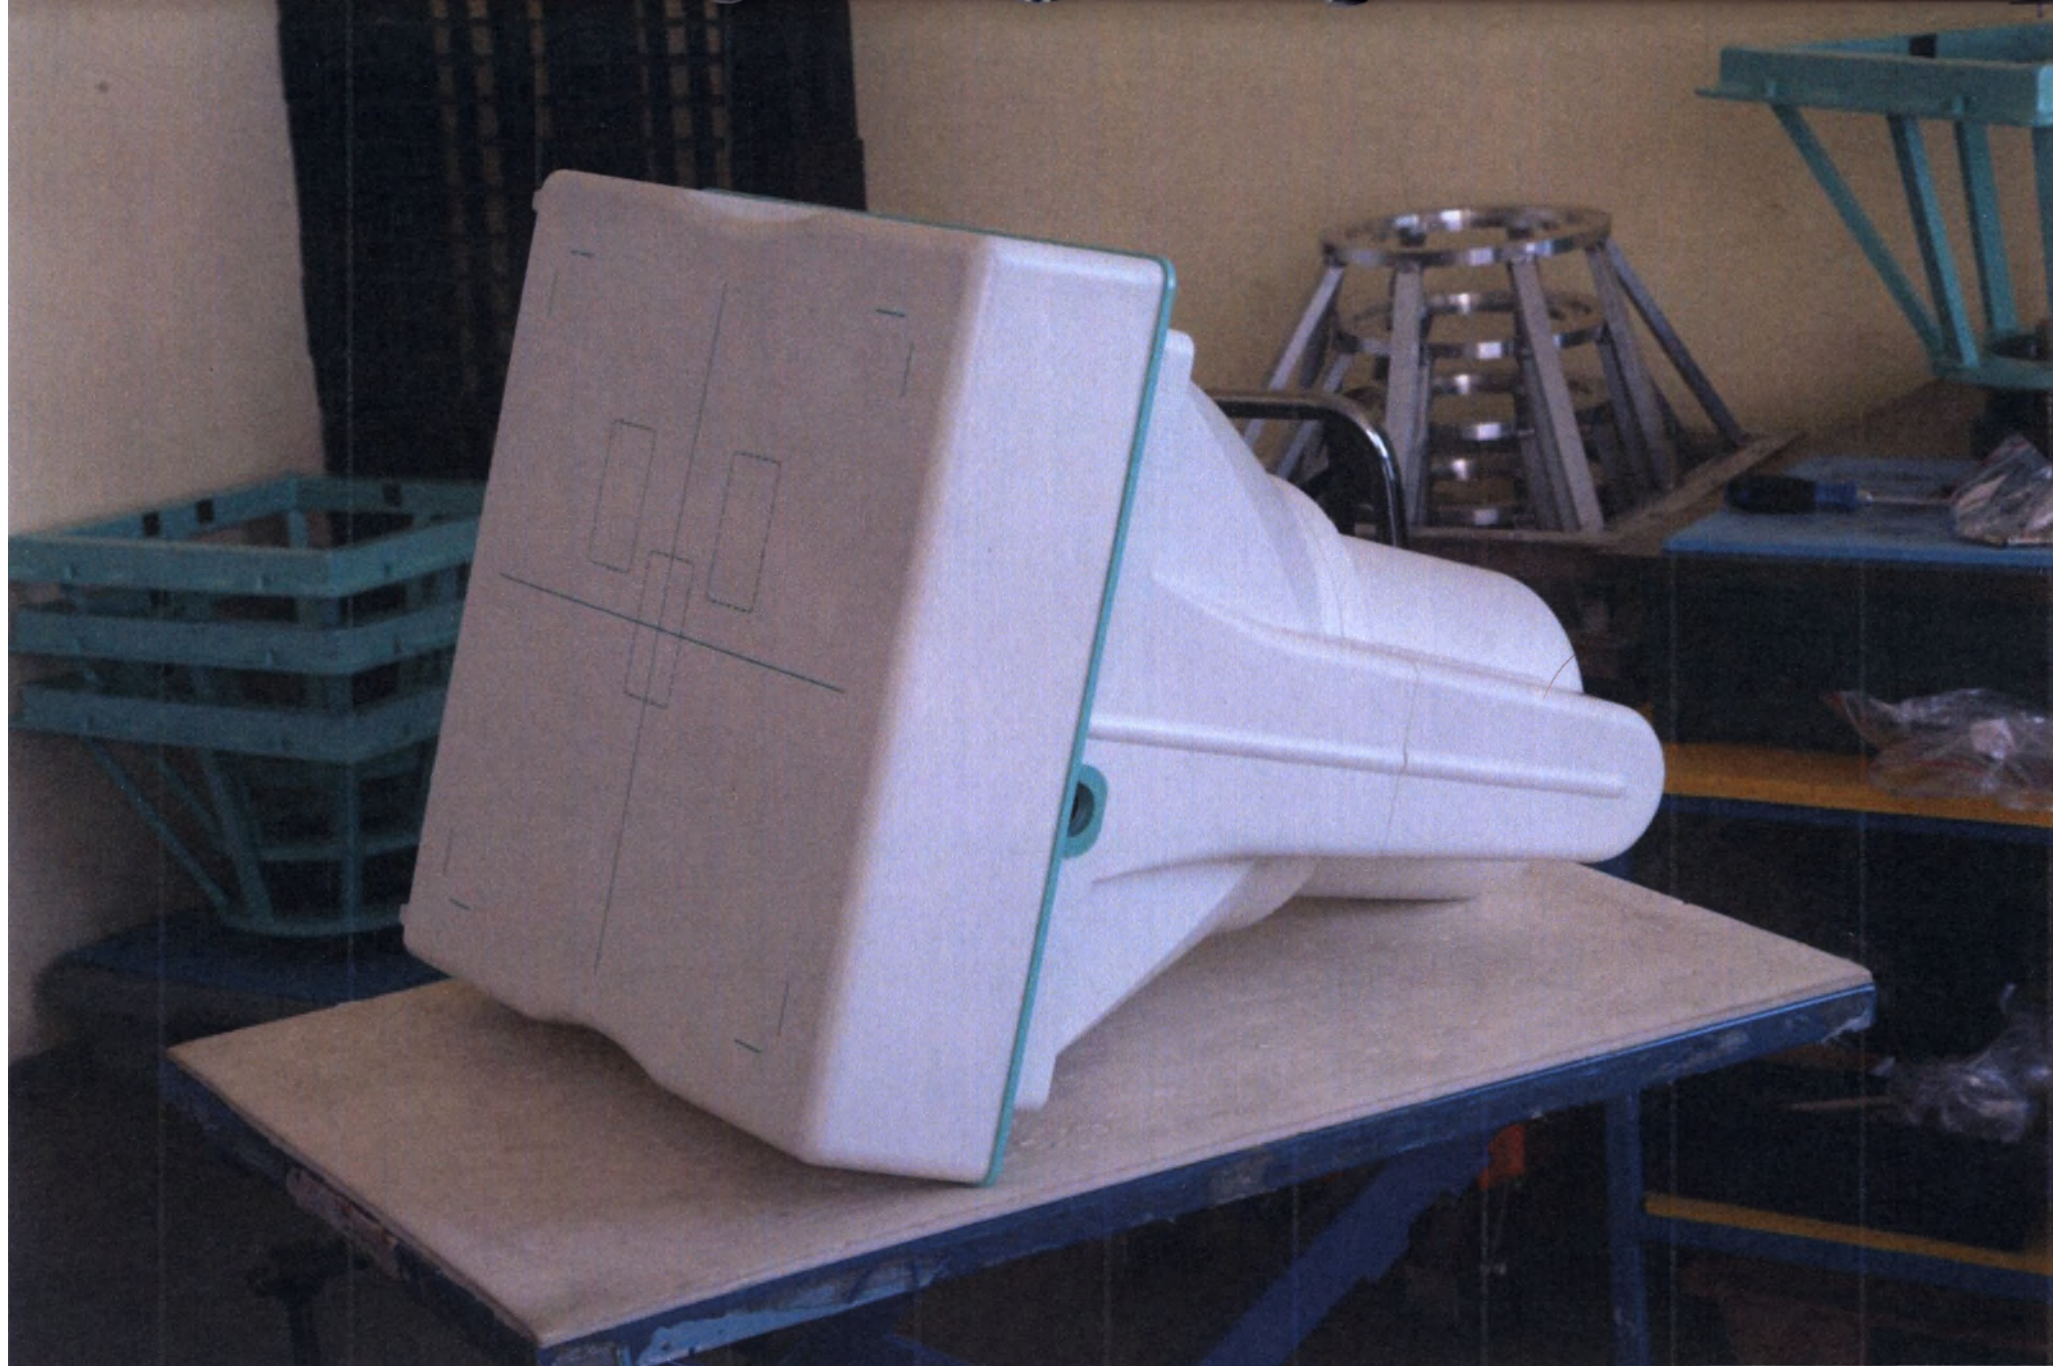


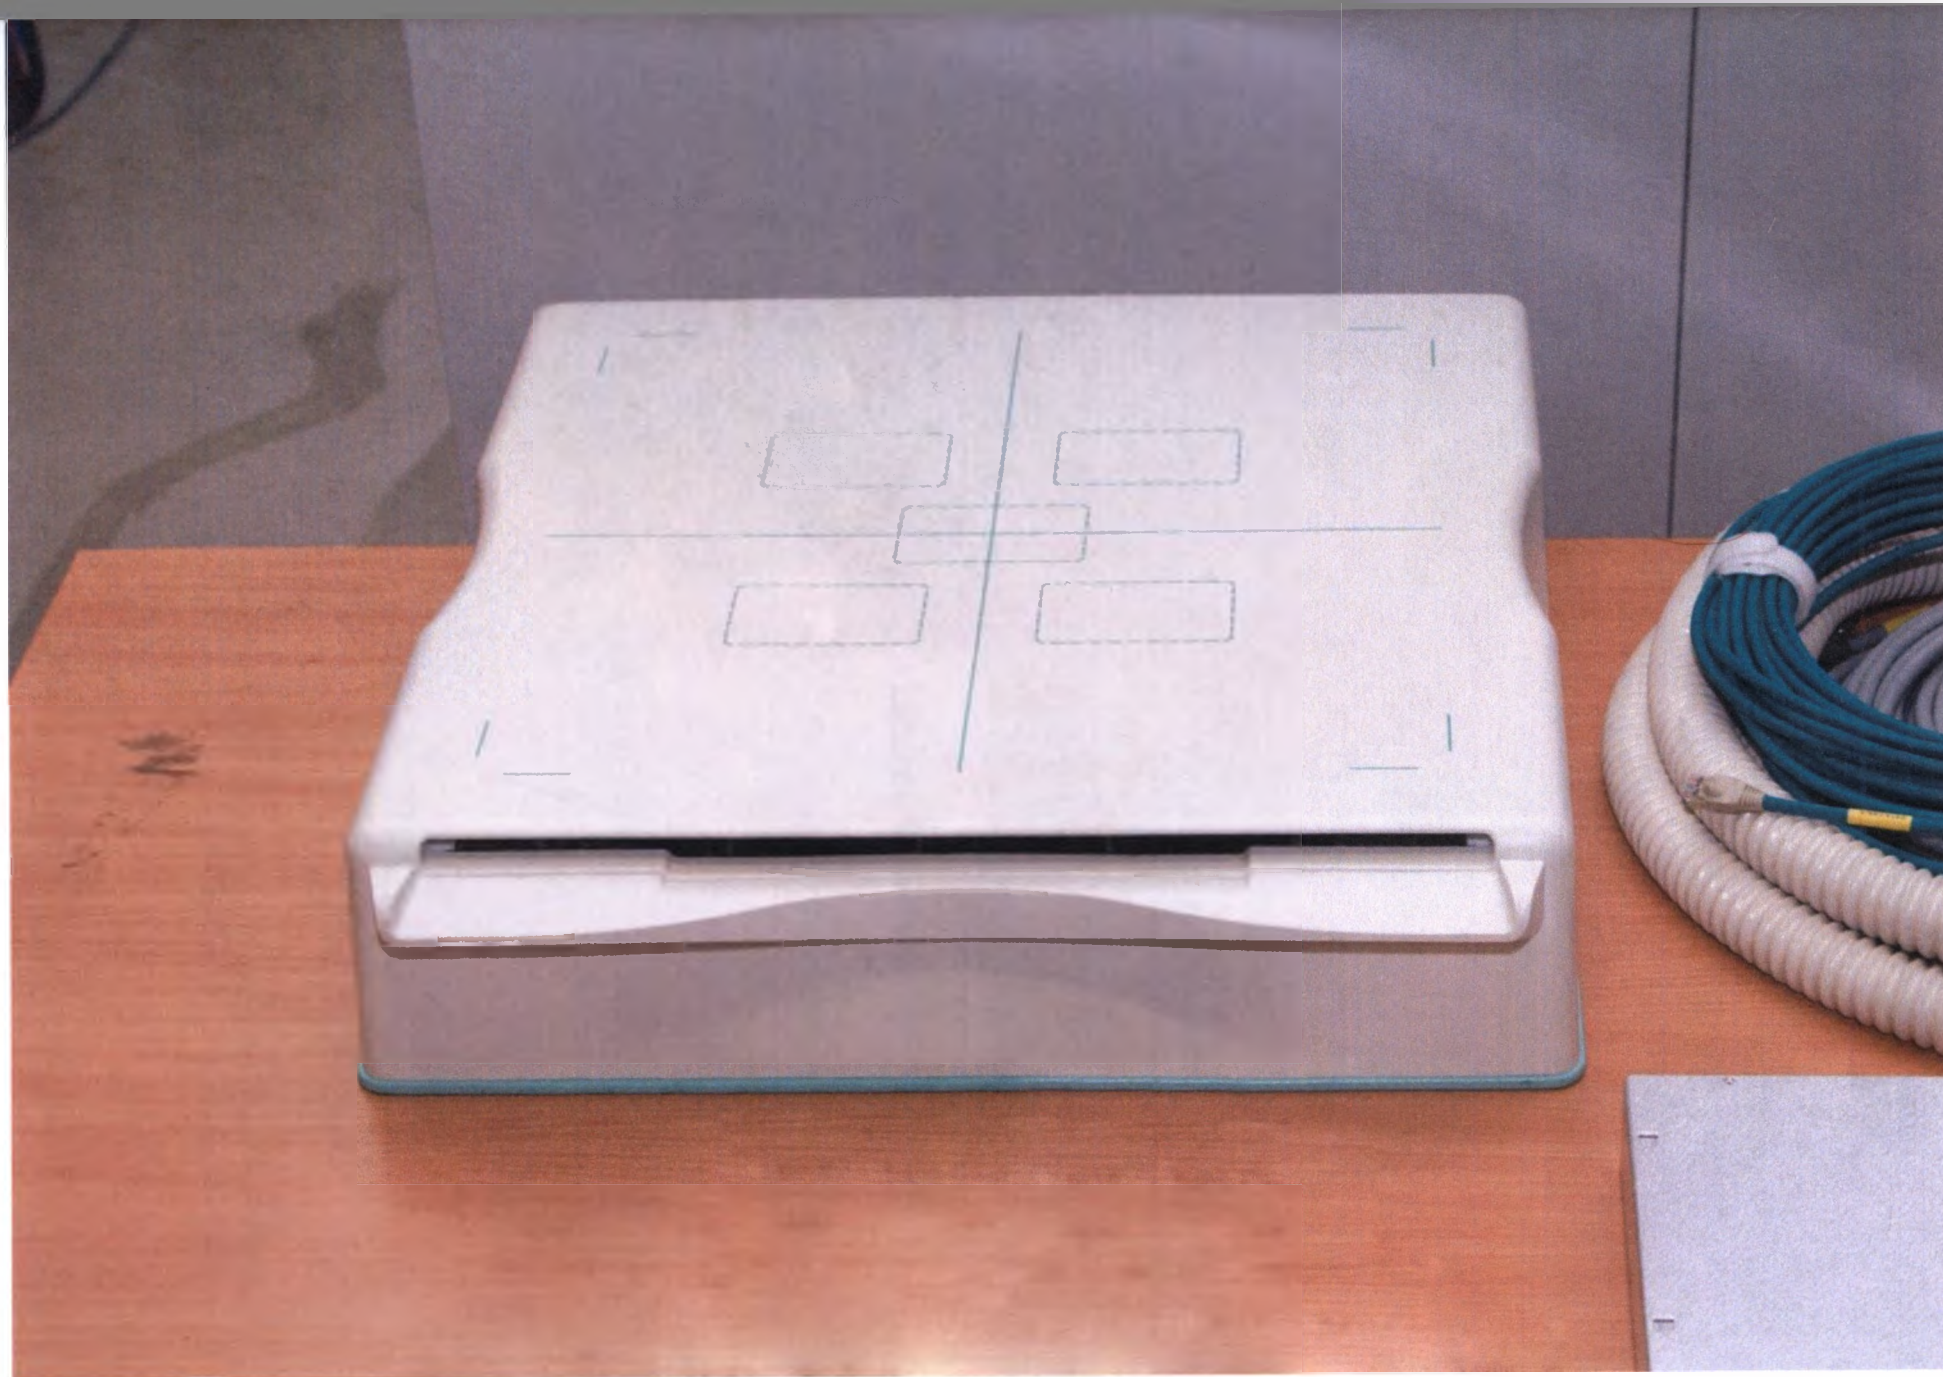

10. Приемник рентгеновский цифровой ДФП

Детектор плоскостельный

Комплект кабелей

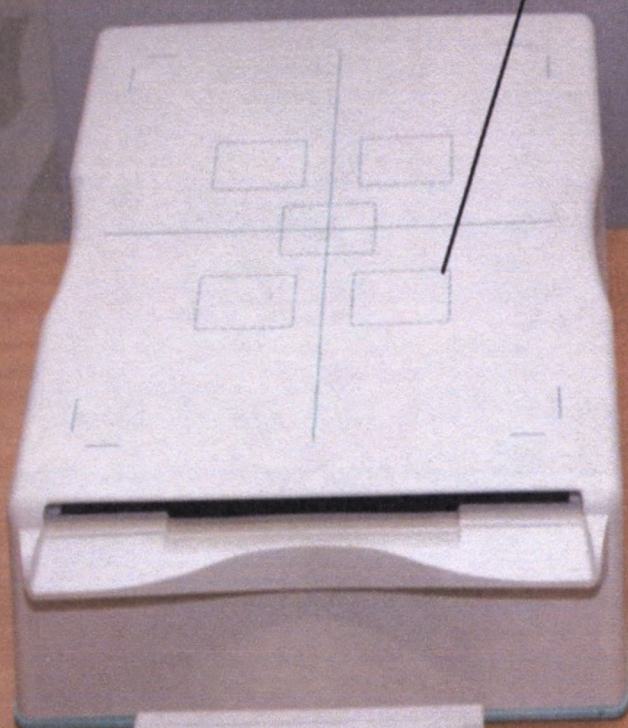


Блок питания

Блок сопряжения



12. РПАК (рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс) - сервер

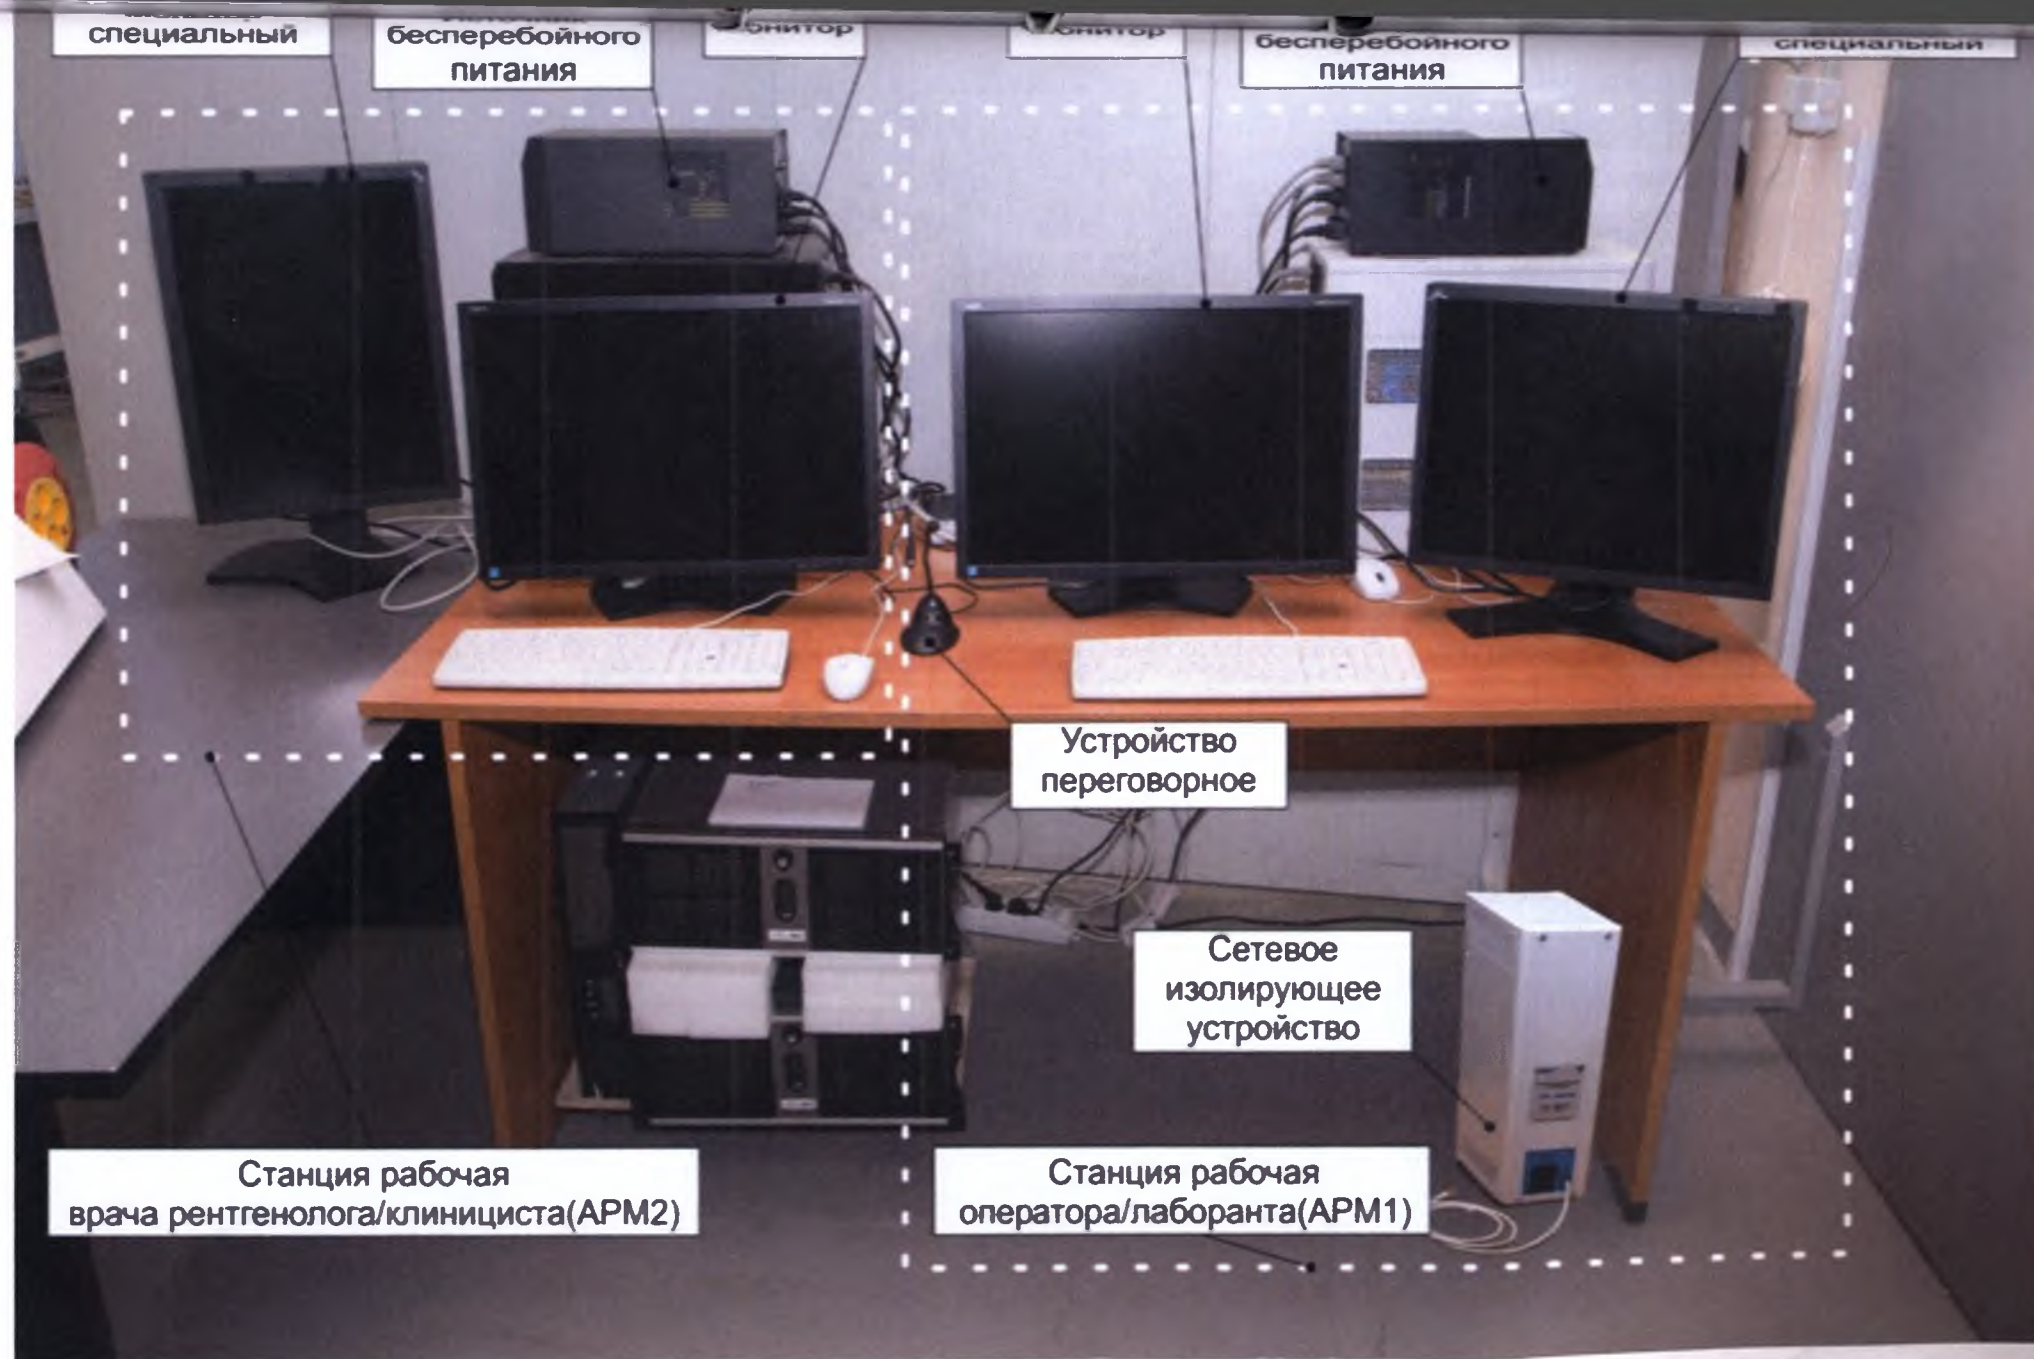

12. РПАК (рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс)- Станция рабочая оператора/лаборанта (АРМ1) Станция рабочая


Монитор

Системный блок


Клавиатура


Манипулятор
«Мышь»

По требованию заказчика поставляется с
ИБП, идентичным применяемым в АРМ1
оператора

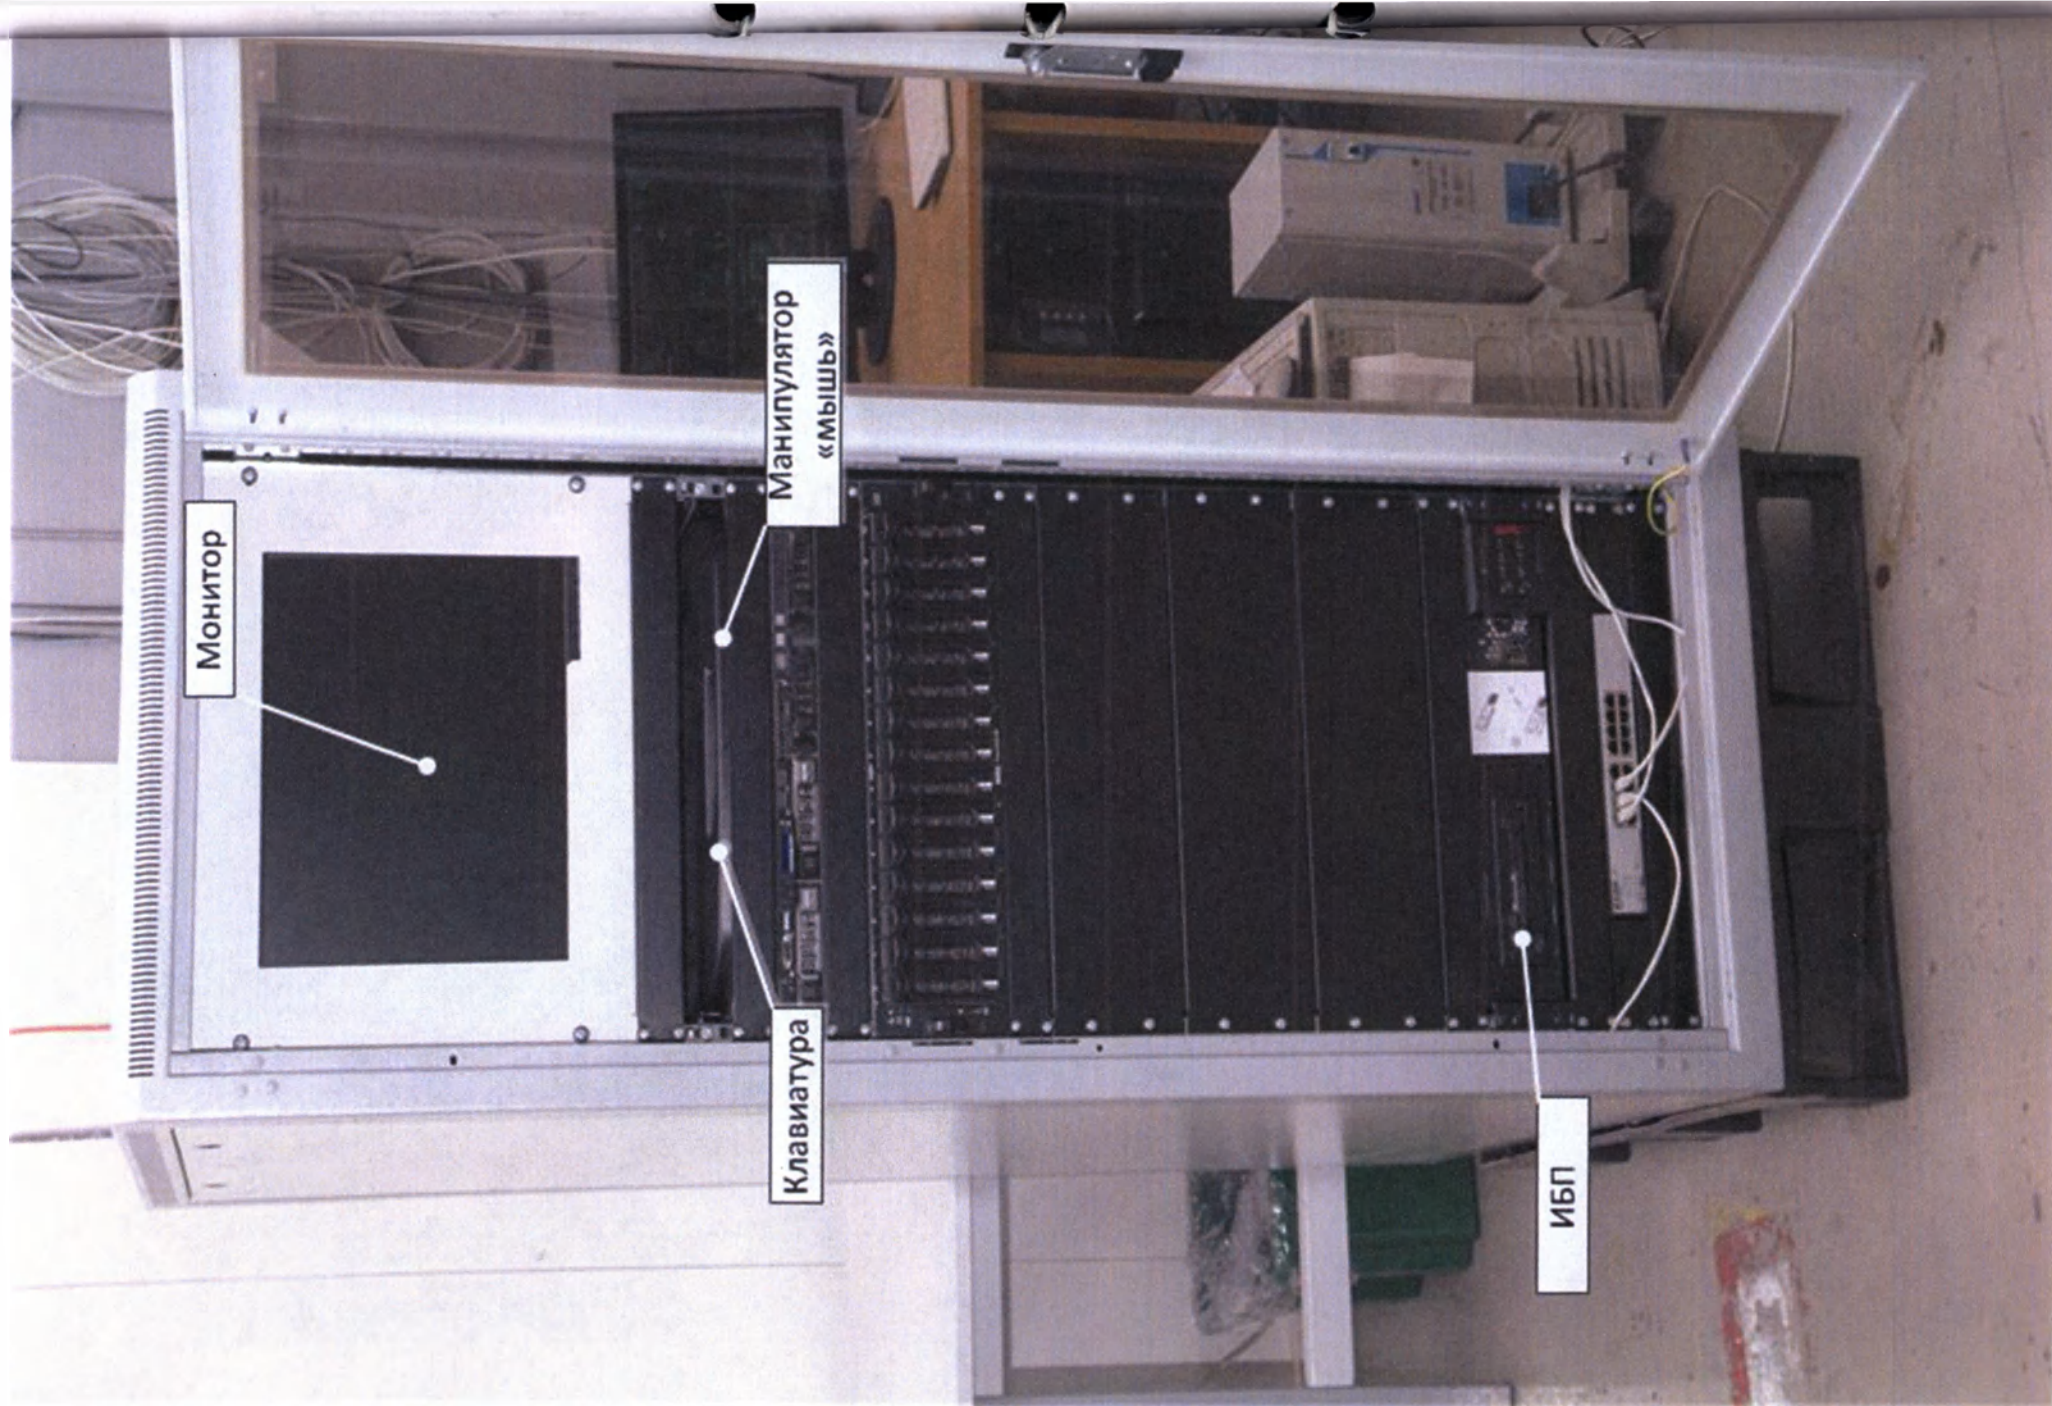




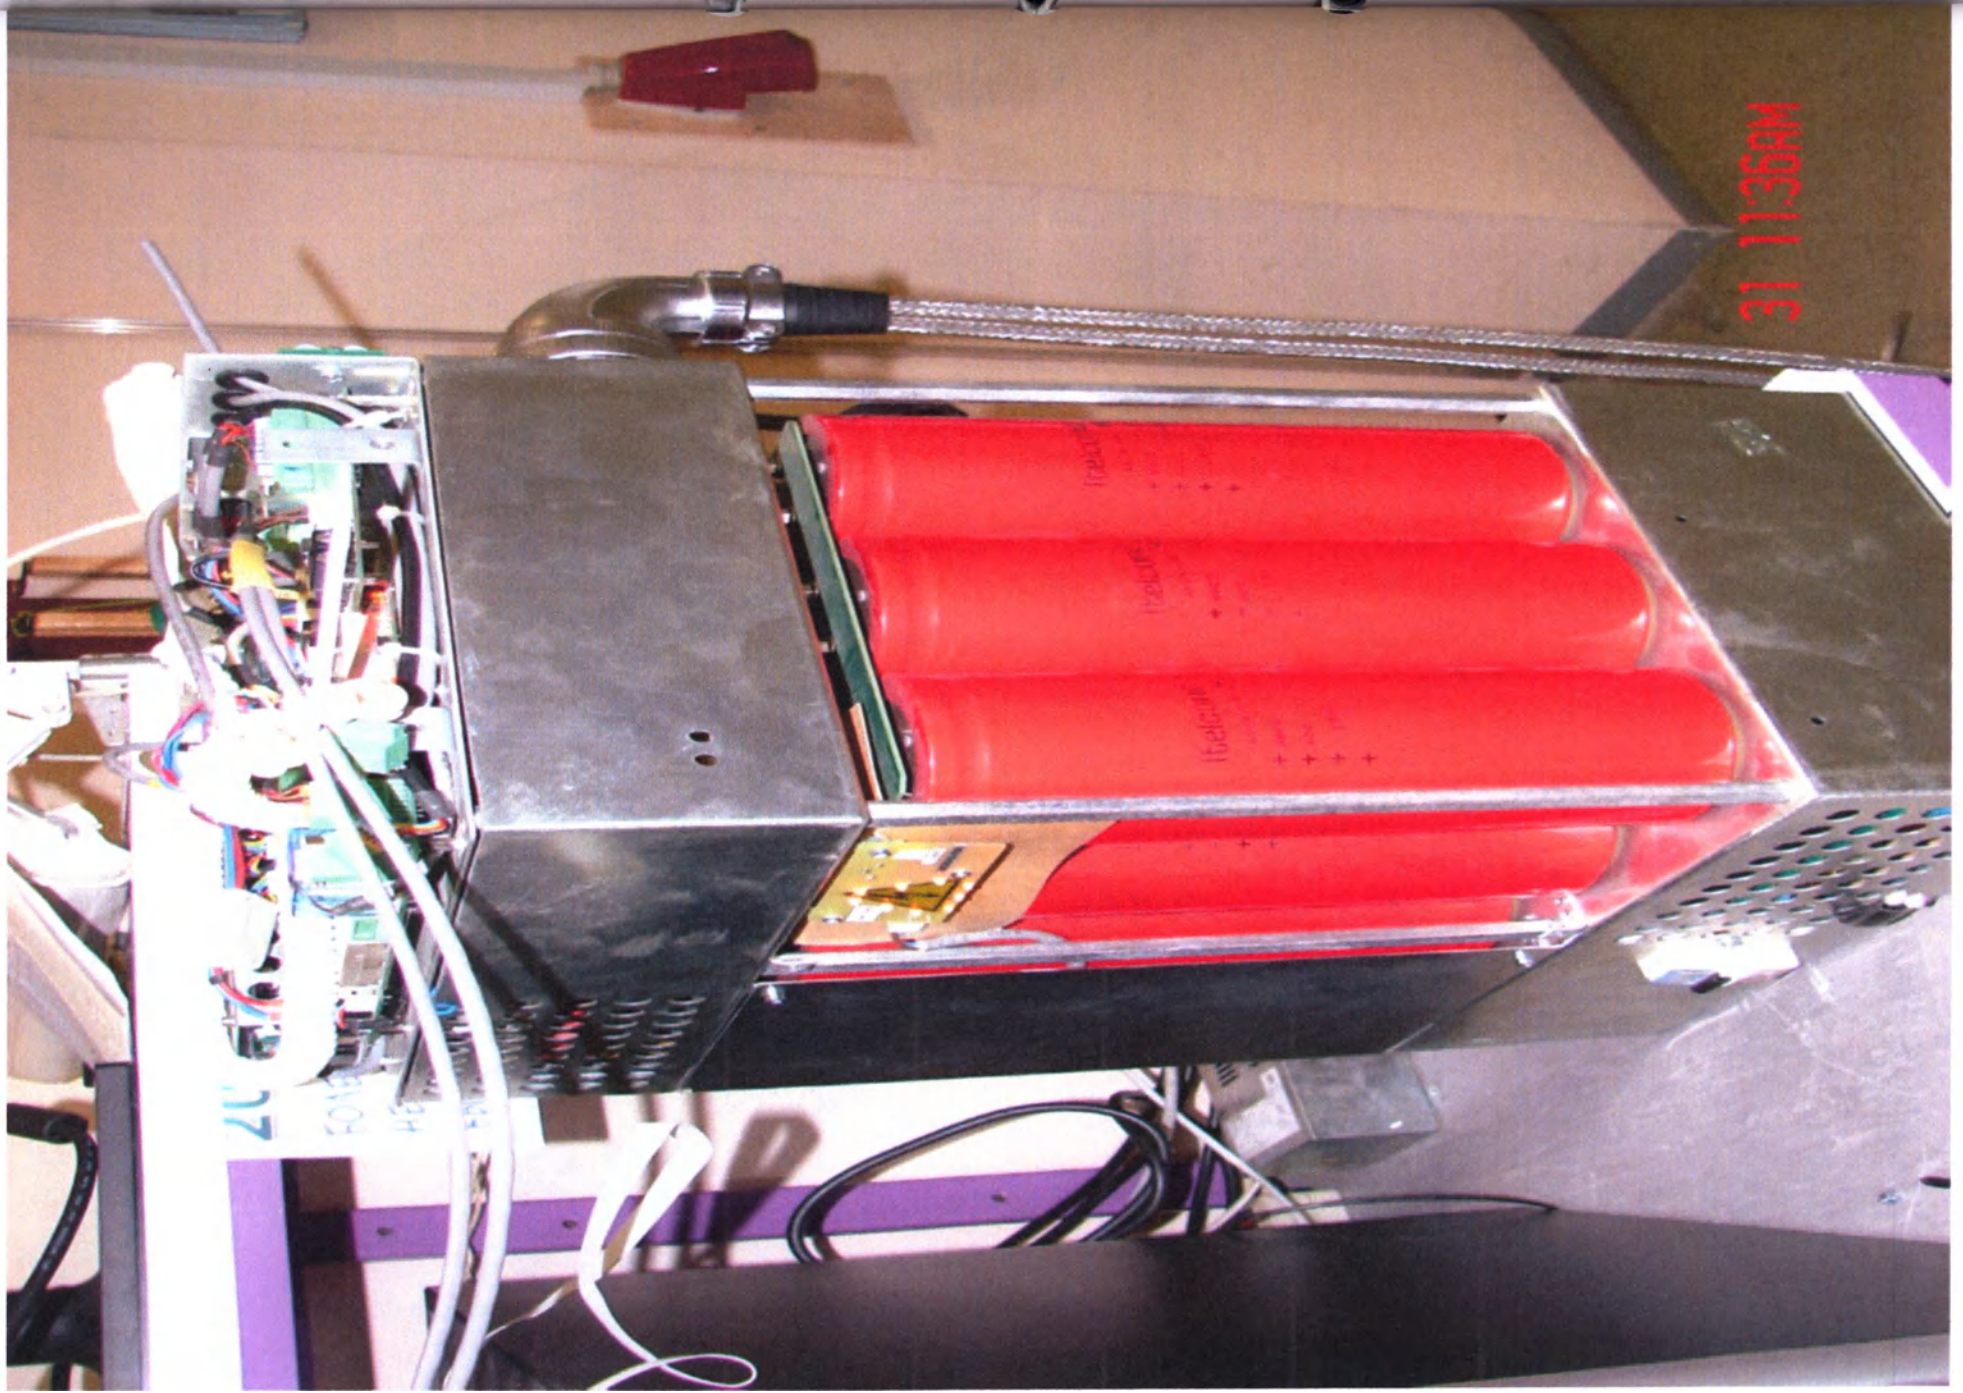

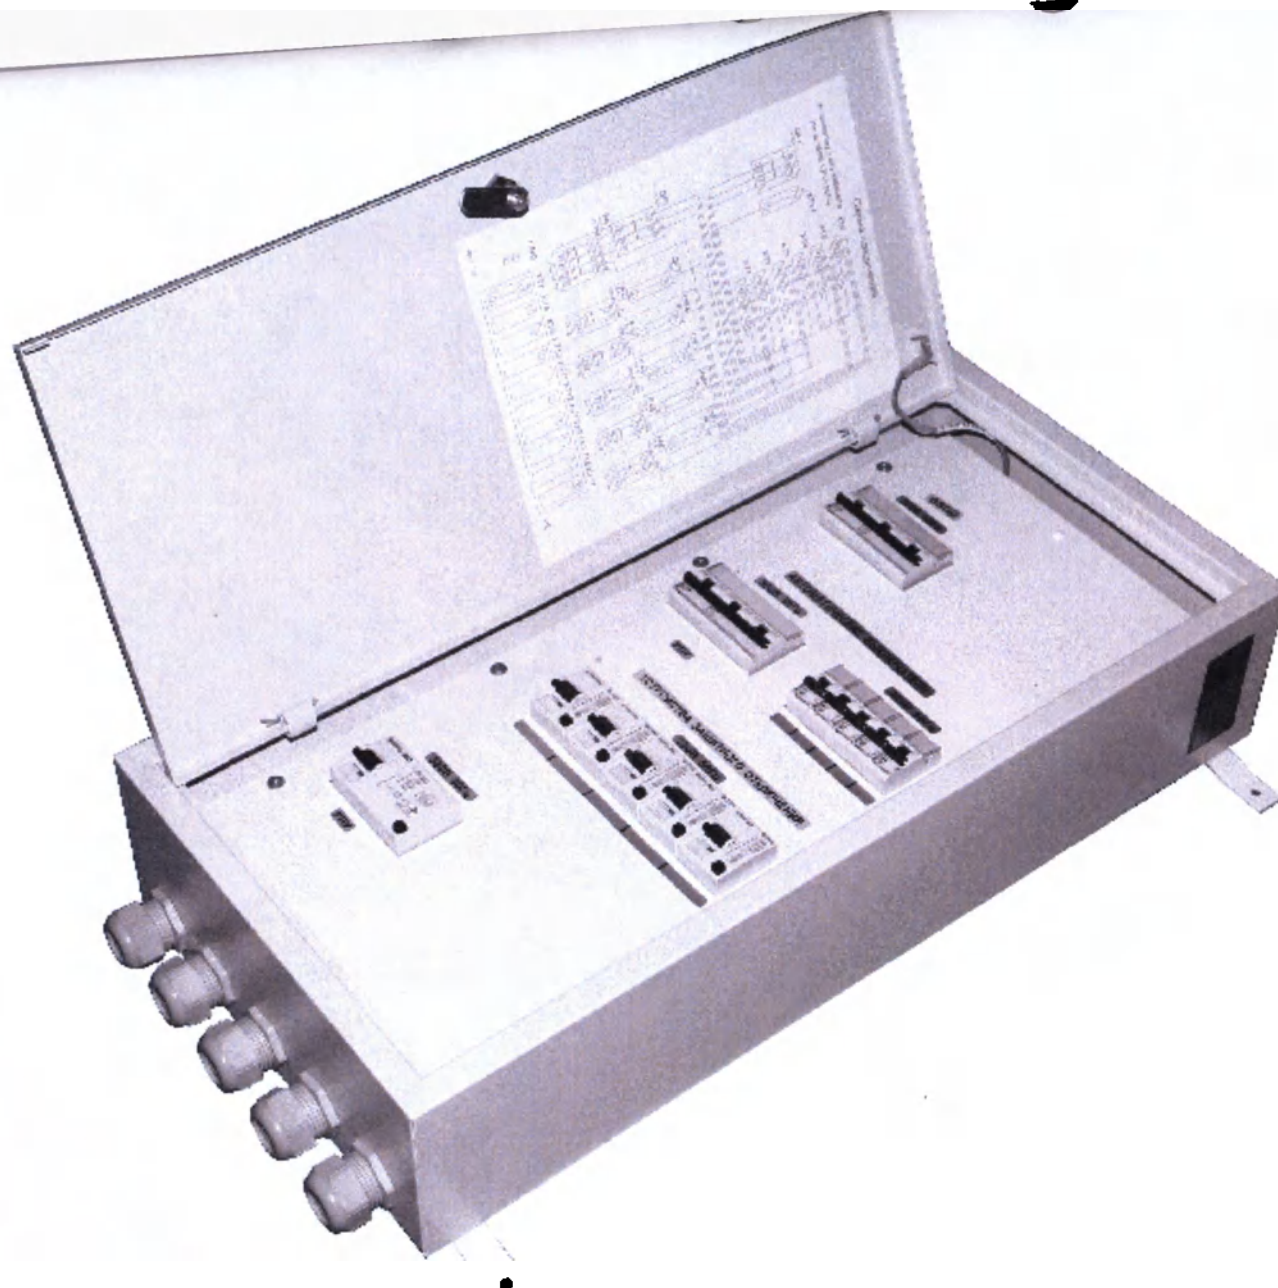

Шкаф питания и защиты

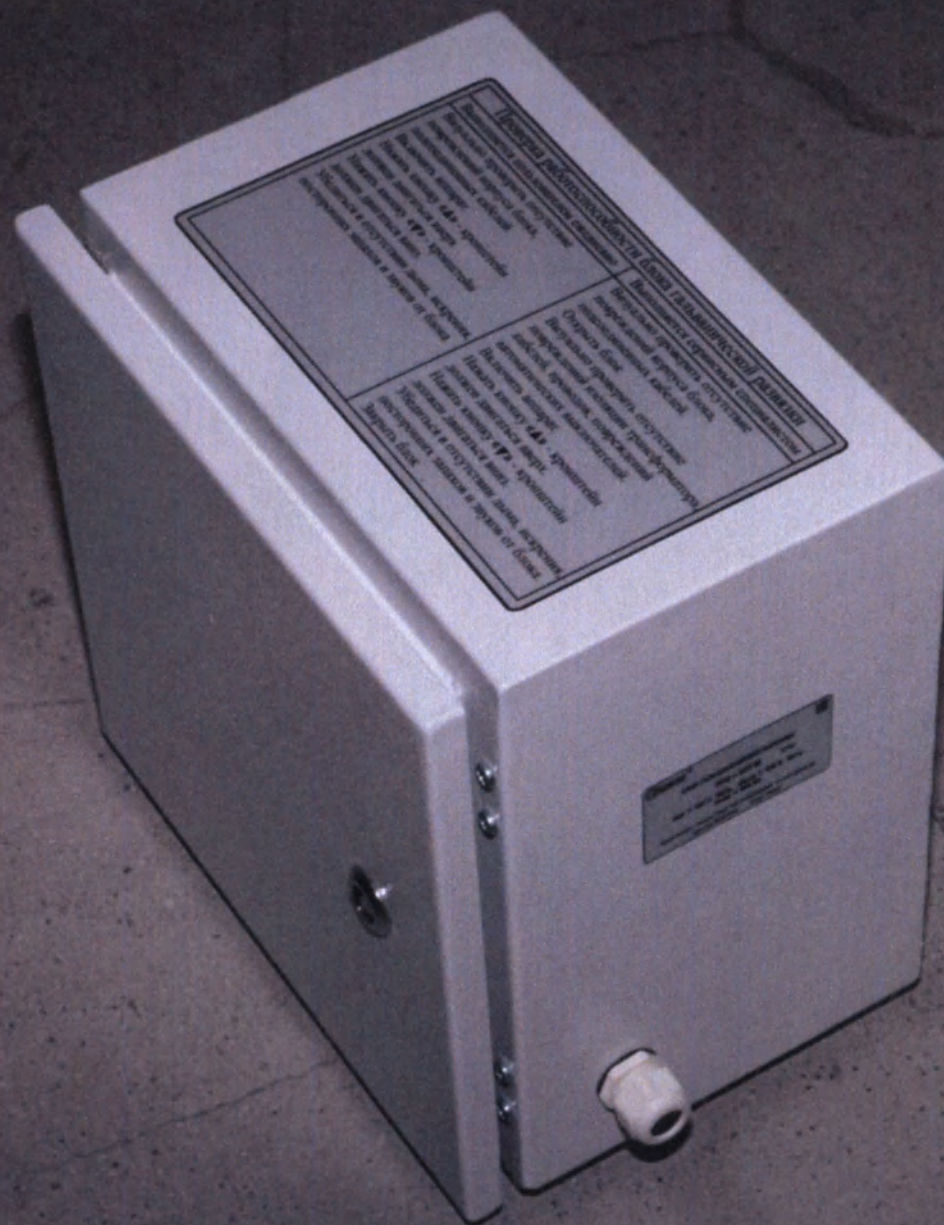



19. Дополнительное оборудование: 19.1. Окно рентгенозащитное серии MACO

Монитор

Стол

Системный блок

Клавиатура

Манипулятор
«Мышь»

По требованию заказчика поставляется с
ИБП, идентичным применяемым в АРМ1
оператора







19.2. Комплект мебели: тумба




19.3. Комплект индивидуальных средств защиты от рентгеновского излучения: жилет







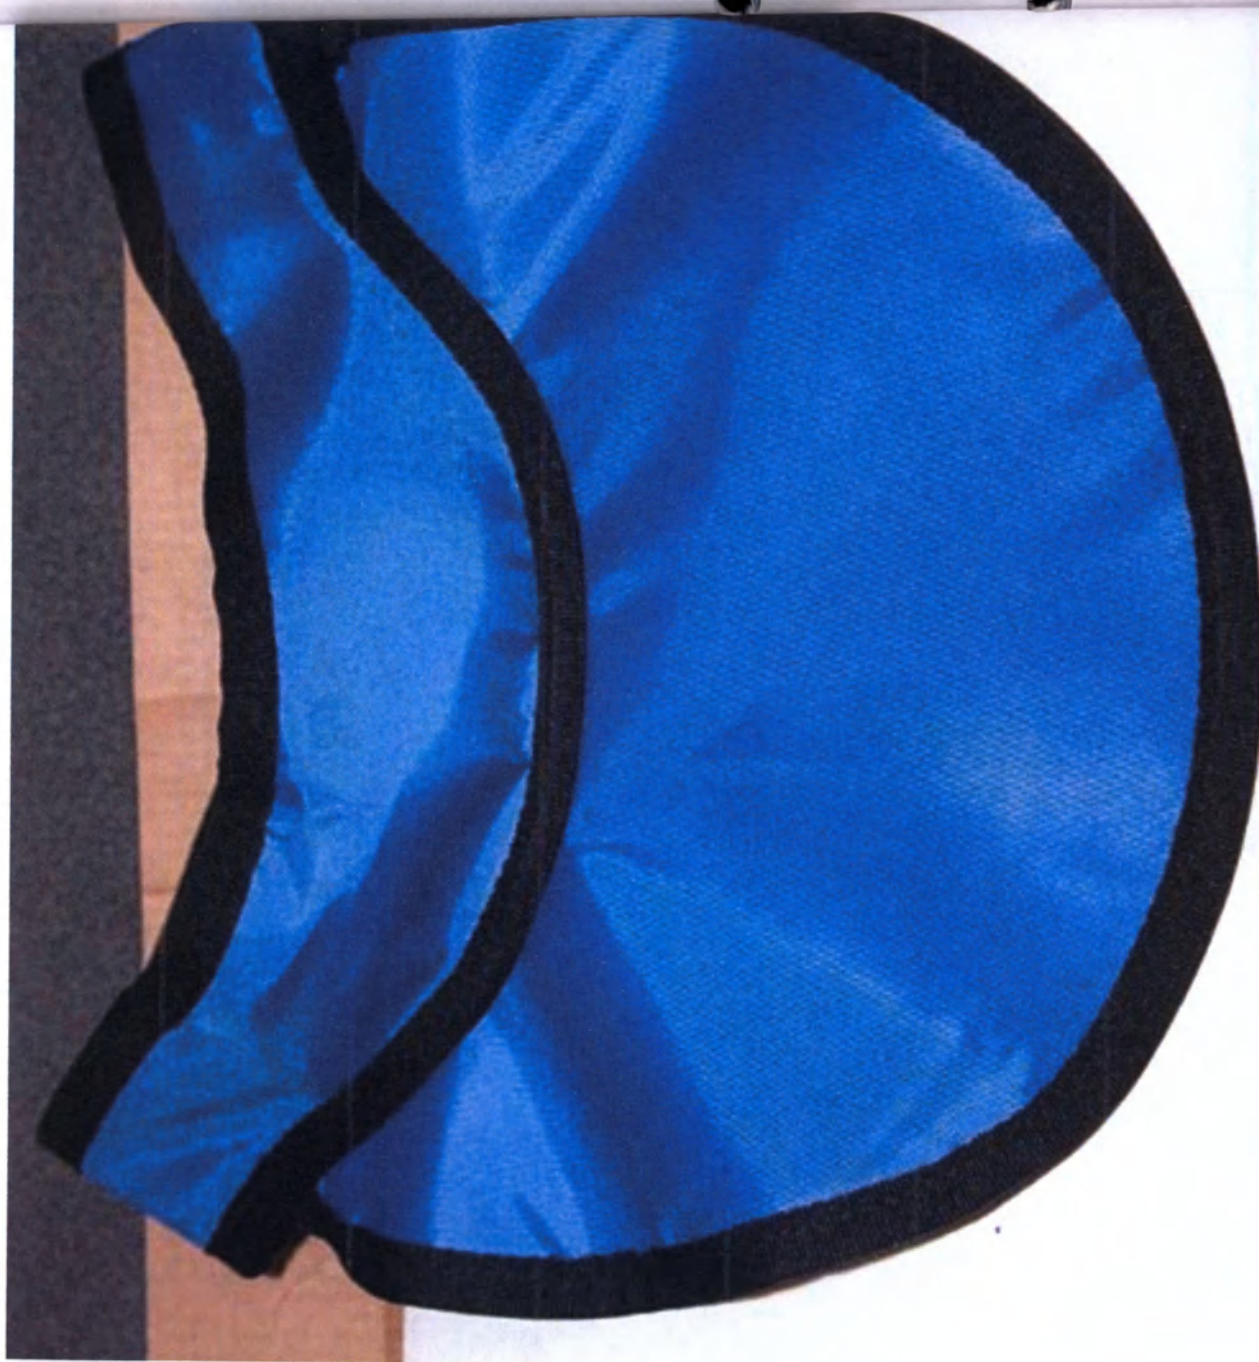

Комплект индивидуальных поливинилхлоридных
средств защиты пациентов и медицин
персонала от рентгеновского излу

КИСЗ-"РЕНЕКС"

Изготовлено в России

МЭК 61331-3:1998, ГОСТ Р 51
ТУ 9398-010-21009821-2004

Условия хранения:

Условия хранения по группе 1(1) ГОСТ 15150-69

Гарантийный срок хранения до ввода в эксплуатацию - 6 месяцев с даты выпуска и
ЗАО "РЕНЕКС", 630063, Россия, г. Новосибирск, ул. Дзержинская, 2159,
тел. (383) 262-25-06, факс (383) 262-60-29, e-mail: office@renek.ru, www.renek.ru

Универсальный защитный экран
РЕНЕКС ПР-0.5, РБ 0.5/100



Комплект индивидуальных поливинилхлоридных щитов
средств защиты пациентов и медицинского
персонала от рентгеновского излучения



КИСЗ-"РЕНЕКС"

Изготовлено в России

МЭК №1331-3 1998 ГОСТ Р 51534-99
ТУ 9398-010-21009821-2004

Условия хранения:

Условия хранения по группе 1 (по ГОСТ 15150-98)

Гарантийный срок хранения до момента эксплуатации - 5 месяцев с даты выпуска изделия
ЗАО "РЕНЕКС", 630063, Россия - Новосибирск, ул. Декабристов, 289
тел. (383) 262-25-06, факс (383) 262-50-29, e-mail: office@reneks.ru, kilmat@www.reneks.ru

Дата



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

34

лист(с

Будущая сетка

Генеральный директор
ЗАО «НИПК «Электрон»

А.М. Элинс

