

Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-«ОКО»
по ТУ 9442-024-1150760-2008**

Аппараты рентгенографические цифровые АРЦ. Исполнение 2 АРЦ-«ОКО», GP0005427



Фотография 1 – Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-ОКО, GP0005427 в комплектации Стол со штативом снимков ТОМОС в исполнении ТОМОС-ДЕ и Стойка снимков СС в исполнении СС-ДП, кронштейн в сборе с излучателем рентгеновским серии ИРД, коллиматор серии CRUX



Фотография 1.1 – Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-ОКО, GR0005427 в комплектации Стол со штативом снимков ТОМОС в исполнении ТОМОС-ДЕ и Стойка снимков СС в исполнении СС-ДП, в комплектации с излучателем рентгеновским серии XRPS и трубкой IAE



Фотография 2 – Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-ОКО. Вариант общего вида в комплектации Штатив поворотный U-DRC в комплектации с кронштейном в сборе с излучателем рентгеновским серии ИРД, коллиматор серии Ralco R, а также Стол-каталка SUR-10

НАИМЕНОВАНИЕ

Аппарат рентгенографический
цифровой АРЦ-"ОКО"

ОБОЗНАЧЕНИЕ

ARC1-00-0000

ТУ

ТУ 9442-024-1150760-2008

Серийный номер МИ

GP0005427

Дата изготовления

2022-08

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"




3N~380 В, 50 Гц, 85 кВА



NP-20-001

Фотография 3 – Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-ОКО. Маркировка

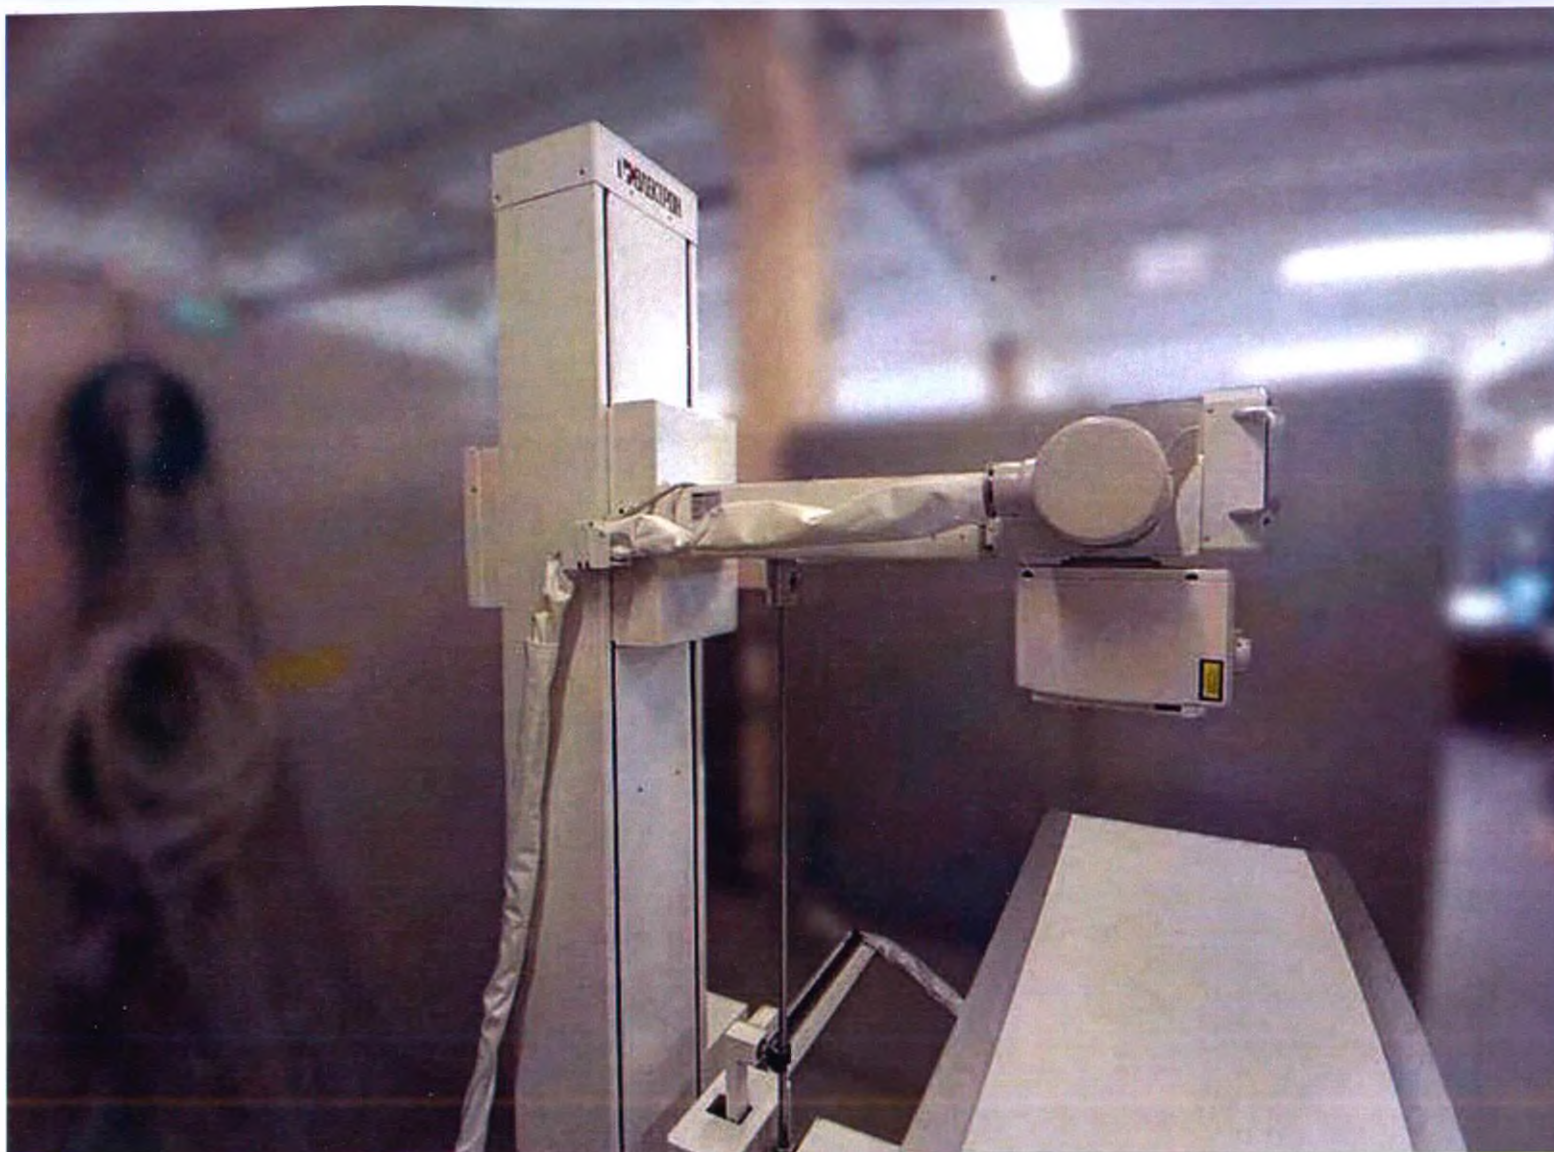

Фотография 4 – Штатив ARC1-00 по спецификации, включающей систему позиционирования рентгеновскую в варианте комплектности со штативом снимков ТОМОС в исполнении ТОМОС-ДЕ

Наименование

Штатив

Серийный номер
Дата изготовления

NN1461274
2022-08

Обозначение

ARC1-00-1400

Серийный номер МИ

GP0005427


Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0002-01



~ 220 В, 50 Гц, 1000 ВА

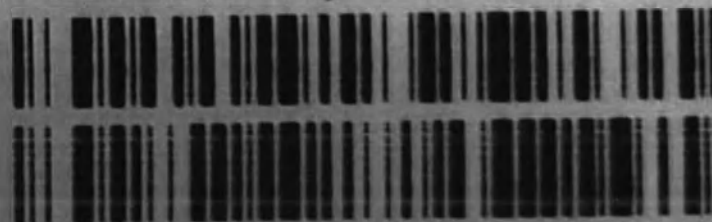

Фотография 5 – Штатив. Маркировка

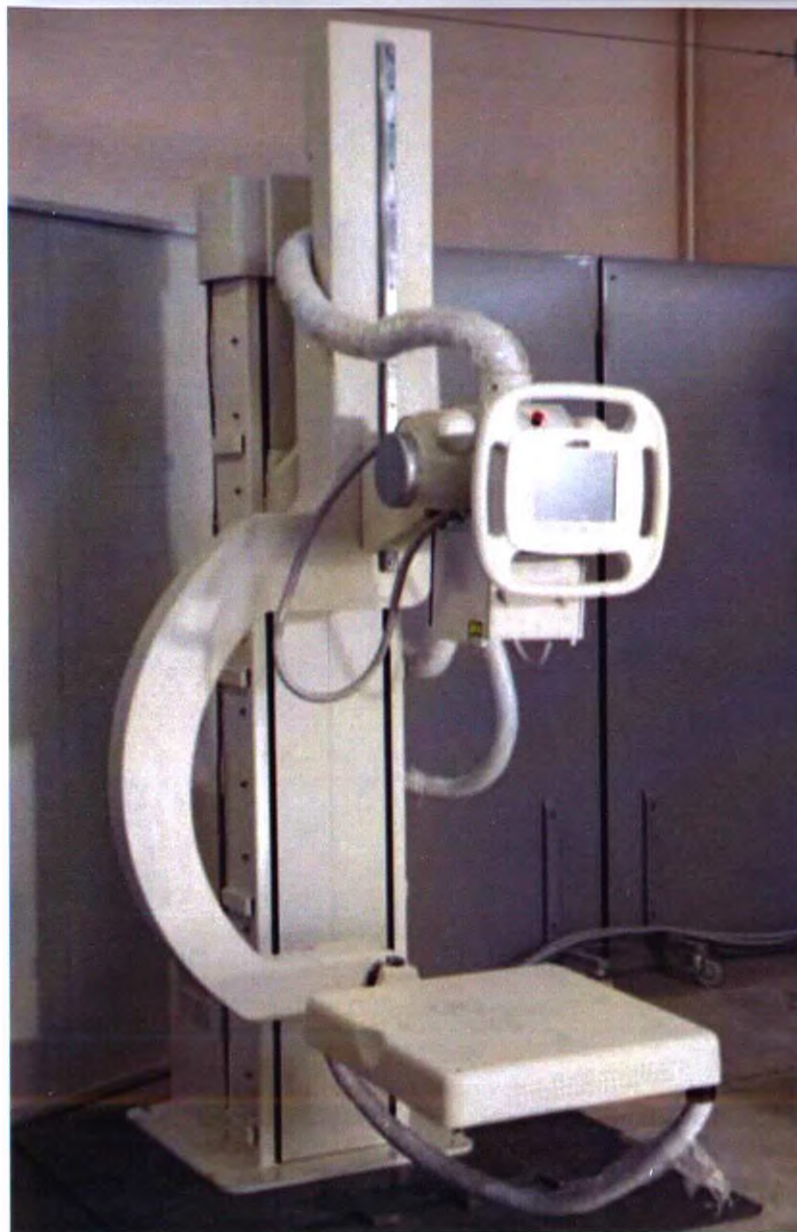

Фотография 6 – Штатив с поворотным кронштейном серии U-DRC

Наименование

Штатив

**с поворотным кронштейном
серии U-DRC**

Серийный номер

2011002013

Дата изготовления

2022-08

Обозначение

ARC1-00-1420


Серийный номер МИ

GP0005427

Изготовитель

Shanghai Hanqing Hi-tech Co,
Ltd., Китай


NF-20-0002-01



~220 В, 50 Гц, 1000 ВА



Фотография 7 – Маркировка. Штатив с поворотным кронштейном серии U-DRC

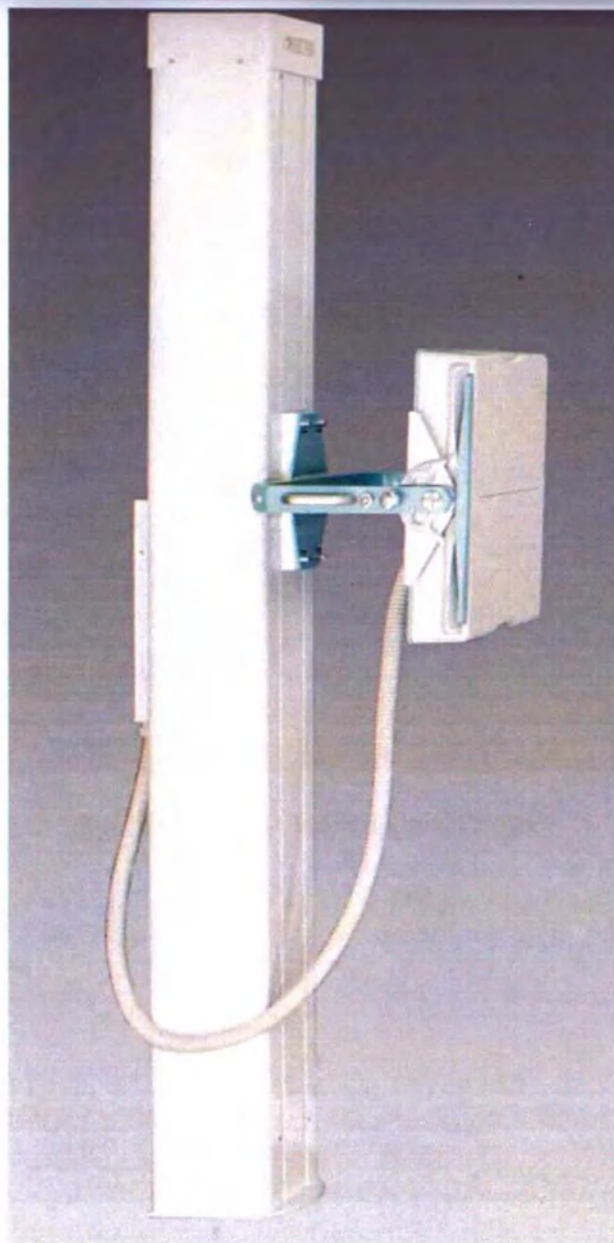


Фотография 8 – Стойка RTOMO-00-1500 по спецификации, включающая Стойку снимков СС в исполнении СС-ДП

Наименование	Стойка
Серийный номер	NN1461272
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	RTOMO-00-1500
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
24 В. 50 ВА	
	

NR 20.0002.01

Фотография 9 – Маркировка Стойки

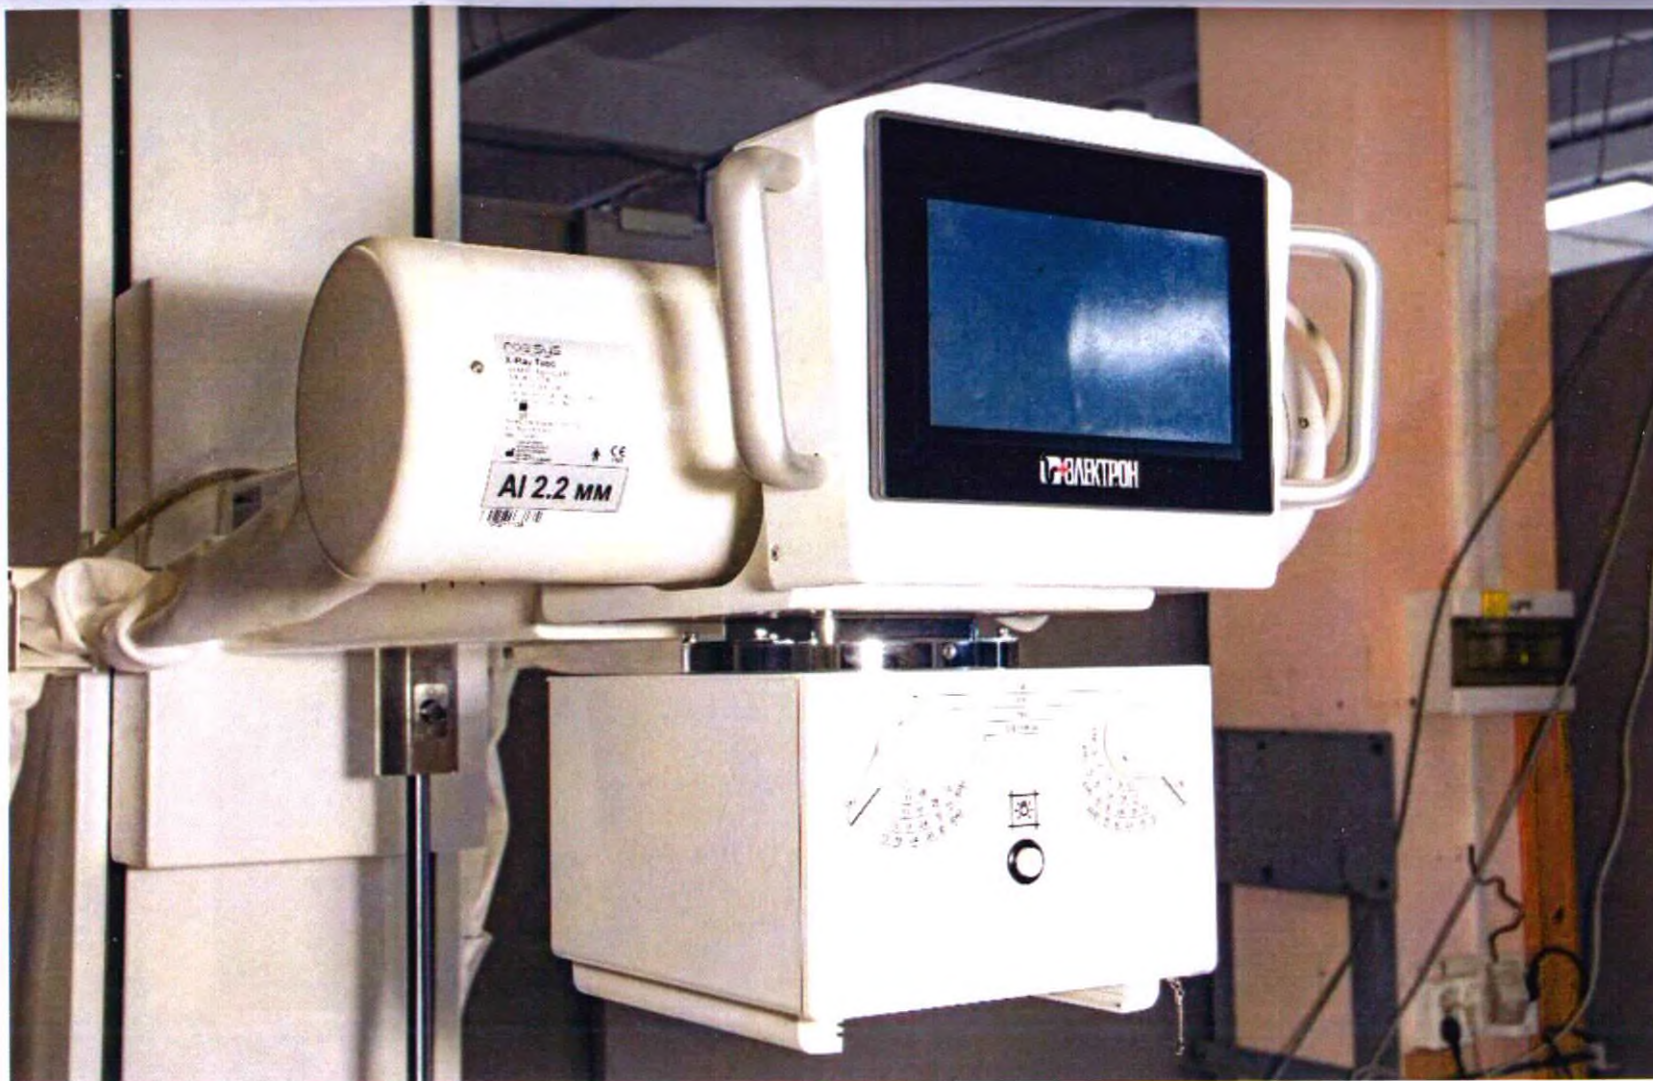

Фотография 10 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии CRUX и излучателем рентгеновским серии Roesys

Наименование	Кронштейн с излучателем в сборе
Серийный номер	NN1461351
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	RTOMO-10-1900
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
№ 20-0002-01	24 В, 3 А
	
	

Фотография 11 – Маркировка кронштейна с излучателем в сборе RTOMO-10-1900



Фотография 12 – Излучатель рентгеновский XRPS (вариант внешнего вида)



Фотография 13 – Маркировка излучателя рентгеновского XRPS по спецификации моноблок с трубкой IAE




Фотография 14 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии Ralco R 302/A DHHS и излучателем рентгеновским серии Roesys



Фотография 15 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии CRUX и и излучателем рентгеновским XRPS




Фотография 16 – Маркировка излучателя рентгеновского серии Roesys

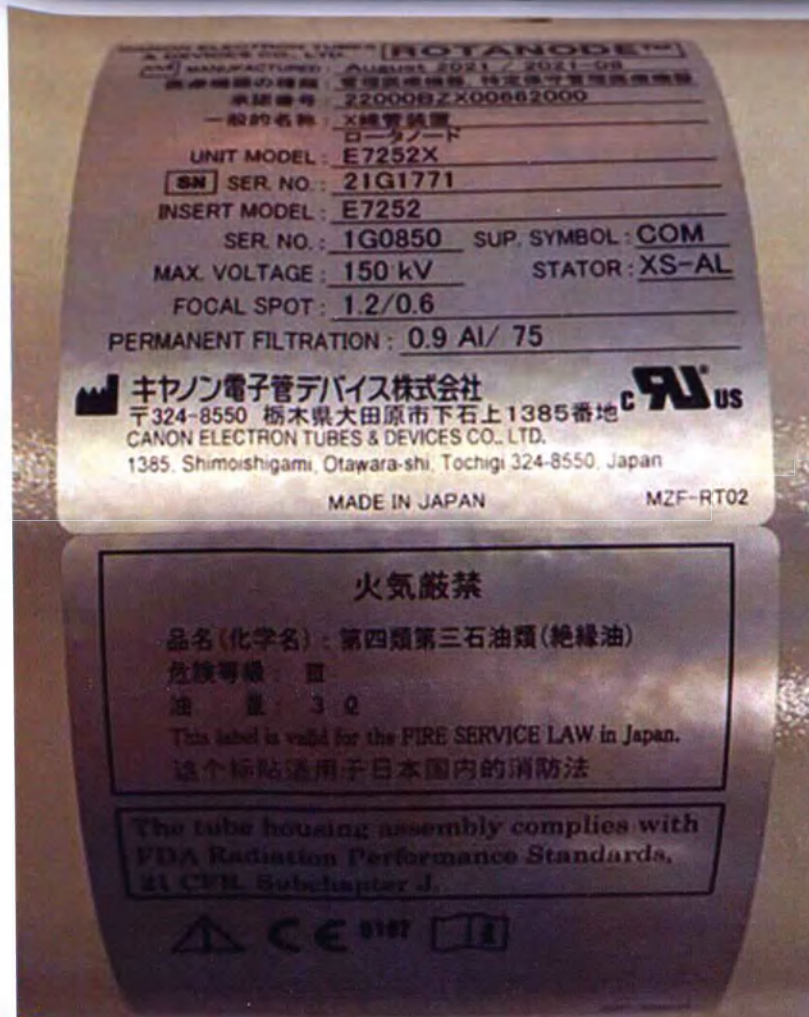


Фотография 17 – Маркировка излучателя рентгеновского серии E



Фотография 18 – Маркировка излучателя рентгеновского серии ИРД

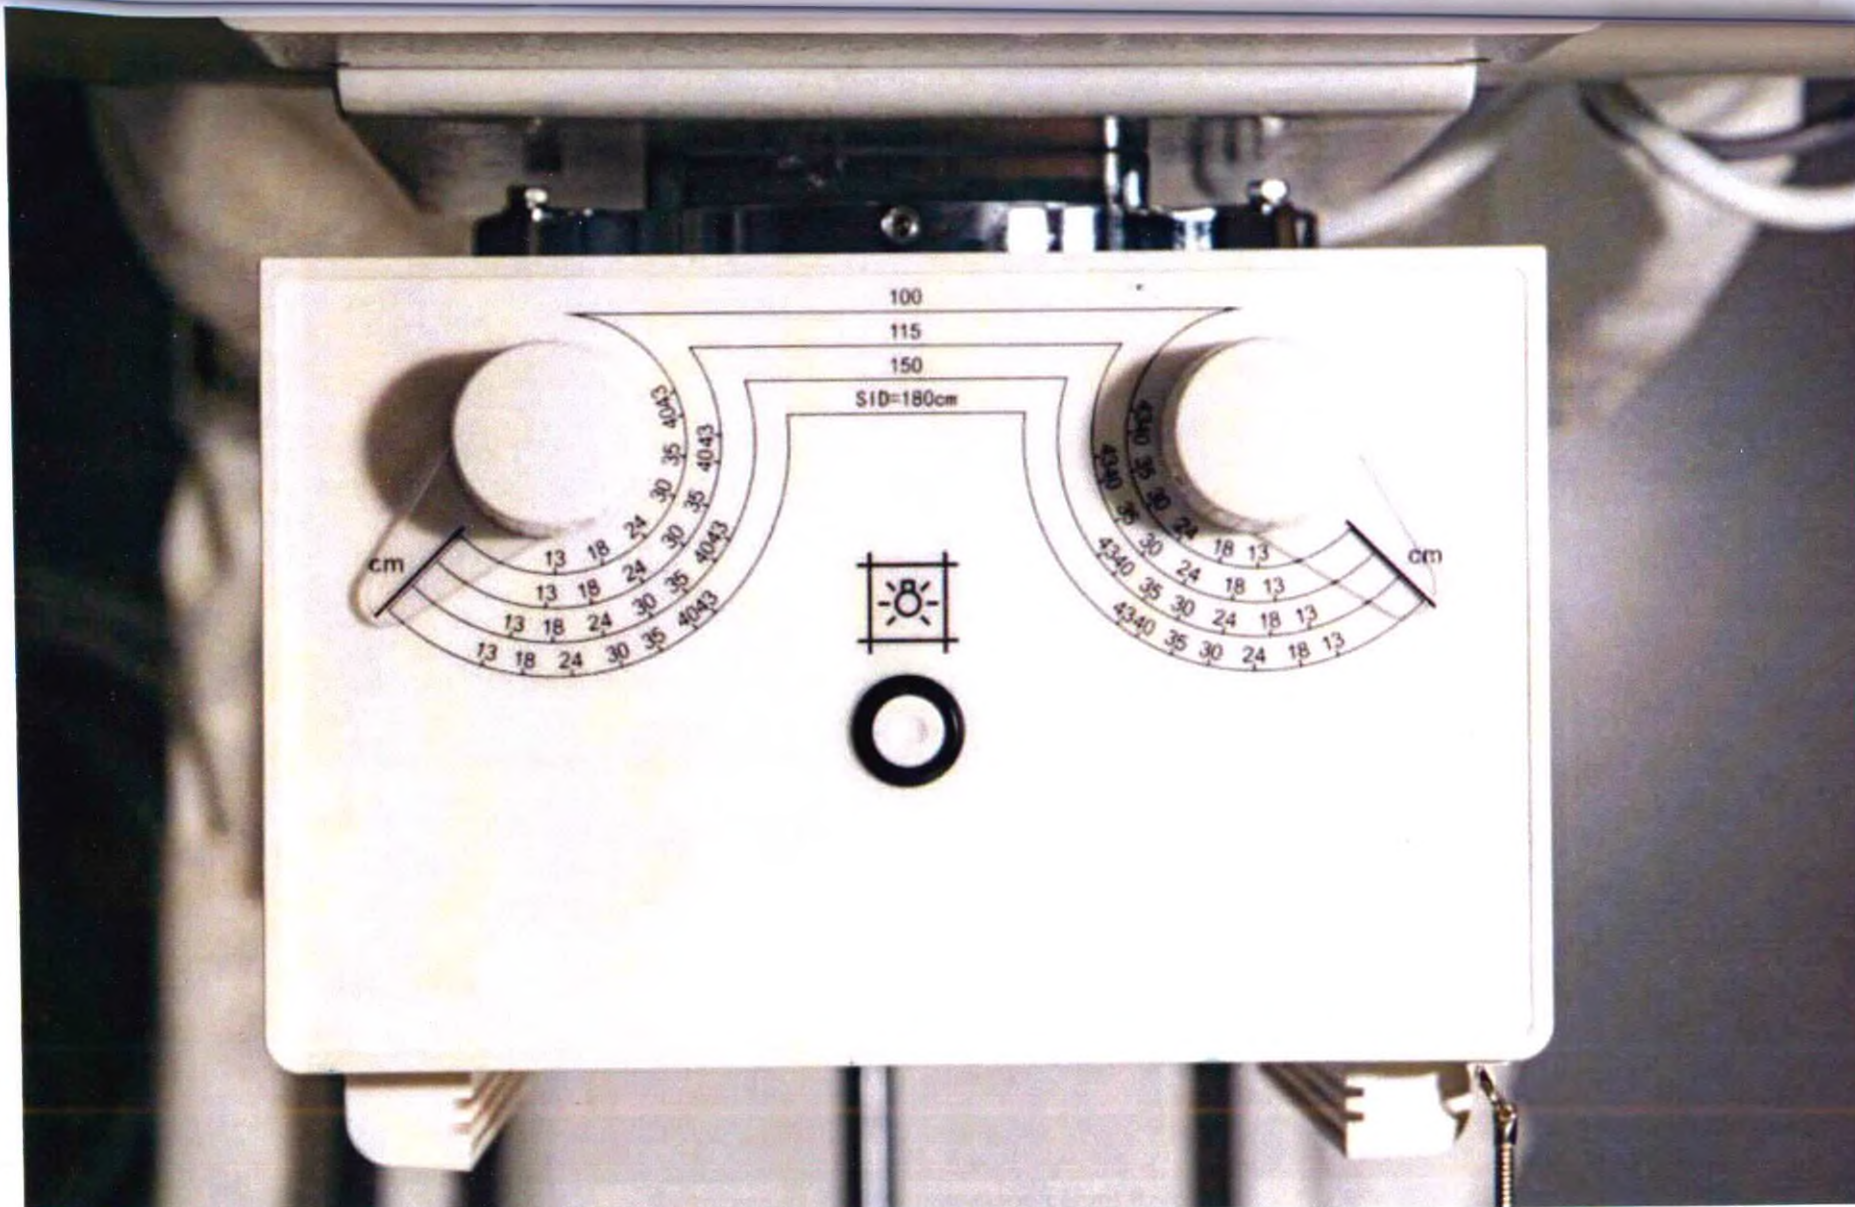

Фотография 19 – Коллиматор серии CRUX

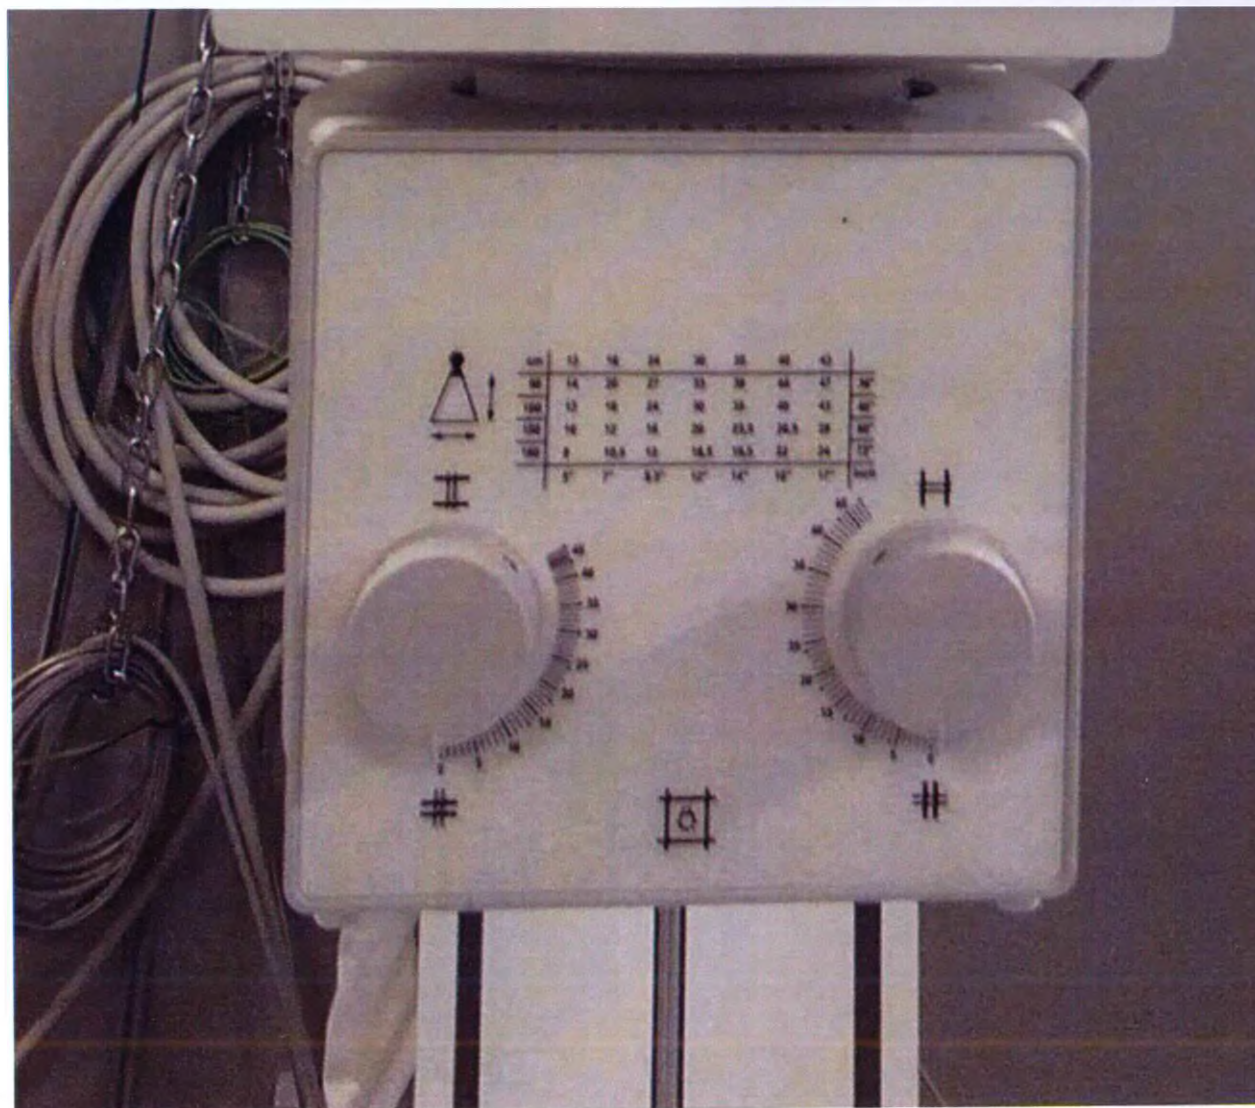

Фотография 20 – Коллиматор серии Ralco R



а) - Маркировка коллиматора серии R 302/A DHHS



б) - Маркировка коллиматора серии R 221/A DHHS



в) - Маркировка коллиматора серии R 225 ACS DHHS



г) Маркировка коллиматора серии CRUX

Фотография 21 – Маркировка коллиматоров




Фотография 22 – Стол пациента RTOMO-1100, по спецификации, включающей стол снимков серии ТОМОС в исполнении ТОМОС-ДЕ

Наименование	Стол пациента
Серийный номер	NN1461269
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	RTOMO-1100
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
NR-20-0002-01    ~380 В, 50 Гц, 5000 ВА 	

Фотография 23 – Маркировка стола пациента RTOMO-1100




Фотография 24 – Система позиционирования рентгеновская согласно п.4.1 таблицы комплектности ТУ (вариант внешнего вида)

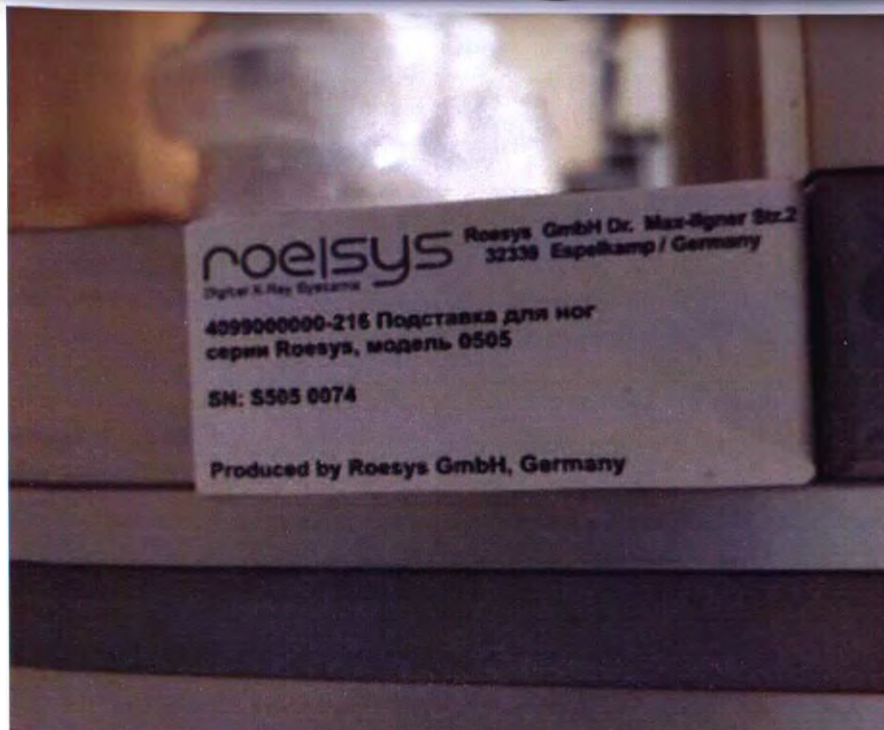


Фотография 25 – Маркировка системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой для ног серии Roesys 0505



Фотография 26 – Маркировка системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой для ног SUR-10-2680

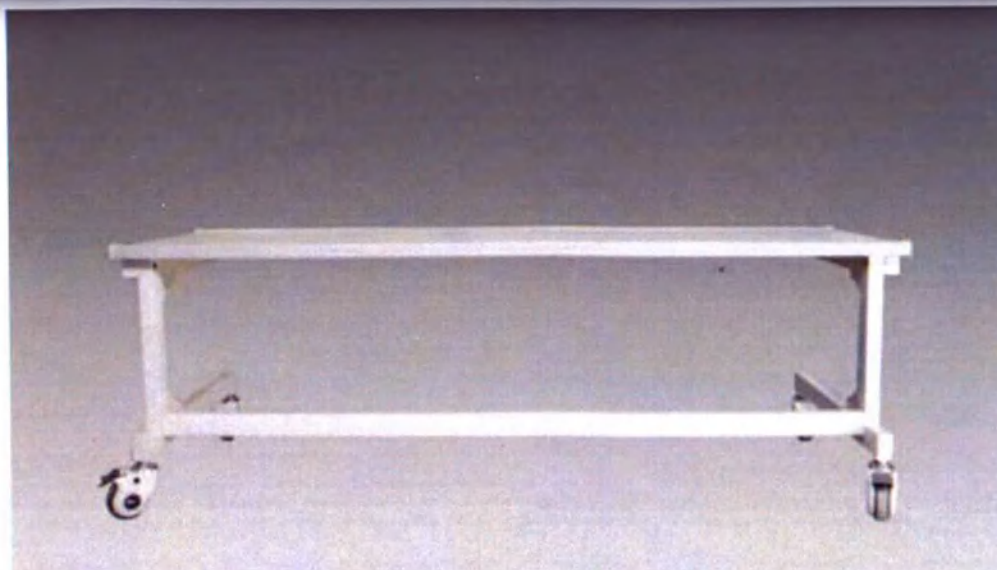

Фотография 27 – Стол пациента по спецификации, в варианте комплектности со Столом-каталкой серии SUR-10

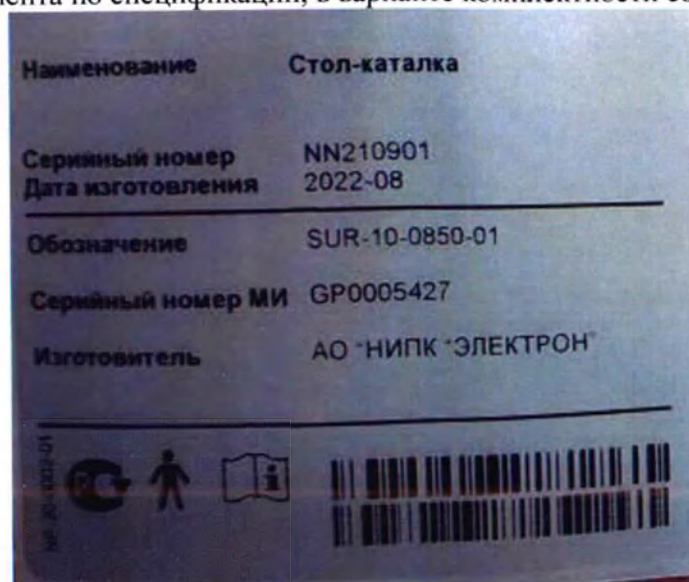

а) - Маркировка стола-каталки серии SUR-10

Фотография 28 – Пример маркировки столов-каталок



Фотография 29 – Рентгеновское питающее устройство XRPS по спецификации (вариант внешнего вида)

Наименование	Рентгеновское питающее устройство
Серийный номер	PF0025233
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	XRPS-10-3500
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК-ЭЛЕКТРОН"

ИП-20-0002-01



~220 В, 50 Гц, 3 кВА



Фотография 30 – Маркировка. Рентгеновское питающее устройство XRPS

Наименование	Рентгеновское питающее устройство РПУ -"ОКО"
Серийный номер	PF1461312
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	RPU60E-00-0000
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01




3N~380 В, 50 Гц, 60 кВА


Фотография 31 – Маркировка РПУ-«ОКО», РПУ-60

Наименование	Рентгеновское питающее устройство РПУ -"ОКО"
Серийный номер	PF1461311
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	RPU50E-00-0000
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01




3N~380 В, 50 Гц, 50 кВА


Фотография 32 – Маркировка РПУ-«ОКО», РПУ-50




Фотография 33 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей согласно п.5.1.2 ТУ в варианте комплектования кабелем высоковольтным с комплектом монтажных частей серии Wanbo




Фотография 34 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии АСН




Фотография 35 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии СНЭ (вариант внешнего вида)

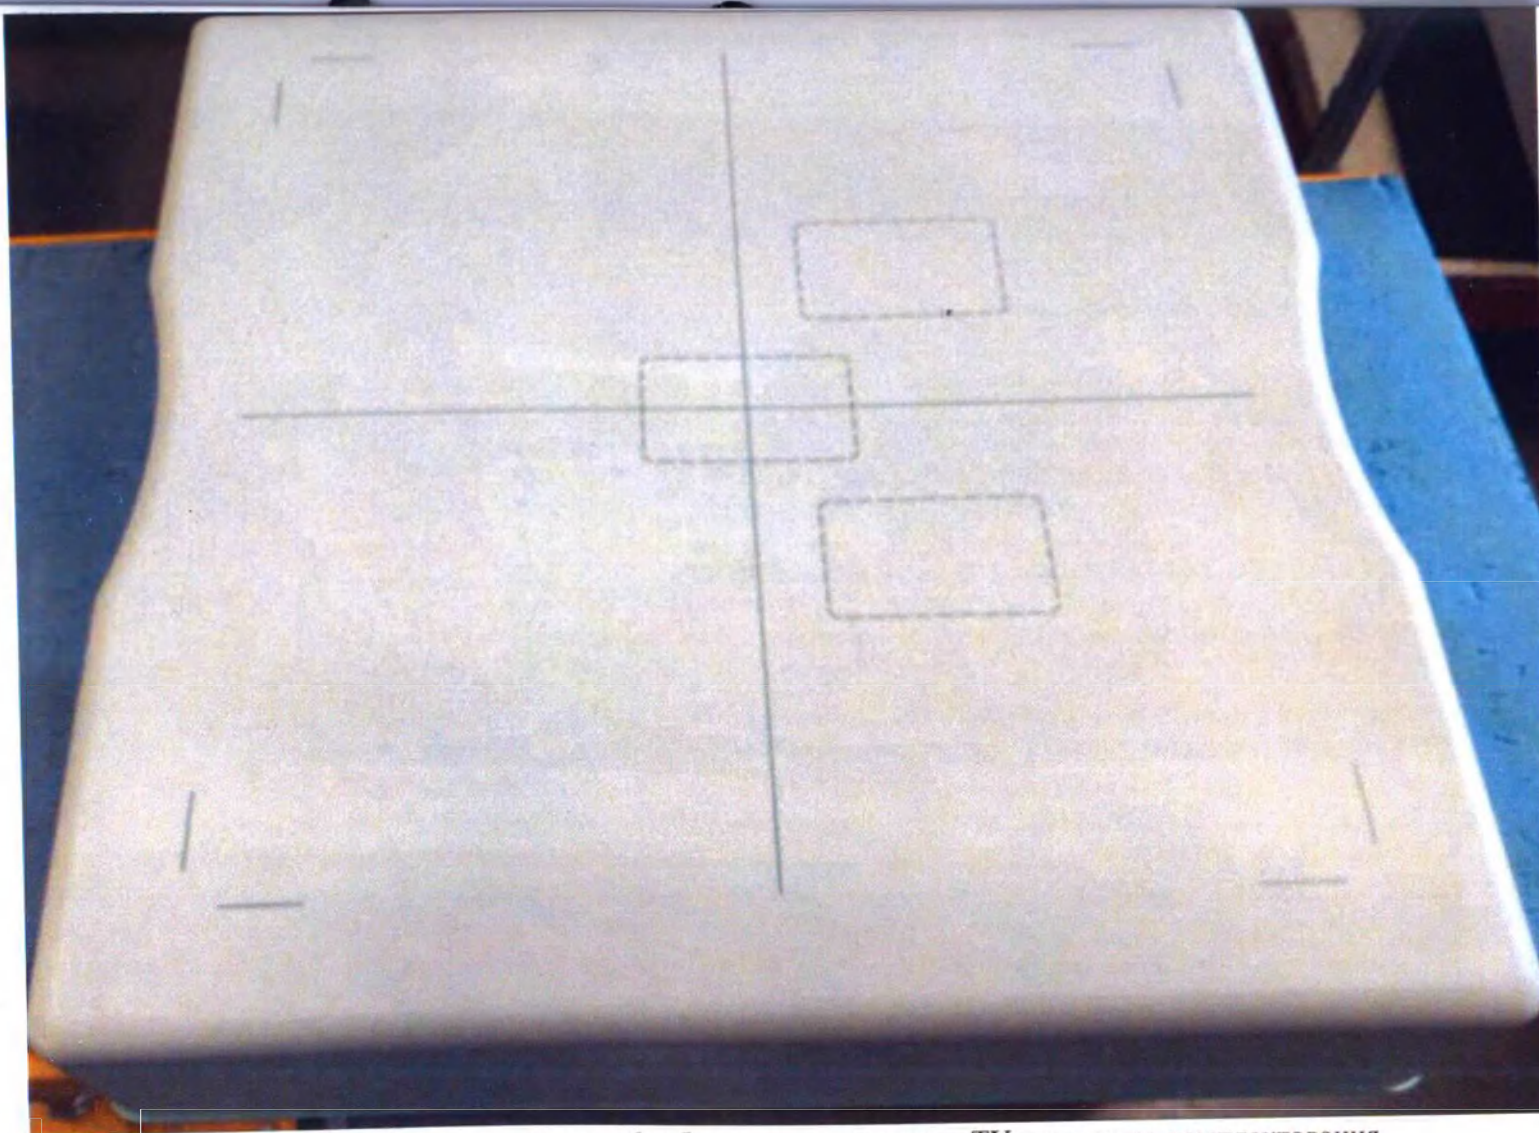


Фотография 36 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида для комплектования на Стойку)

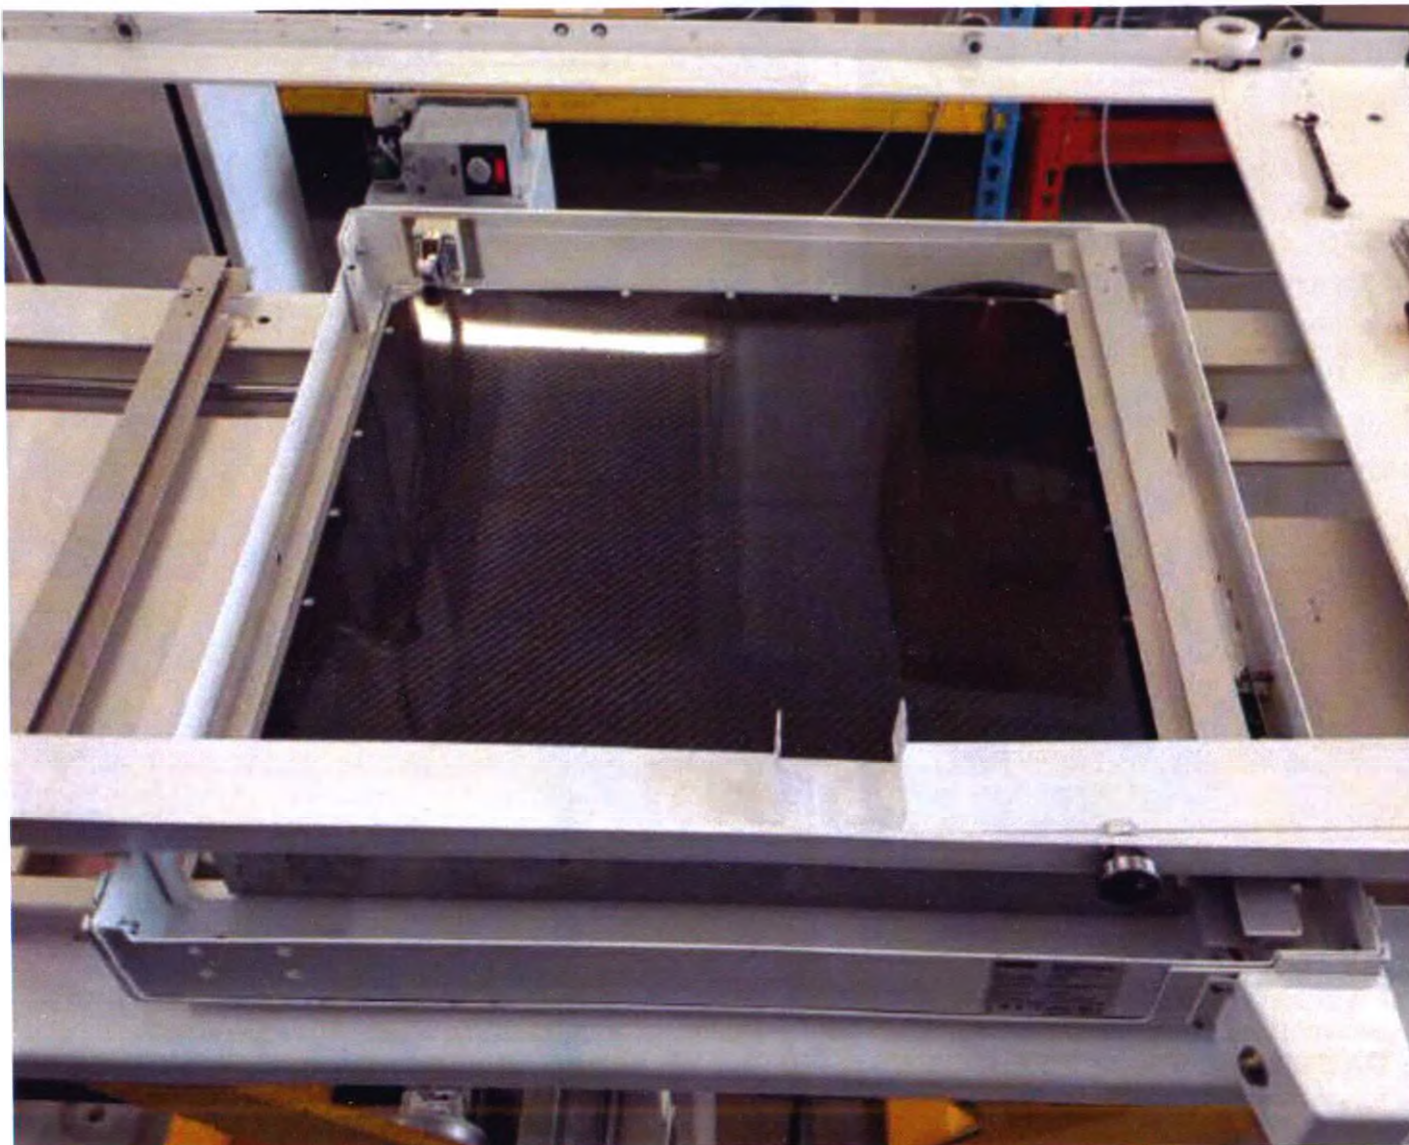

Фотография 37 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)


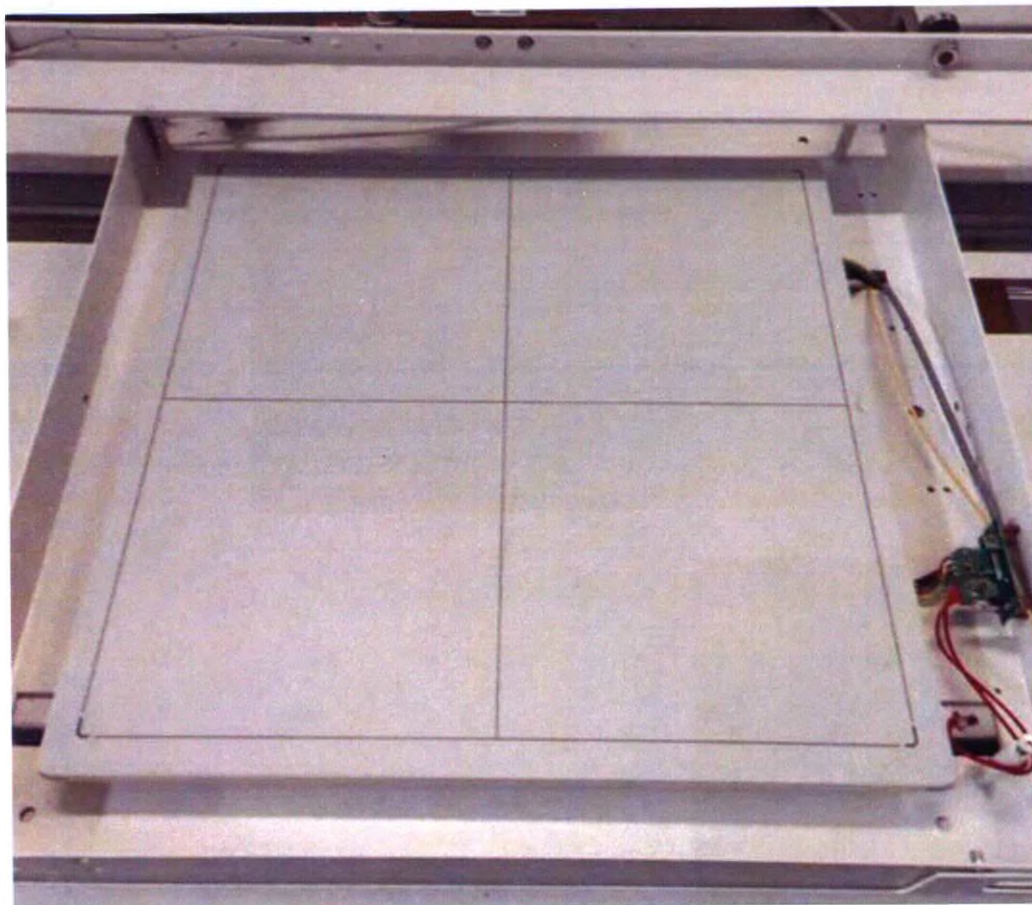


а) вид спереди

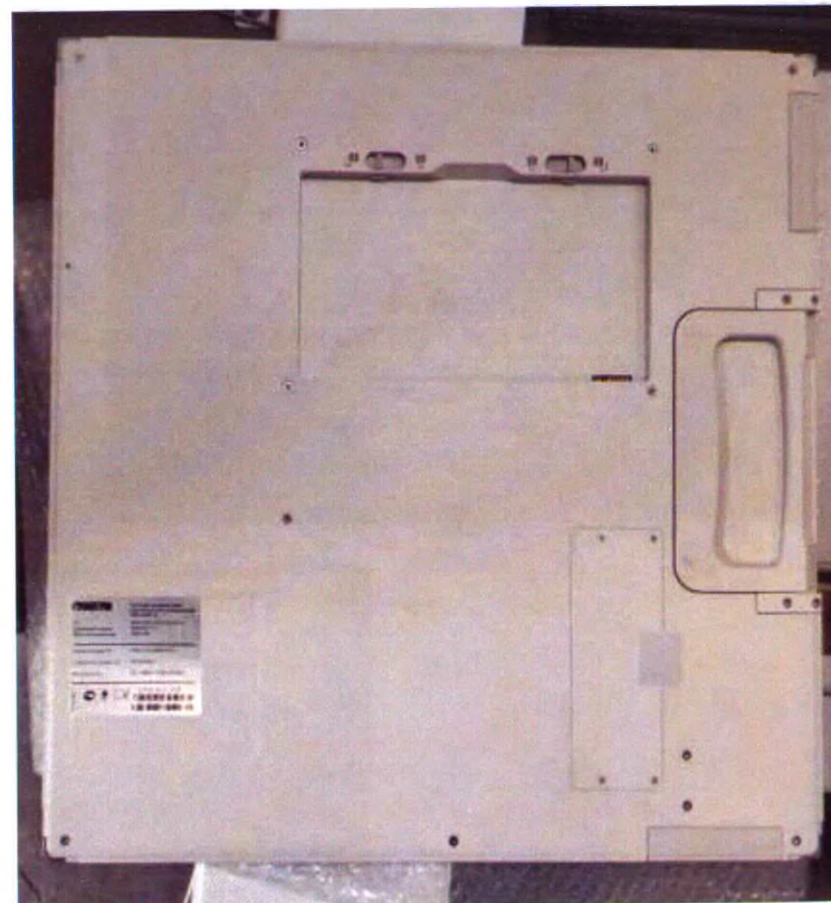

б) вид сзади

Фотография 38 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (с функцией wi-fi, вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)

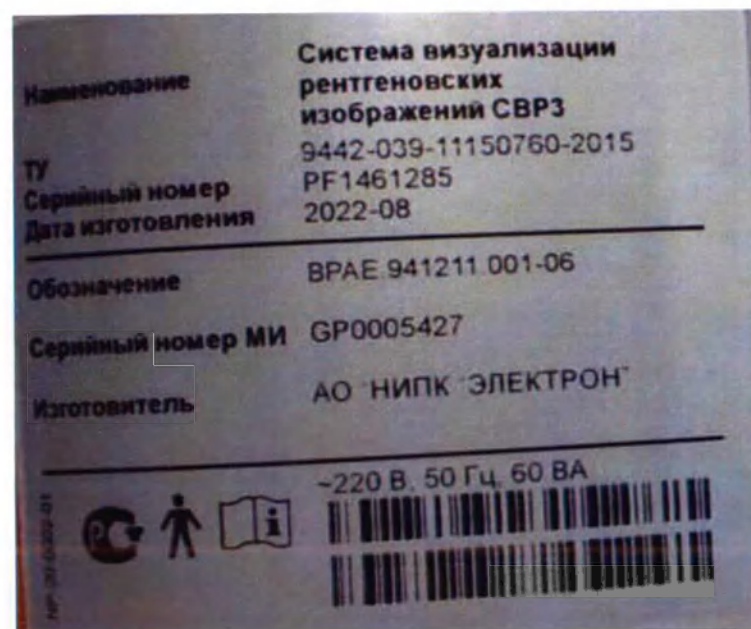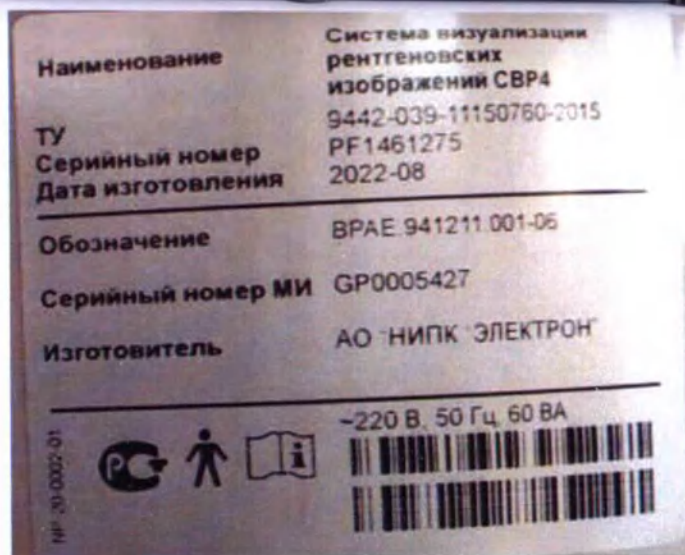

Фотография 39 – Маркировка. Система визуализации рентгеновских изображений СВР




Фотография 40 – Блок питания камеры (детектора)

Наименование	Блок питания детектора
Серийный номер	NN1461512
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	DIRA_DFP-10-0240
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
NP-20-0002-01	~100-240 В. 50/60 Гц
	

Фотография 41 – Блок питания камеры (детектора). Маркировка




а) – зарядное устройство

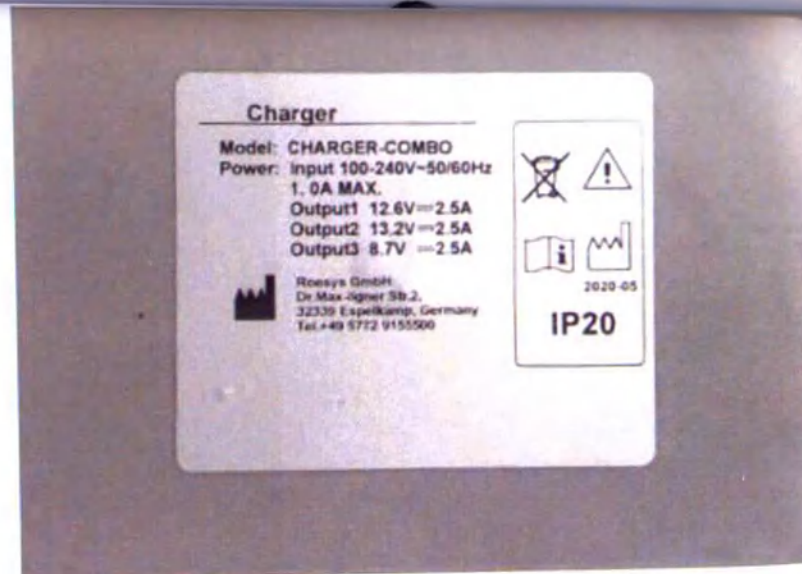


б) – образец шильда зарядного устройства

Фотография 42 – Зарядное устройство камеры (детектора с функцией wi-fi) и маркировка

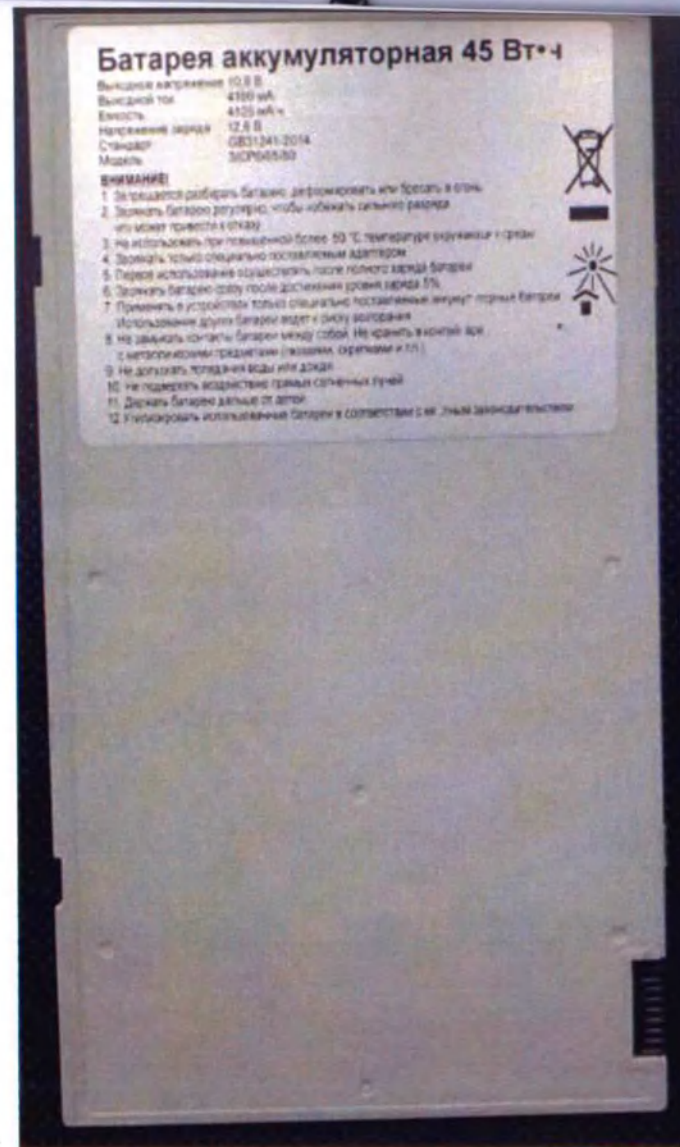

Фотография 43 – Батарея аккумуляторная камеры (детектора с функцией wi-fi) и маркировка

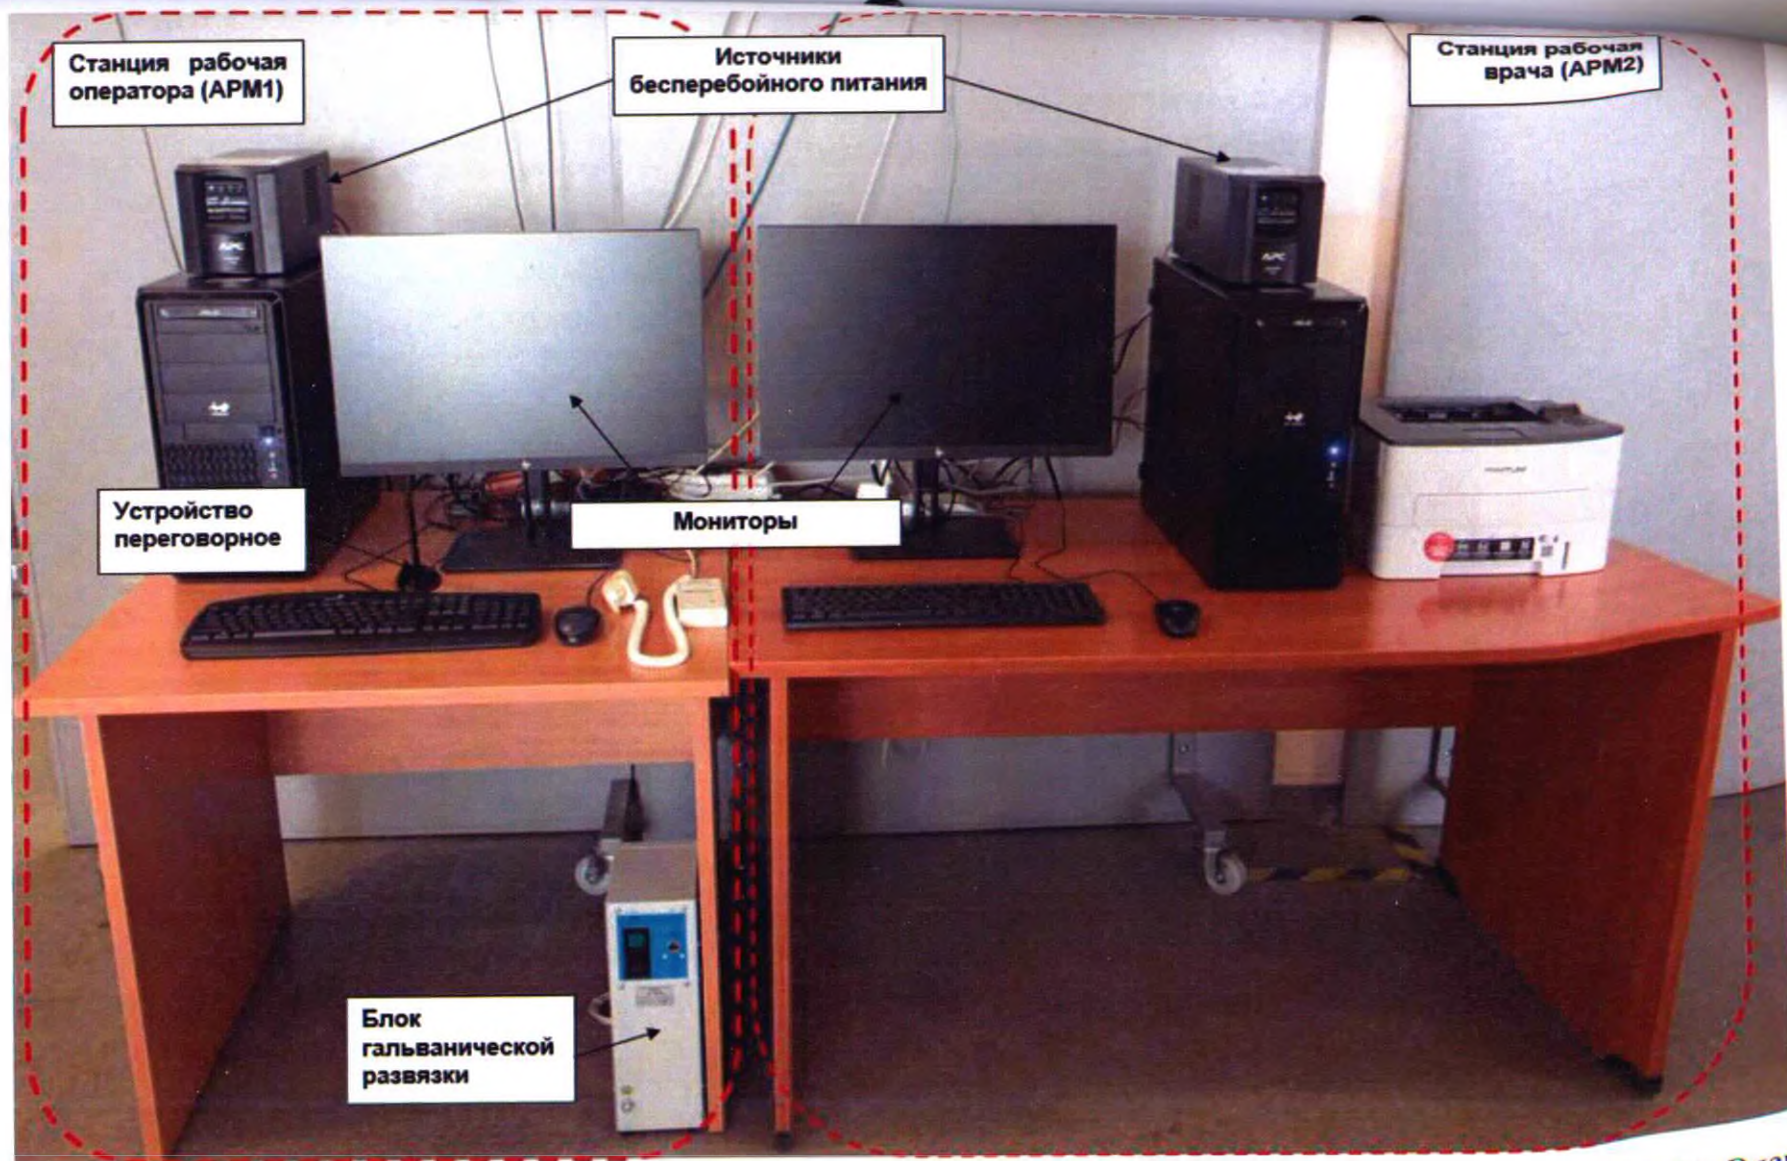

Фотография 44 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) в составе CWS по спецификации АО «НИПК «Электрон».
Вариант общего вида.

Наименование	Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс РПАК
Серийный номер	NN1461402
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	CWS-00-2500
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NР-20-0002-01




~220 В, 50 Гц, 15 А


Фотография 45 – Маркировка. Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК)



Наименование	Станция рабочая оператора/лаборанта (АРМ1)
Серийный номер	NN1461270
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	WST1-00-7700
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
NP-20-0002-01   ~220 В, 50 Гц, 6 А 	

Фотография 46 – Станция рабочая оператора/ рентген-лаборанта (АРМ1) и маркировка



Фотография 47 – Станция рабочая врача-рентгенолога (АРМ2). Маркировка

Наименование	Станция рабочая врача/рентгенолога (АРМ2)
Серийный номер Дата изготовления	NN1461265 2022-08
Обозначение	WST2-00-1600
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"
NP-20-0002-01   ~220 В, 50 Гц, 6 А	
	




Фотография 48 – Станция рабочая регистратора (АРМ3) (вариант внешнего вида)



Фотография 49 – Монитор Jusha серии R. Маркировка.



Фотография 50 – Монитор Jusha серии C. Маркировка.

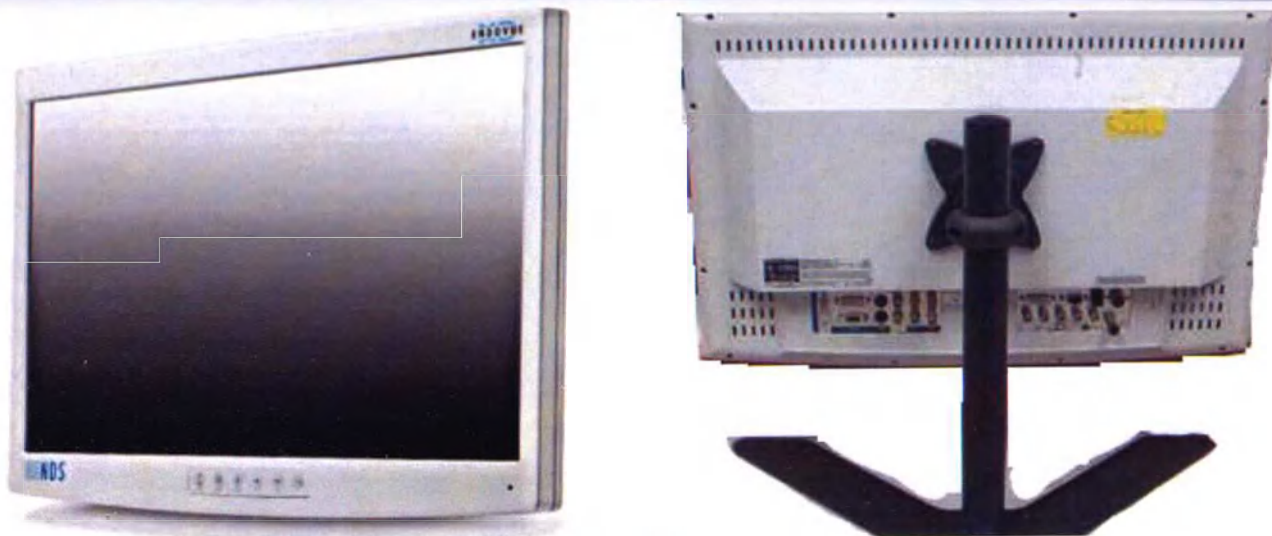

Фотография 51 – Монитор серии Endovue (вариант внешнего вида)



Фотография 52 – Монитор серии Radiance (вариант внешнего вида)



Фотография 53 – Монитор серии ProLite T2453MTS и ProLite T2453MIS и маркировка



Фотография 54 – Монитор серии RadiForce и маркировка



Фотография 55 – Монитор серии Dell и маркировка



Фотография 56 – Монитор серии NEC и маркировка



Фотография 57 – Монитор серии NEC и маркировка




Фотография 58 – Монитор серии HP и маркировка



Фотография 59 – Источник бесперебойного питания Eaton. Маркировка



Фотография 60 – Источник бесперебойного питания APC (вариант внешнего вида)

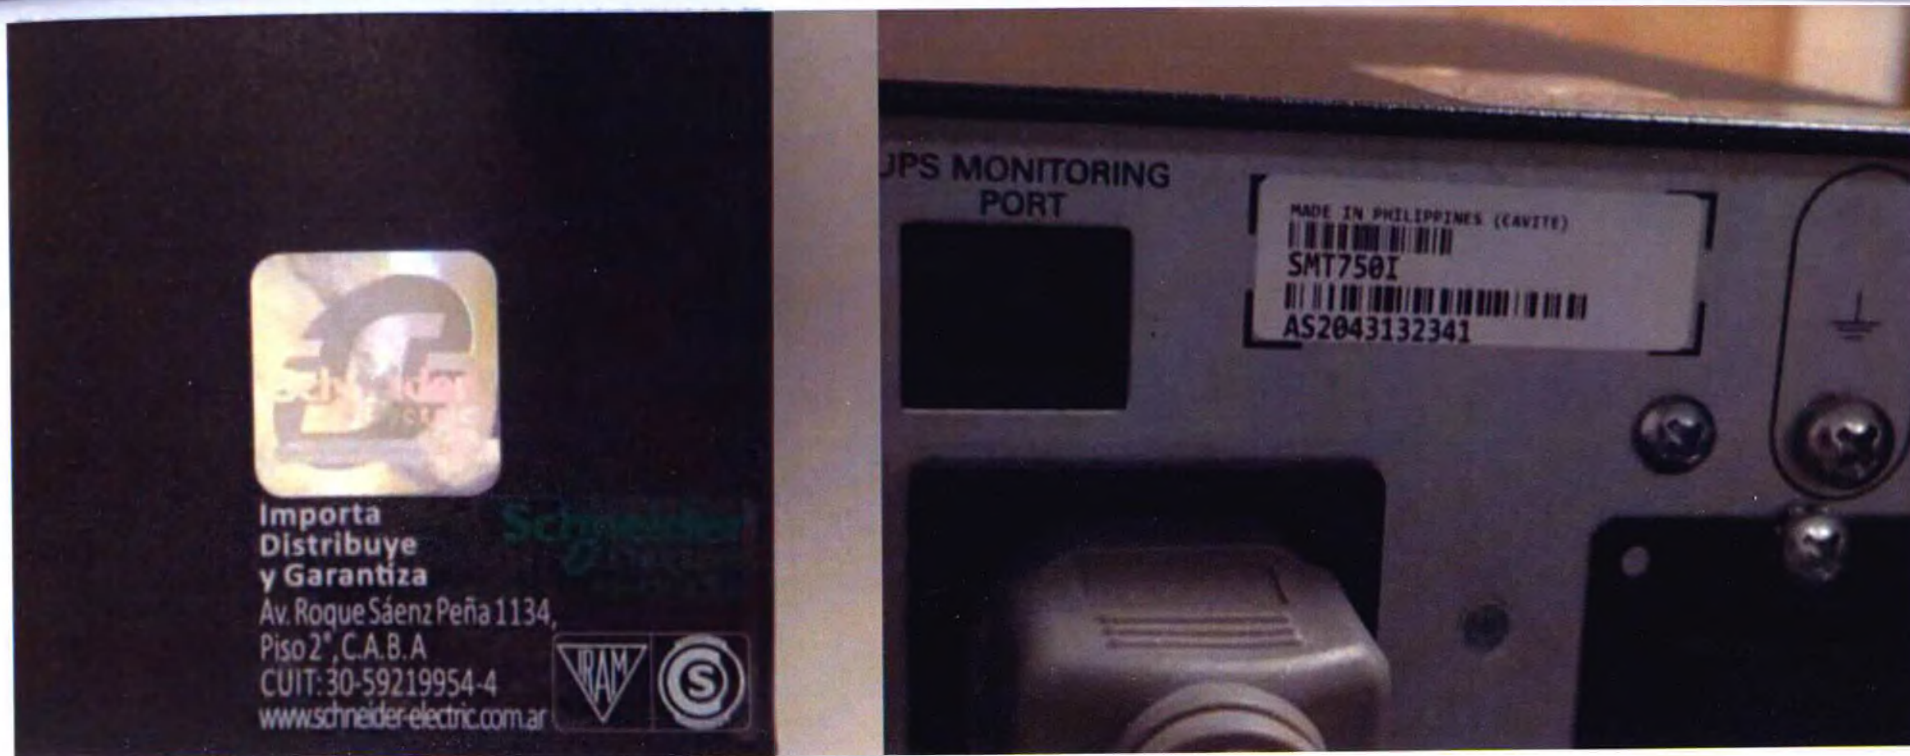

Фотография 61 – Источник бесперебойного питания APC. Маркировка



Фотография 62 – Блок гальванической развязки ТРО – 600 МИ (вариант внешнего вида)



Фотография 63 – Блок гальванической развязки ТРО – 600 МИ. Маркировка



Фотография 64 – Блок гальванической развязки ТРО-600 М (вариант внешнего вида)



TM

ЕАС

БЛОК ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ

ТРО – 600 М


Р 54

**$U_{вх} = 220 В$ 50Гц, $U_{вых} = 220 В$ 50Гц,
 $P_{ном} = 600 ВА$**

Изготовитель: Россия, НПО "ПО "СОЗВЕЗДИЕ" т. (812) 327 67 68

Дата изг. 12.09.2017 N изд. 170007


Фотография 65 – Блок гальванической развязки ТРО – 600 МИ и маркировка

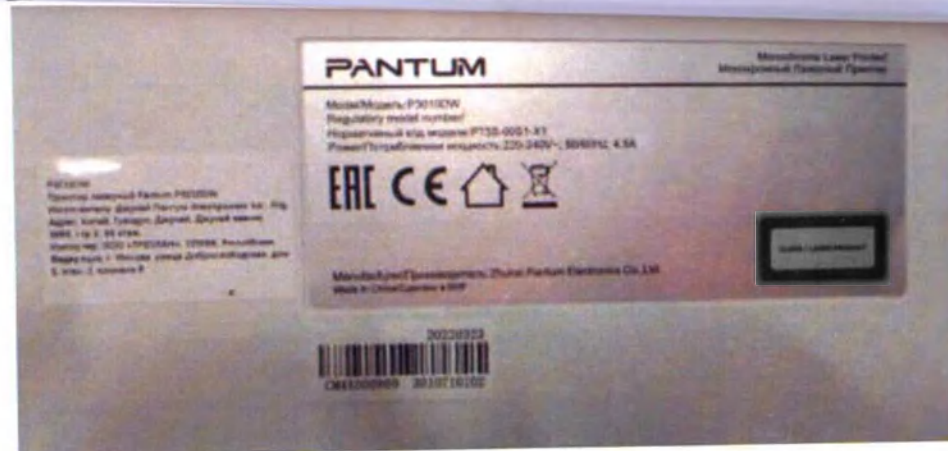

Фотография 66 – Образцы принтеров лазерных и их маркировка



Фотография 67 – Сервер и маркировка сервера

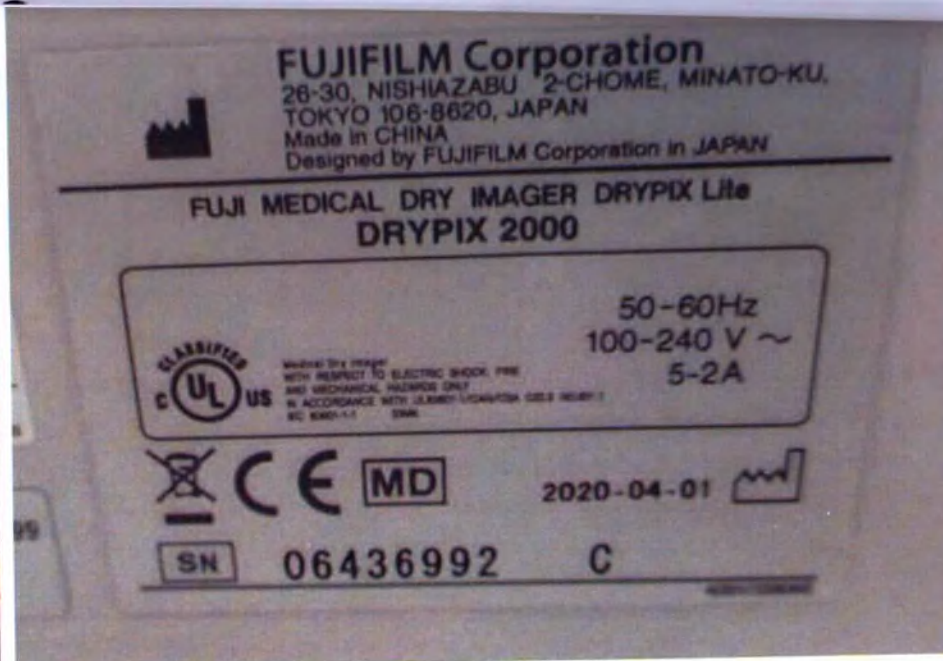

Фотография 68 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX и маркировка



Фотография 69 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP



Фотография 70 – Камера мультиматная термографическая серии Drystar



Фотография 71 – Камера лазерная мультимедийная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений



Фотография 72 – Камера лазерная мультимедийная серии DRYPRO (с маркировкой)



Фотография 73 – Дополнительное оснащение. Дозиметр серии ДРК (вариант внешнего вида)



а) Вариант исполнения по спецификации СП-815



б) Вариант исполнения по спецификации СП-815

Фотография 74 – Стойка приборная (варианты внешнего вида)

Наименование	Стойка приборная
Серийный номер	NN1461357
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	СП- 815-04
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01





Наименование	Стойка приборная
Серийный номер	NN1461388
Дата изготовления	2022-08
Обозначение	СП- 815-06
Серийный номер МИ	GP0005427
Изготовитель	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

NP-20-0002-01






Фотография 75 – Стойка приборная. Маркировка



Фотография 76 – Окно рентгенозащитное, ЗАО «Ренекс»



КОМПЛЕКТ СТАЦИОНАРНЫХ СРЕДСТВ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ "РЕНЕКС КСРЗ"
Оконный блок

смотровой рентгенозащитный
РЕНЕКС ОСРЗ

ТУ 6968-015-21009821-2010

Размер стекла:

800x1000 мм

Свинцовый эквивалент
при $U_a=100$ kV не менее 2,5 мм Pb

Заводской номер: **2041191**

Производитель: ЗАО "РЕНЕКС"


г. Москва, Россия - Новогорьковский пр. Декабристов 268, пом. 37
тел. (383) 262-52-04 факс (383) 262-50-29



max.
3 months



Фотография 77 – Окно рентгенозащитное, ЗАО «Ренекс» и маркировка

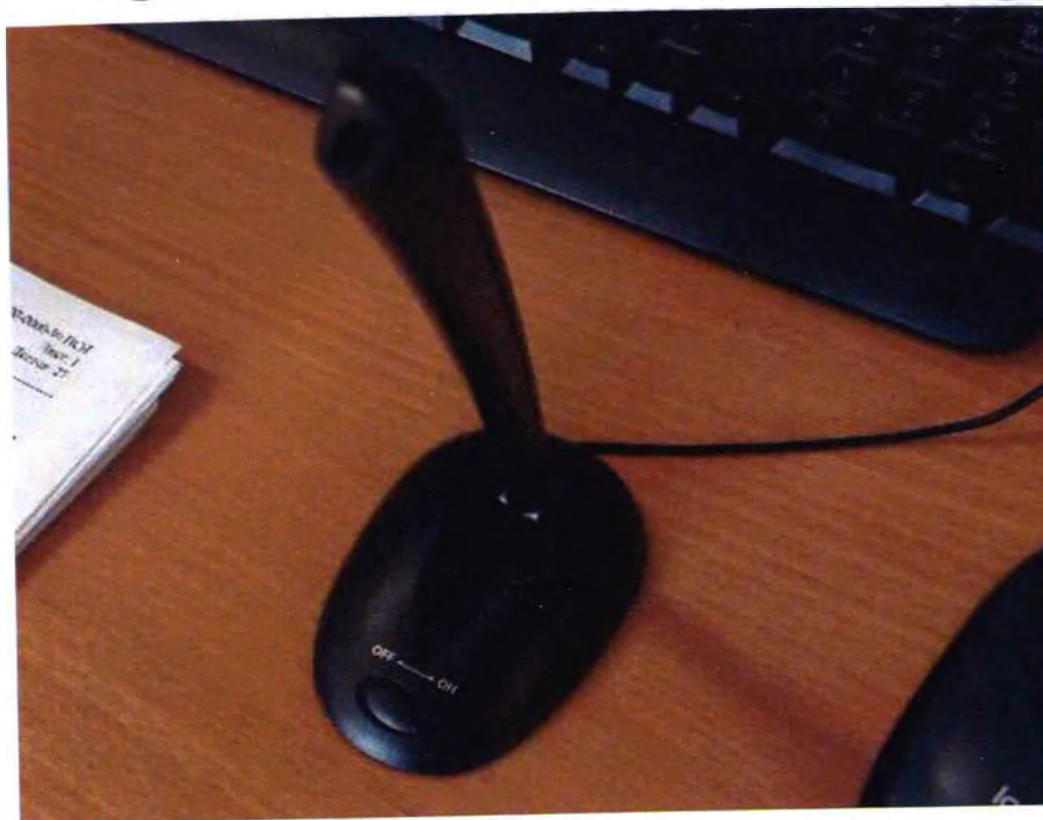

Фотография 78 – Устройство переговорное АРЦ1-2410 (микрофон располагается на столе АРМ1)

НАИМЕНОВАНИЕ	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ	АРЦ1-2410
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР МИ	GP0005427
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

Фотография 79 – Устройство переговорное АРЦ1-2410. Маркировка.



Фотография 80 – Образцы из Комплекта индивидуальных поливинилхлоридно-свинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения № ФСР 2008/03184, ЗАО «Ренекс»

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Семьдесят два 72 лист(ов)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕНИСОВА О.А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ




Фотографические изображения медицинского изделия

**Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-«ОКО»
по ТУ 9442-024-1150760-2008**

Аппараты рентгенографические цифровые АРЦ


(варианты комплектности, внесенные в таблицу 5 ТУ, согласно извещению № КЭ-0.03.443-2022 ТУ 9442-024-11150760-2008)

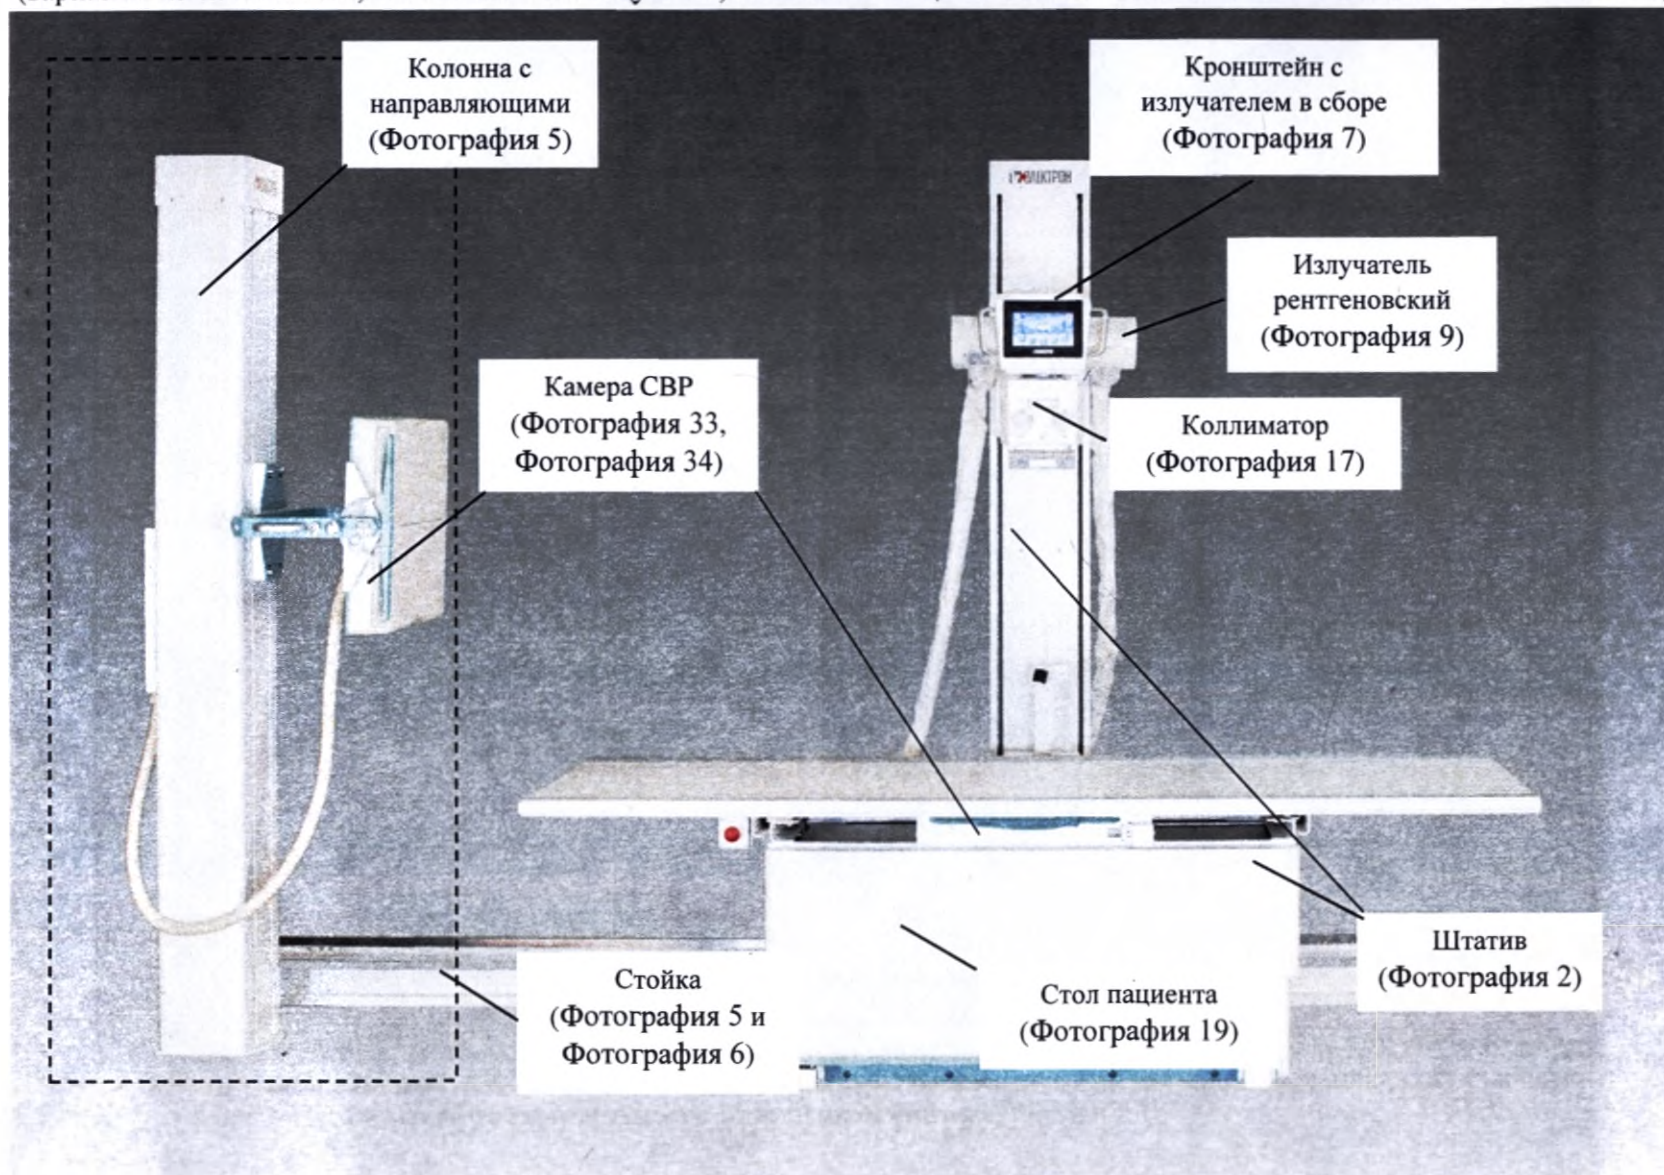

Фотография 1 – Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ. Вариант общего вида.




Фотография 2 – Штатив ARC1-10 по спецификации, включающей систему позиционирования рентгеновскую в варианте комплектности со штативом снимков ТОМОС

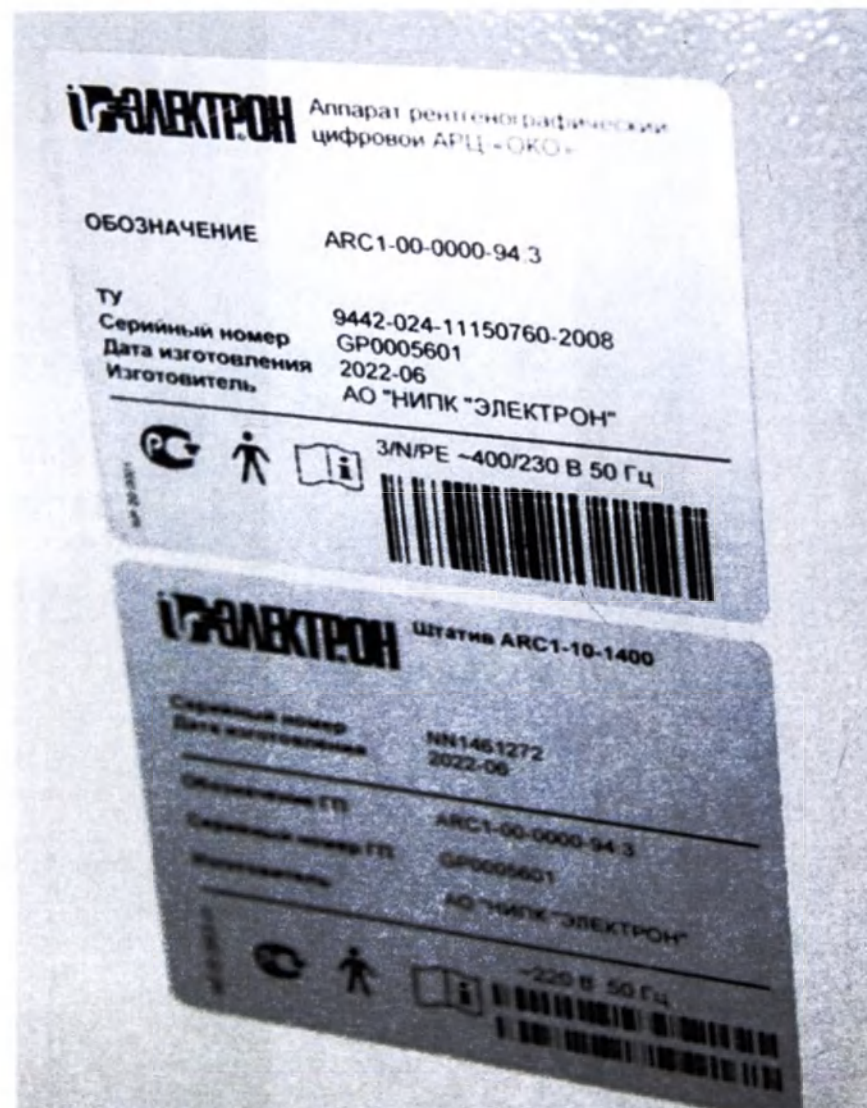


Фотография 3 – Пример маркировки аппарата в варианте исполнения 2 АРЦ-«ОКО» по ТУ 9442-024-11150760-2008 и пример маркировки штатива ARC1-10



Фотография 4 – Штатив с поворотным кронштейном серии U-DRC

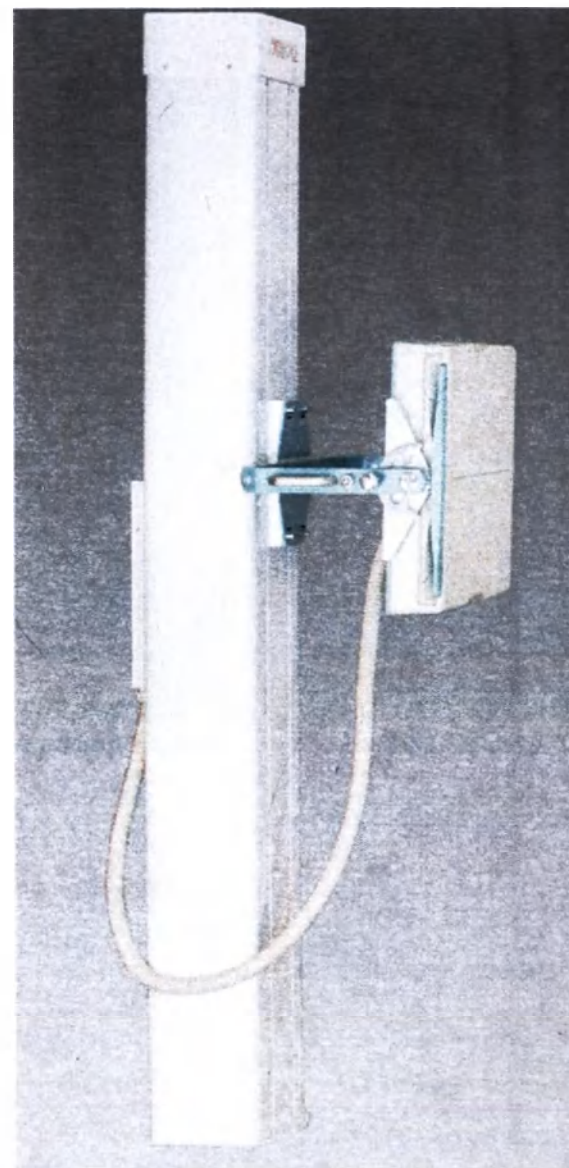

Фотография 5 – Стойка RTOMO-1500, по спецификации, включающей, колонну с направляющими в варианте комплектности со стойкой снимков серии СС

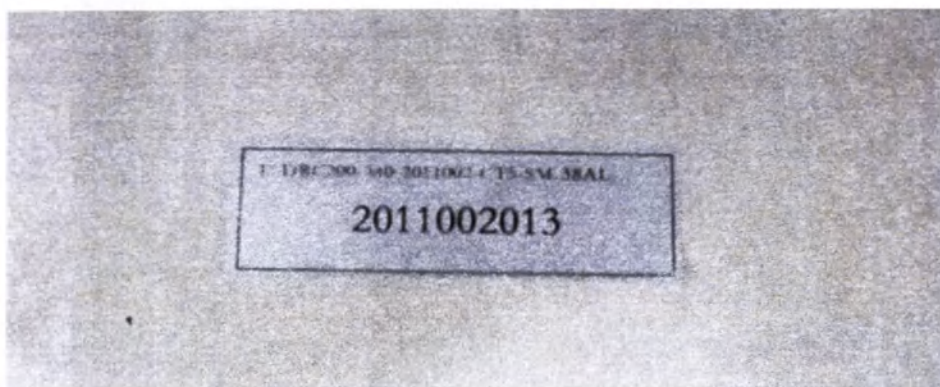


а) – пример маркировки штатива с поворотным кронштейном серии U-DRC



б) - пример маркировки стойки RTOMO-1500

Фотография 6 – Примеры маркировки штатива и стойки

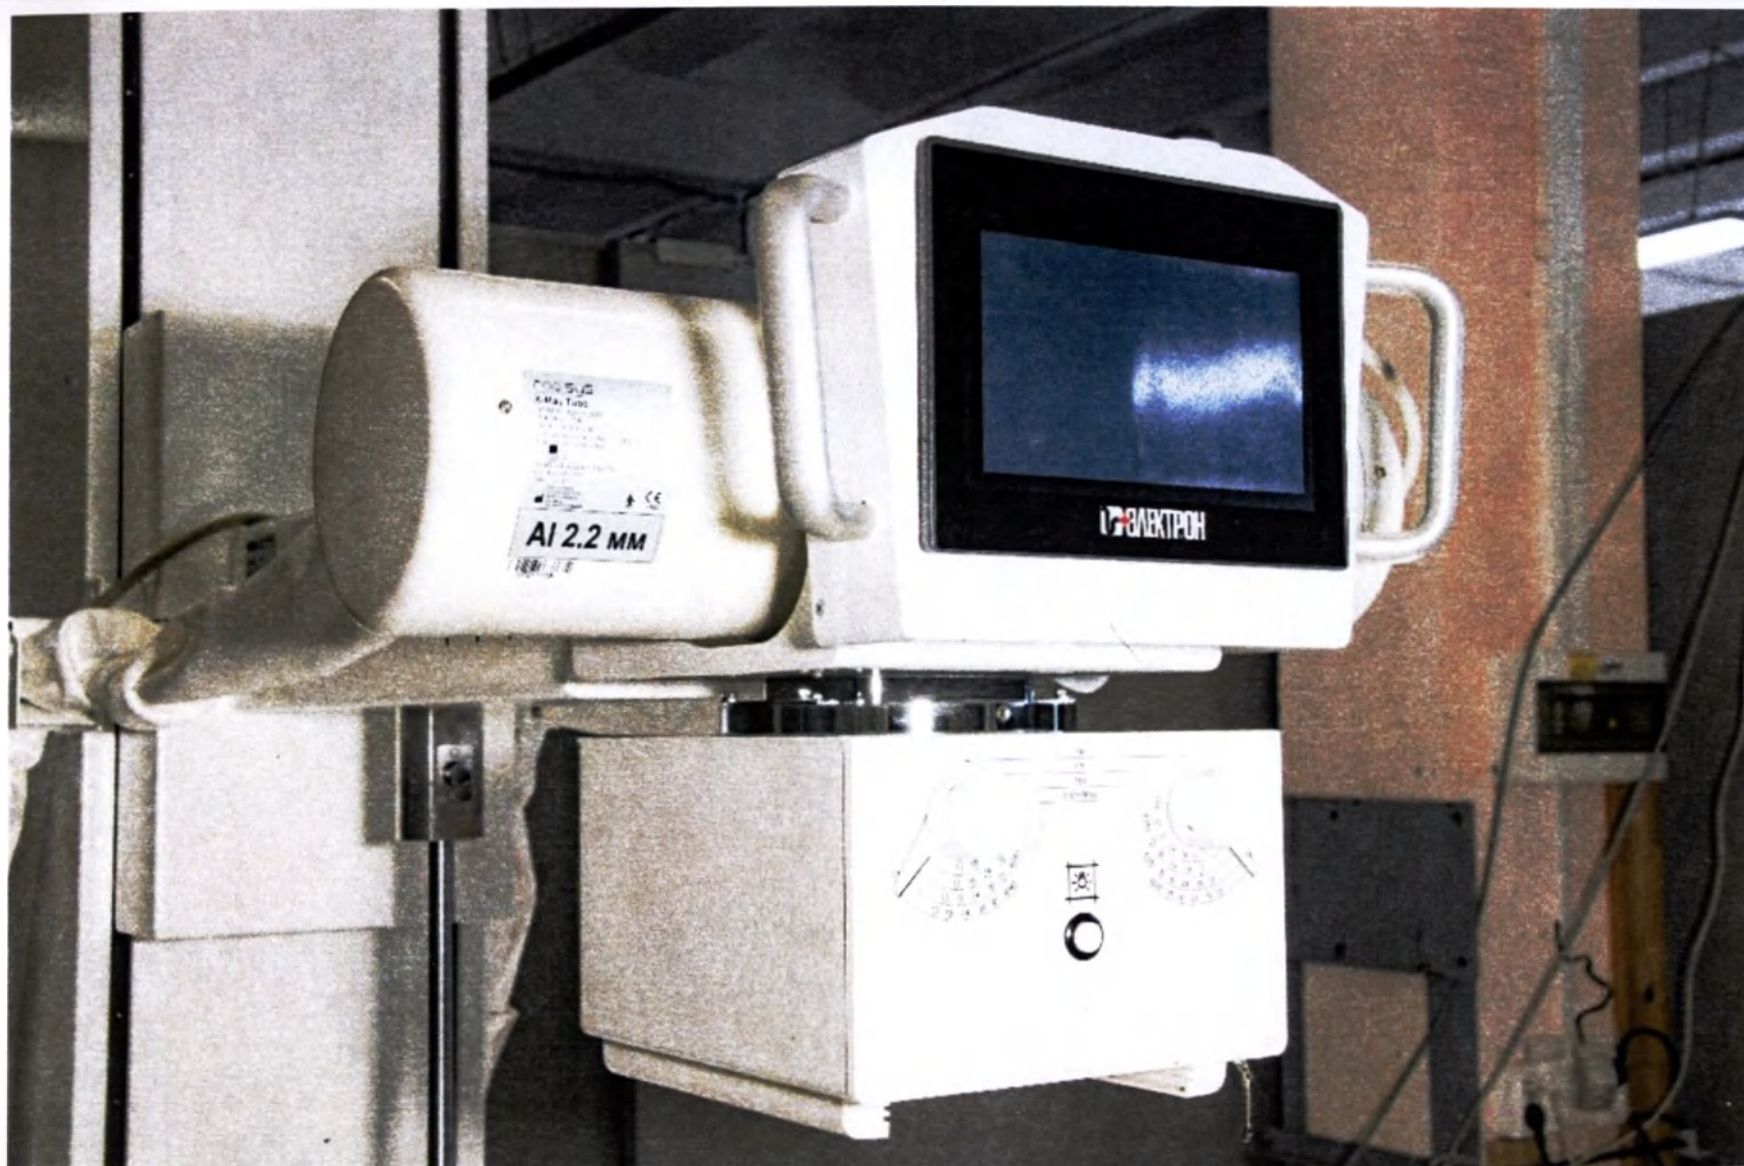

Фотография 7 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии CRUX и излучателем рентгеновским серии Roesys

ЭЛЕКТРОН

Кронштейн с излучателем
в сборе
RTOMO-10-1900

Серийный номер
Дата изготовления

NN1461265
2022-06

Обозначение ГП

ARC1-00-0000-94.3

Серийный номер ГП

GP0005601


Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"

№ 20 0002-01




~220 В 50 Гц 1000ВА

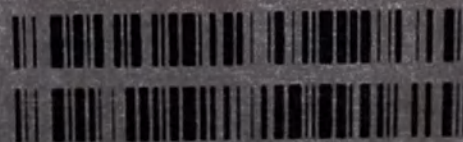

Фотография 8 – Пример маркировки кронштейна с излучателем в сборе RTOMO-10



Фотография 9 – Излучатель рентгеновский XRPS (вариант внешнего вида)

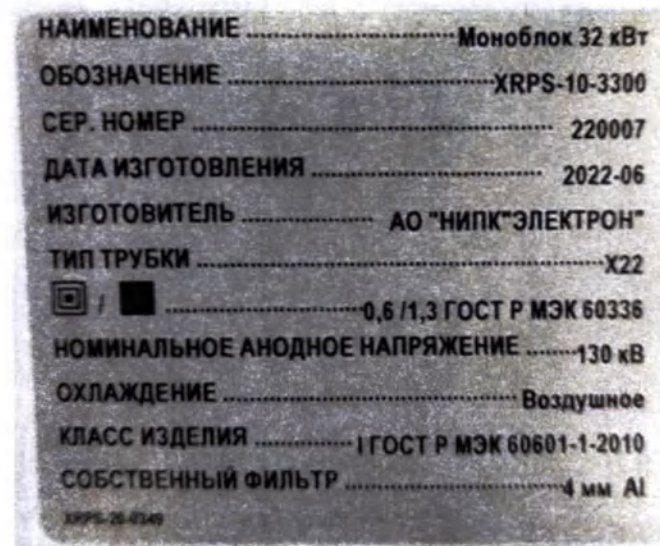


Фотография 10 – Пример маркировки излучателя рентгеновского XRPS по спецификации с трубкой IAE




Фотография 11 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии Ralco и и излучателем рентгеновским серии Roesys



Фотография 12 – Кронштейн с излучателем в сборе RTOMO-10, по спецификации в варианте комплектности с коллиматором серии CRUX и и излучателем рентгеновским XRPS

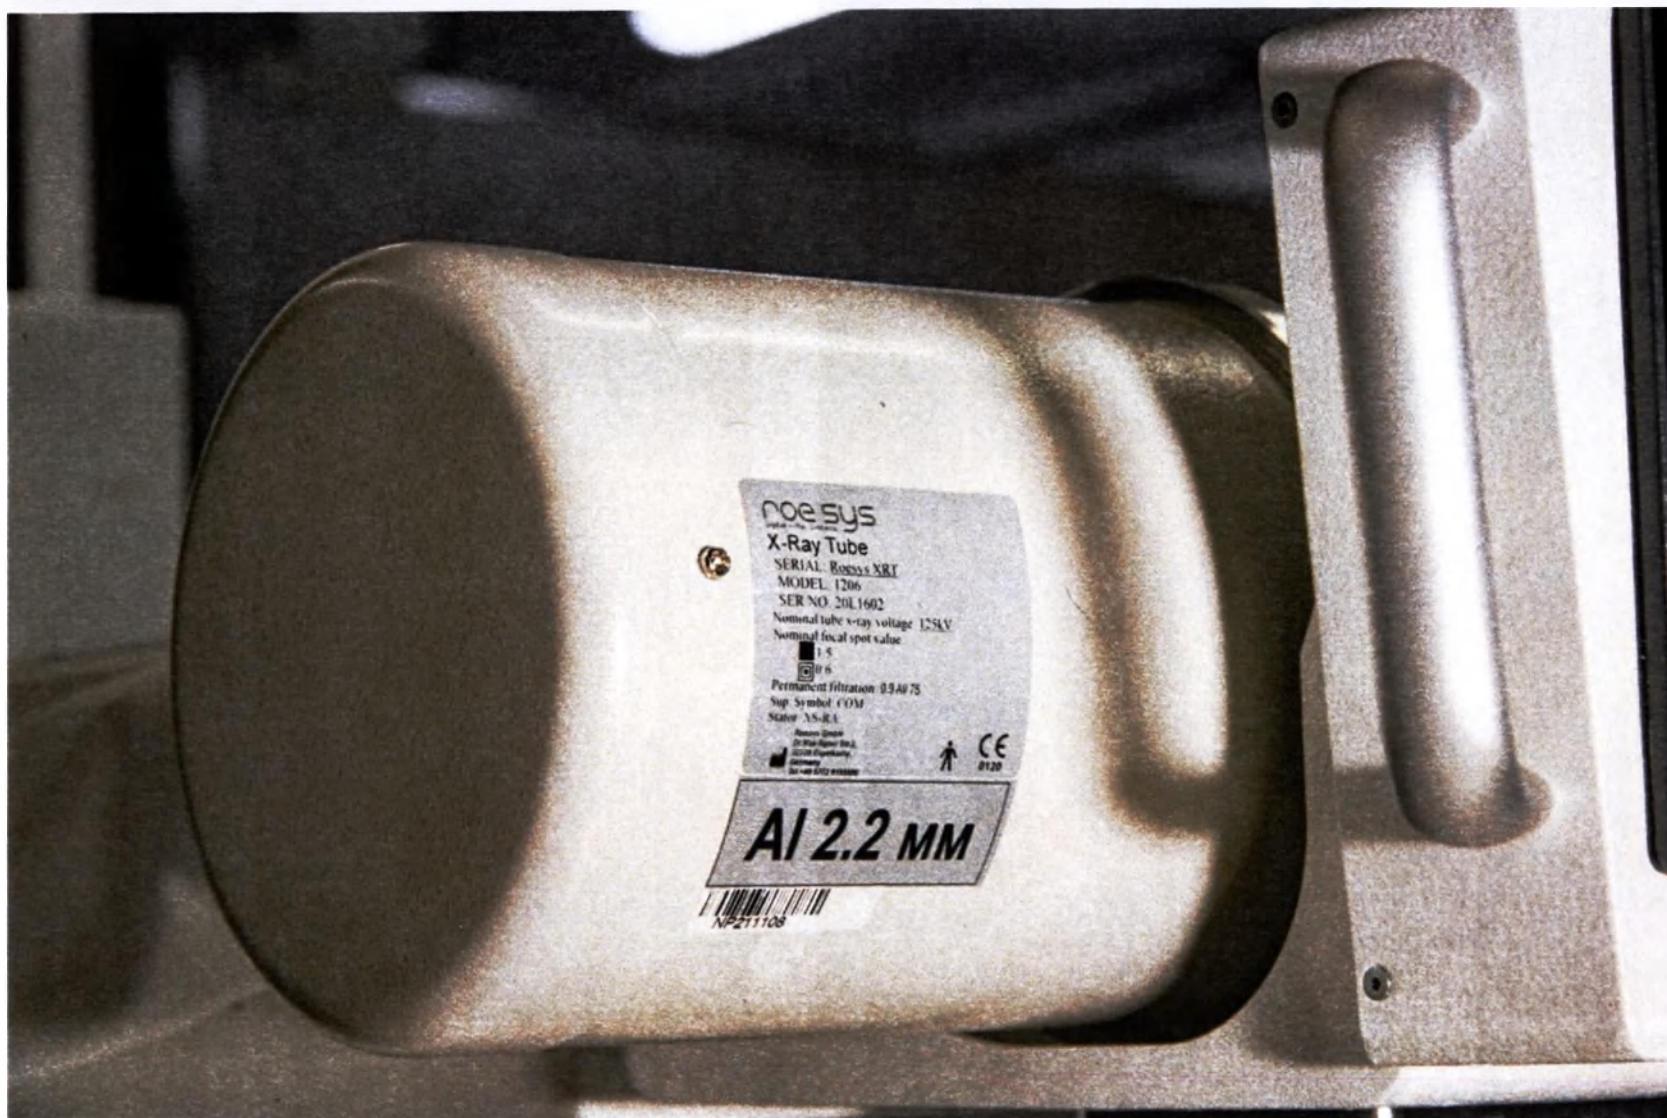


Фотография 13 – Пример маркировки излучателя рентгеновского серии Roesys

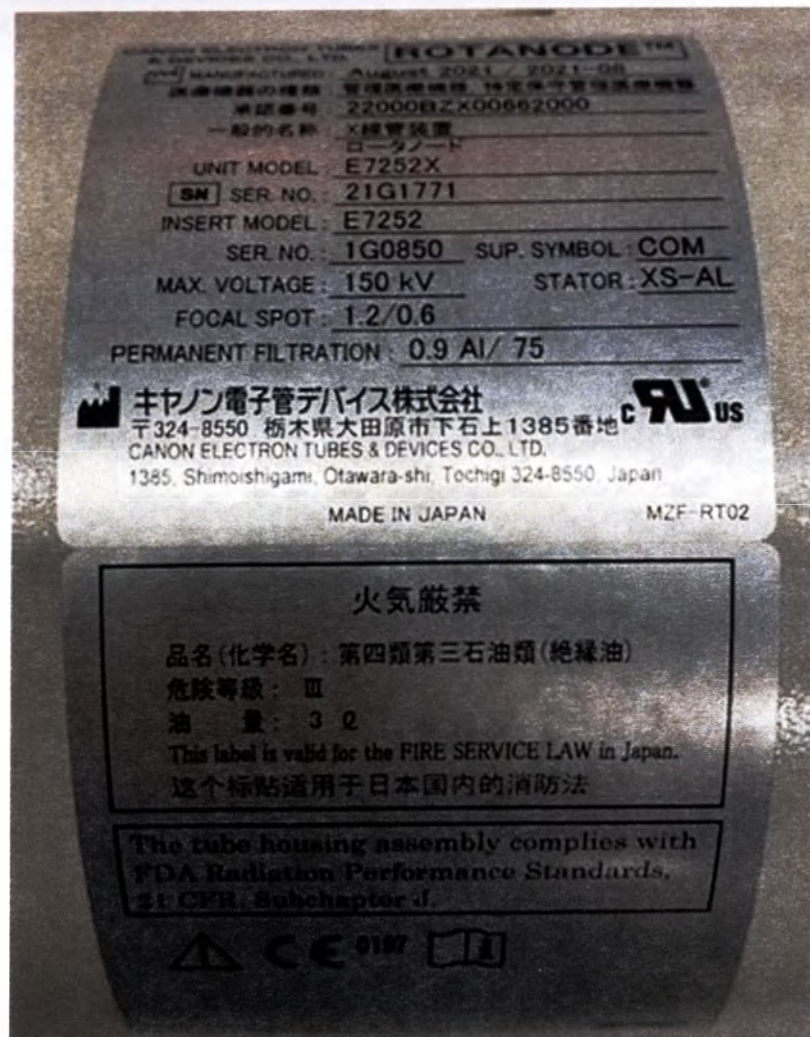


Фотография 14 – Пример маркировки излучателя рентгеновского серии E



Фотография 15 – Пример маркировки излучателя рентгеновского серии ИРД

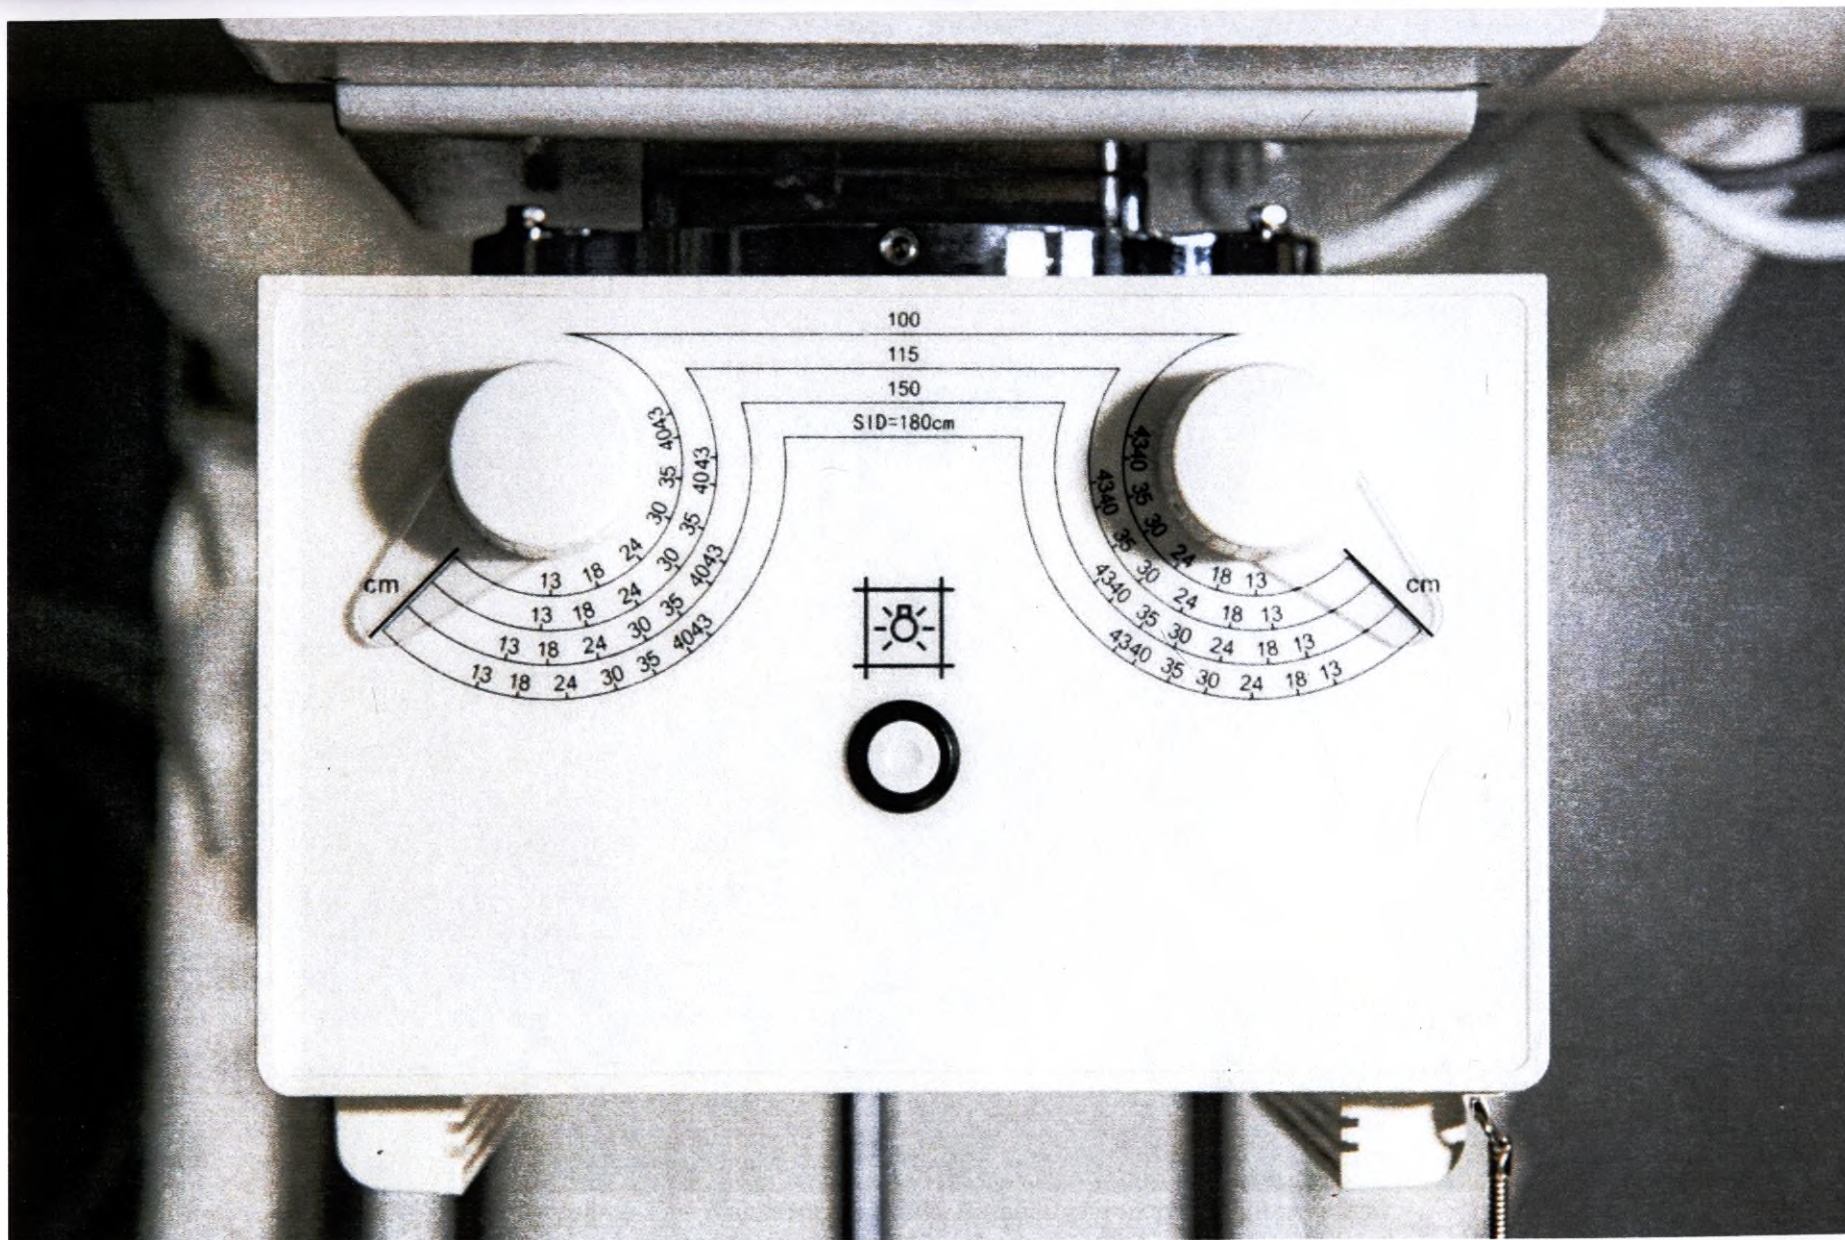

Фотография 16 – Коллиматор серии CRUX (вариант внешнего вида)

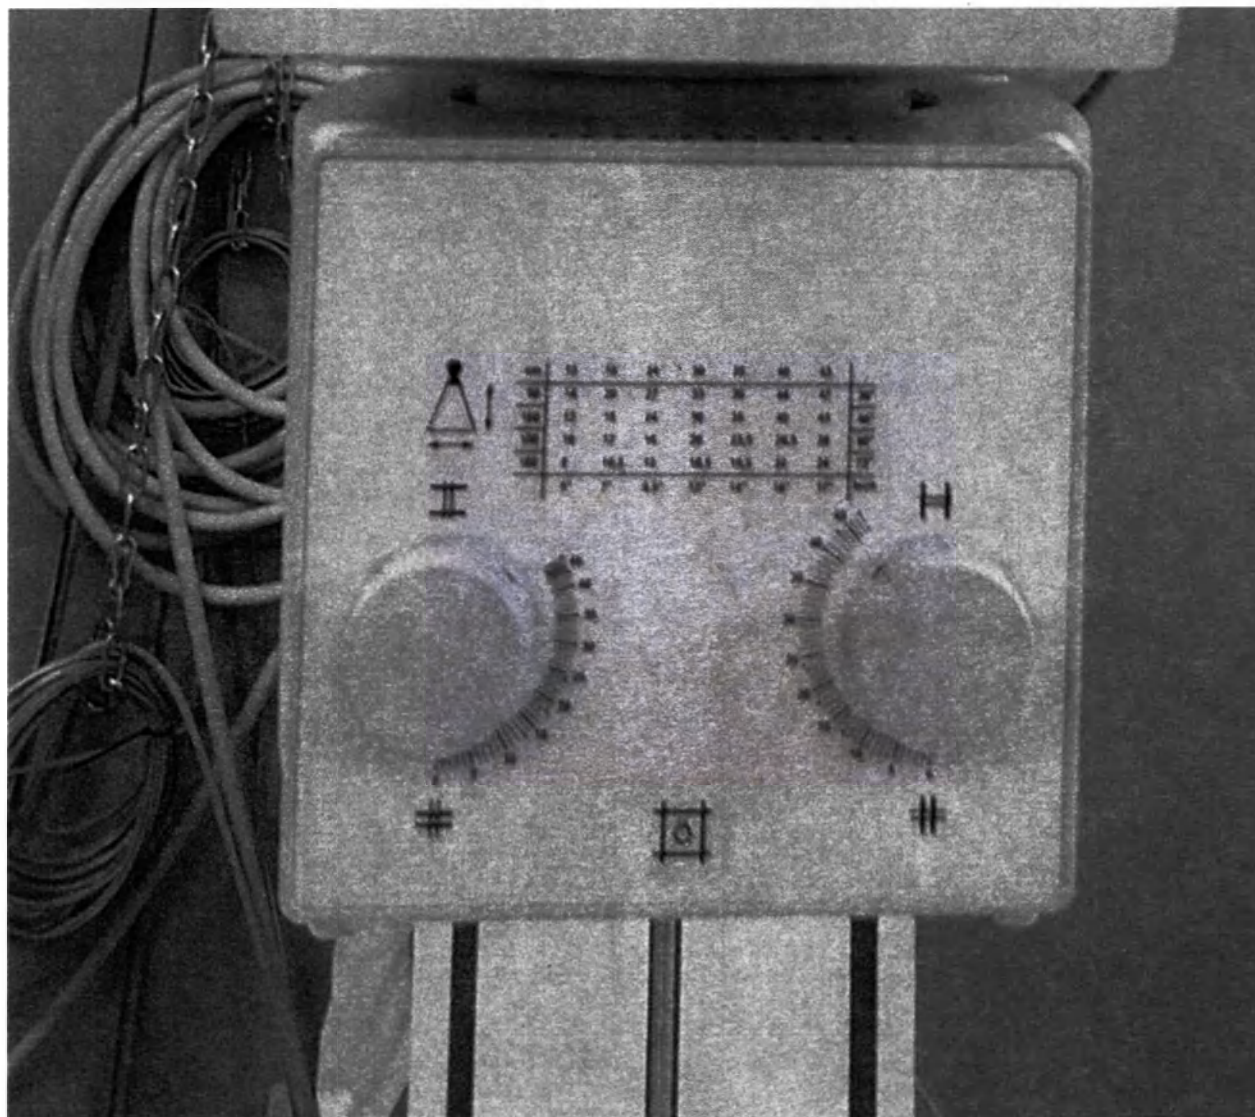

Фотография 17 – Коллиматор серии Ralco R (вариант внешнего вида)



а) - Пример маркировки коллиматора серии R 302/A DHHS



б) - Пример маркировки коллиматора серии R 221/A DHHS



в) - Пример маркировки коллиматора серии R 225 ACS DHHS



г) - Пример маркировки коллиматора серии CRUX

Фотография 18 – Примеры маркировки коллиматоров




Фотография 19 – Стол пациента RTOMO-1100, по спецификации, включающей стол снимков, в варианте комплектности со столом снимков серии TOMOC




Фотография 20 – Пример маркировки стола пациента RTOMO-1100




Фотография 21 – Система позиционирования рентгеновская согласно п.4.1 таблицы комплектности ТУ (вариант внешнего вида)

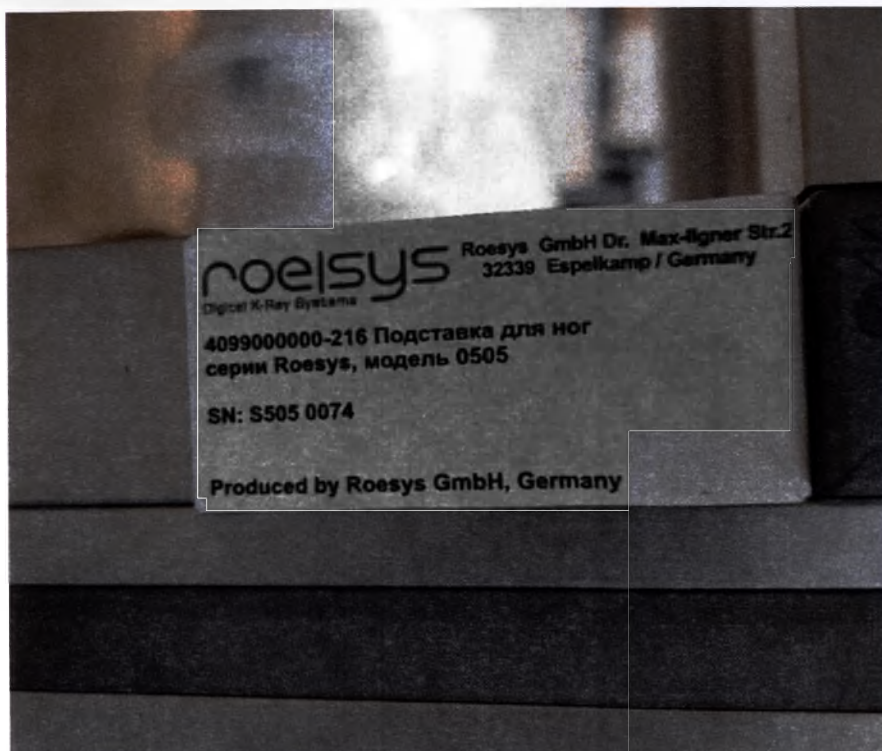

Фотография 22 – Пример маркировки системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой для ног серии Roesys 0505

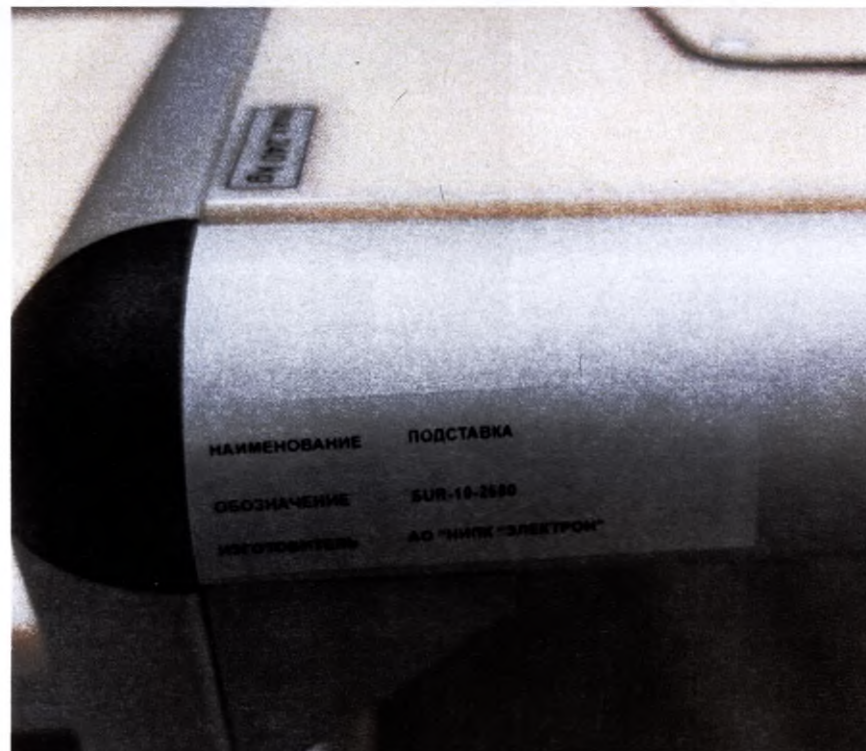


Фотография 23 – Пример маркировки системы позиционирования рентгеновской по спецификации, включающей вариант комплектности с подставкой SUR-10-2680

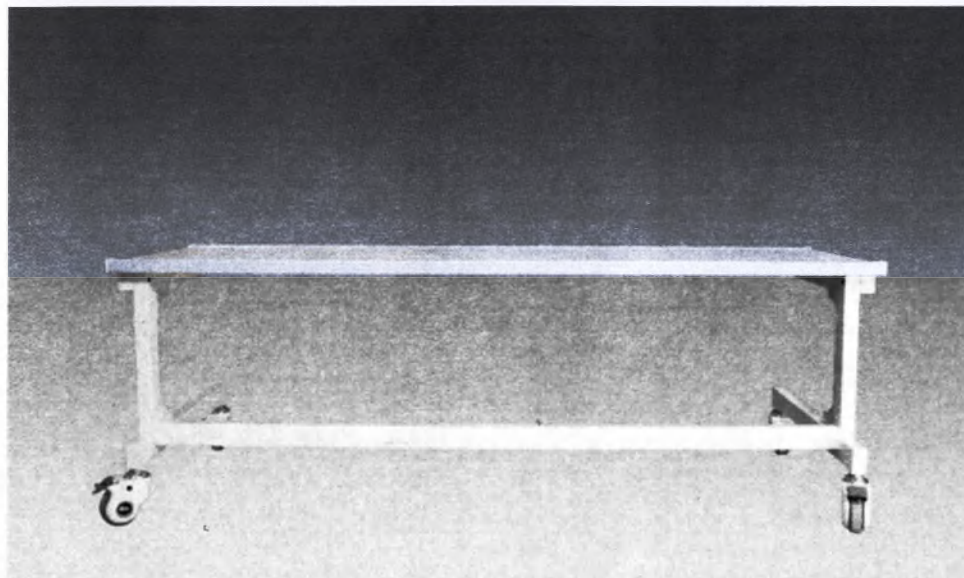

Фотография 24 – Стол пациента по спецификации, в варианте комплектности со Столом-каталкой серии SUR-10



а) - Пример маркировки стола-каталки серии SUR-10

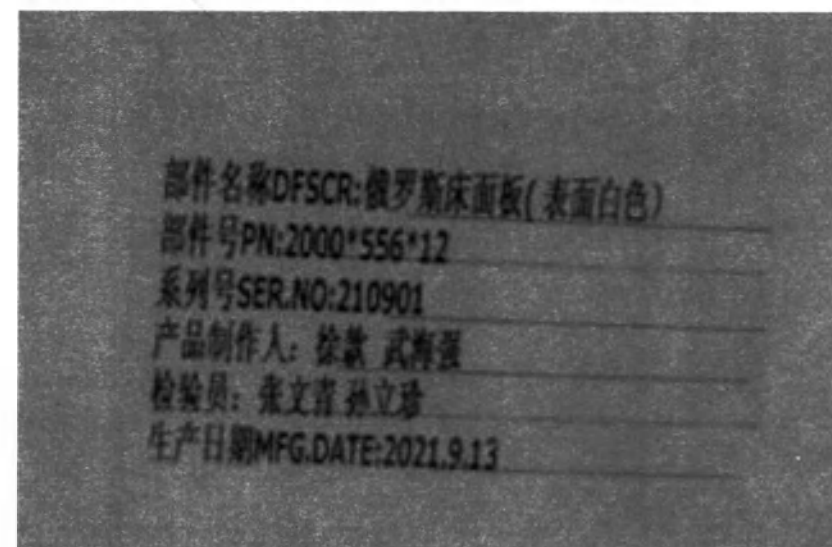


б) - Пример маркировки стола-каталки серии DFSCR

Фотография 25 – Примеры маркировки столов-каталок




Фотография 26 – Рентгеновское питающее устройство XRPS по спецификации (вариант внешнего вида)

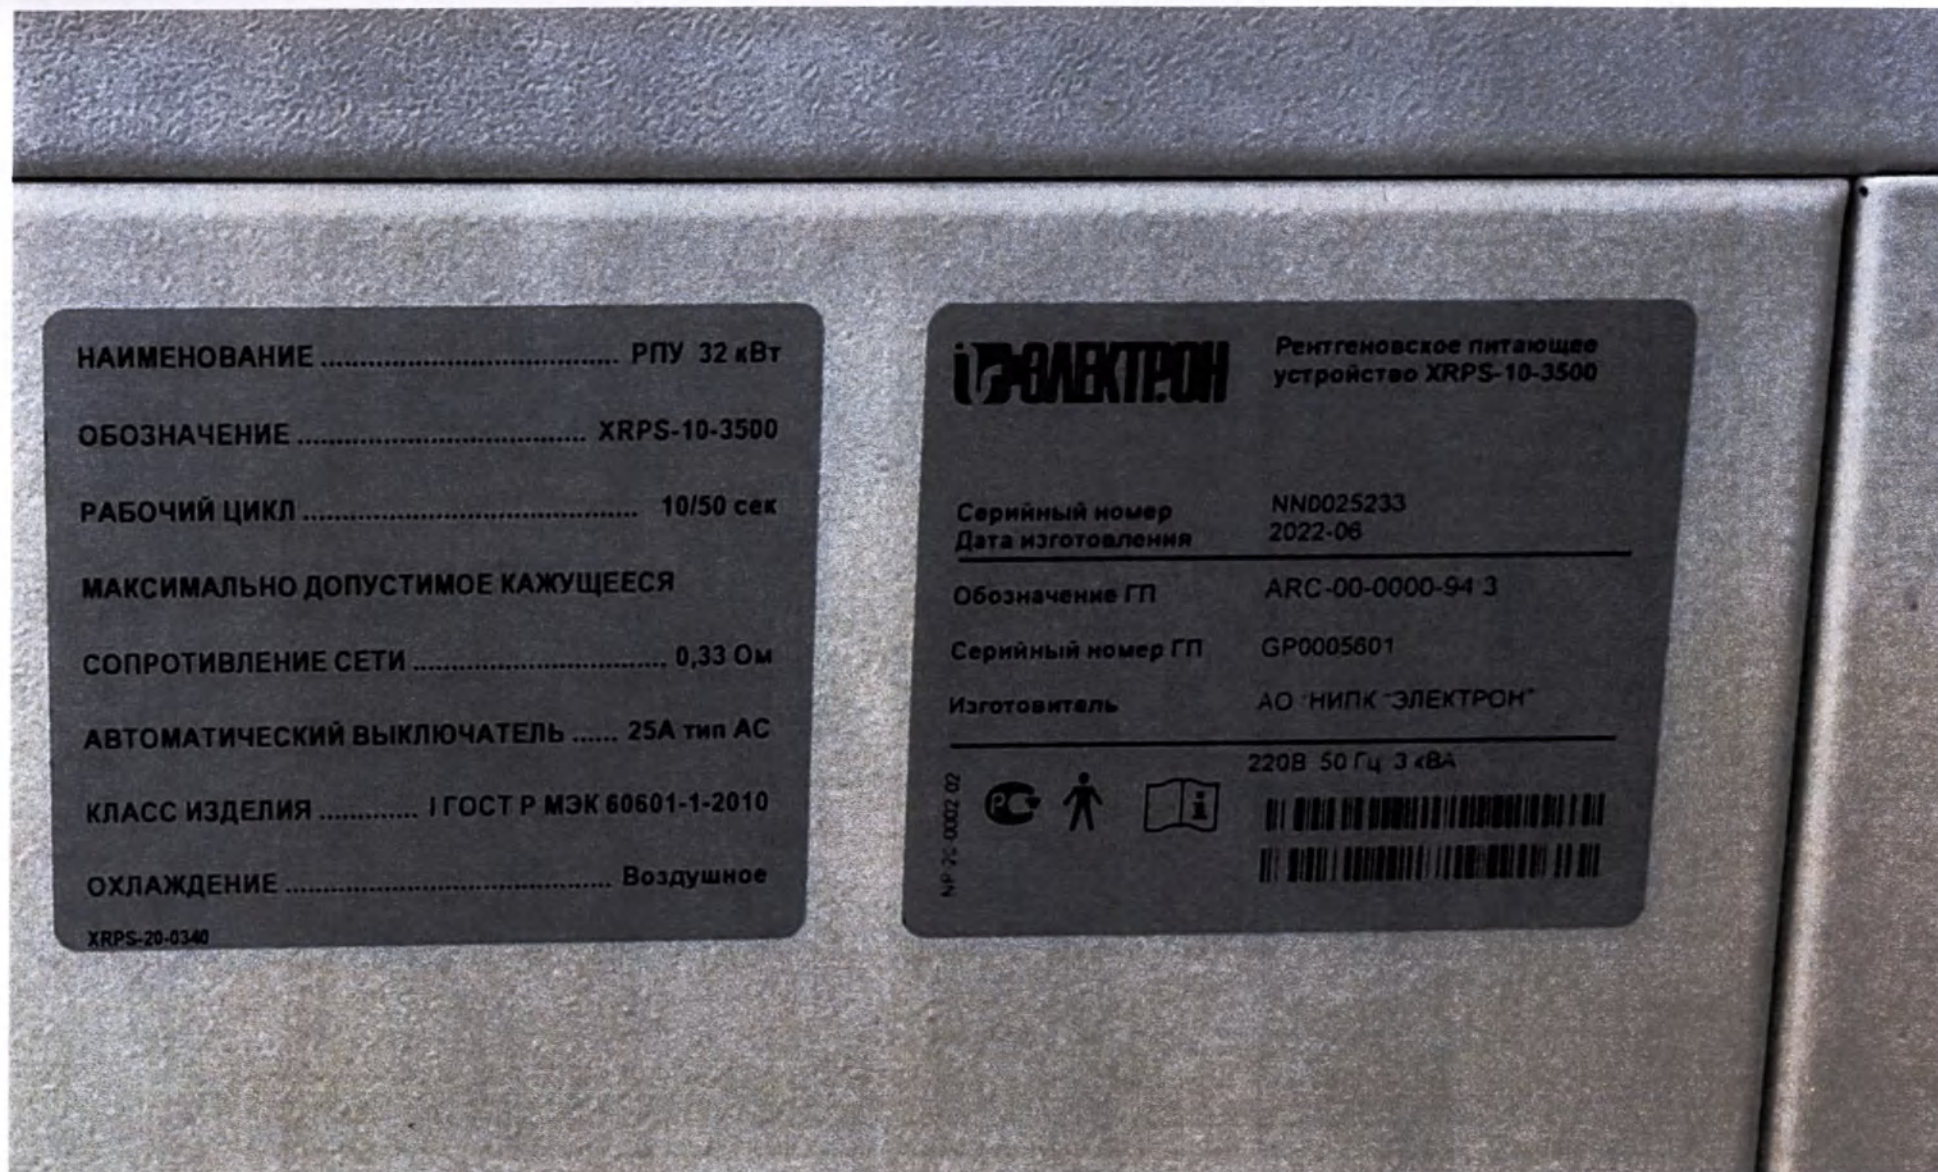

Фотография 27 – Пример маркировки. Рентгеновское питающее устройство XRPS



Фотография 28 – Кабель высоковольтный с комплектом монтажных частей согласно п.5.1.2 ТУ в варианте комплектования кабелем высоковольтным с комплектом монтажных частей серии Wanbo

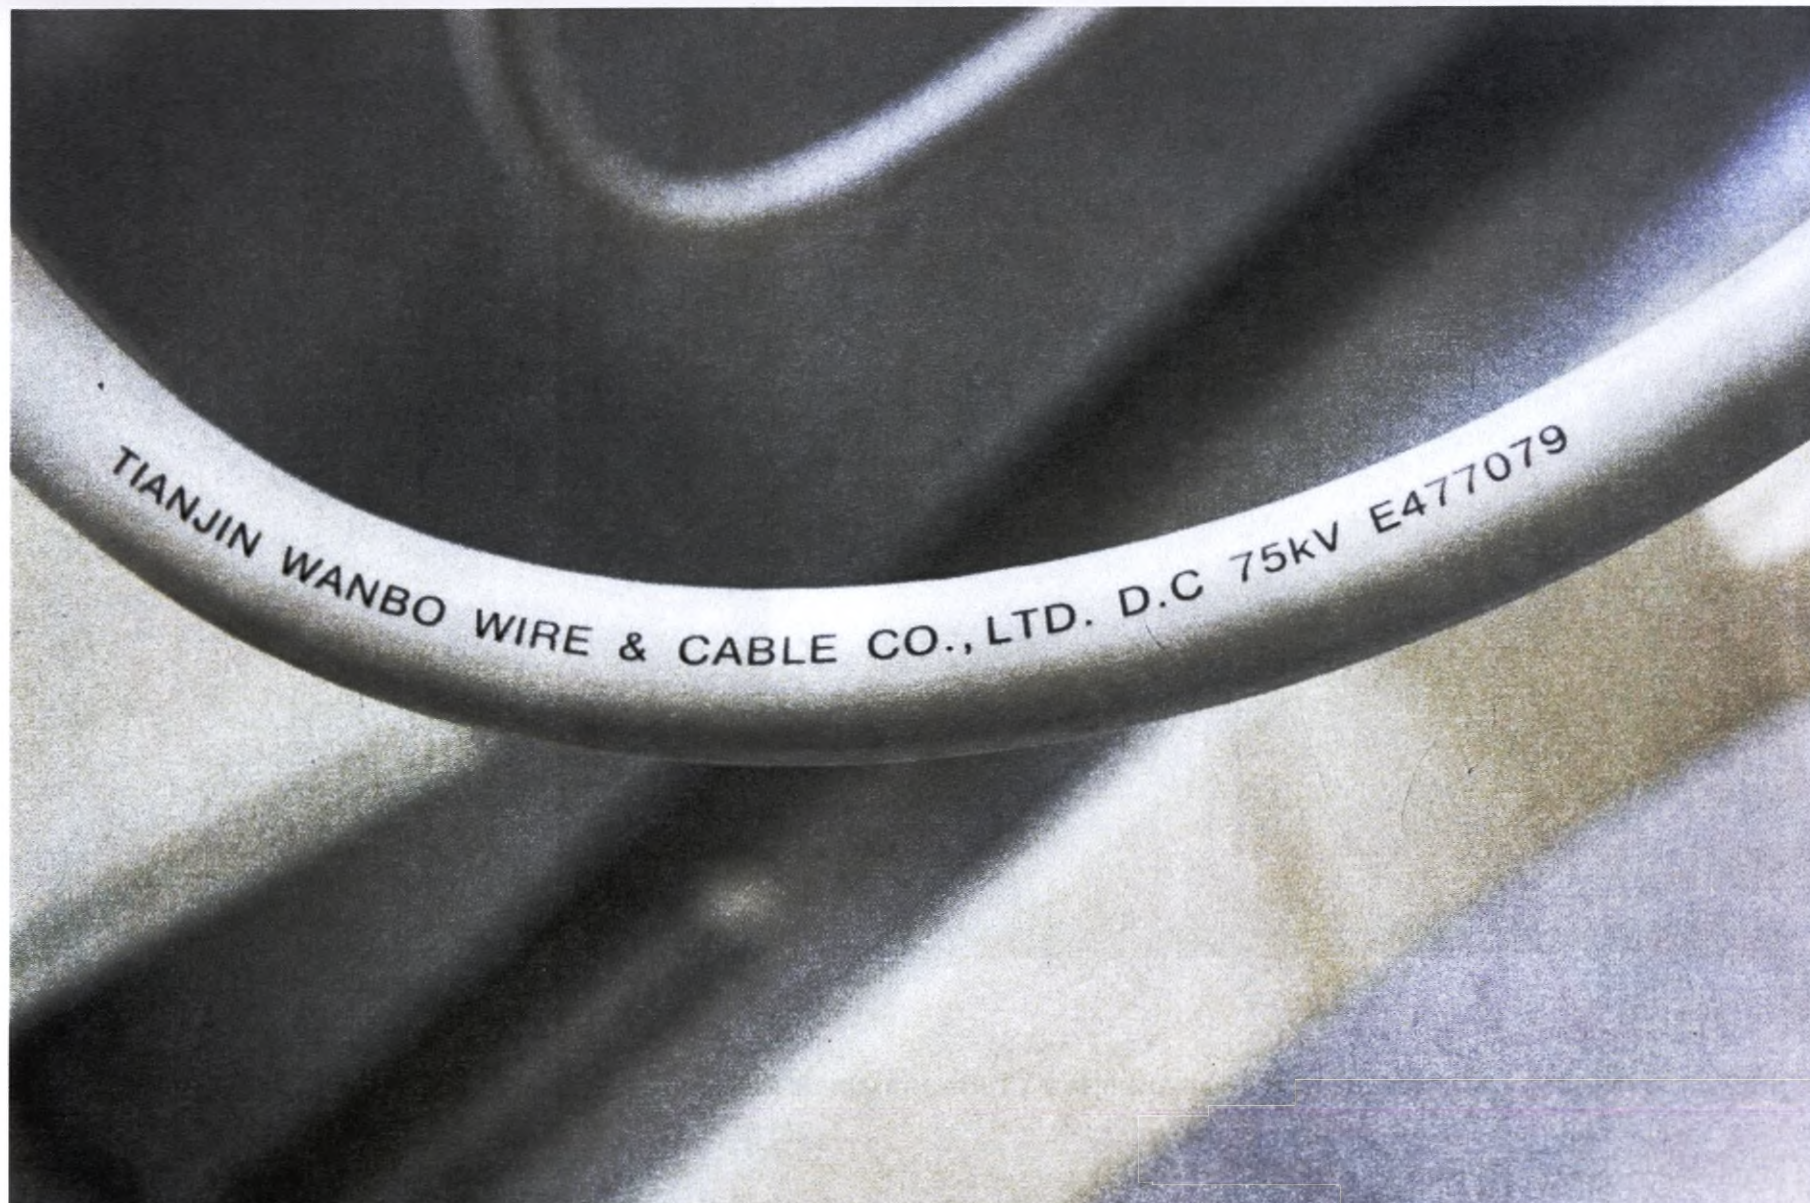


Фотография 29 – Пример варианта маркировки кабеля высоковольтного




Фотография 30 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии АСН



Фотография 31 – Стабилизатор согласно п.5.2 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования стабилизатором серии СНЭ (вариант внешнего вида)

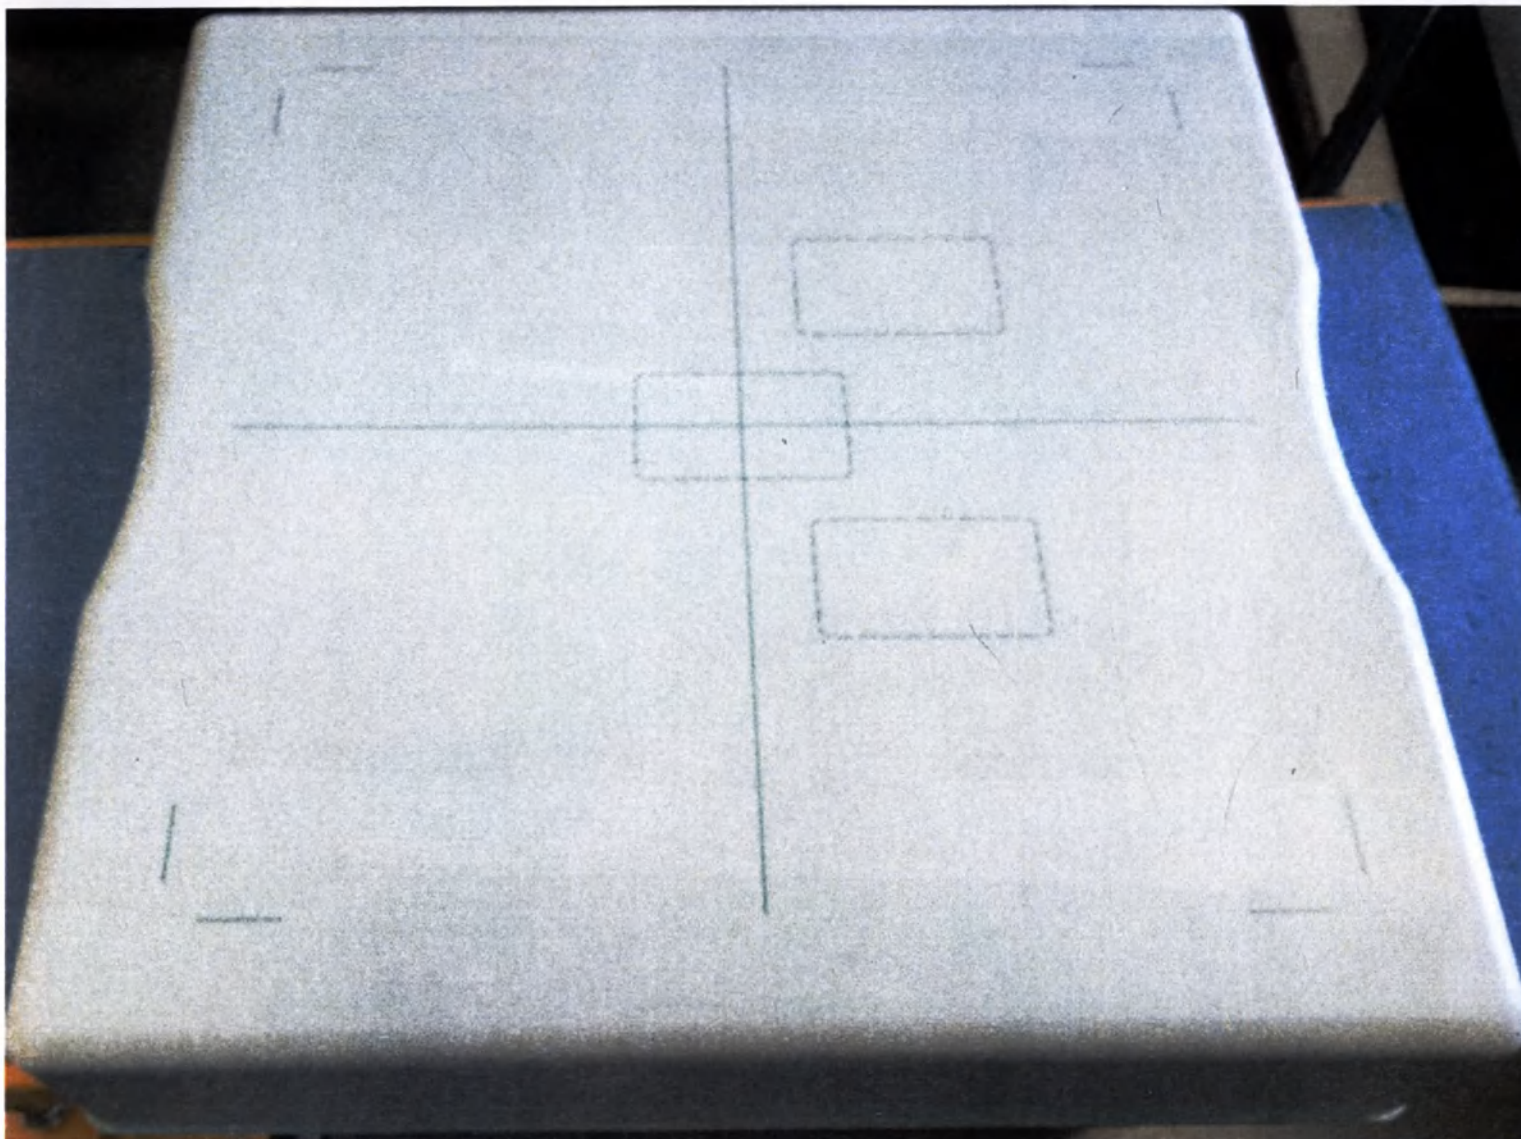


**Фотография 32 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования
Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон»
(вариант внешнего вида для комплектования на Стойку)**

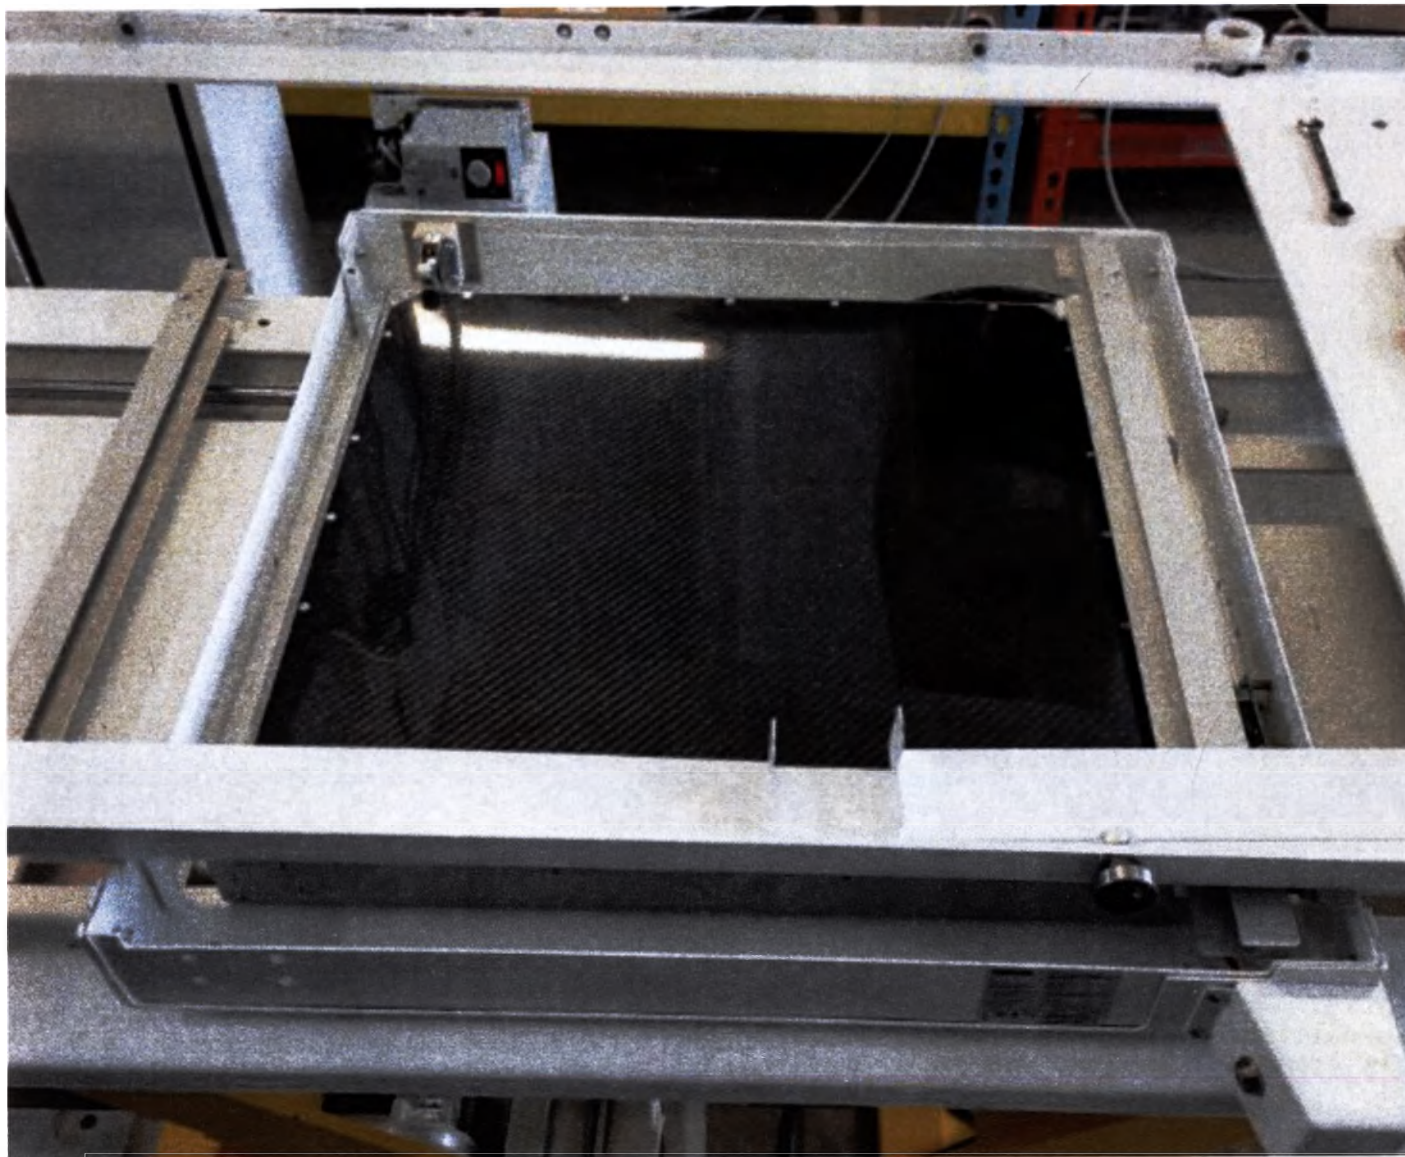

Фотография 33 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)



а) вид спереди

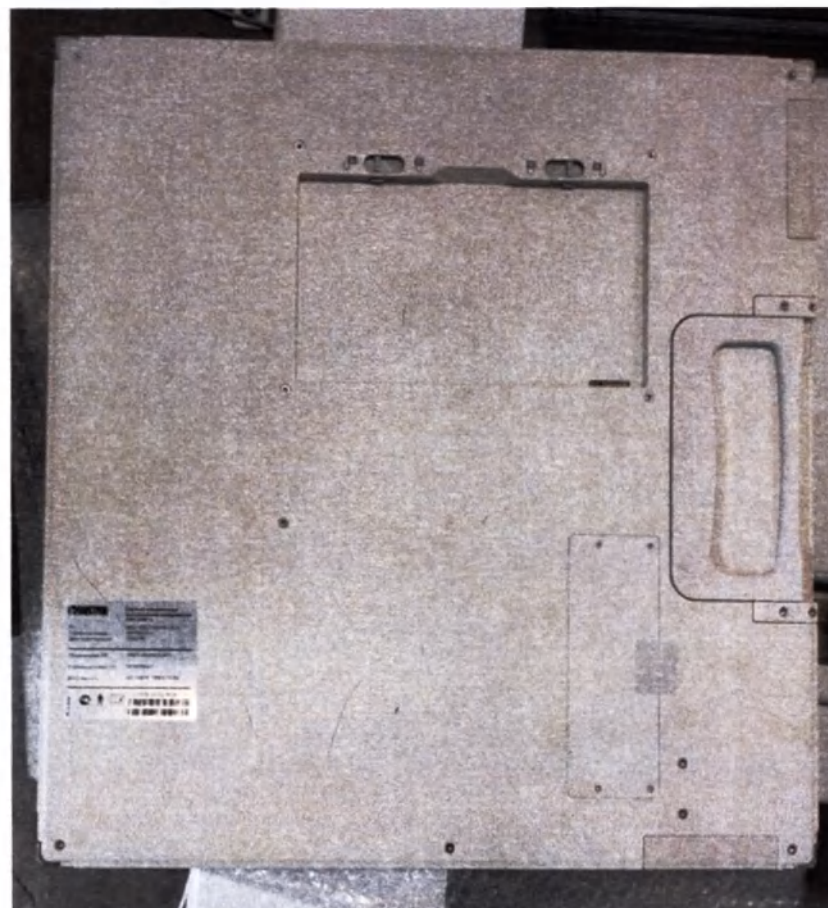

б) вид сзади

Фотография 34 – Камера согласно п.6 таблицы комплектности ТУ в варианте комплектования Система визуализации рентгеновских изображений СВР, ТУ 9442-039-11150760-2015, РУ № ФСР 2016/5112, АО «НИПК «Электрон» (с функцией wi-fi, вариант внешнего вида для комплектования в Стол пациента)

ЭЛЕКТРОН

Система визуализации
рентгеновских изображений
СВР (СВР 4)

ТУ
Серийный номер
Дата изготовления

9442-039-11150760-2015
NN1461273
2022-06

Обозначение ГП

ARC1-00-0000-94.3

Серийный номер ГП

GP0005601

Изготовитель

АО "НИПК "ЭЛЕКТРОН"


NP-20-0006



~220 В, 50 Гц, 60 Вт



Фотография 35 – Пример варианта маркировки. Система визуализации рентгеновских изображений СВР

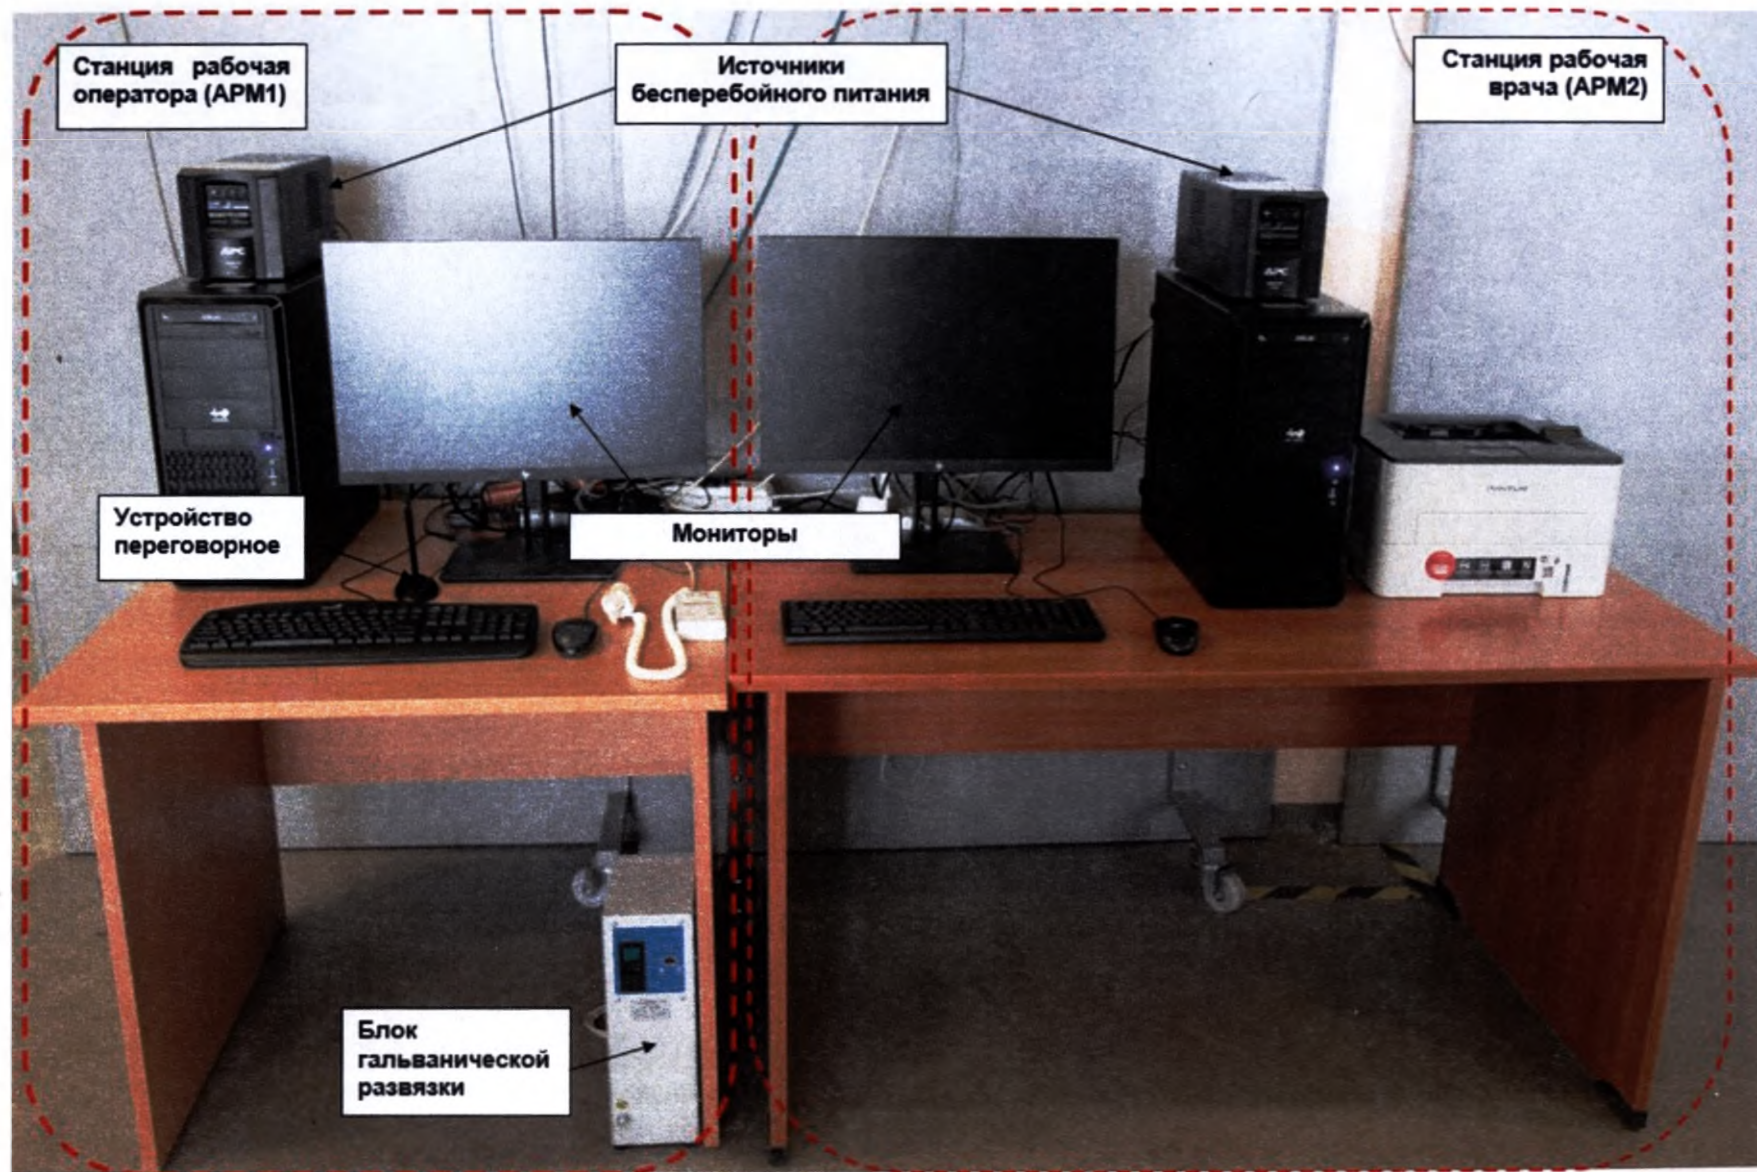

Фотография 36 – Рентгенодиагностический программно-аппаратный комплекс (РПАК) в составе CWS по спецификации АО «НИПК «Электрон».
Вариант общего вида.



Фотография 37 – Станция рабочая оператора/ рентген-лаборанта (АРМ1). Пример маркировки.



Фотография 38 – Станция рабочая врача-рентгенолога (АРМ2). Пример маркировки.




Фотография 39 – Станция рабочая регистратора (АРМ3) (вариант внешнего вида)



Фотография 40 – Монитор Jusha серии R. Пример маркировки.



Фотография 41 – Монитор Jusha серии C. Пример маркировки.

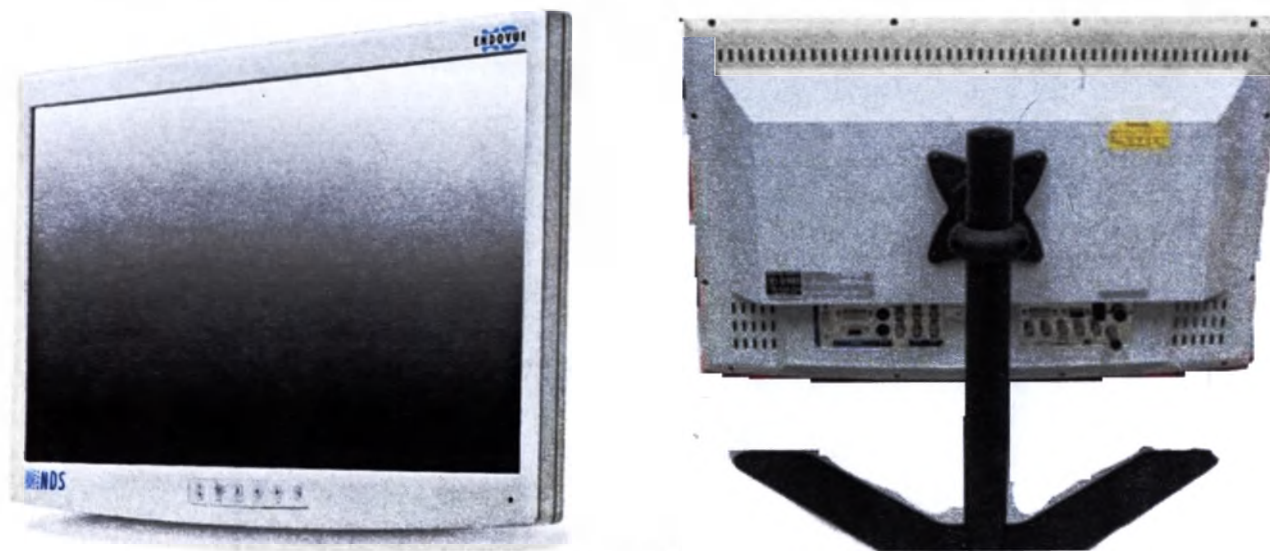

Фотография 42 – Монитор серии Endovue (вариант внешнего вида)



Фотография 43 – Монитор серии Radiance (вариант внешнего вида)



Фотография 44 – Монитор серии ProLite. Пример маркировки.



Фотография 45 – Монитор серии RadiForce. Пример маркировки.



Фотография 46 – Монитор серии Dell. Пример маркировки.



Фотография 47 – Монитор серии NEC. Пример маркировки.



Фотография 48 – Монитор серии NEC. Пример маркировки.



Фотография 49 – Монитор серии HP. Пример маркировки.



Фотография 50 – Источник бесперебойного питания Eaton. Пример маркировки.



Фотография 51 – Источник бесперебойного питания APC (вариант внешнего вида)



Фотография 52 – Источник бесперебойного питания APC. Пример маркировки.




Фотография 53 – Блок гальванической развязки ТРО – 600 МИ (вариант внешнего вида)




Фотография 54 – Блок гальванической развязки ТРО – 600 МИ. Пример маркировки




Фотография 55 – Блок гальванической развязки ТРО-600 М (вариант внешнего вида)

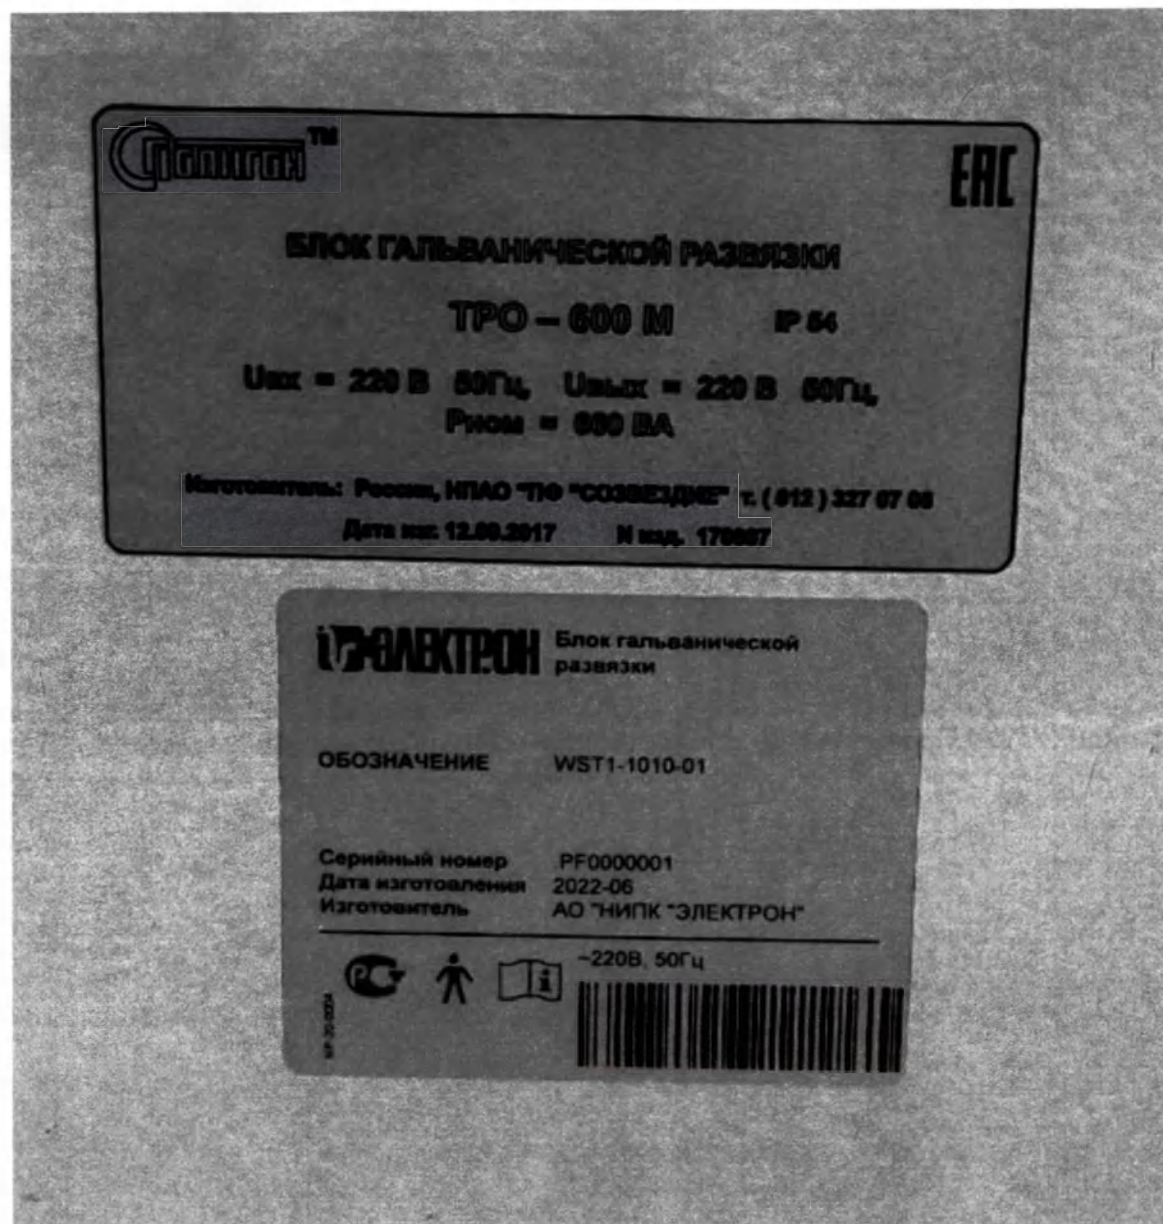

Фотография 56 – Блок гальванической развязки WST1-10. Пример маркировки

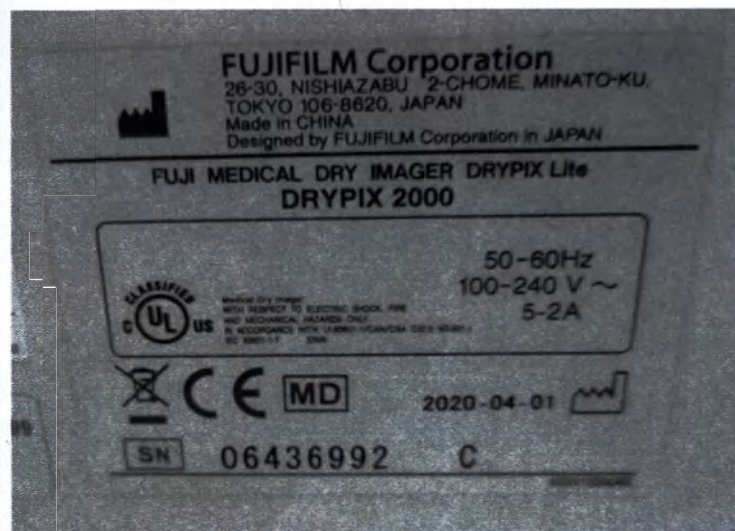


Фотография 57 – Камера медицинская термографическая мультформатная серии DRYPIX. Пример маркировки

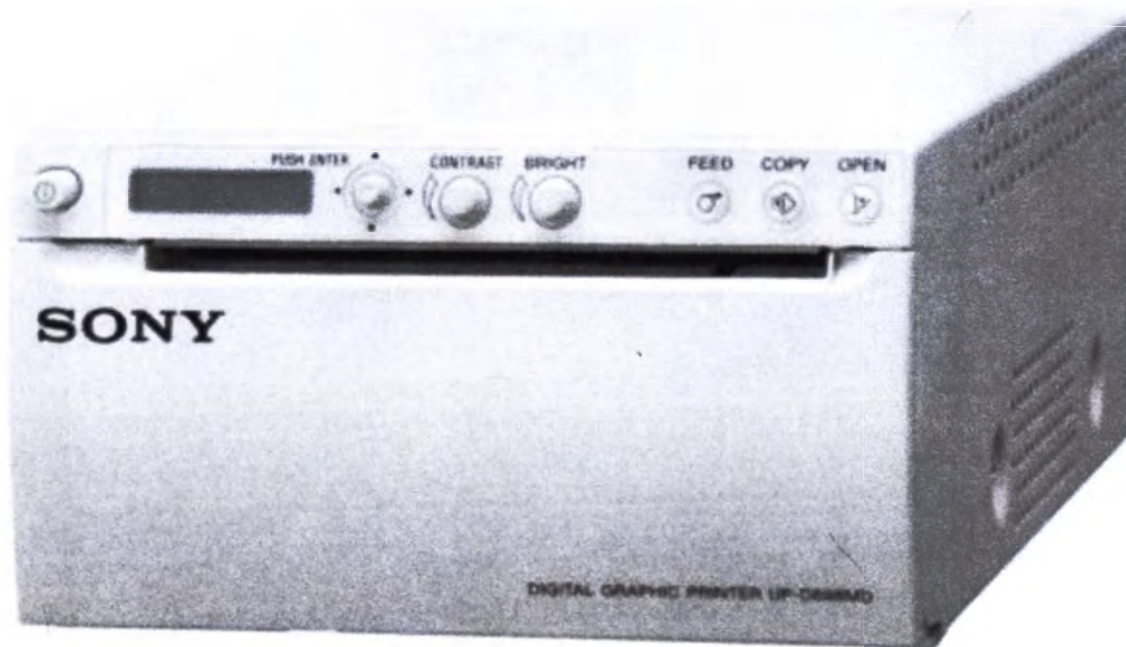

Фотография 58 – Устройство для печати медицинских изображений, серии UP



Фотография 59 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYVIEW для печати медицинских изображений

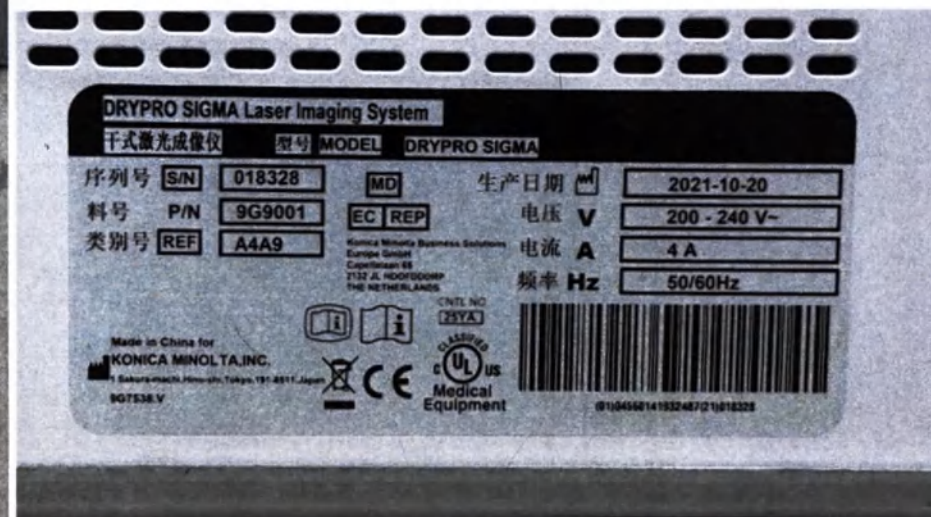

Фотография 60 – Камера лазерная мультиформатная серии DRYPRO (с маркировкой)



Фотография 61 – Камера мультиматная термографическая серии Drystar



Фотография 62 – Дополнительное оснащение. Дозиметр серии ДРК (вариант внешнего вида)



а) Вариант исполнения по спецификации СП-815



б) Вариант исполнения по спецификации СП-815

Фотография 63 – Стойка приборная (варианты внешнего вида)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 57
Пятьдесят семь лист(ов)

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
СЕРТИФИКАЦИИ
ДЕКИСОВА О.А.
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

