



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СОЛТ»

В.В. Заяц

« 20 » ноября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор полуавтоматический мочевой URIT-560

производства

URIT Medical Electronic Co., Ltd. (УРИТ Медикал Электроник Ко., Лтд.), Китай

Наименование и состав медицинского изделия:

Анализатор полуавтоматический мочевой URIT-560, в составе:

1. Основной блок анализатора URIT-560 – 1 шт.
2. Тест-полоски проверочные – 2 шт.
3. Термобумага для печати – 1 шт.
4. Блок питания сети – 1 шт.
5. Стилус – 1 шт.
6. Ключ от передней крышки – 1 шт.
7. Контейнер для использованных тест-полосок – 1 шт.
8. Кабель питания – 1 шт.
9. Этикетка качества – 1 шт.
10. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
11. Руководство по техническому обслуживанию - 1 шт. (при необходимости)

**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия,
его составляющих и комплектующих**

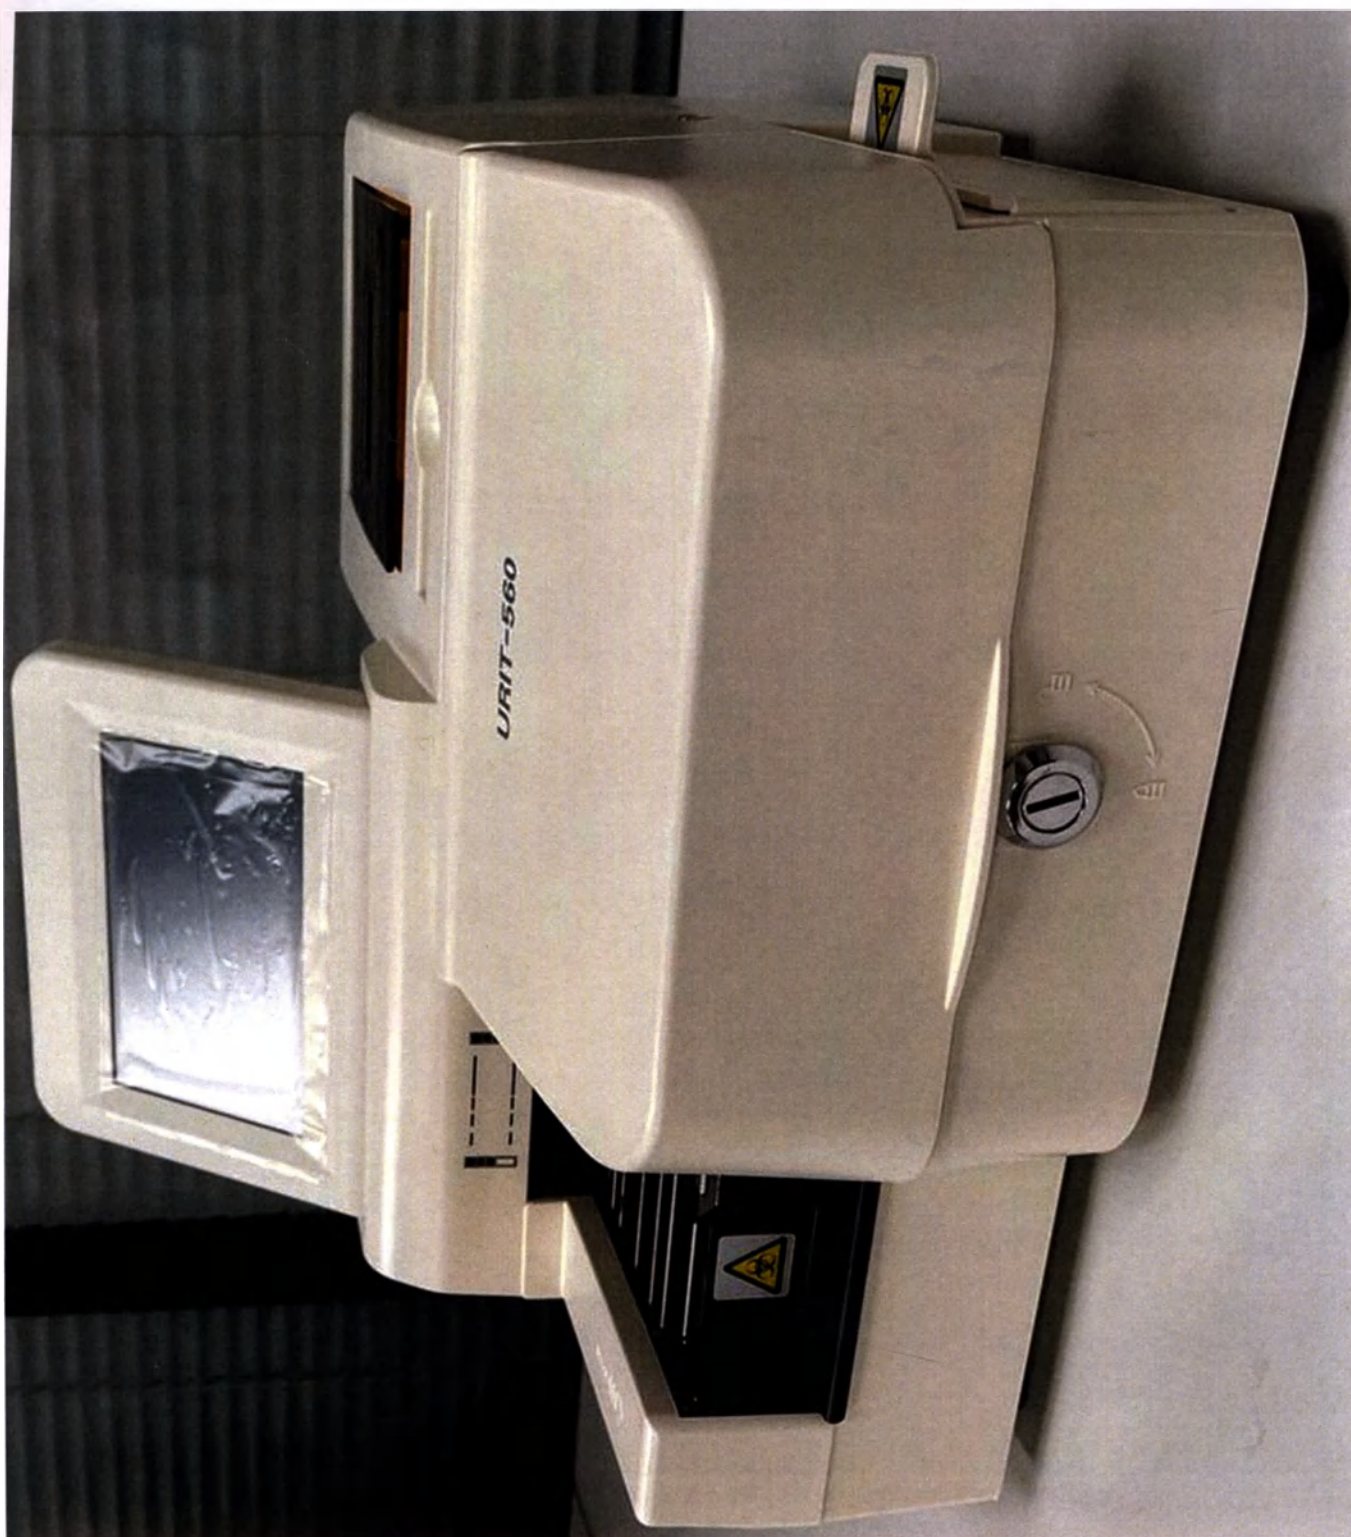


Рисунок 1 – Анализатор. Общий вид



Рисунок 2 – Анализатор. Вид спереди с открытой передней крышкой и открытой крышкой термопринтера

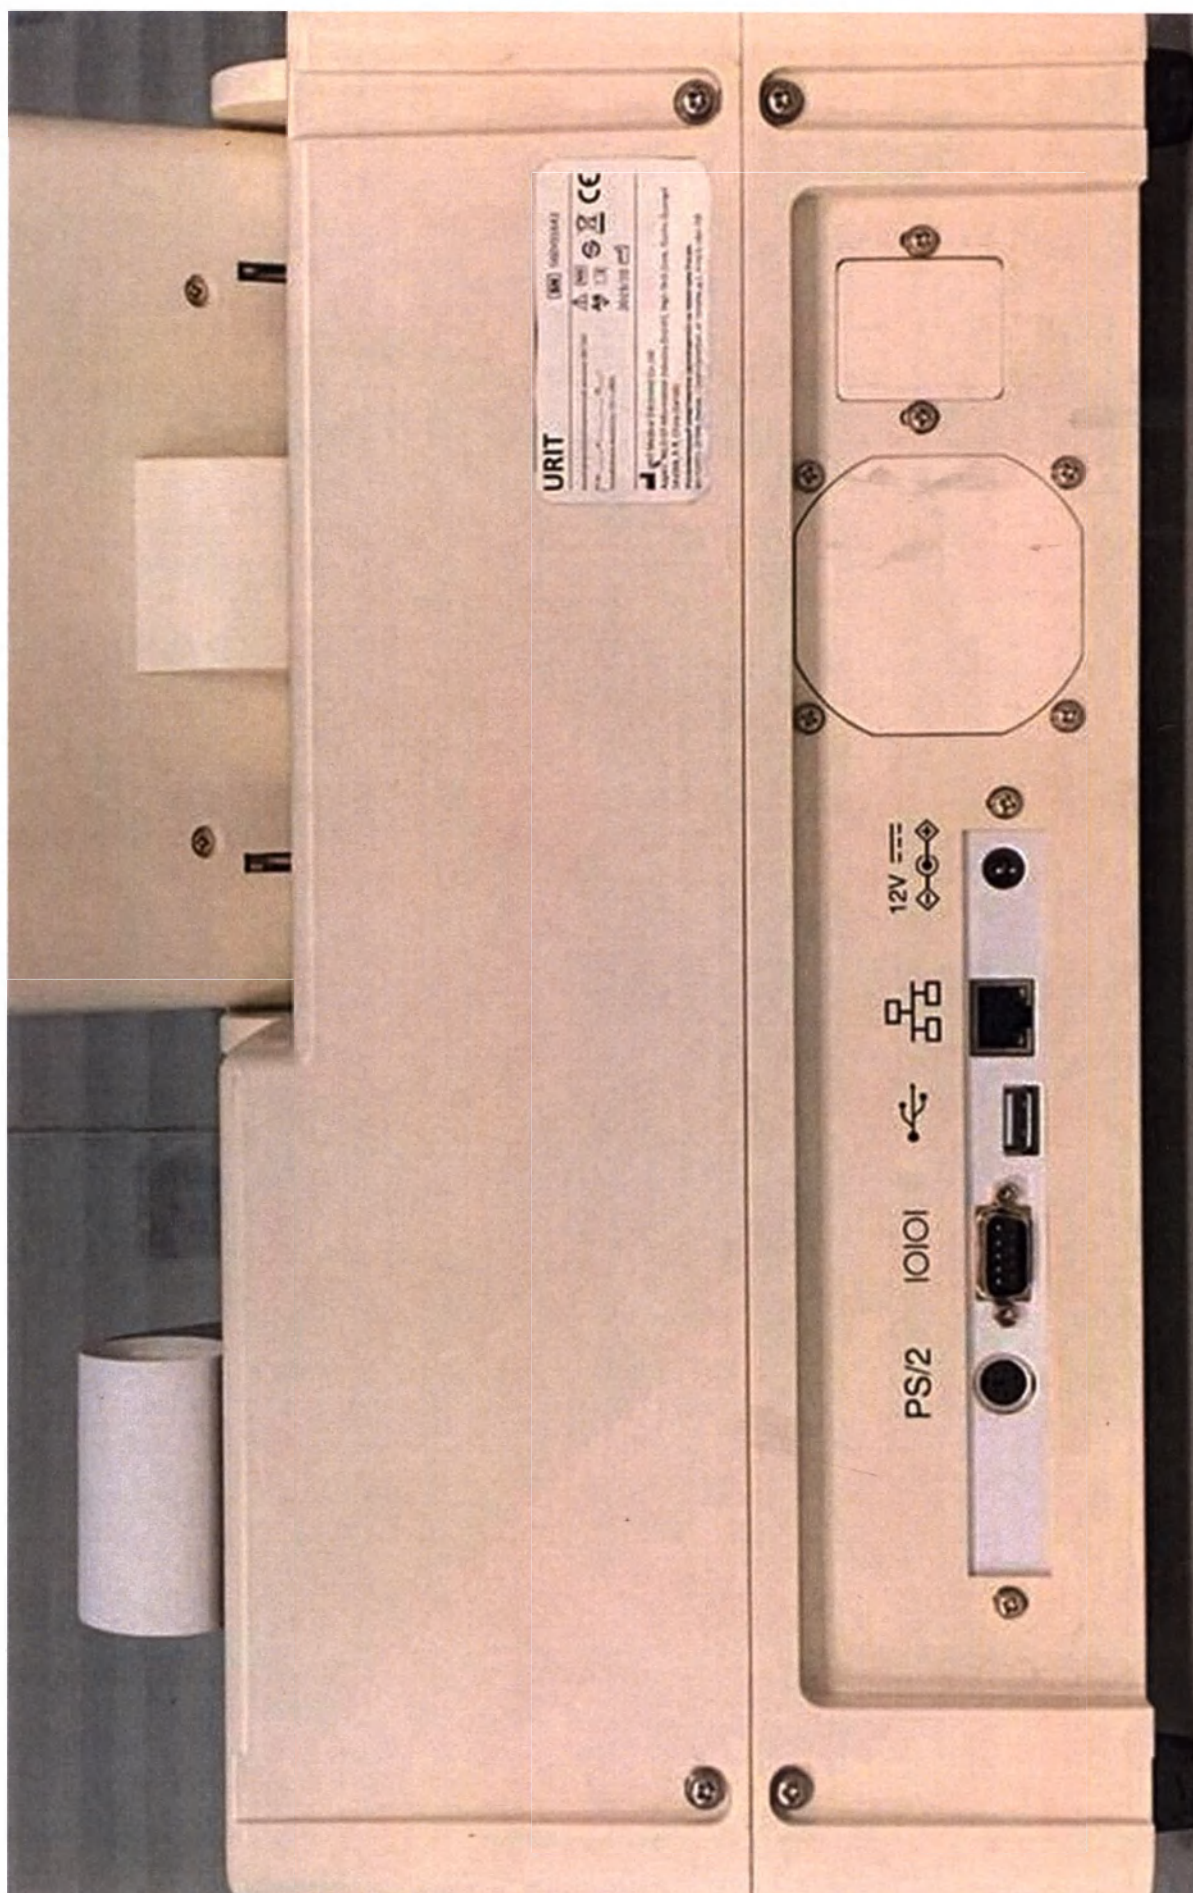


Рисунок 3 – Анализатор. Вид сзади

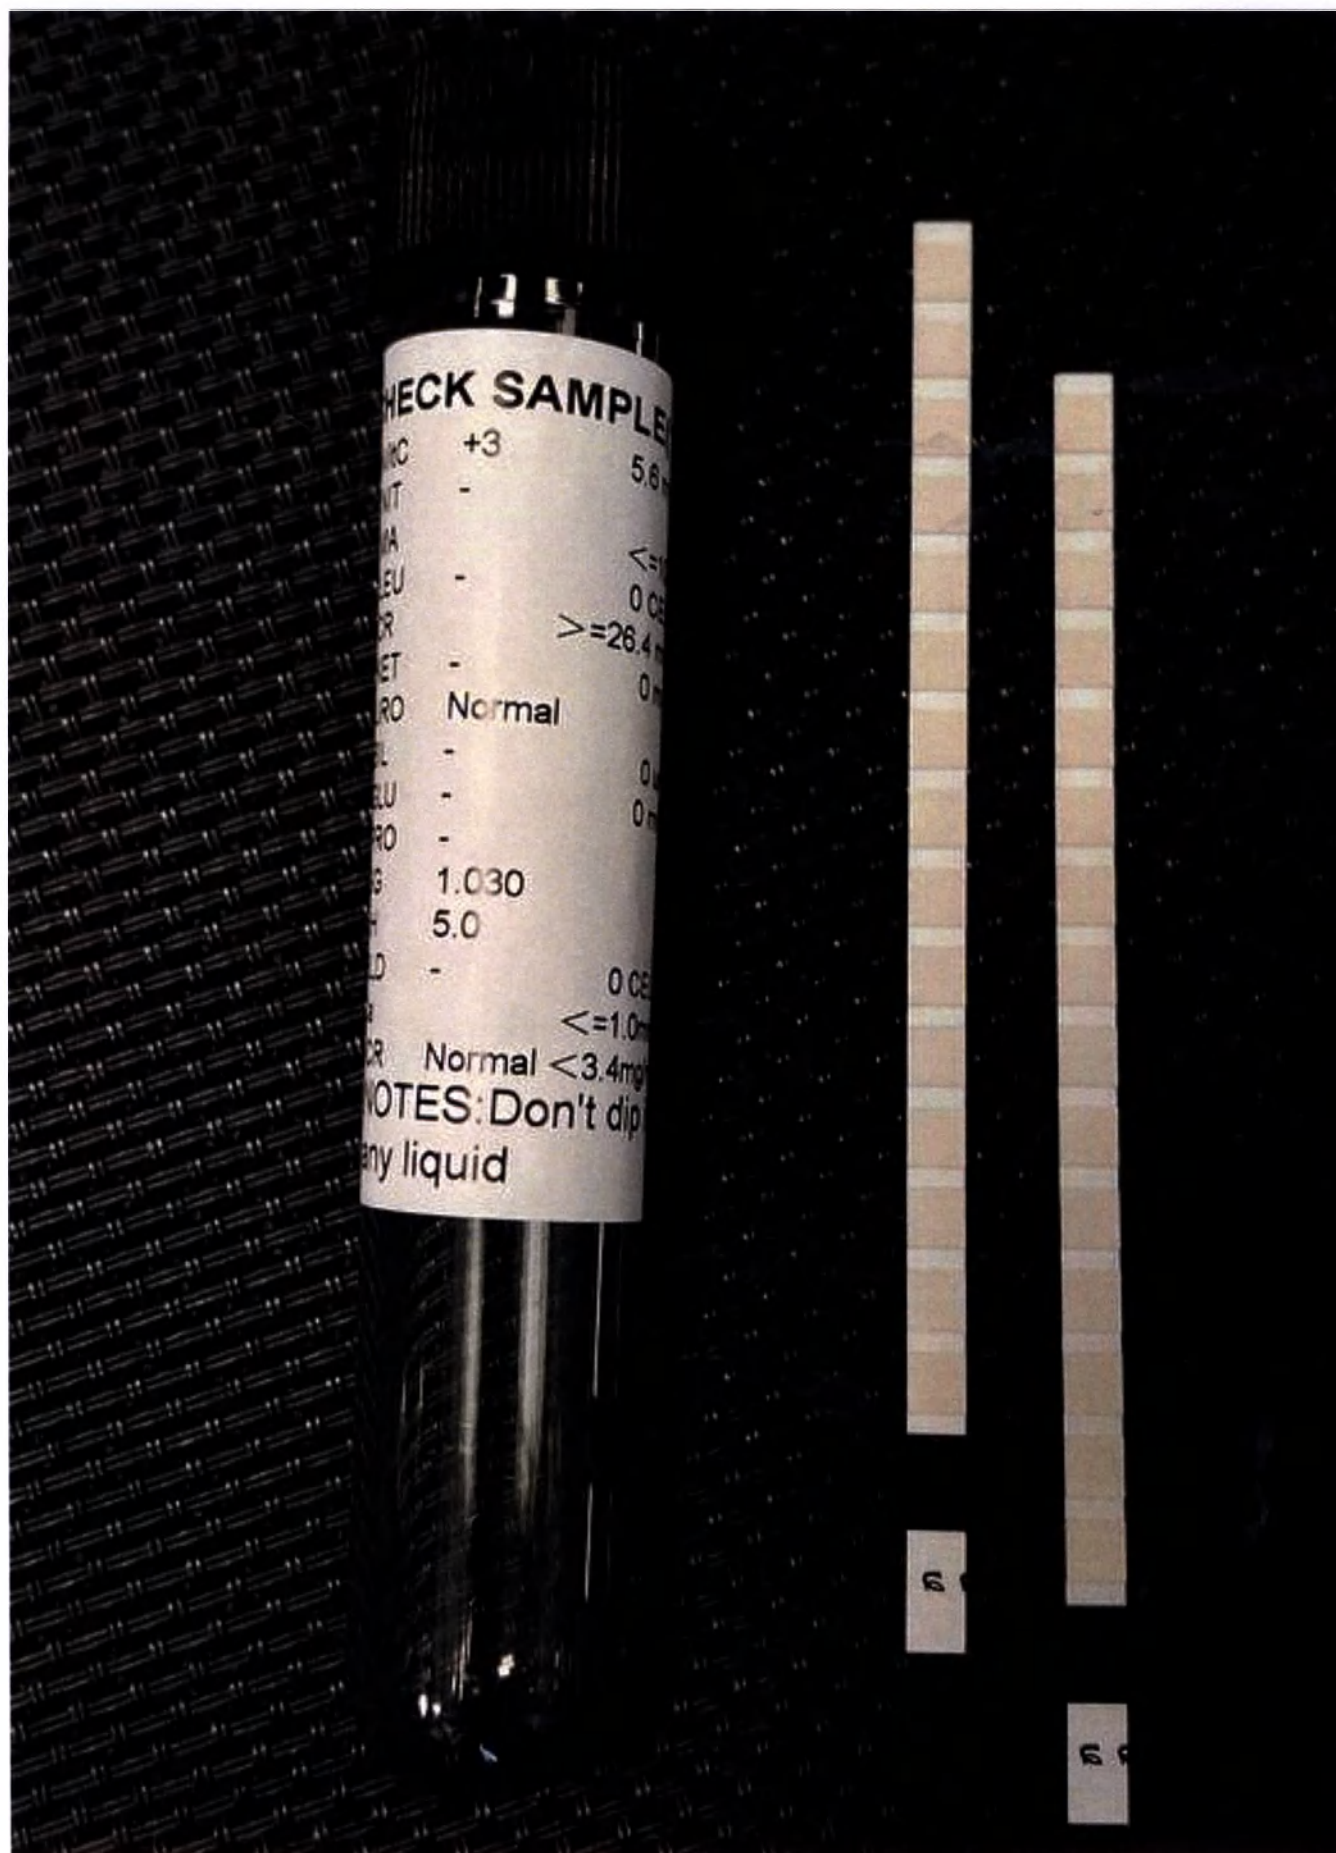


Рисунок 4 – Тест-полоски проверочные



Рисунок 5 – Термобумага для печати



Рисунок 6 – Блок питания сети



Рисунок 7 – Стилус



Рисунок 8 – Ключ от передней крышки

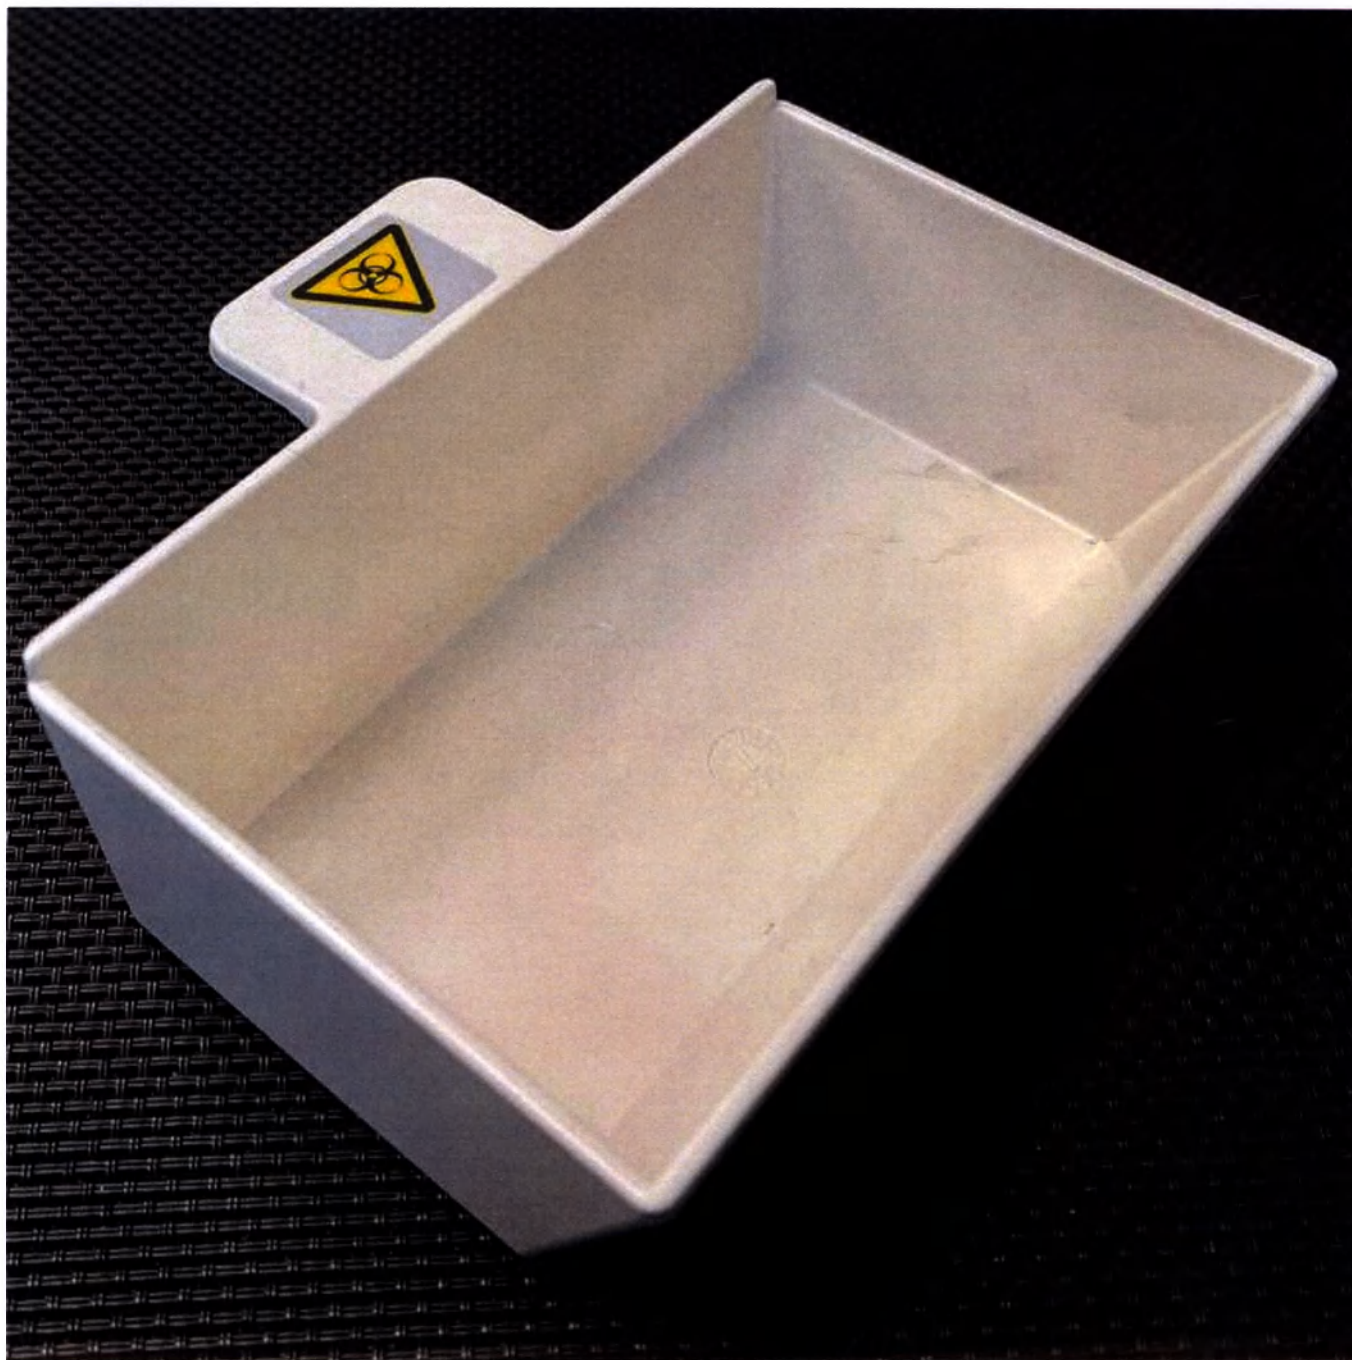


Рисунок 9 – Контейнер для использованных тест-полосок



Рисунок 10 – Кабель питания


URIT

SN 560Y01642

Анализатор полуавтоматический мочевой URIT-560

РУ № _____ от _____ 20 ____ г.

Потребляемая мощность: 12V ~ 48VA

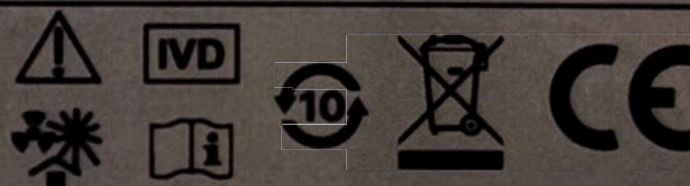

2023/10



URIT Medical Electronic Co.,Ltd.

Адрес: No.D-07 Information Industry District, High-Tech Zone, Guilin, Guangxi
541004, P. R. China (Китай)

Уполномоченный представитель производителя на территории России:

АО «СОЛТ», 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.3, литер Б, офис 308

Рисунок 11 – Этикетка анализатора



Рисунок 12 – Маркировка транспортной упаковки анализатора



Рисунок 12.1 – Маркировка транспортной упаковки анализатора

Прошито и скреплено печатью
на 15 листах
Генеральный директор
АО «СОЛТ»
Заяц В.В.

