

**УТВЕРЖДАЮ**



Генеральный директор  
АО «СОЛТ»  
В.В. Заяц  
2021 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Индикаторные полоски для анализа мочи для анализатора автоматического мочевого  
сухой химии С-1800, в вариантах исполнения: URIT 11 FA, URIT 12 FA, URIT 14 FA,**



**производства**

**URIT Medical Electronic Co., Ltd. (УРИТ Медикал Электроник КО., ЛТД), Китай.**


## Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 11 FA

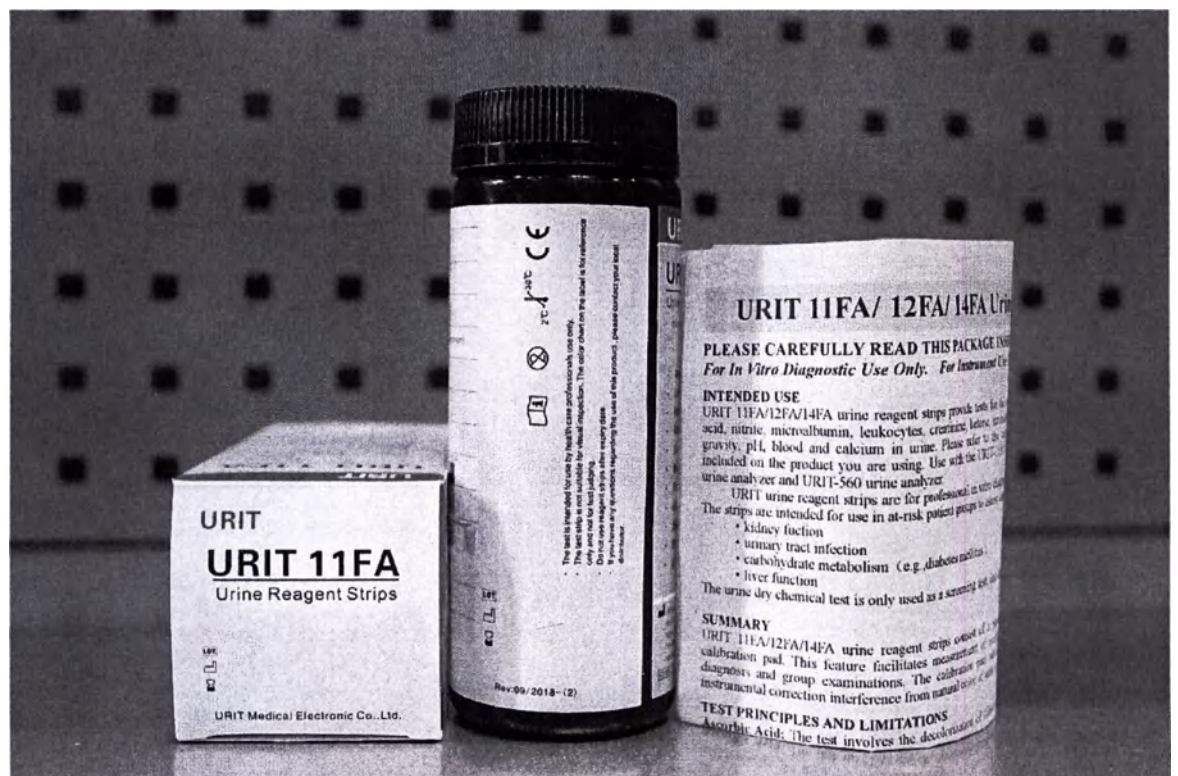

## Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 12 FA

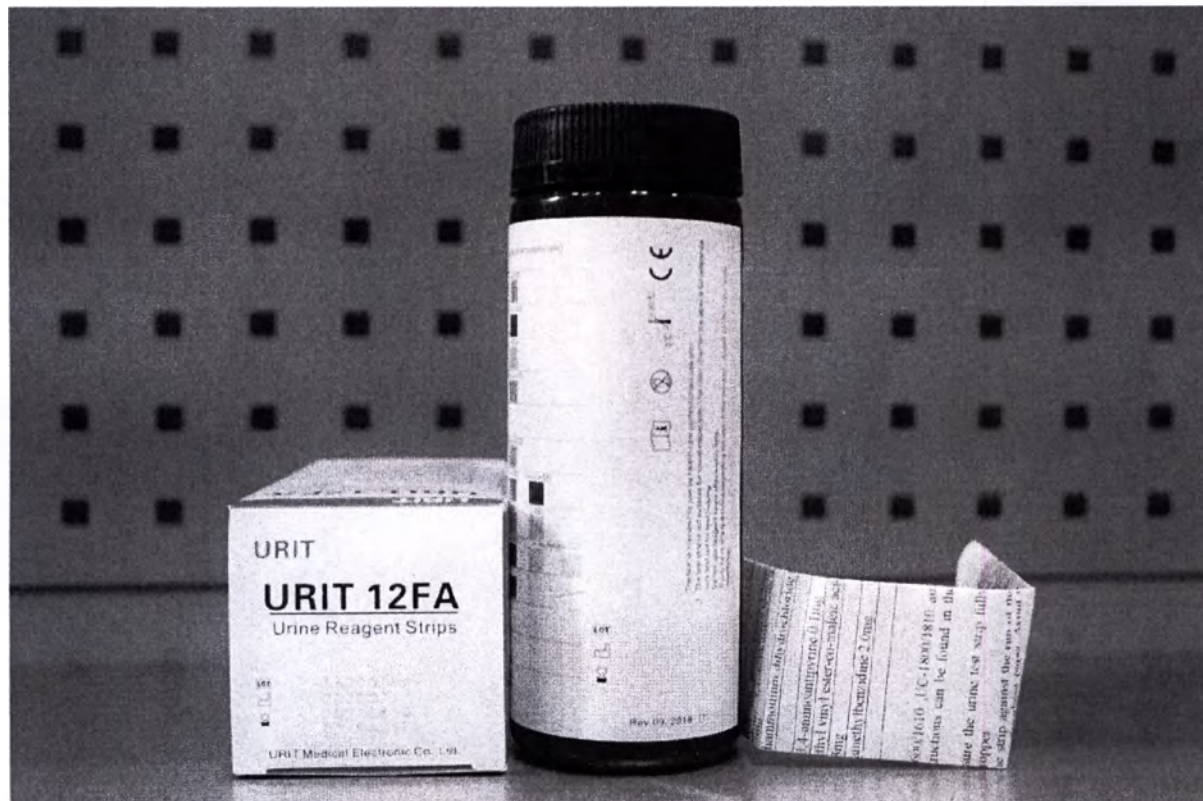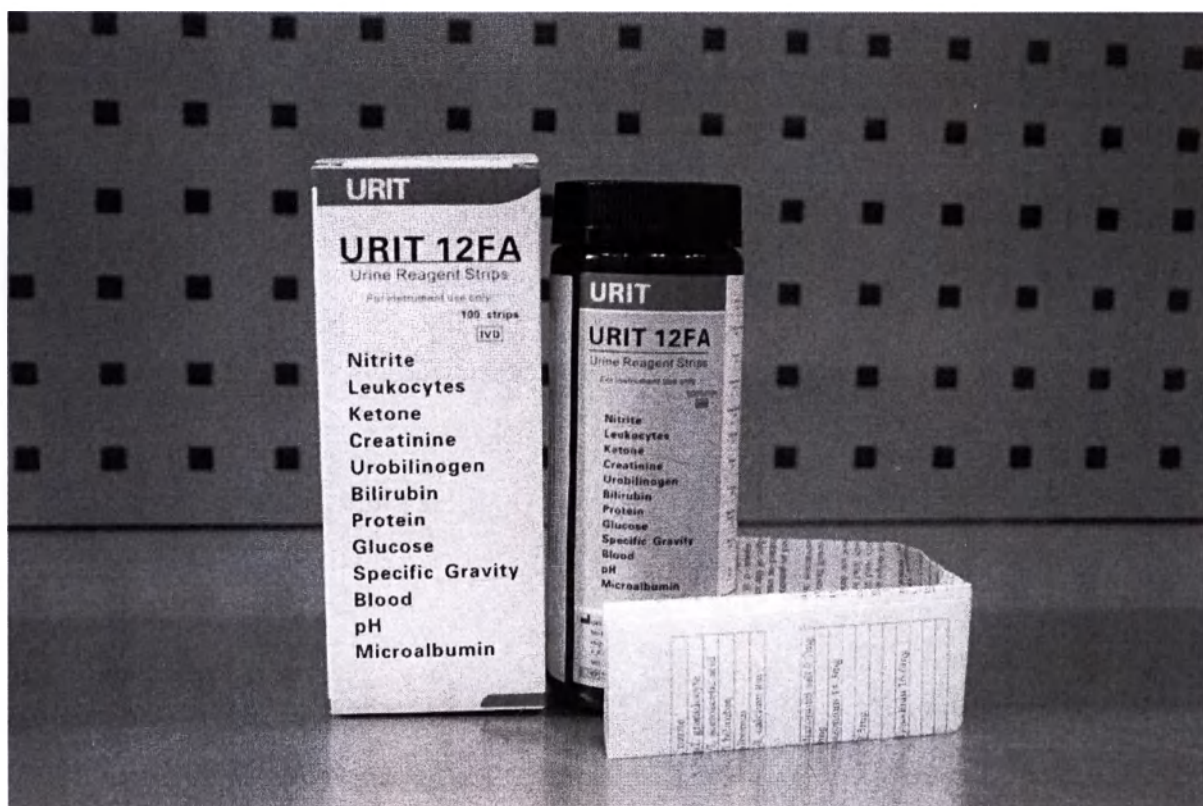

## Индикаторные полоски для анализа мочи URIT 14 FA

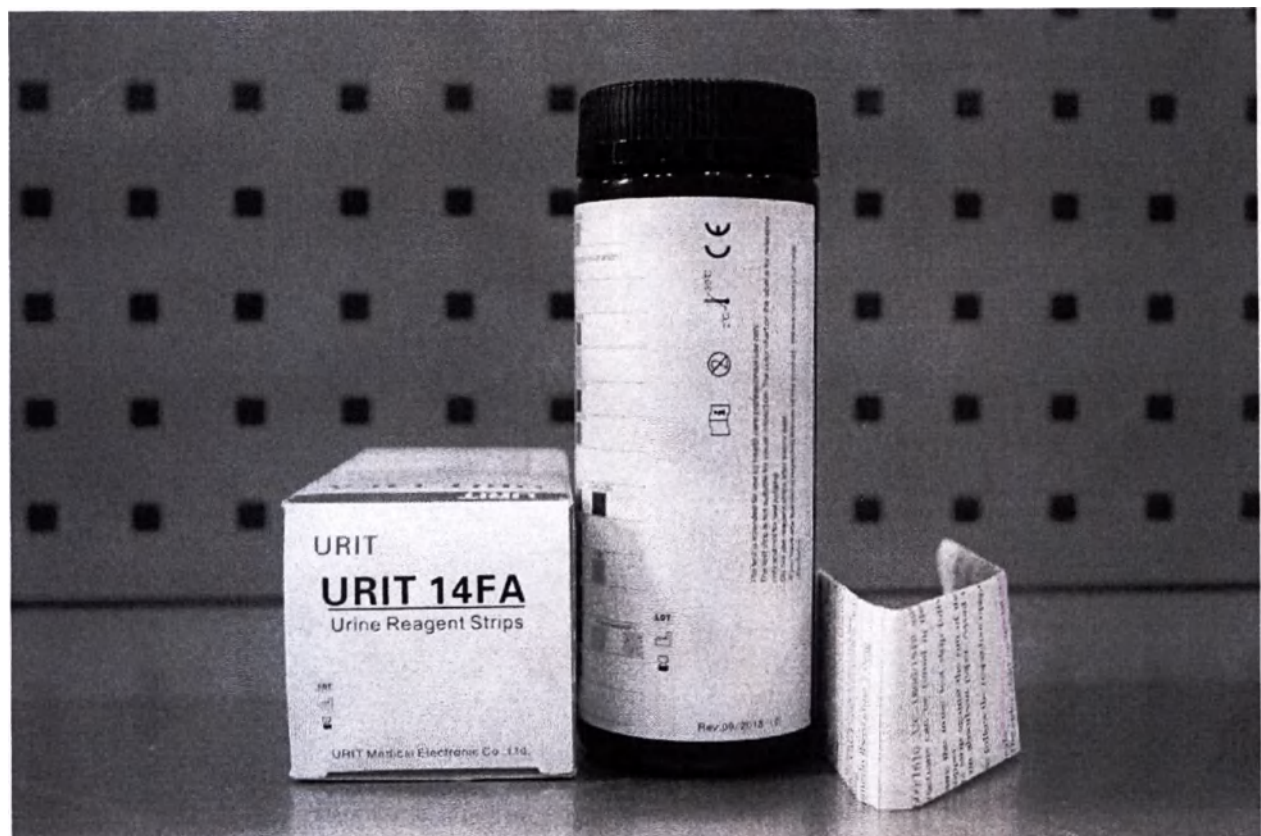

Прошито и скреплено печатью  
на 4 листах

Генеральный директор  
АО «СОЛТ»  
Заяц В.В.

