

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «СЕНСАР»


М.Г. Богданов

2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Видеоларингоскоп интубационный «СЕНСАР» по ТУ 26.60.12-001-91531720-2023»

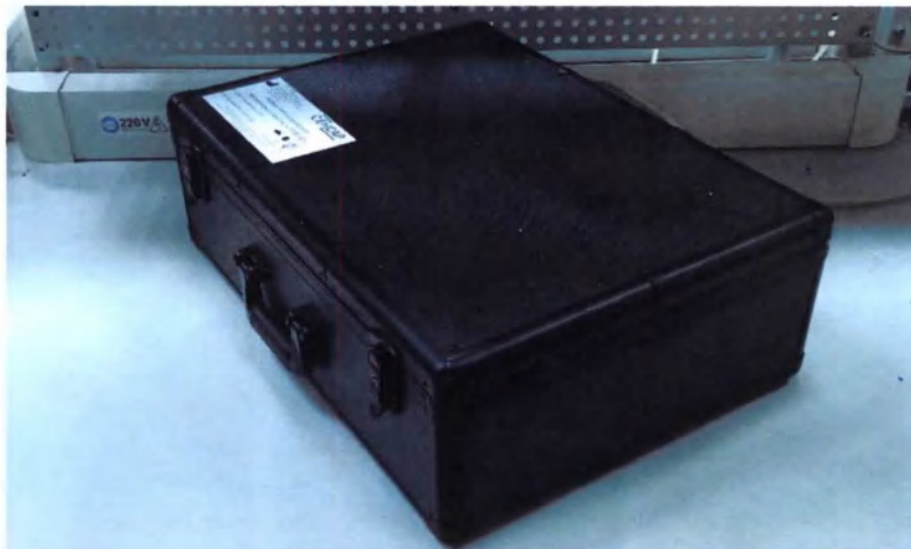

Фотографическое изображение 1.



Фотографическое изображение 2.

Фотографические изображения 1-2 показывают внешний вид транспортного кейса



Фотографическое изображение 3. Маркировка на транспортном кейсе



Фотографическое изображение 4.



Фотографическое изображение 5.



Фотографическое изображение 6.



Фотографическое изображение 7.




Фотографическое изображение 8.



Фотографическое изображение 9.



Фотографическое изображение 10.

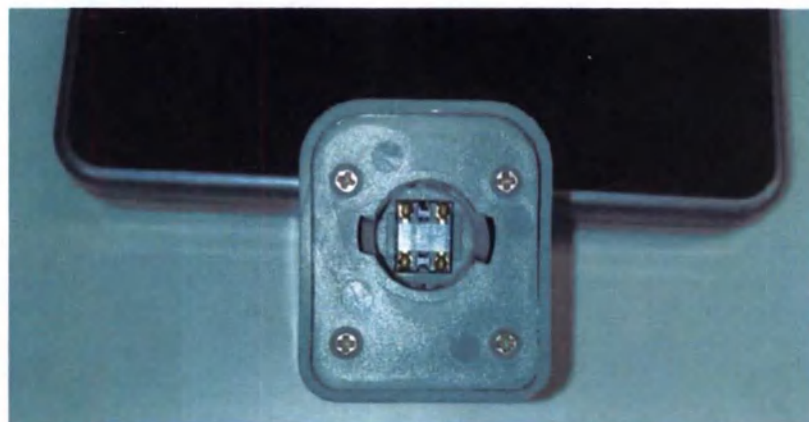


Фотографическое изображение 11.

Фотографические изображения 4-11 показывают внешний вид
Блока визуализации видеоларингоскопа «СЕНСАР»



Фотографическое изображение 12.

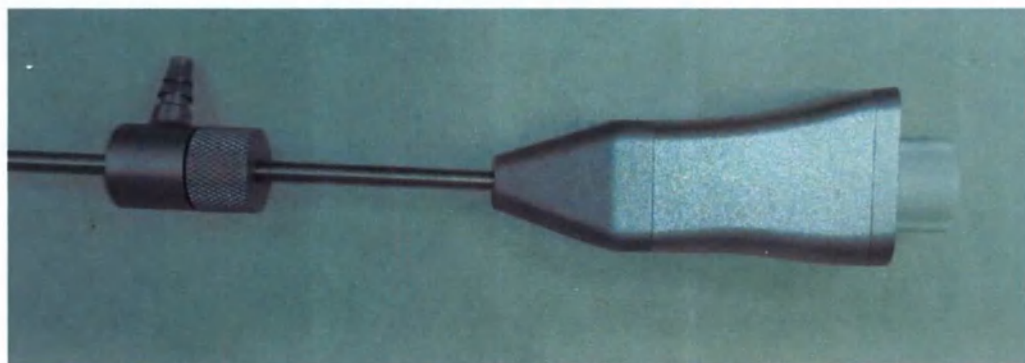


Фотографическое изображение 13.



Фотографическое изображение 14.



Фотографическое изображение 15.

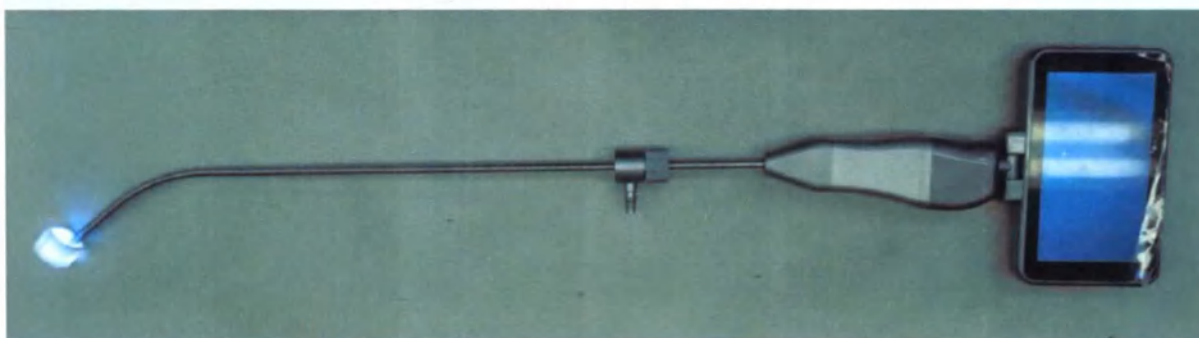

Фотографическое изображение 16.



Фотографическое изображение 17.

Фотографические изображения 12-17 показывают внешний вид
Видеостилета интубационного для взрослых




Фотографическое изображение 18.




Фотографическое изображение 19.



Фотографическое изображение 20.

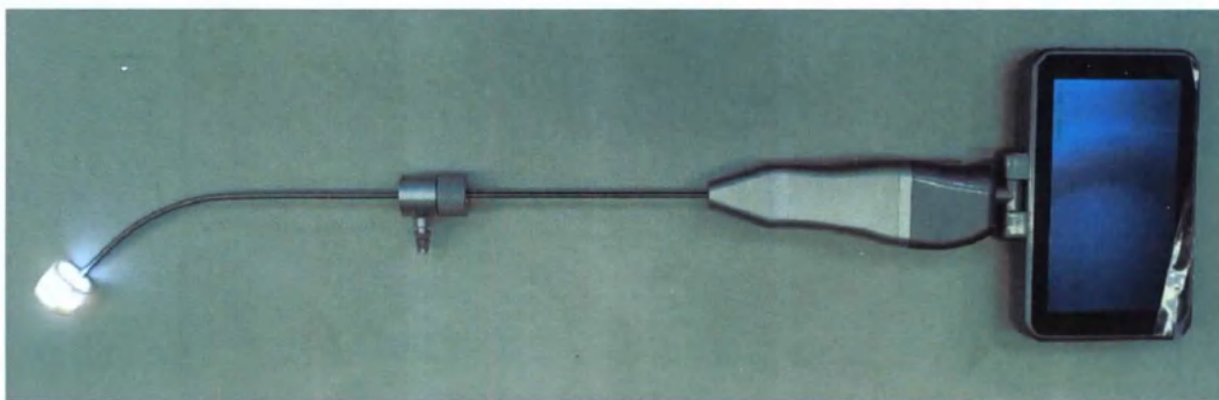

Фотографическое изображение 21.

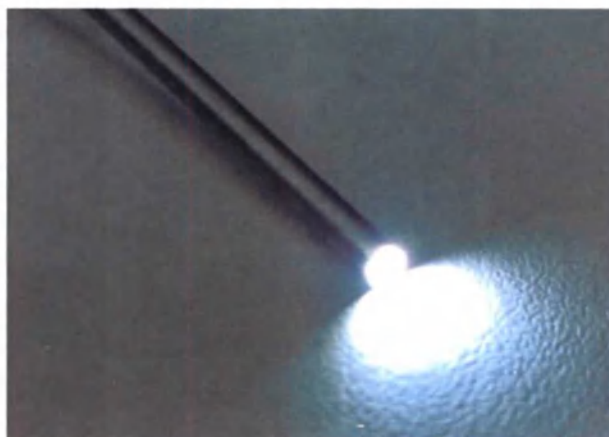


Фотографическое изображение 22.

Фотографические изображения 18-22 показывают внешний вид
Видеостилета интубационного педиатрического



Фотографическое изображение 23.

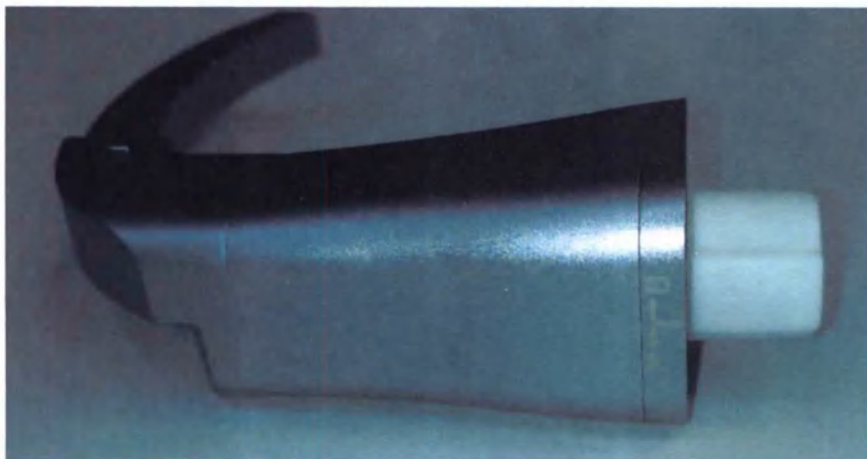

Фотографическое изображение 24.



Фотографическое изображение 25.



Фотографическое изображение 26.



Фотографическое изображение 27.



Фотографическое изображение 28.

Фотографические изображения 23-28 показывают внешний вид
Держателя для клинков типа MAC




Фотографическое изображение 29.



Фотографическое изображение 30.



Фотографическое изображение 31.

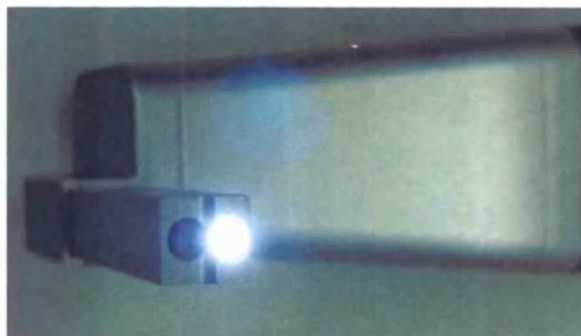

Фотографическое изображение 32.




Фотографическое изображение 33.

Фотографические изображения 29-33 показывают внешний вид
Держателя для клинков типа MIL



Фотографическое изображение 34.

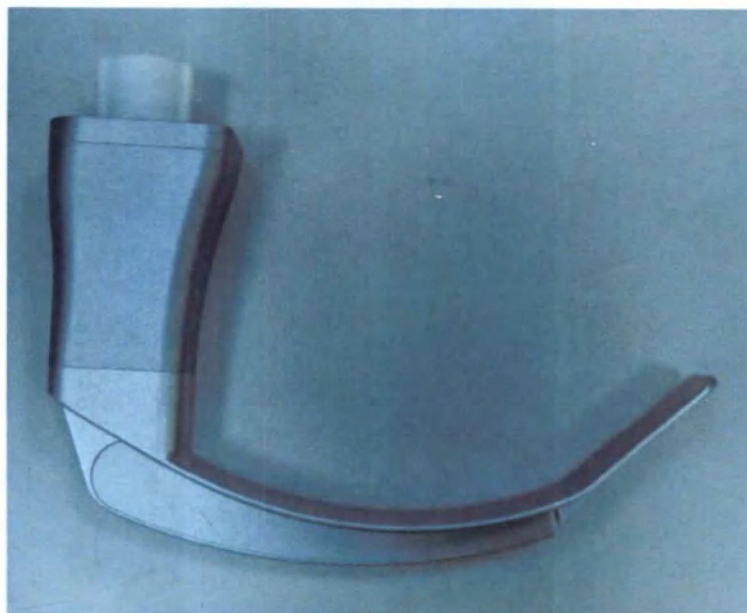

Фотографическое изображение 35.



Фотографическое изображение 36.



Фотографическое изображение 37.



Фотографическое изображение 38.




Фотографическое изображение 39.


Фотографические изображения 34-39 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа типа MAC-3



Фотографическое изображение 40.

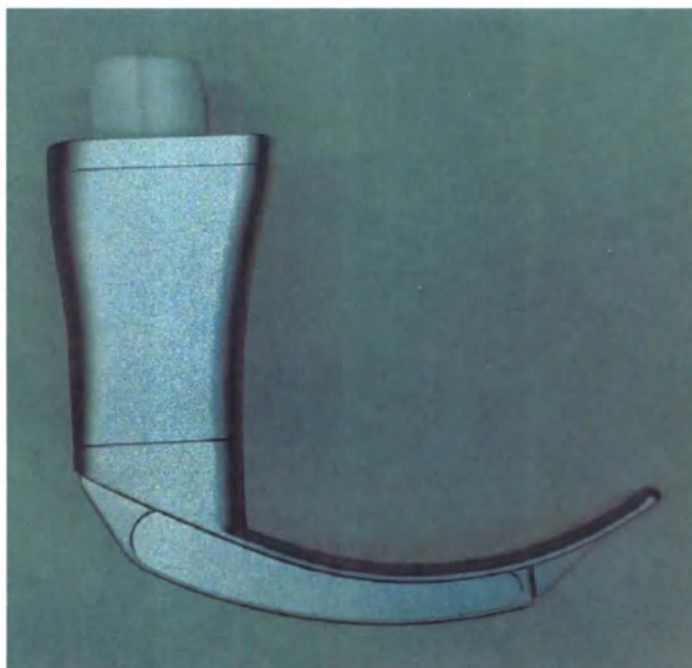

Фотографическое изображение 41.

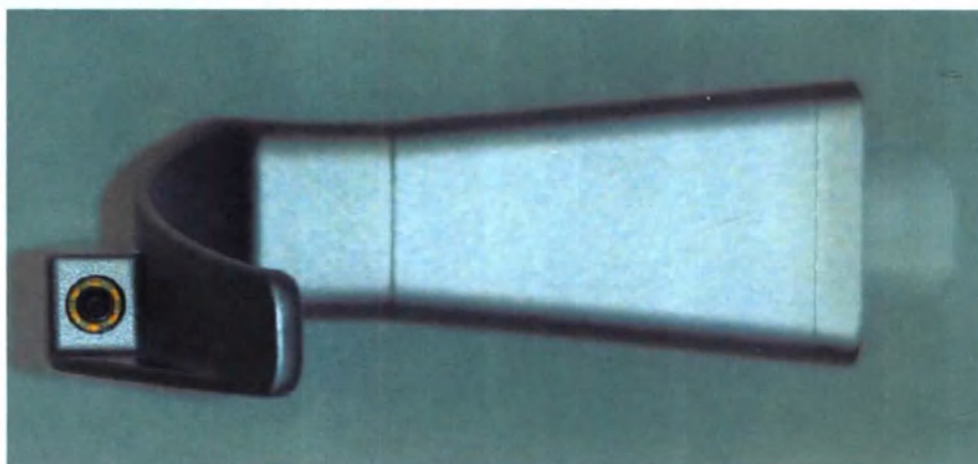

Фотографическое изображение 42.



Фотографическое изображение 43.



Фотографическое изображение 44.



Фотографическое изображение 45.

Фотографические изображения 40-45 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа типа MAC-1



Фотографическое изображение 46.



Фотографическое изображение 47.



Фотографическое изображение 48.



Фотографическое изображение 49.




Фотографическое изображение 50.




Фотографическое изображение 51.


Фотографические изображения 46-51 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа типа MAC-2

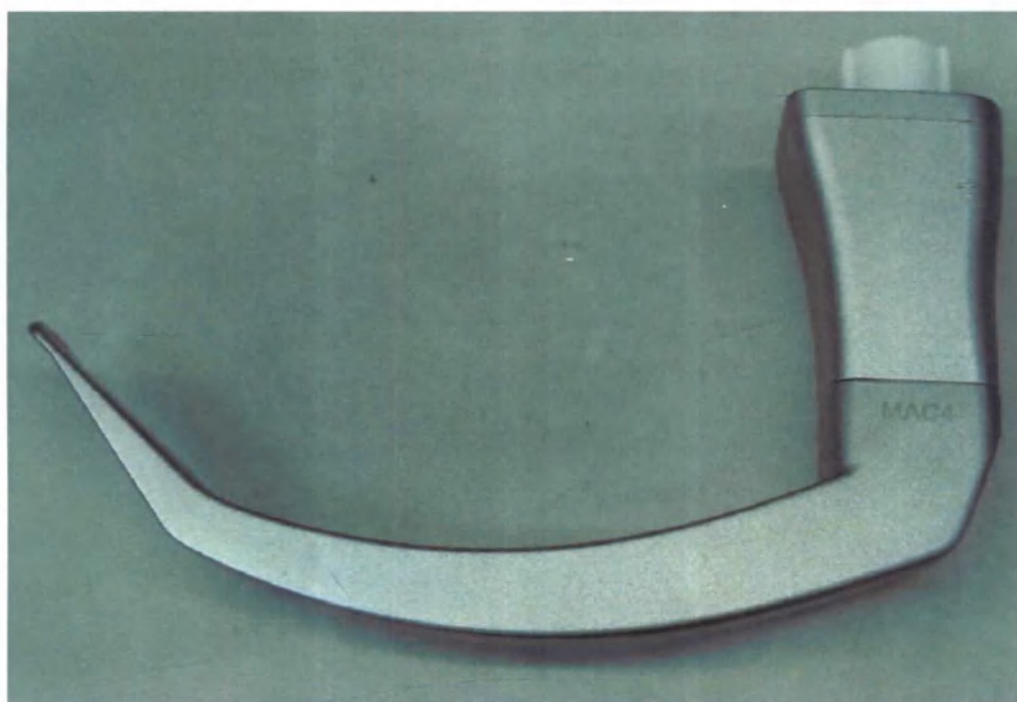

Фотографическое изображение 52.

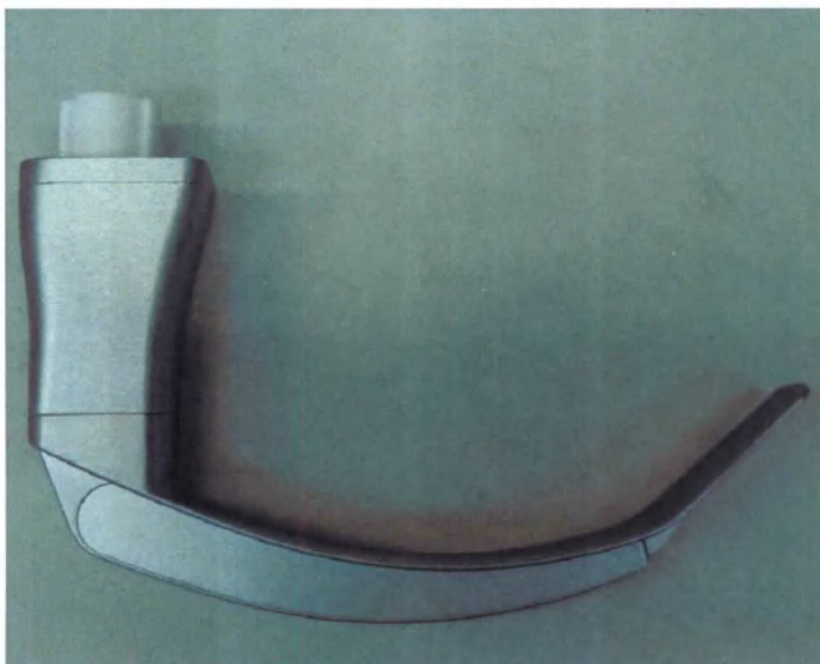

Фотографическое изображение 53.

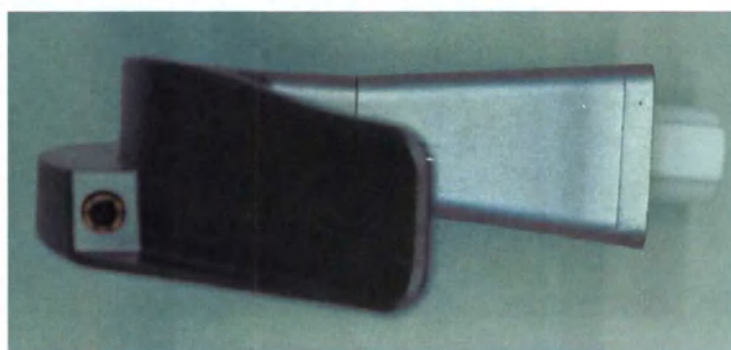

Фотографическое изображение 54.



Фотографическое изображение 55.




Фотографическое изображение 56.




Фотографическое изображение 57.

Фотографические изображения 52-57 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа типа MAC-4

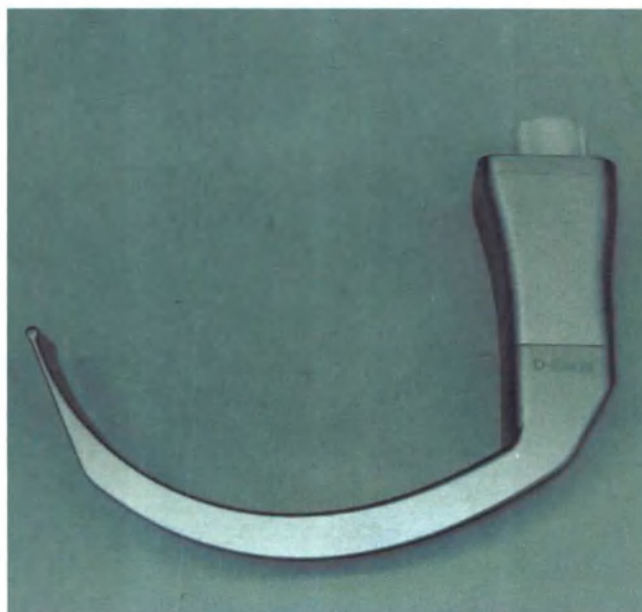

Фотографическое изображение 58.

Фотографическое изображение 59.

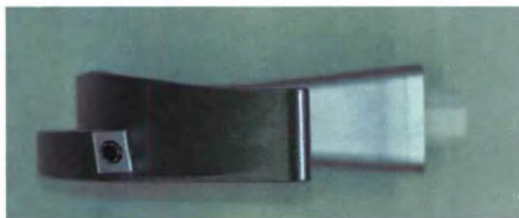

Фотографическое изображение 60.



Фотографическое изображение 61.



Фотографическое изображение 62.




Фотографическое изображение 63.


Фотографические изображения 58-63 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа D-Blade (для сложной интубации)



Фотографическое изображение 64.

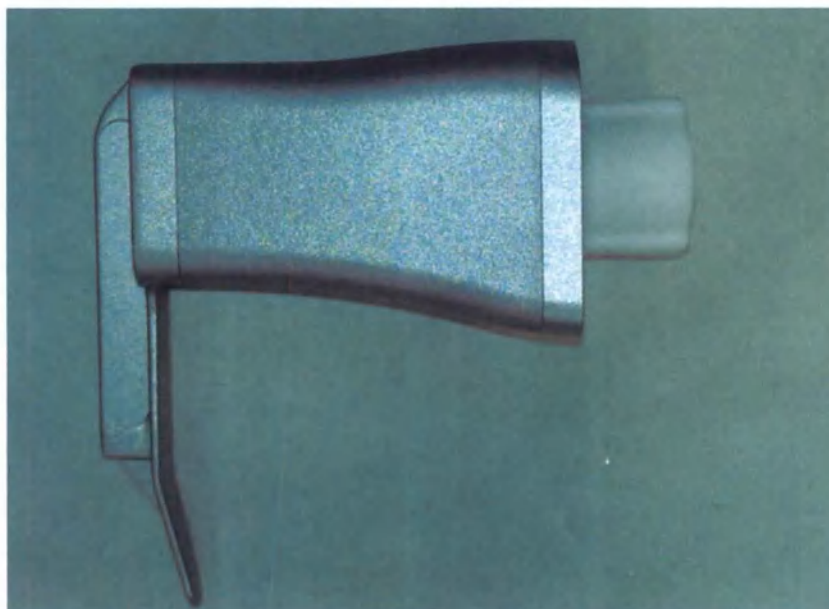

Фотографическое изображение 65.

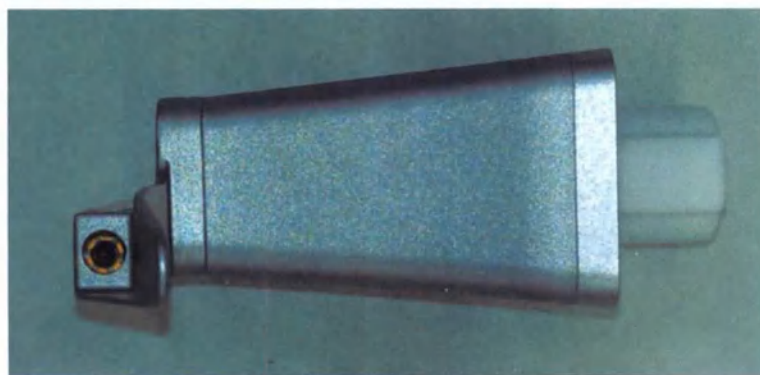

Фотографическое изображение 66.



Фотографическое изображение 67.



Фотографическое изображение 68.


Фотографические изображения 64-68 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа MIL-00




Фотографическое изображение 69.



Фотографическое изображение 70.

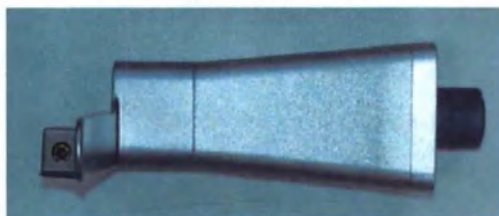


Фотографическое изображение 71.

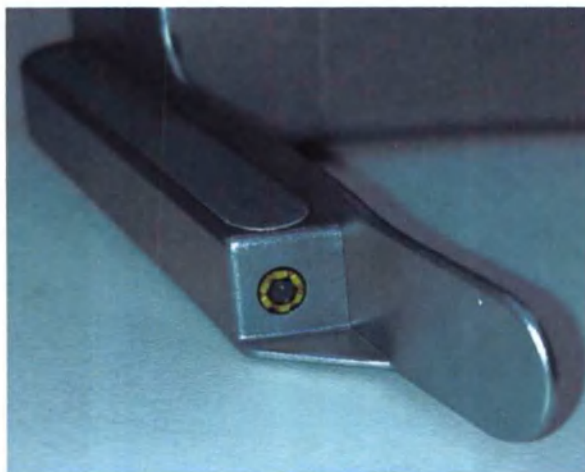

Фотографическое изображение 72.



Фотографическое изображение 73.

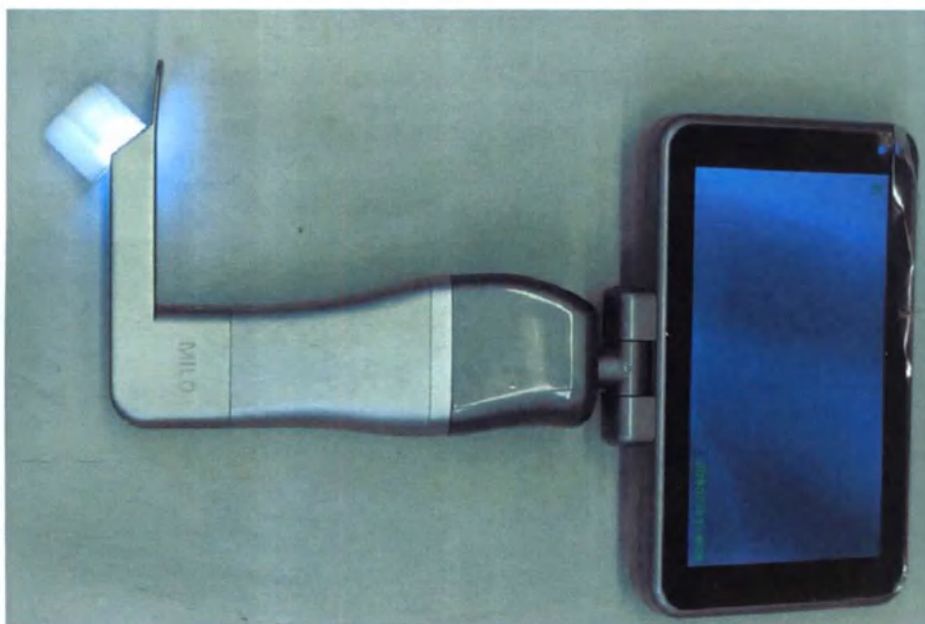


Фотографическое изображение 74.

Фотографические изображения 69-74 показывают внешний вид
Клинка интубационного видеоларингоскопа MIL-0



Фотографическое изображение 75.

Фотографическое изображение 76.

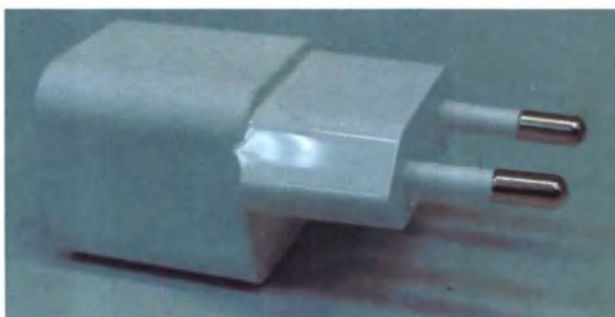

Фотографическое изображение 77.

Фотографические изображения 75-76 показывают внешний вид
Зарядного устройства

Фотографическое изображение 78.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
26 _____ листах

