

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «НПО «Андроидная техника»




А.Ф. Пермяков

«06» марта 2023 г.

Фотографии изделия медицинского назначения

**Роботизированный комплекс экзоскелета кисти
с биологической обратной связью «Ортез-М»
по ТУ 26.60.13-017-64412177-2022**

Рис.1 – Комплекс «Орtez – М», полный комплект

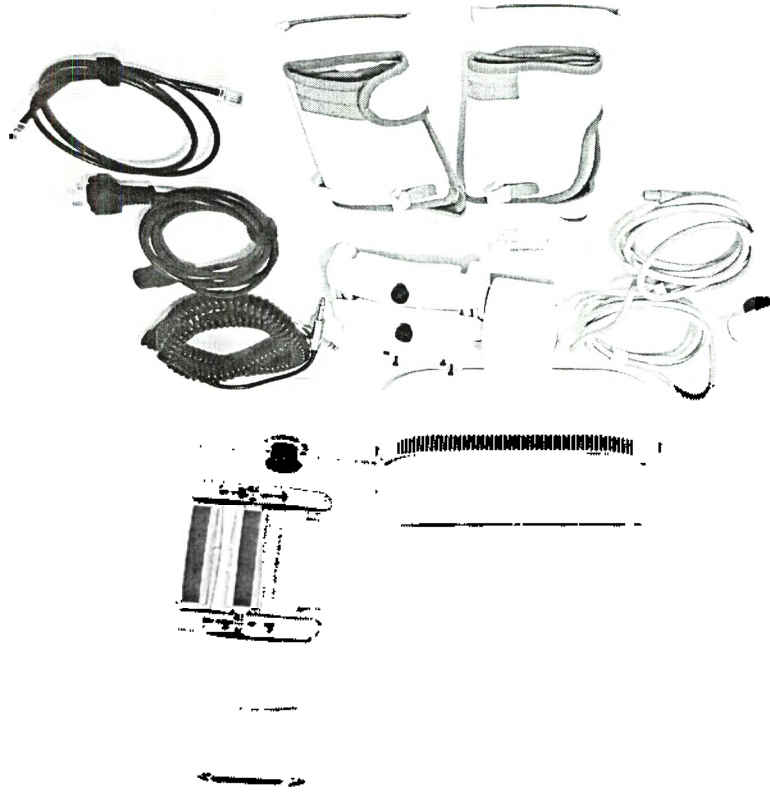

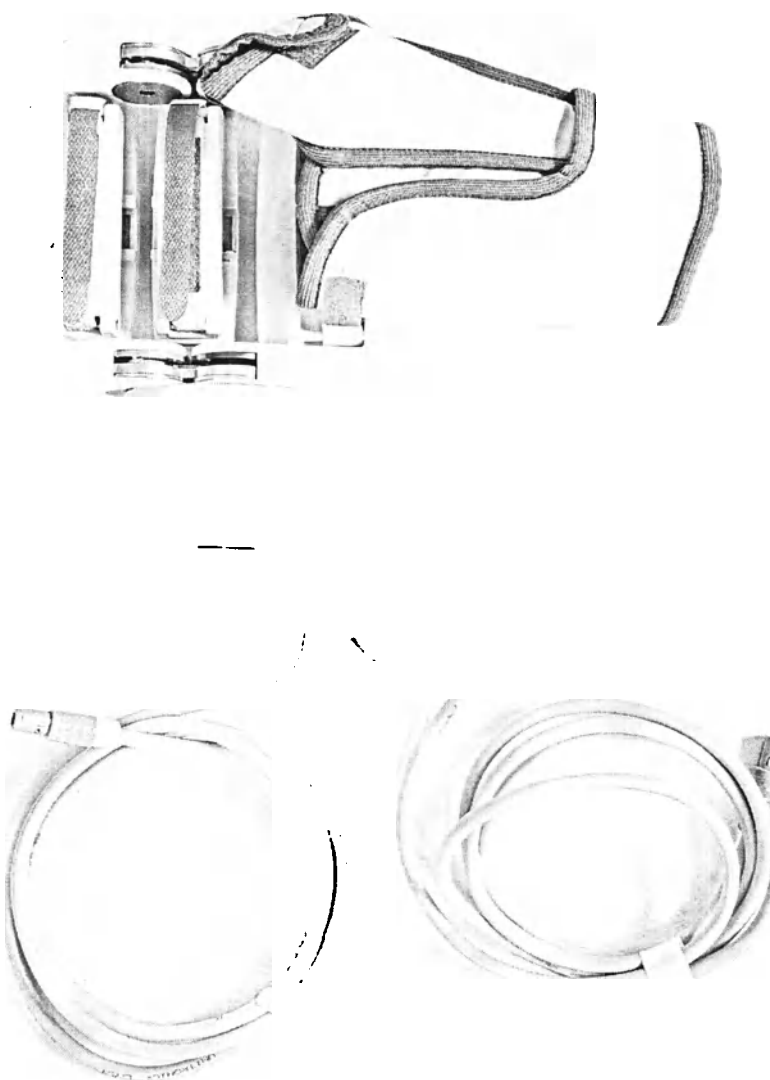


Рис. 2 - Модуль «Кисть» в сборе с тканевым ложементом, ремешками, кабелем фаз мотора, кабелем датчиков обратной связи. Вид слева

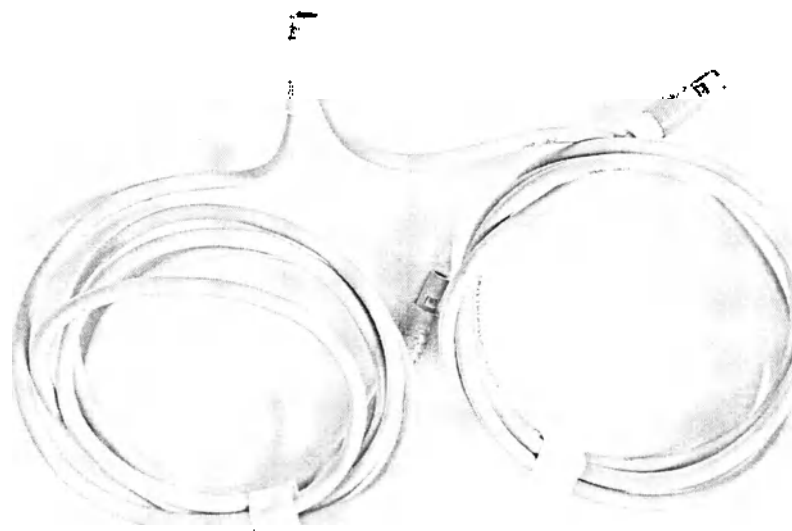
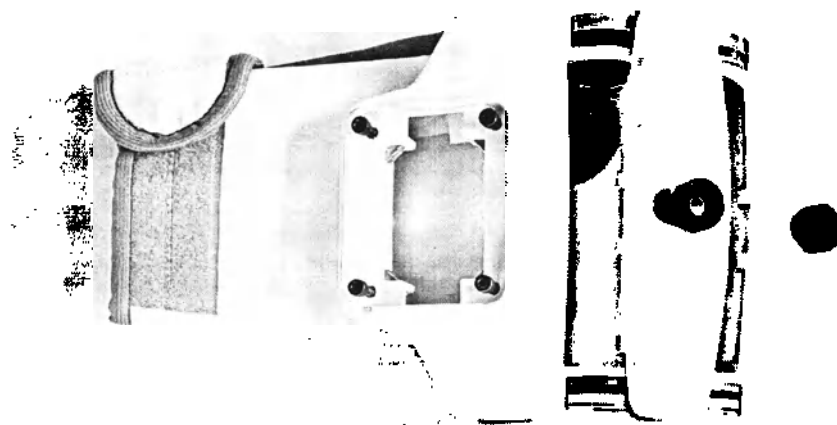


Рис. 3 - Модуль «Кисть» в сборе с тканевым ложементом, кабелем фаз мотора, кабелем датчиков обратной связи. Вид справа

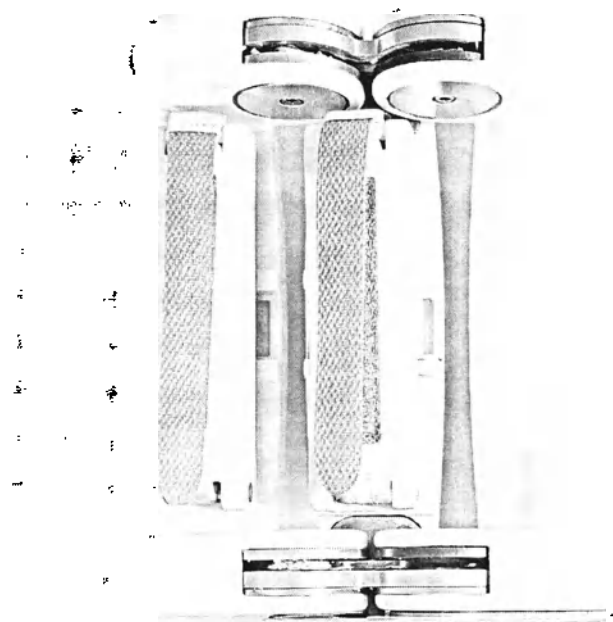


Рис. 4 - Модуль «Кисть» с ремешками. Вид справа

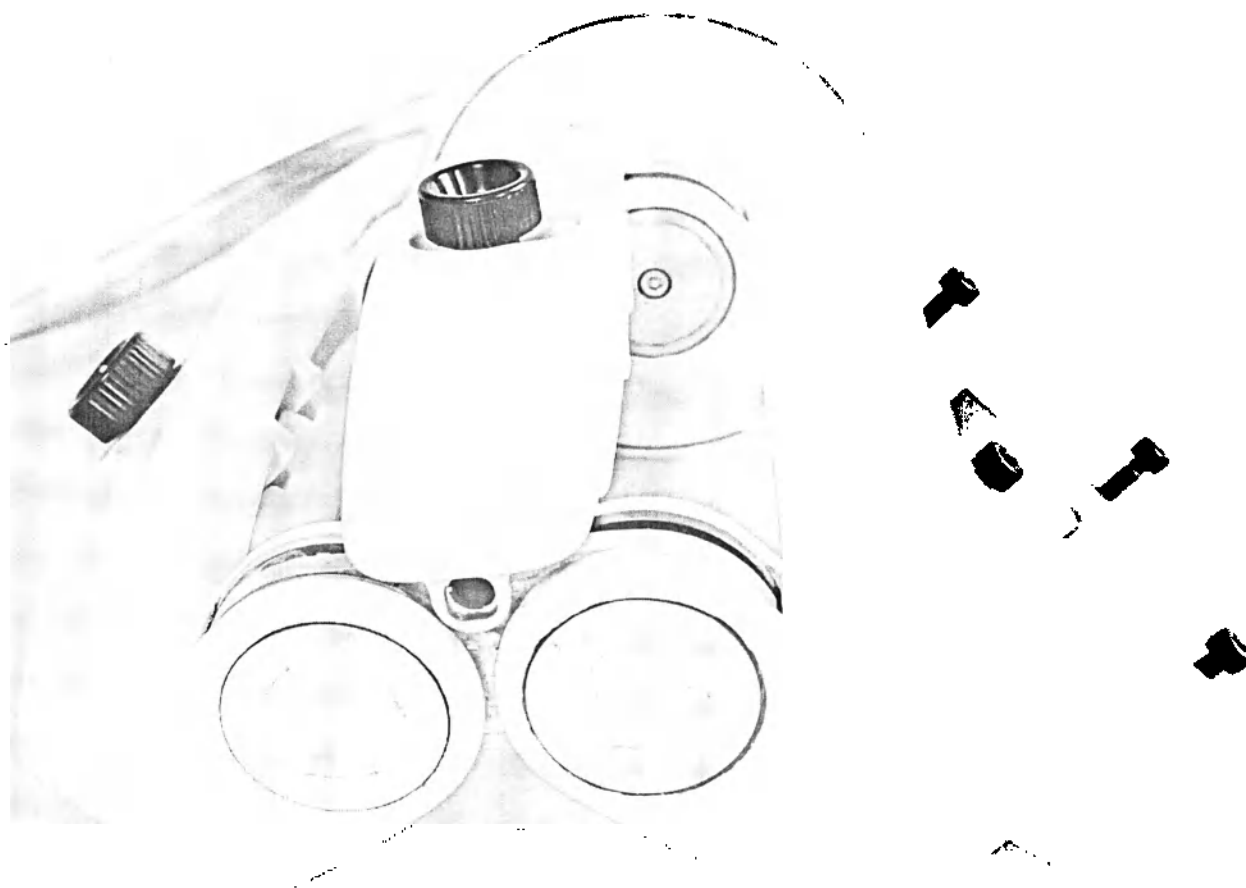


Рис. 5 - Модуль «Кисть». Вид сверху

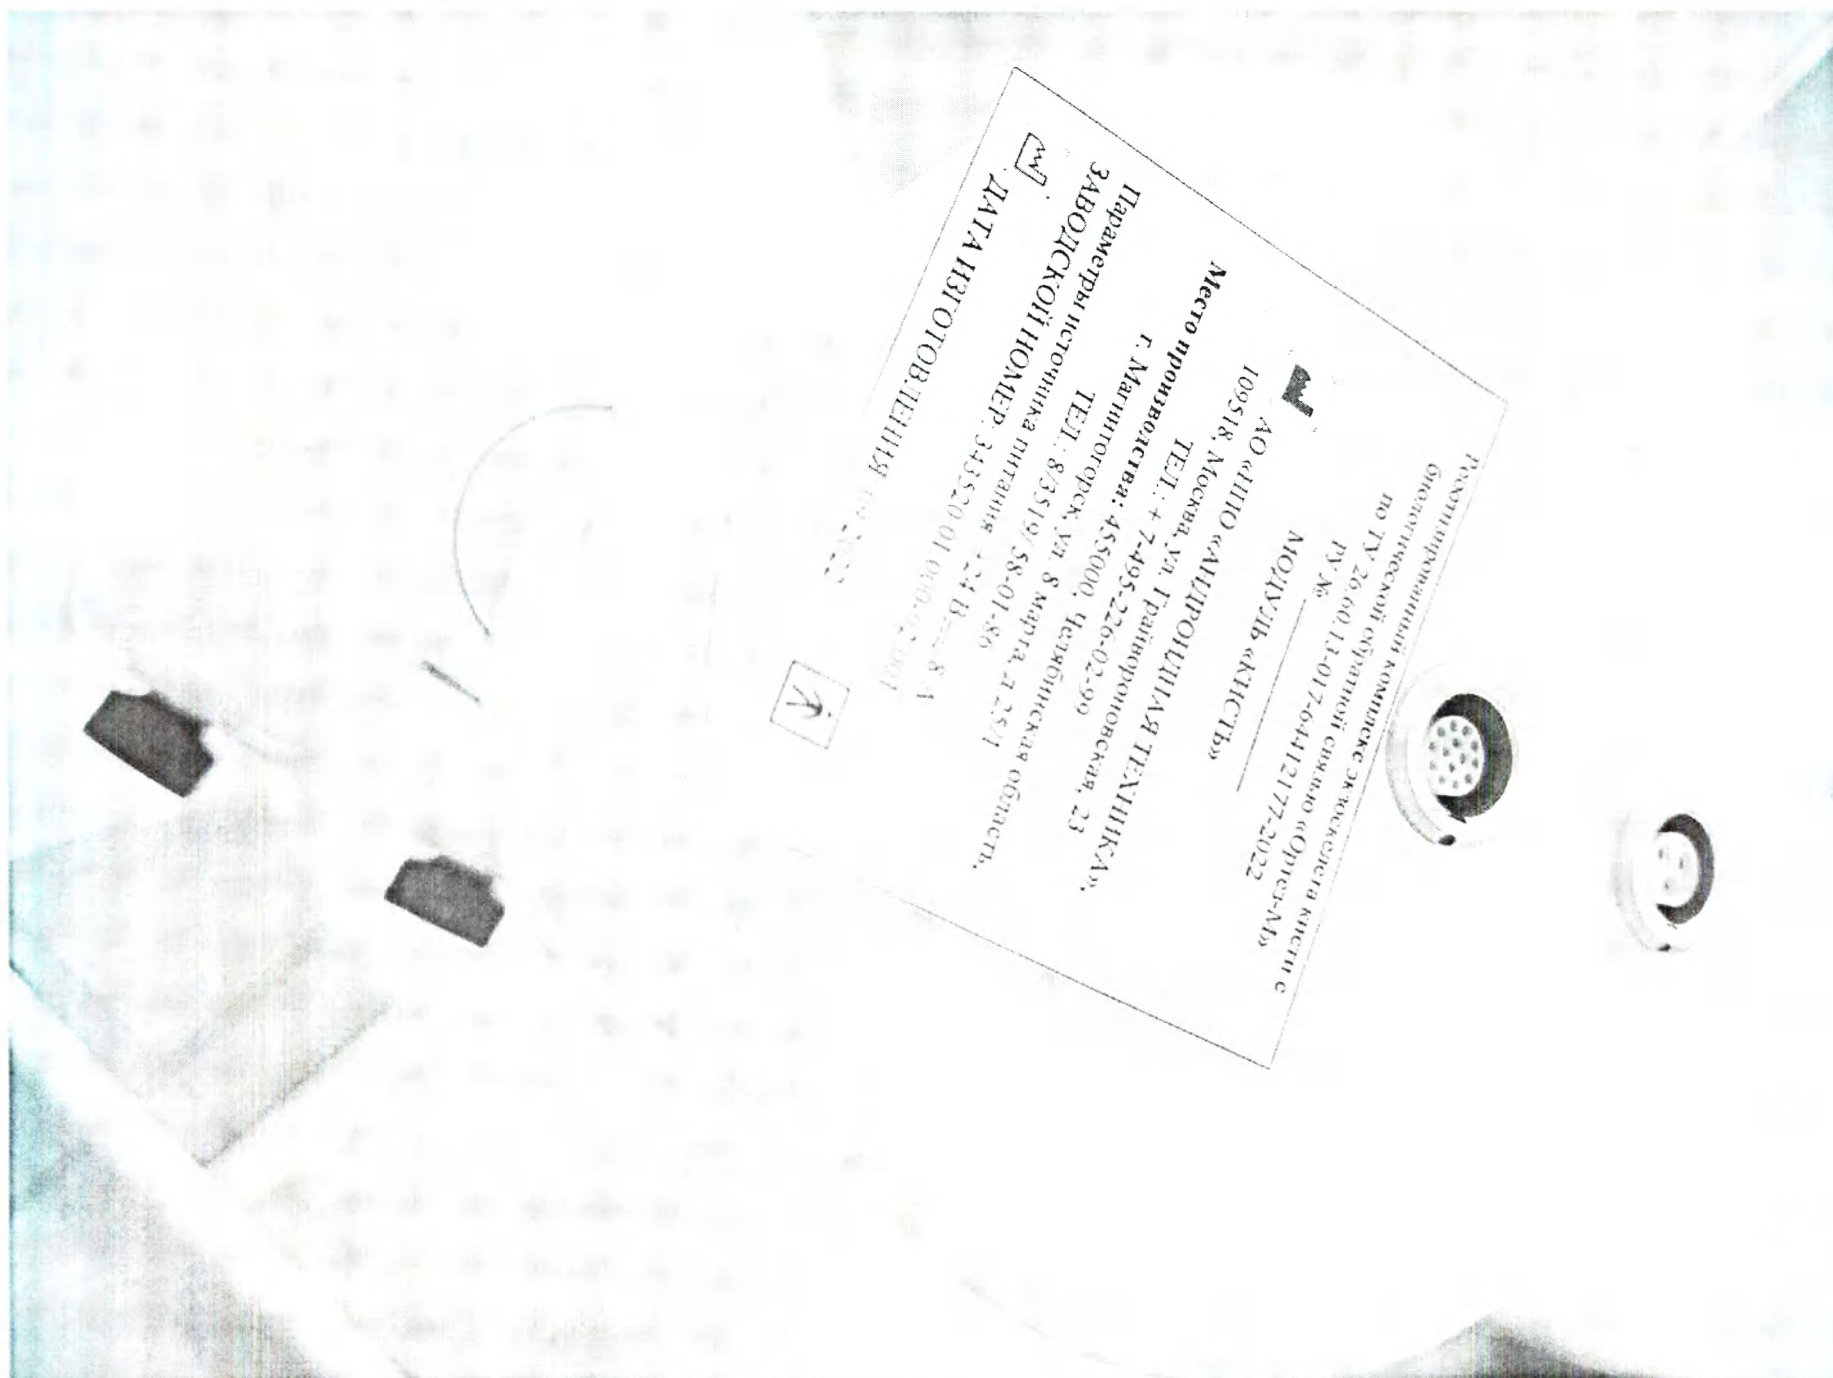


Рис. 6 - Модуль «Кисть». Вид снизу с маркировкой

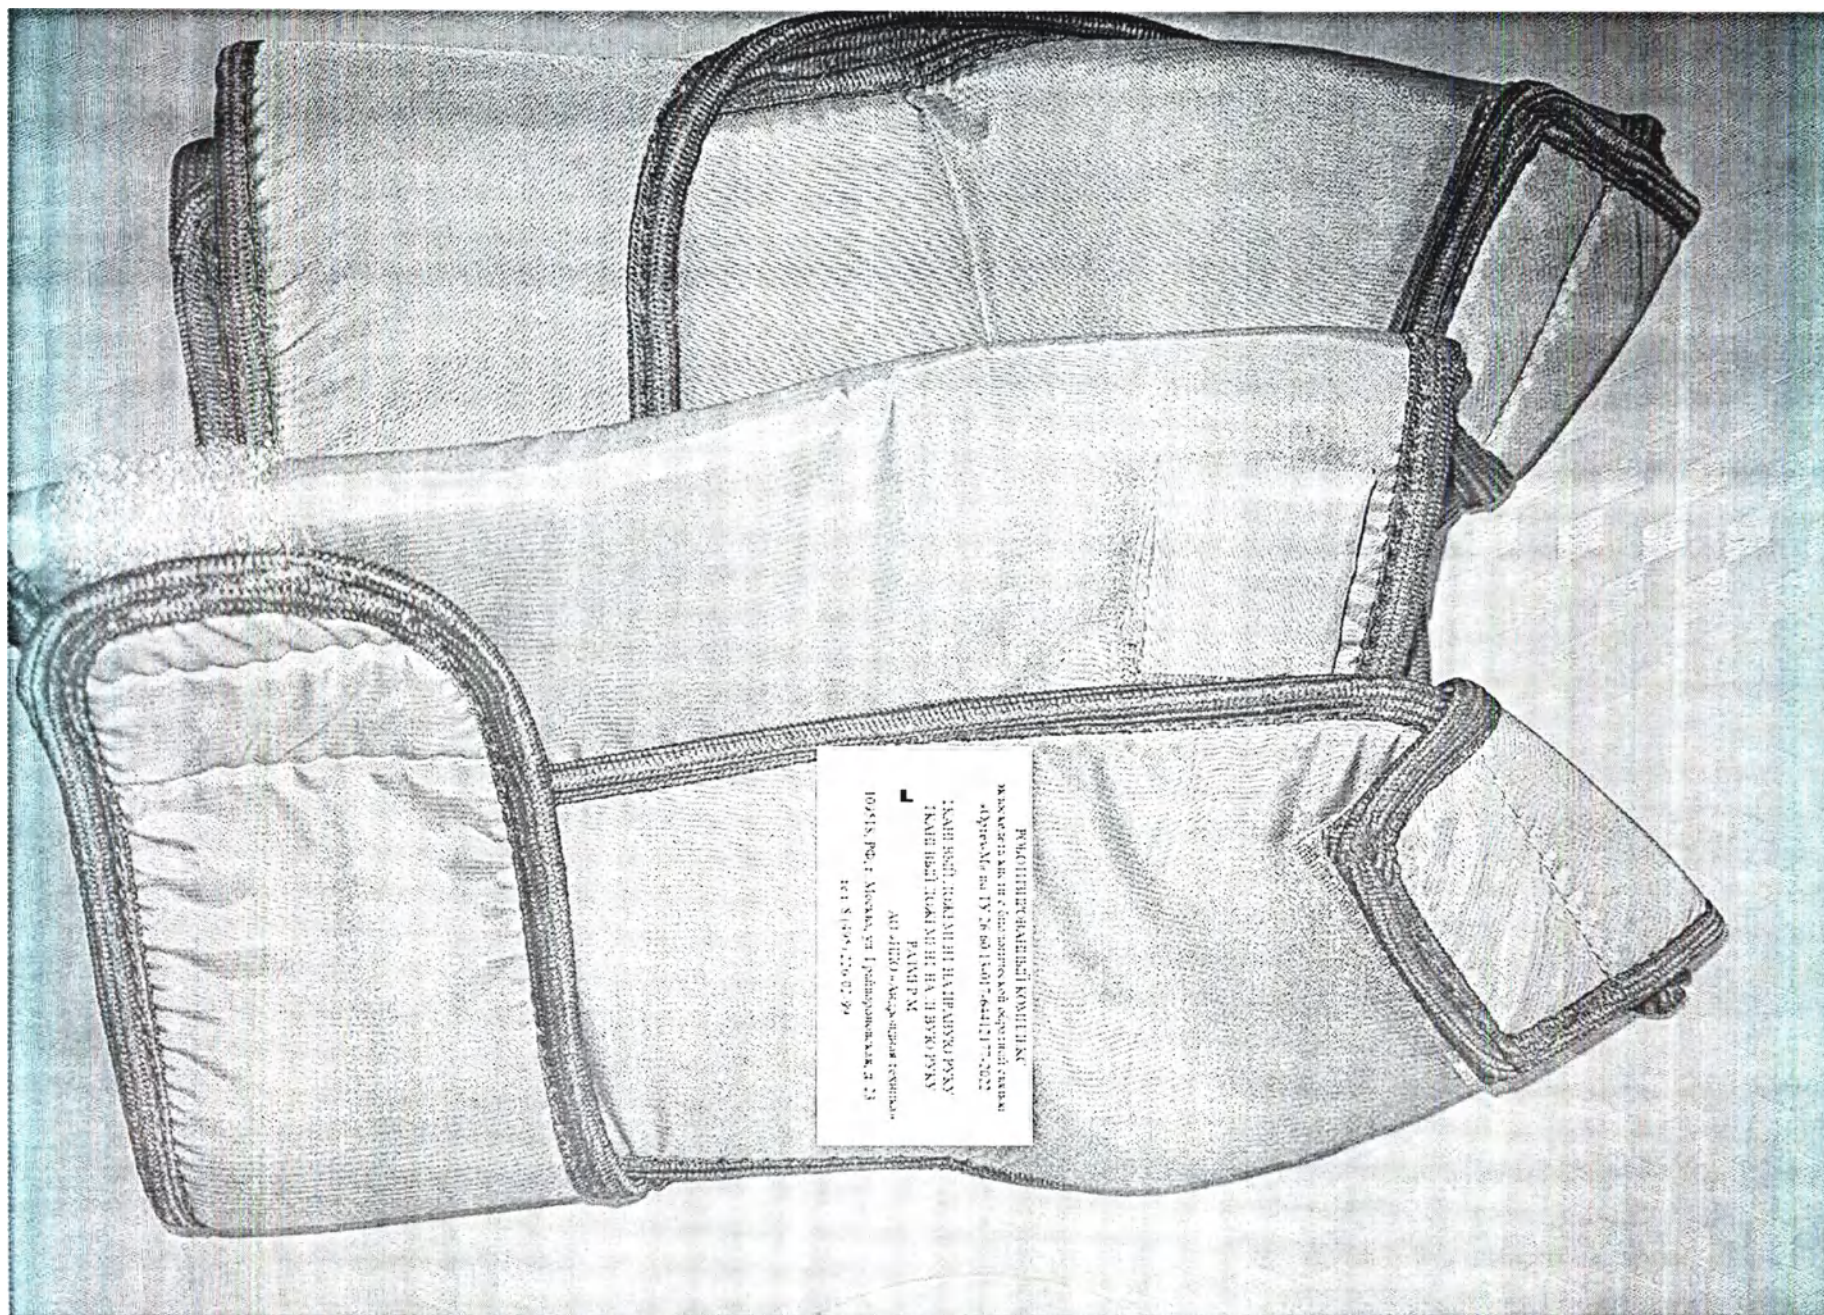


Рис. 8 - Тканевый ложемент на левую и правую руку, размер М

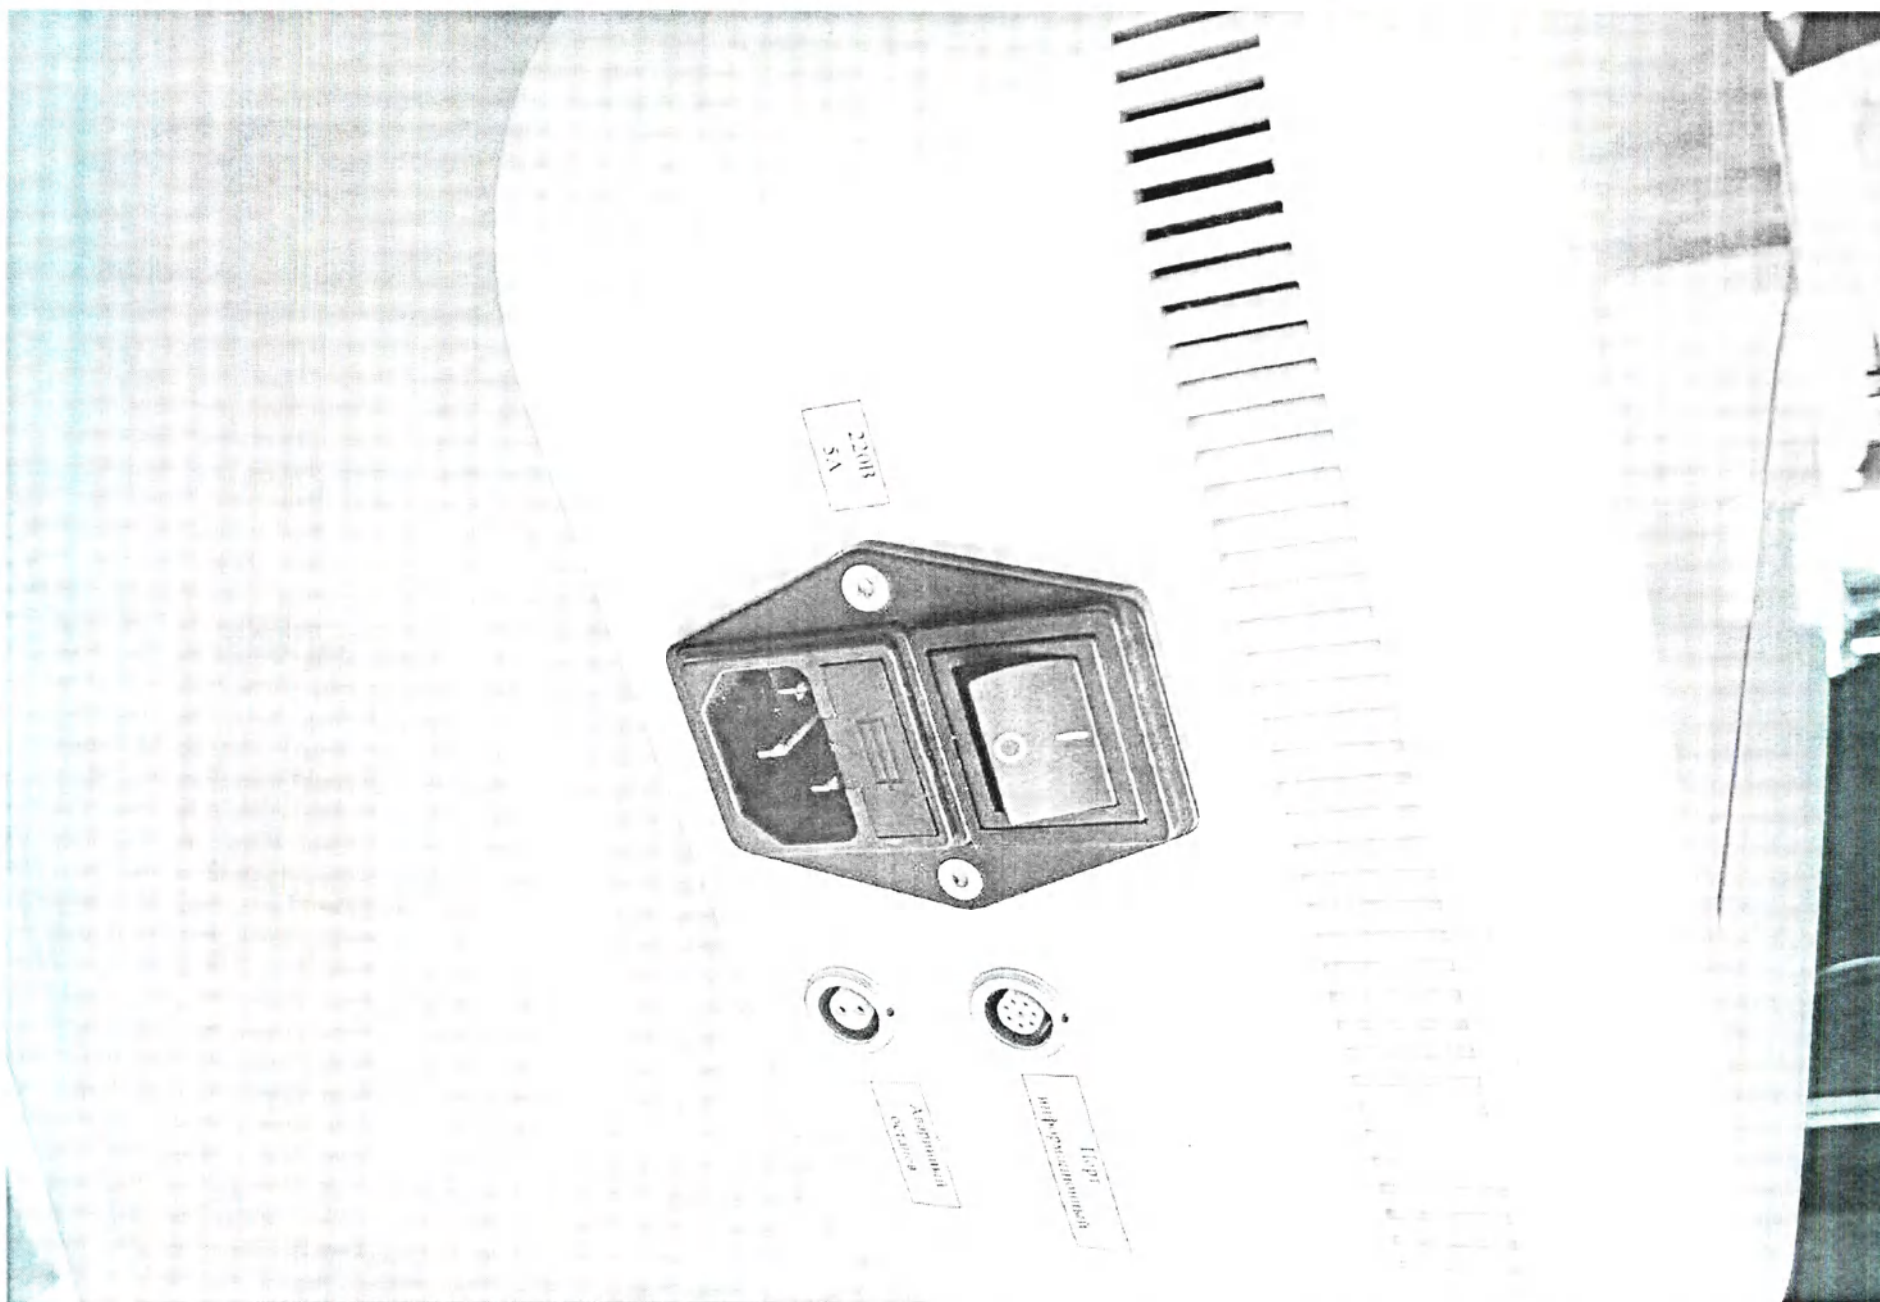


Рис. 9 - Блок управления и электропитания. Вид слева сбоку: разъемы для кабеля питания, кабеля информационного, кабеля кнопки аварийного останова

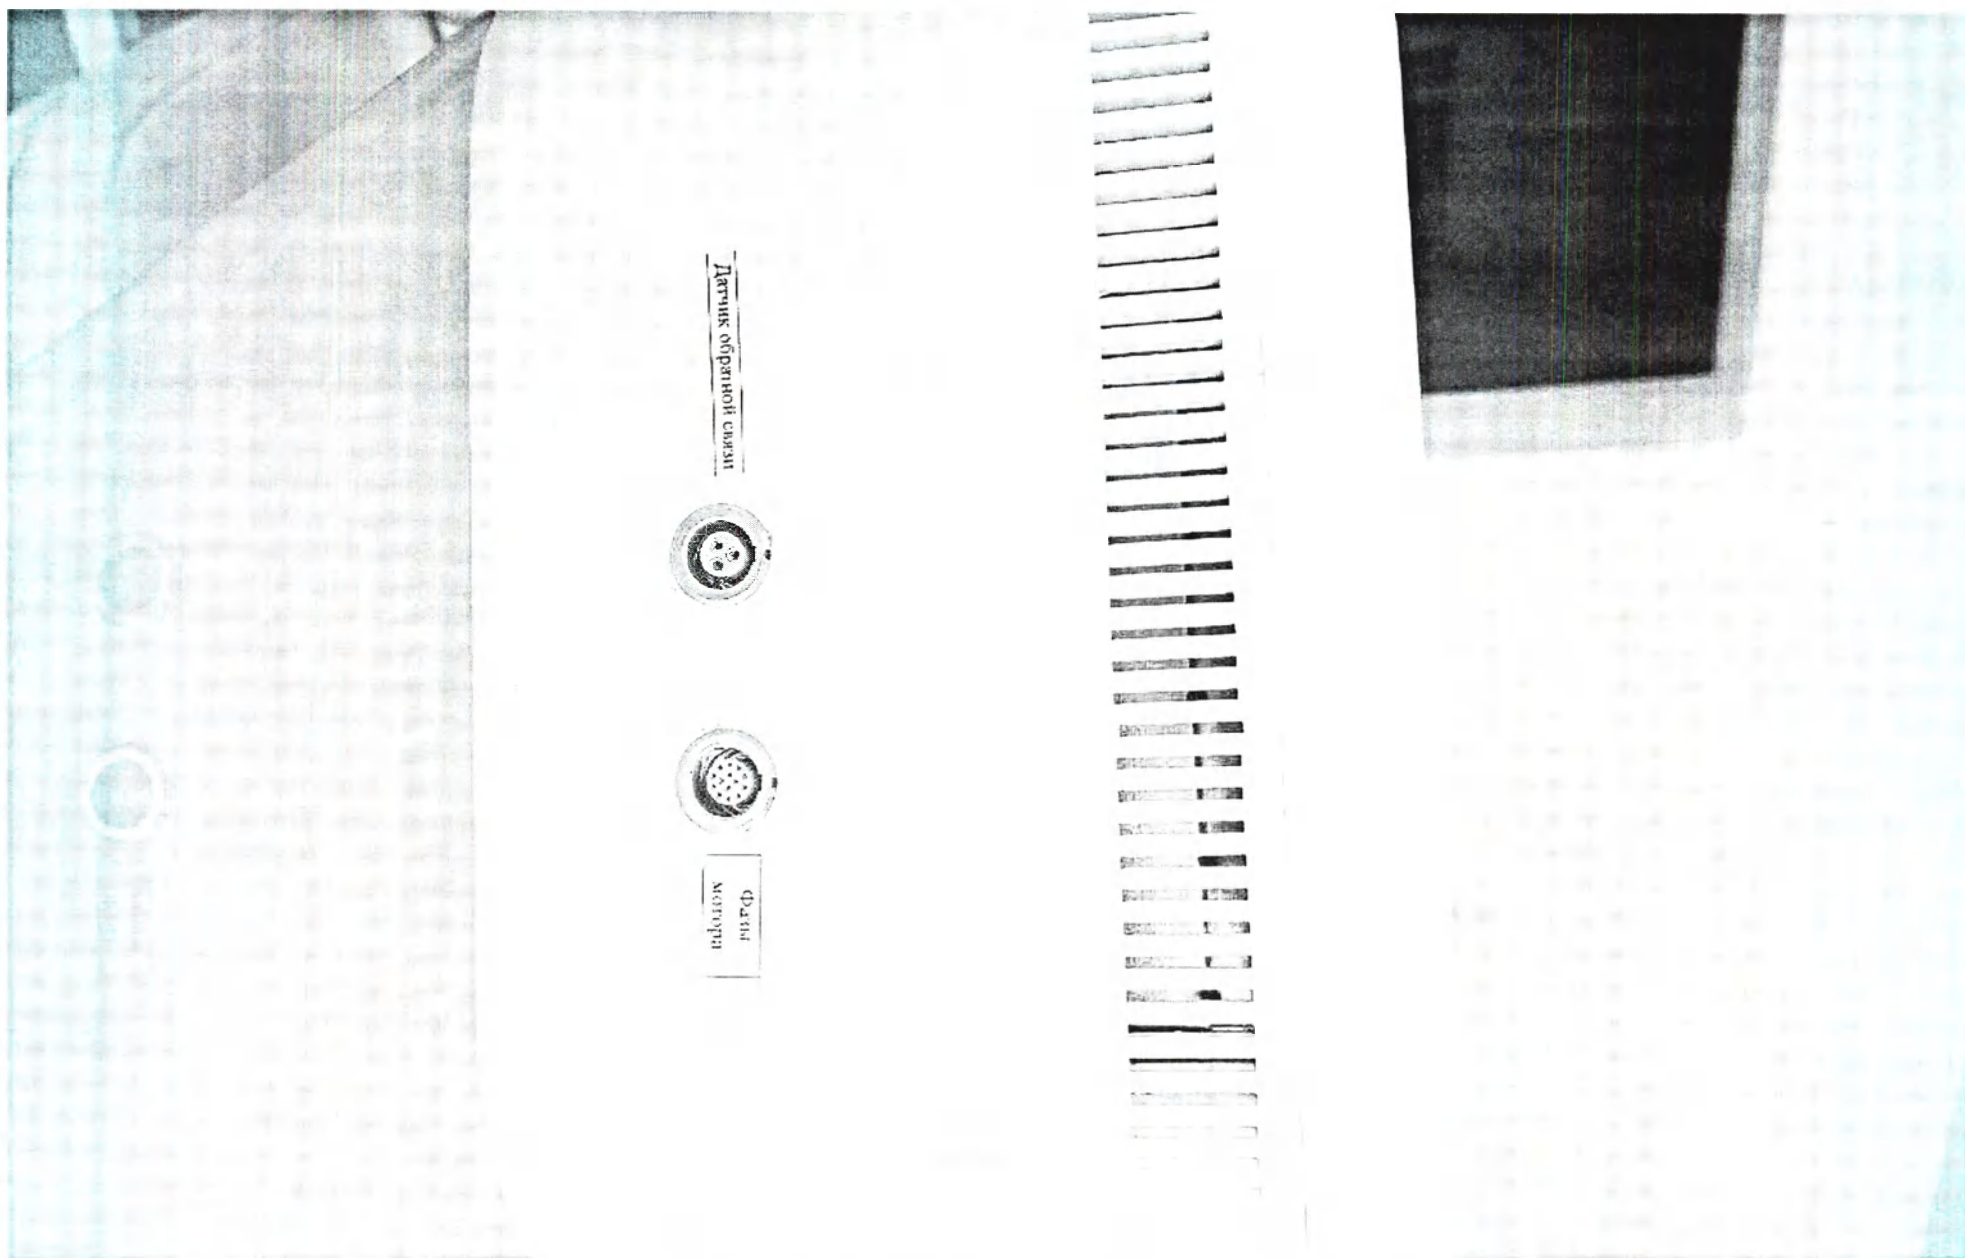


Рис. 10 - Блок управления и электропитания. Вид справа сбоку: разъемы кабеля фаз мотора и кабеля датчиков обратной связи

Роботизированный комплекс маркировки кисти с библиотечной обработкой
по адресу: Москва, ул. 26.60.13-017-64412177-2022
PS №

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ



АО «АНДО-АНДРОНИЙАЯ ТЕХНИКА», 109518, Москва,
ул. Гриневская, 23, Т/Л: +7-495-226-02-99
Место производства: 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. 8 марта, д.25-1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ: 230 В ~ 50 Гц
Класс электрозащитности: I
Потребляемая мощность: не более 200 Вт
Аварийное напряжение: +24 В, 8А
Рабочий цикл:
- максимальное время активации (сек.): 45 мин
- максимальное время деактивации (мин.): 15 мин

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 343529.01.000-02.001

ДАТА И ГОТОВЛЕНИЯ: 09.2022

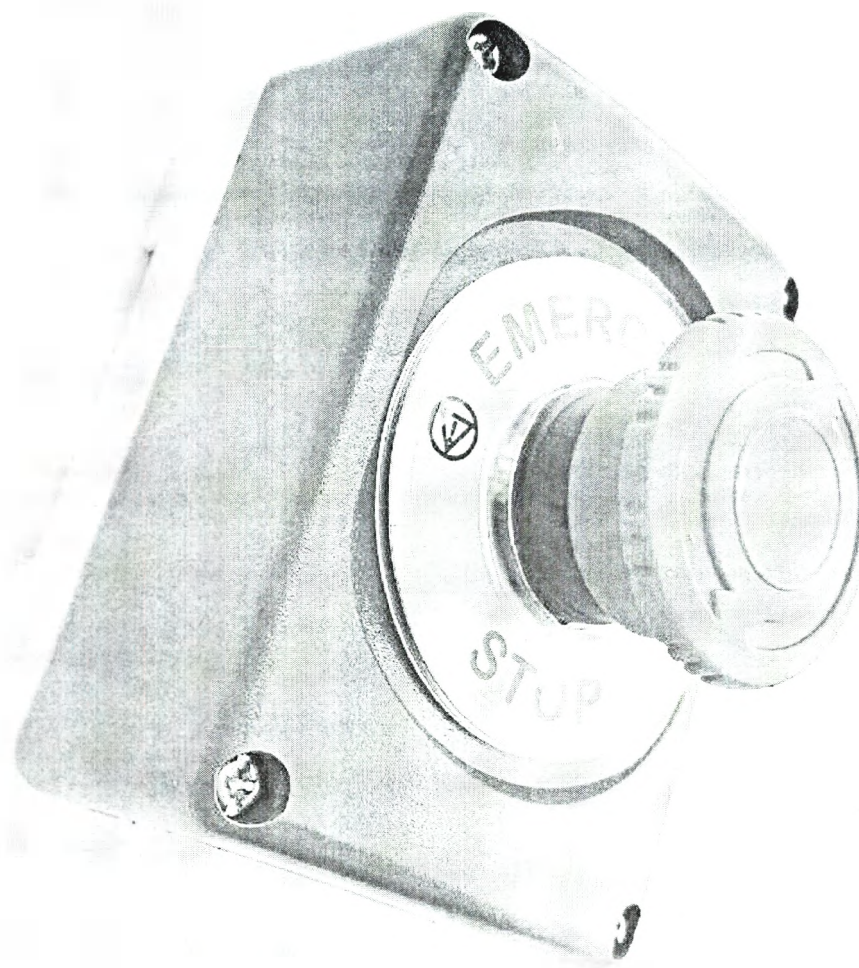
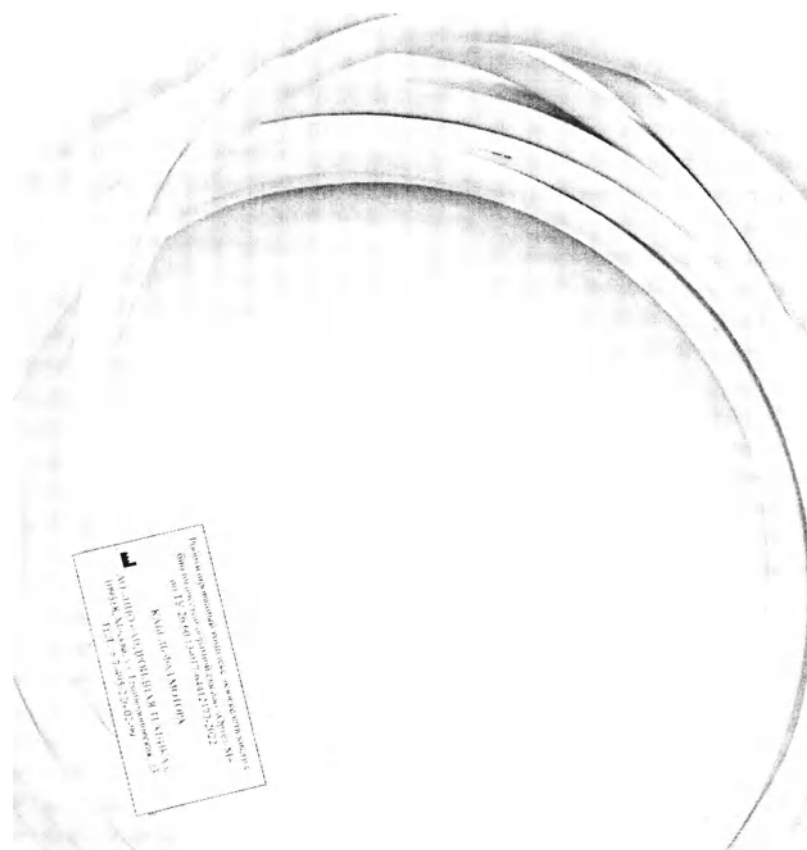




Рис. 13 - Кнопка аварийного останова вид снизу с маркировкой



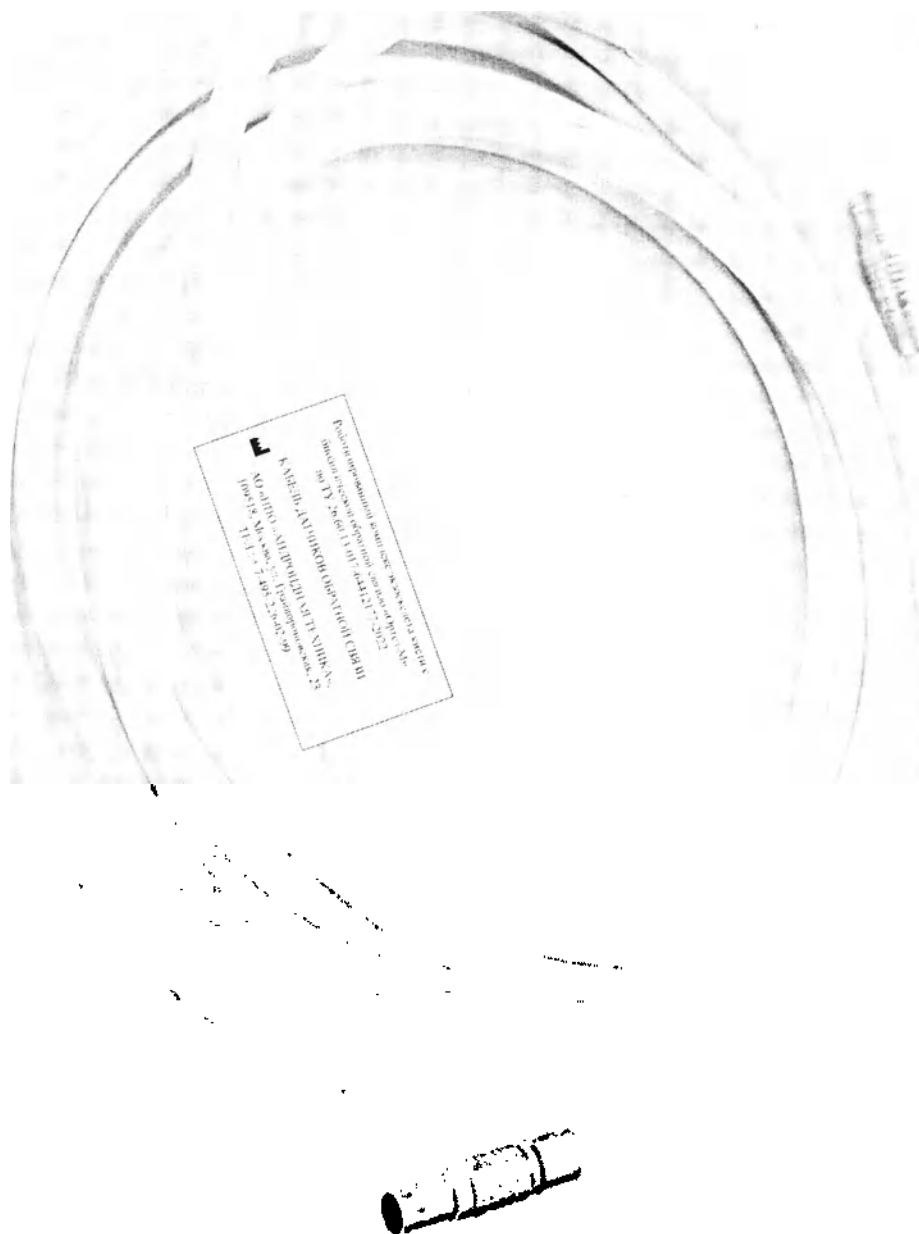


Рис. 15 - Кабель датчиков обратной связи

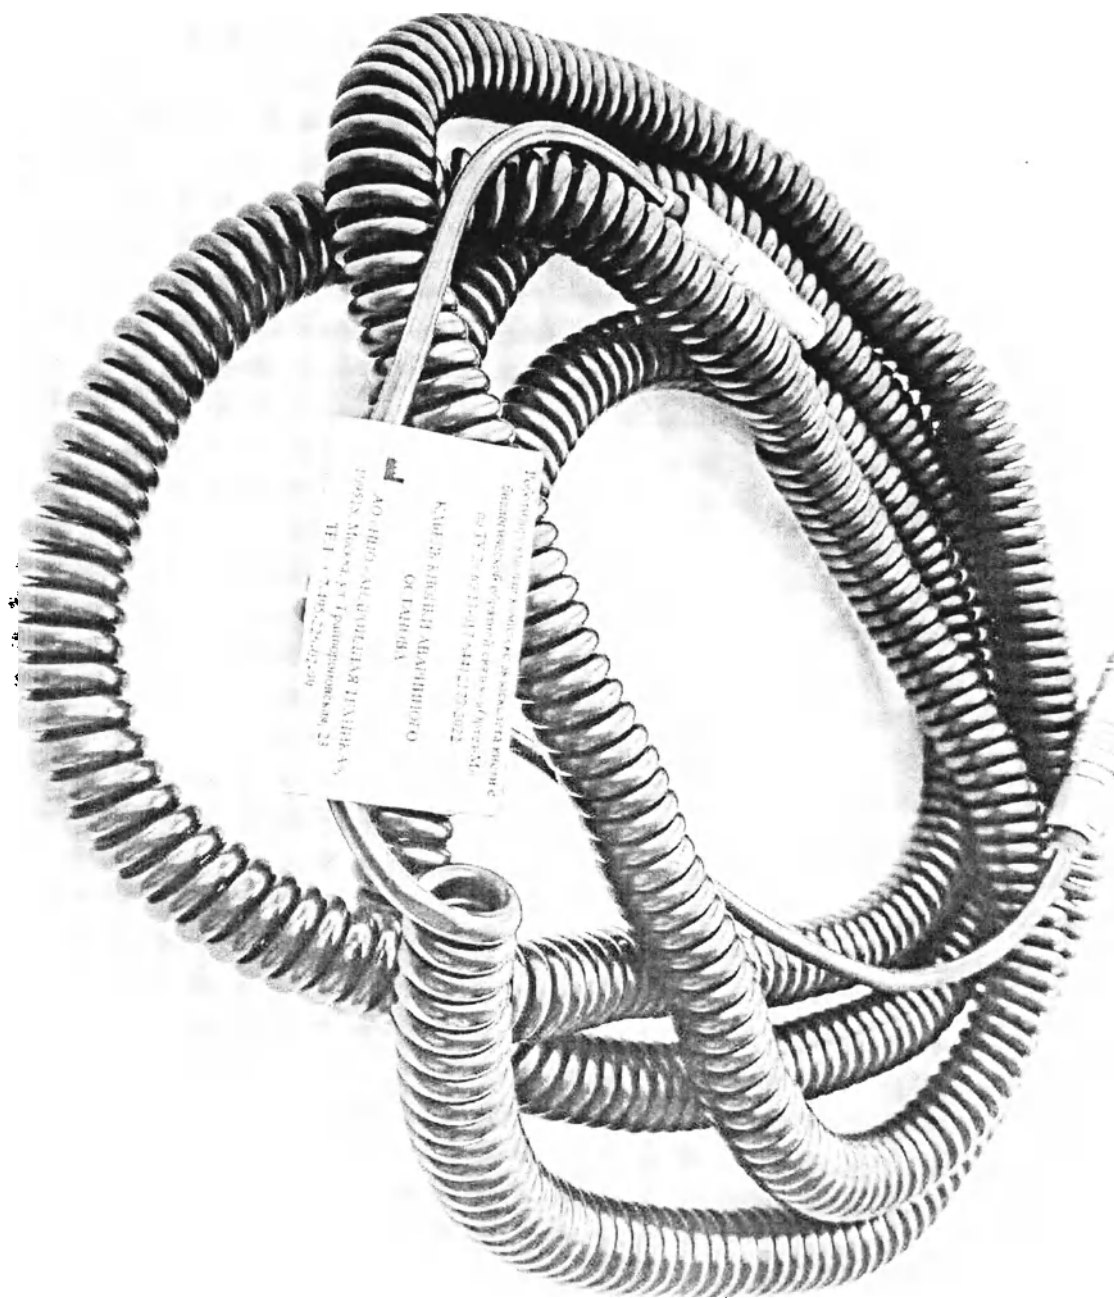


Рис. 16 - Кабель кнопки аварийного останова

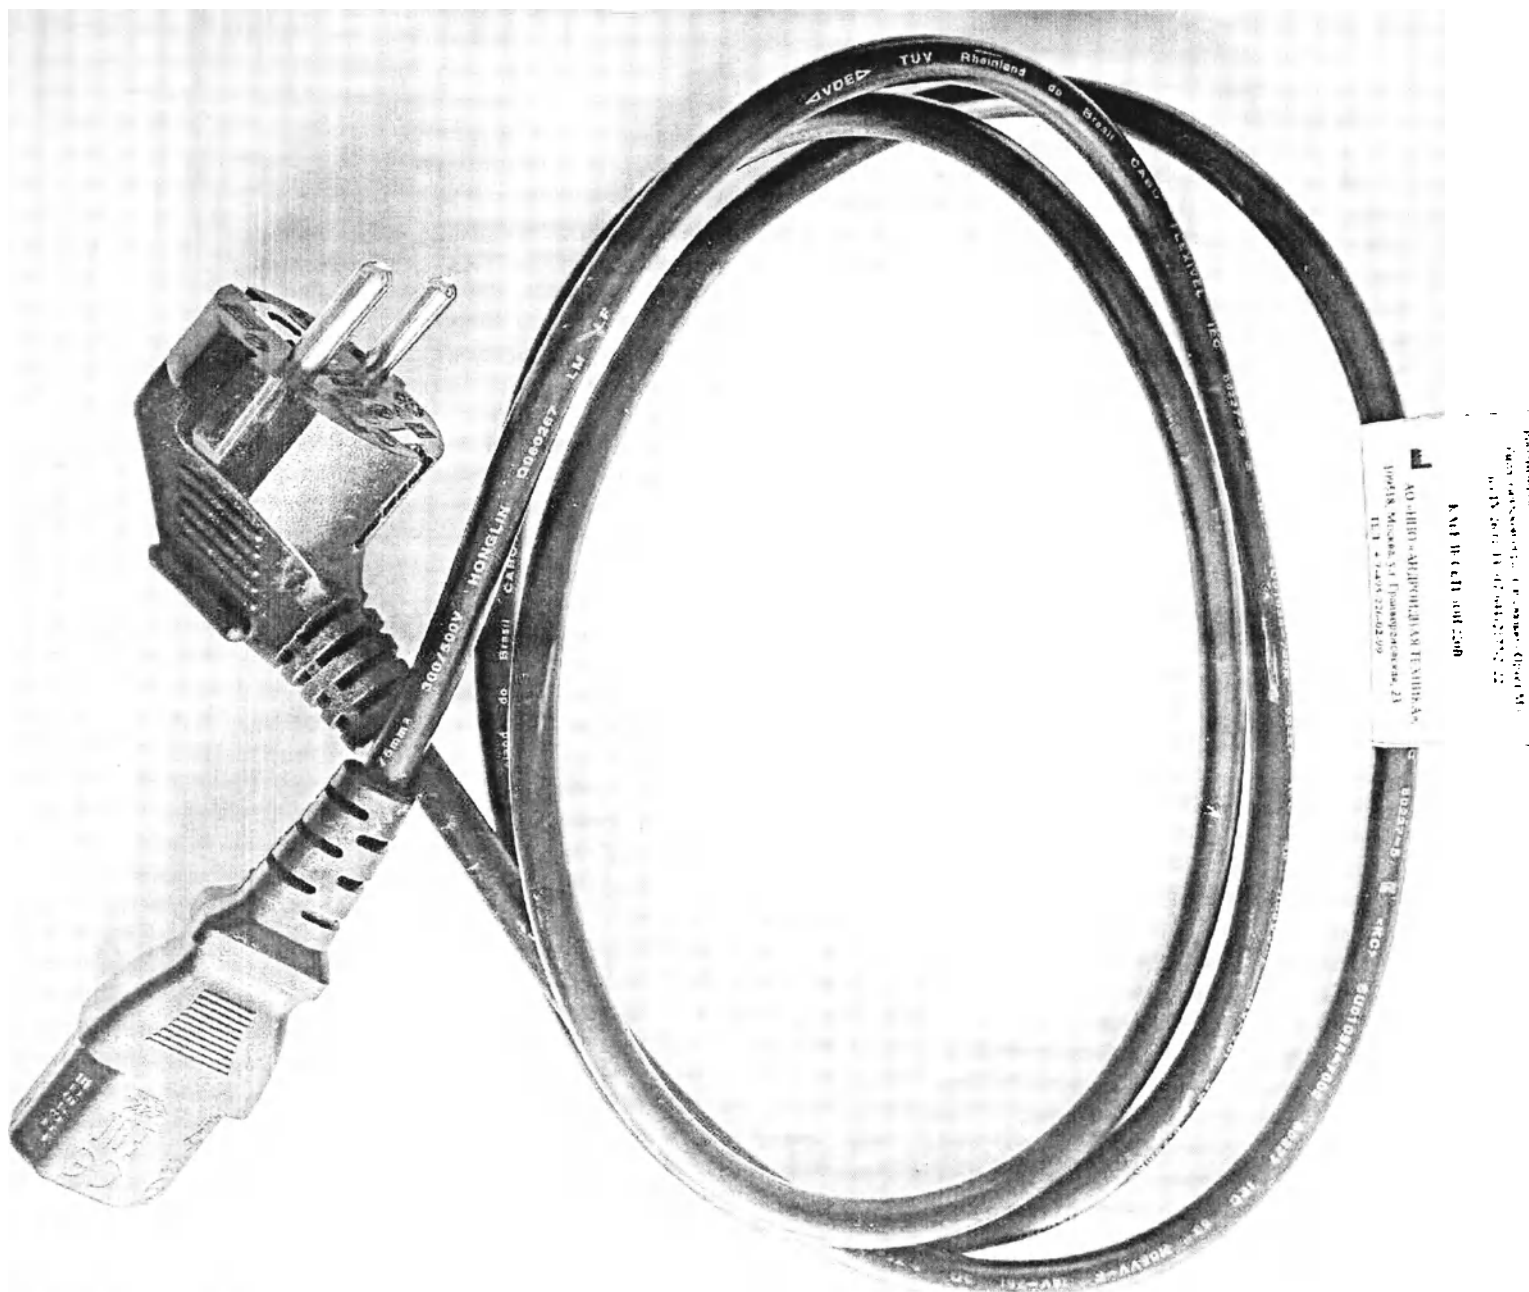


Рис. 18 - Кабель сетевой 220В

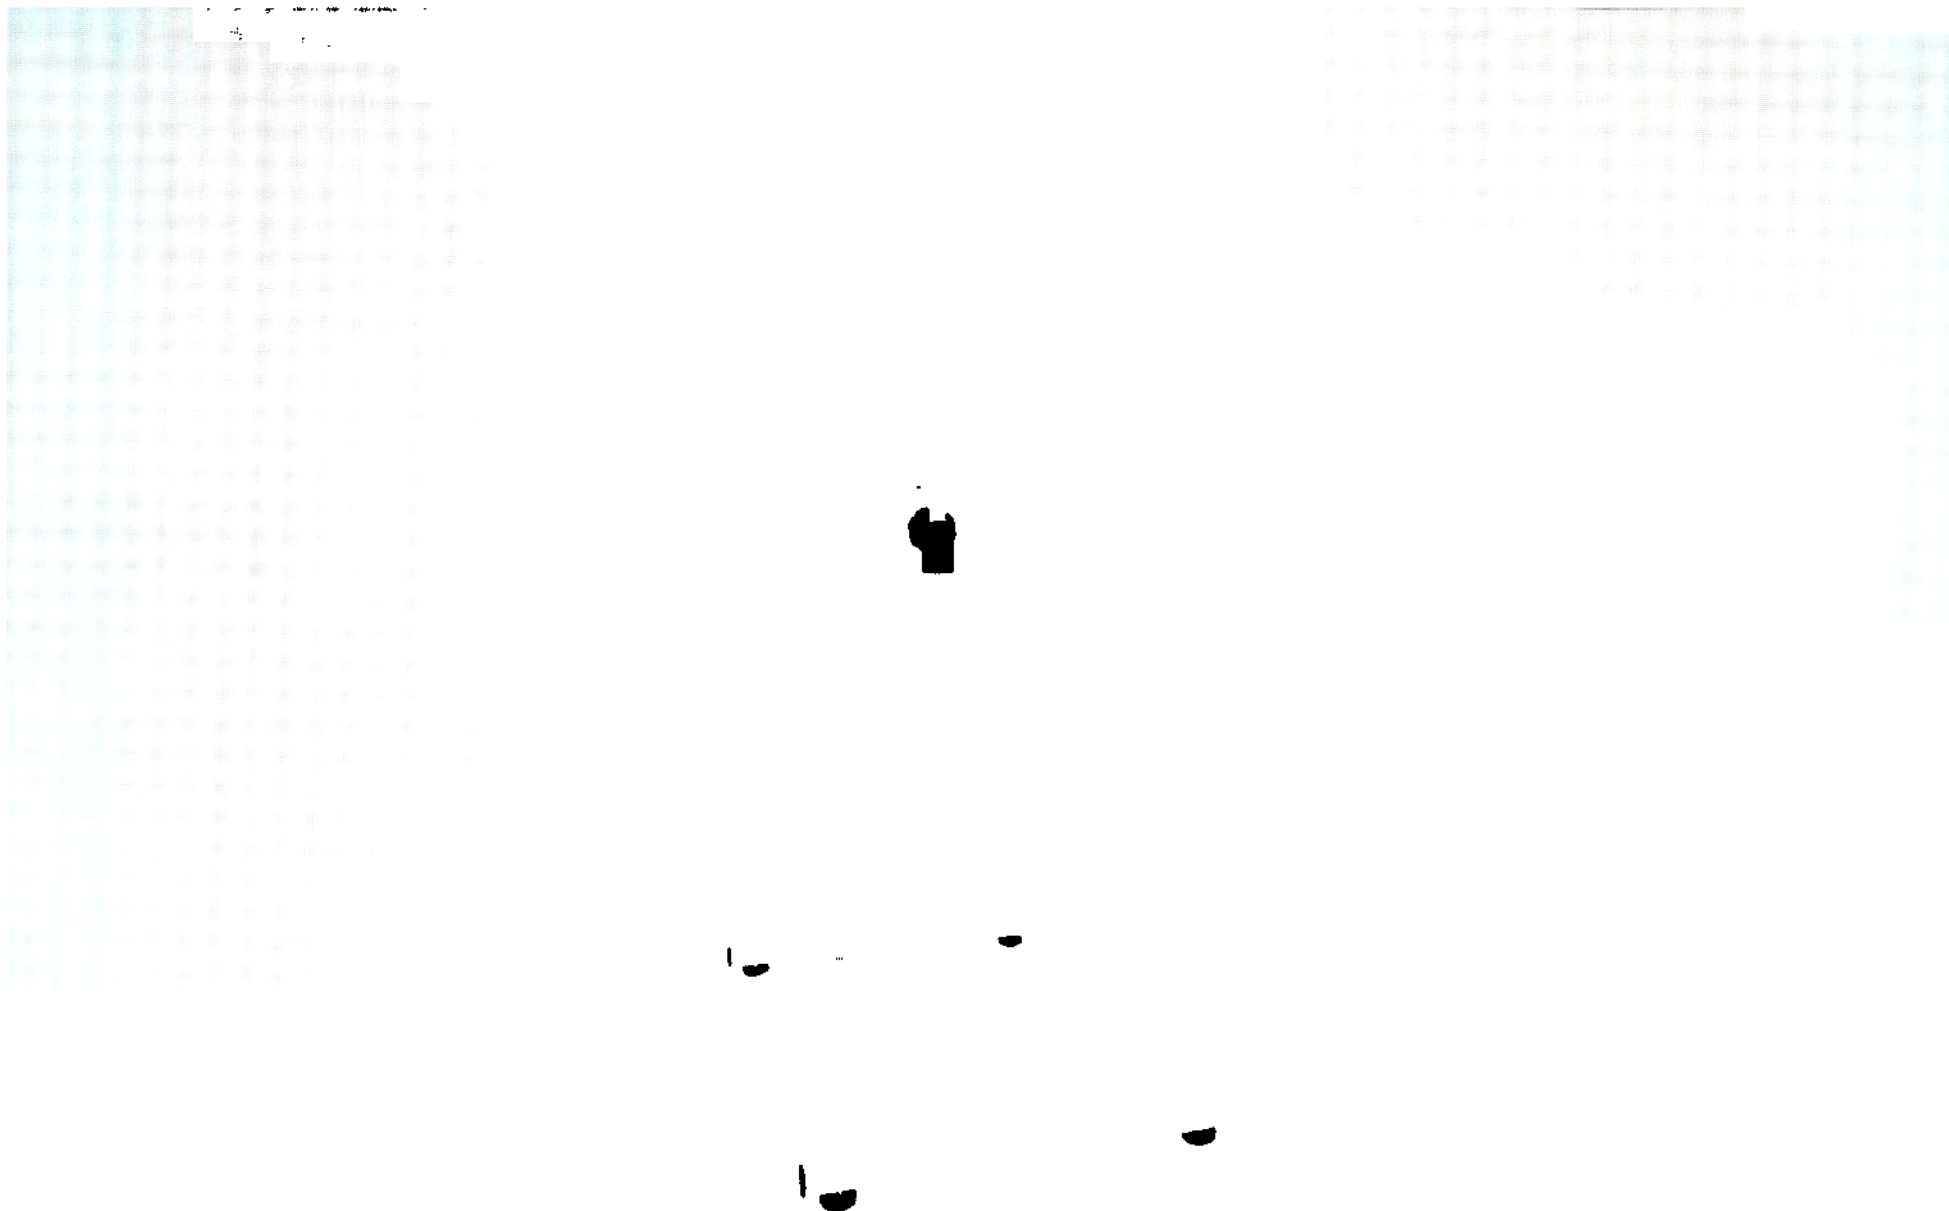


Рис. 19 - Стойка

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА

Роботизированный комплекс экзоскелета кисти с
биологической обратной связью «Орtez-М» по ТУ
26.60.13-017-64412177-2022

РУ № _____

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ОРТЕЗ-М»

Версия: 1.0.



АО «НПО «АНДРОИДНАЯ ТЕХНИКА»,
109518, Москва, ул. Грайвороновская, 23
ТЕЛ.: + 7-495-226-02-99

АО «НПО «АНДРОИДНАЯ
ТЕХНИКА»

Итого в настоящем документе

22 (двадцать два) листа (ов)

Генеральный директор
Пермяков А.Ф.