



**Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для определения иммуноглобулинов класса G
к вирусу кори»
"ИФА-Корь-IgG"**

Серия 01 от 2021.01.11

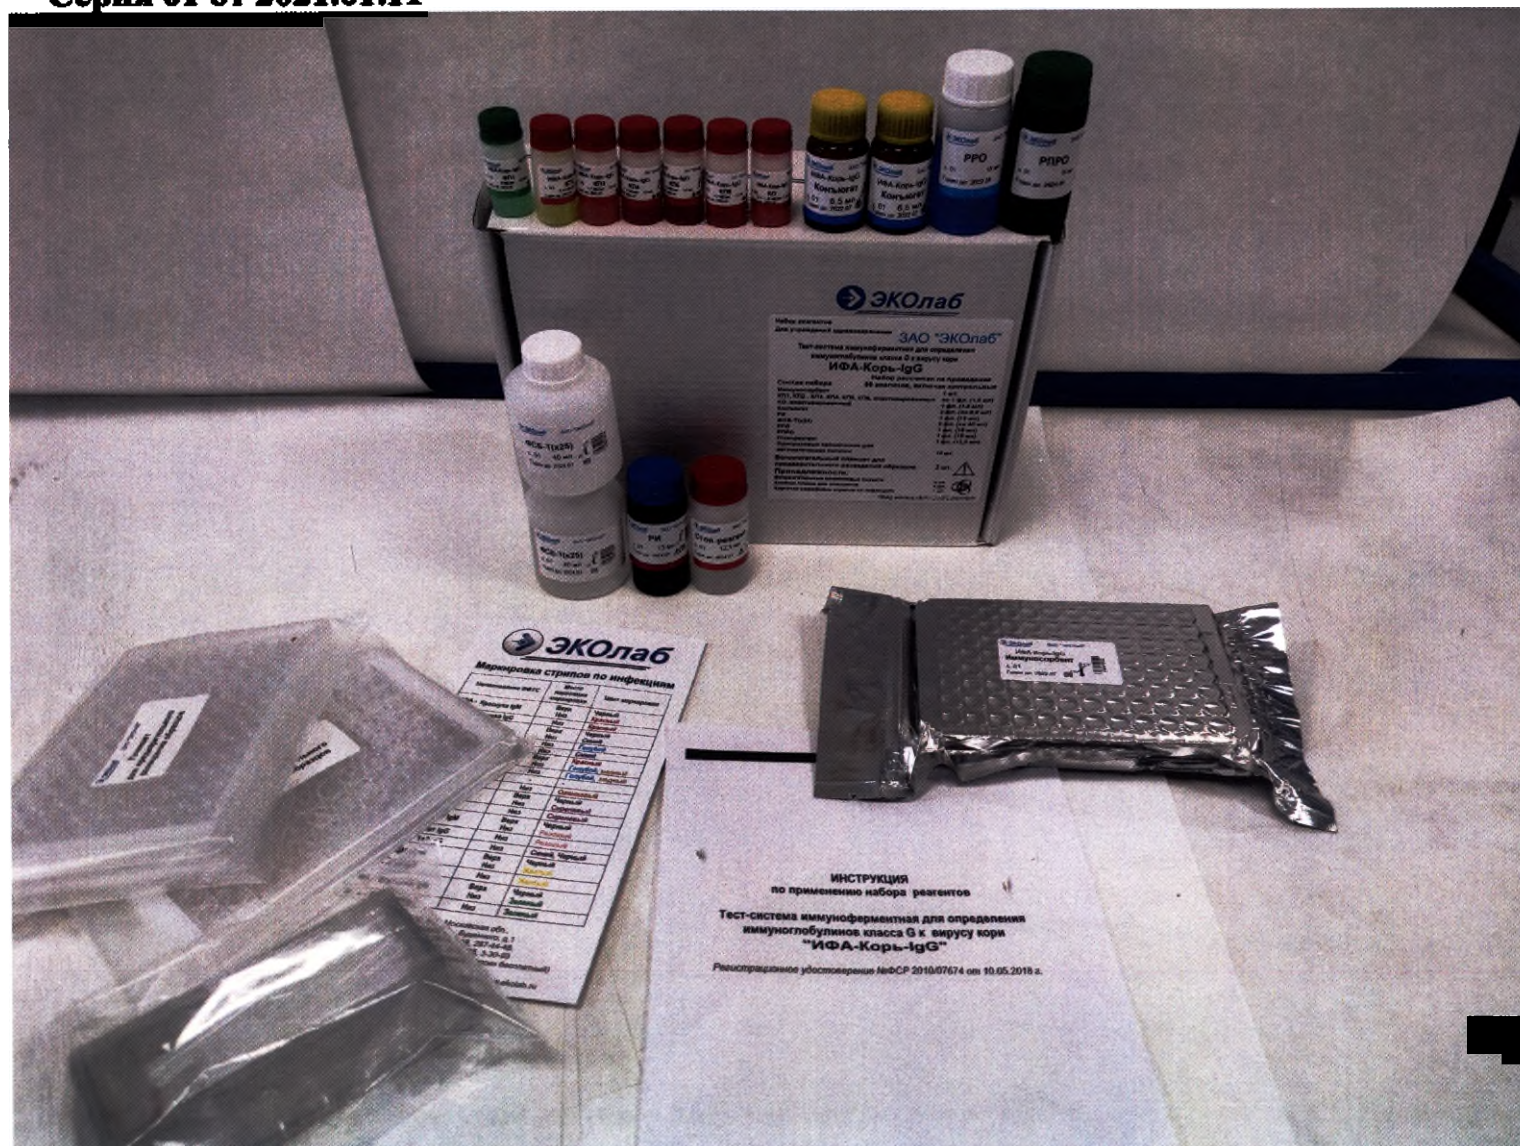

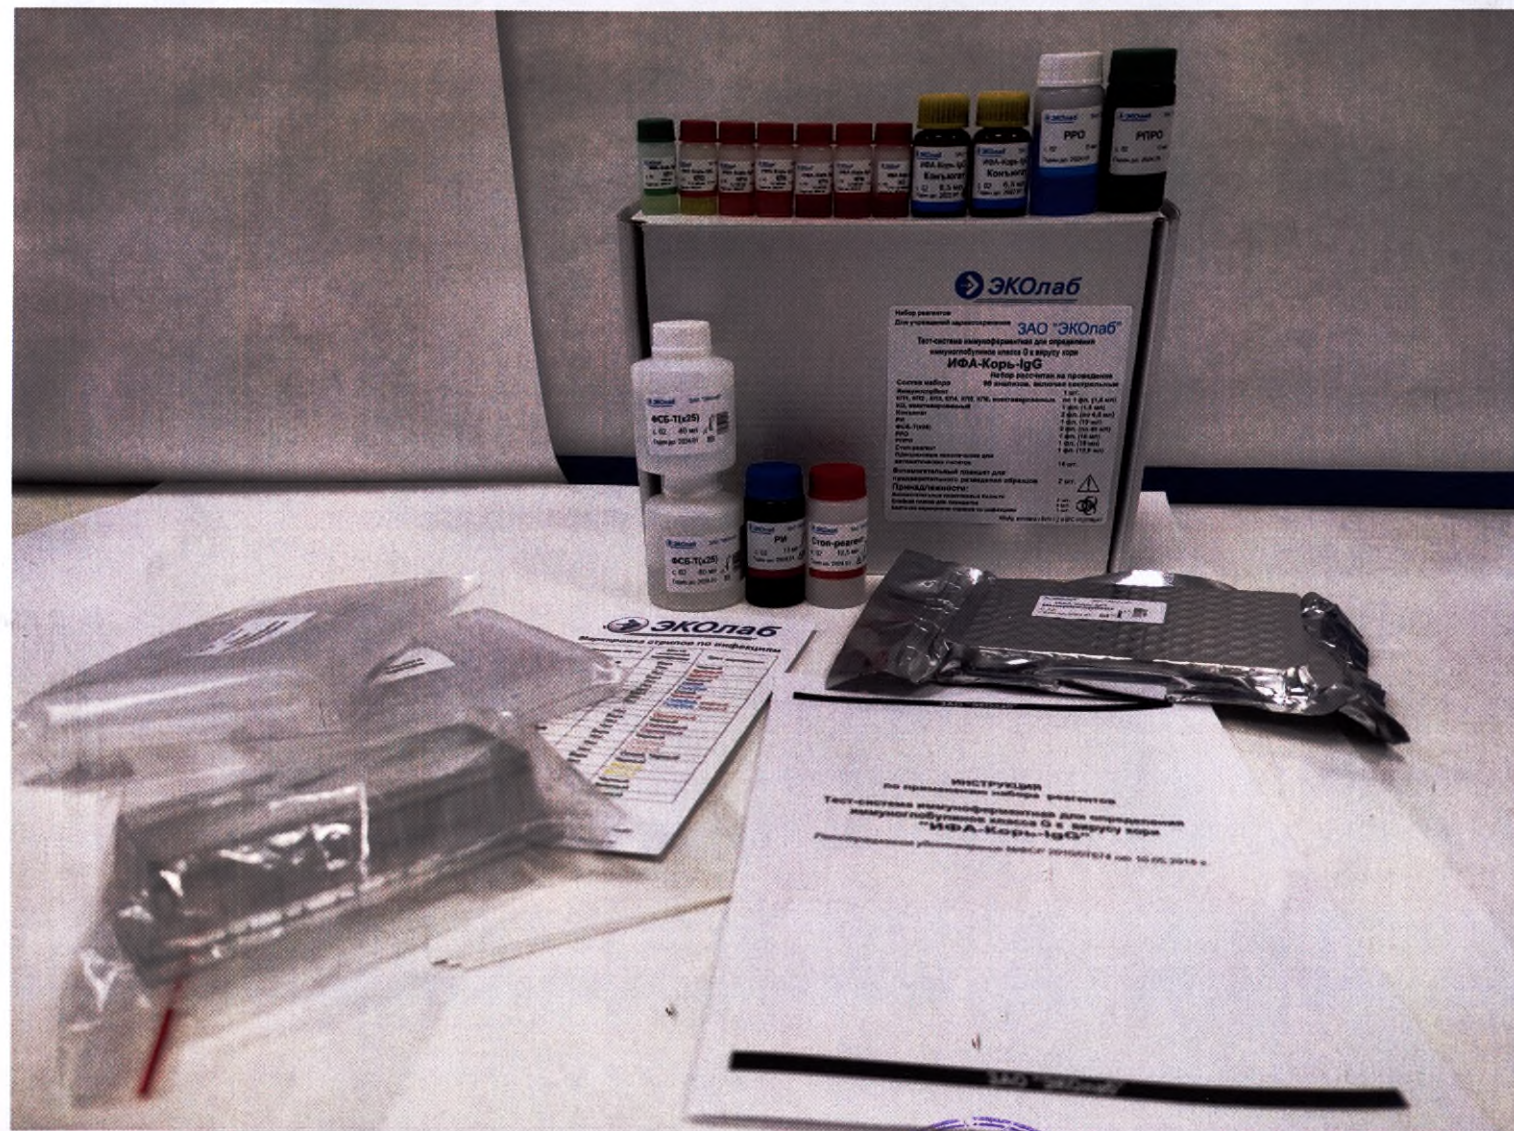

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 9

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

"20" 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения
иммуноглобулинов класса G к вирусу кори

ИФА-Корь-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КП1, КП2, КП3, КП4, КП5, КП6, инактивированные	по 1 фл. (1,5 мл)
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Конъюгат	2 фл. (по 6,5 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (по 40 мл)
РРО	1 фл. (15 мл)
РПРО	1 фл. (15 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Вспомогательный планшет для
предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

4 шт.
4 шт.
1 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального применения

ИФА-Корь-IgG

ТУ 9398-065-70423725-2021

ПУ №ФСР 2010/07674 от 10.05.2018

Каталожный № 19.02

Серия 01

Контрольный № 213














Дата изготовления: 2021.01.11

Годеи до: 2022.07.11



19.02.

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

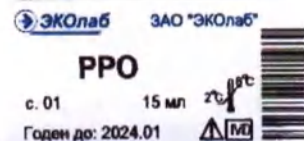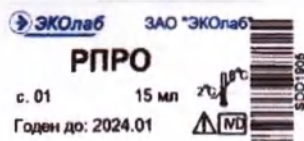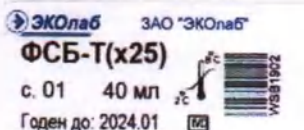

Директор производства ДП:

(Signature)

Осинская А.Д.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для определения
иммуноглобулинов класса G к вирусу кори

ИФА-Корь-IgG

Набор рассчитан на проведение

96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент

КП1, КП2, КП3, КП4, КП5, КП6, инактивированные

КО, инактивированный

Конъюгат

РИ

ФСБ-Т(x25)

РРО

РПРО

Стоп-реагент

Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

Вспомогательный планшет для

предварительного разведения образцов

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

Клейкая пленка для планшетов

Карточка маркировки стрипов по инфекциям

1 шт.

по 1 фл. (1,5 мл)

1 фл. (1,5 мл)

2 фл. (по 6,5 мл)

1 фл. (13 мл)

2 фл. (по 40 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (15 мл)

1 фл. (12,5 мл)

16 шт.

2 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.

HBsAg, антигена к В/Ч-1,2 и ВГС отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ФСБ-Т(x25)

с. 02 40 мл

Годен до: 2024.01

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

РПРО

с. 02 15 мл

Годен до: 2024.01

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

РРО

с. 02 15 мл

Годен до: 2024.01

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

Конъюгат

с. 02 6,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

РИ

с. 02 13 мл

Годен до: 2024.01

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Стоп-реагент

с. 02 12,5 мл

Годен до: 2024.01

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG
Иммуносорбент

с. 02

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП1 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП2 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП3 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП4 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП5 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КО 1,5 мл

Годен до: 2022.07

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-Корь-IgG

с. 02 КП6 1,5 мл

Годен до: 2022.07

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2 а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"26" _____ 2022 г.

