

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «СБ МЕДИКАЛ»



Балаян Л.Г.

«14» октября 2024 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению

Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН
по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024



Рисунок 1 – Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН
по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024



Рисунок 2.1 – Сверло центровочное (внешний вид)

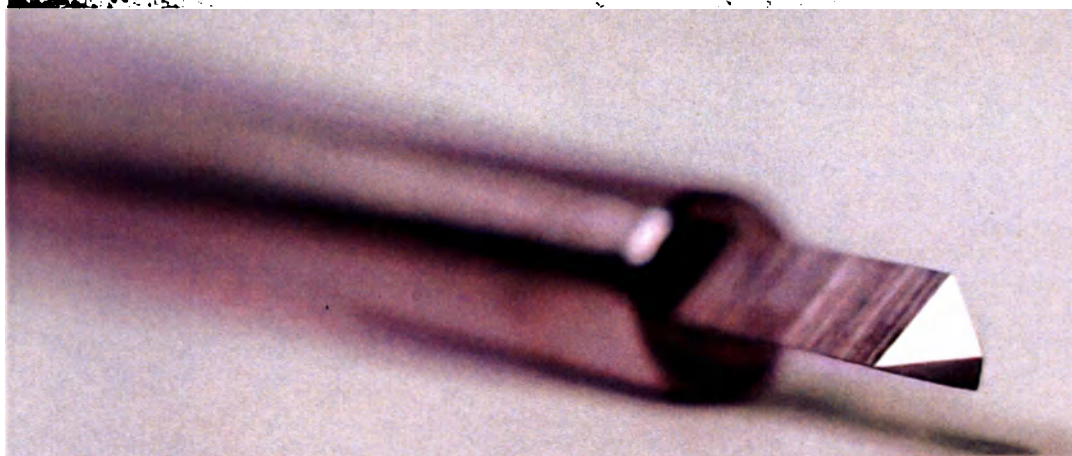


Рисунок 2.2 – Сверло центровочное (рабочий кончик)

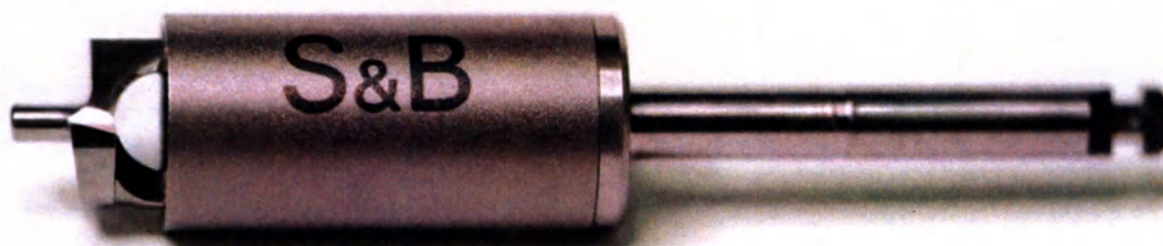


Рисунок 3.1 – Скребок костный с защитным колпачком (в сборе вид спереди)



Рисунок 3.2 – Скребок костный с защитным колпачком (в сборе вид сзади)

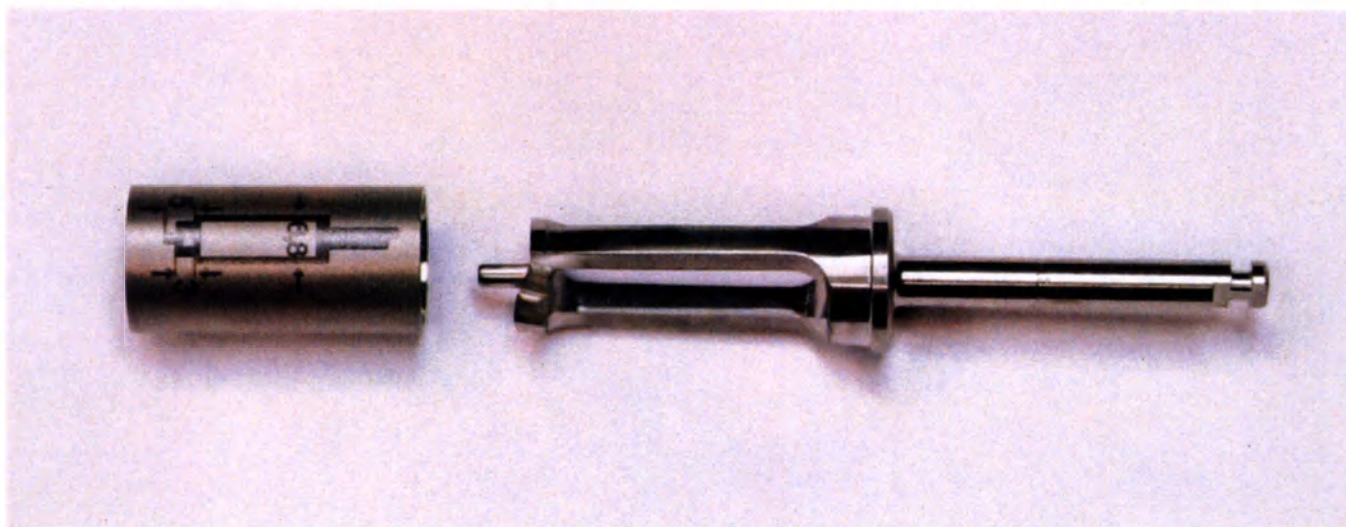


Рисунок 3.3 – Скребок костный с защитным колпачком (разобран)

 ООО "СБ МЕДИКАЛ", 125466, Российская Федерация, г. Москва, ул. Родионовская д.10 к.1 кв/оф 247 info@sbmedical.info www.sbmedical.info	Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024 в составе: 1. Сверло центровочное – 1 шт.; 2. Скребок костный с защитным колпачком – 1 шт.; 3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Нержавеющая сталь ПУ № XXXXXXXXXX ОТ XX.XX.XX REF XXX.XXXX LOT XXXX XX-XXXX      	

Рисунок 4.1 – Макет этикетки для потребительской упаковки



Рисунок 4.2 – Потребительская упаковка (вид внутри)



Рисунок 4.3.1 – Потребительская упаковка (вид внешний) для Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024,

- в составе: 1. Сверло центровочное – 1 шт.,
2. Скребок костный с защитным колпачком – 1 шт.;
 3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Рисунок 4.3.2 – Потребительская упаковка (вид внешний) для Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024, в составе: 1. Сверло центровочное – 1 шт.,
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

РОТОБОН



Рисунок 4.3.3 – Потребительская упаковка (вид внешний) для Скребок-сверло для забора аутогенной кости РОТОБОН по ТУ 32.50.11-003-43993997-2024, в составе: 1. Скребок костный с защитным колпачком – 1 шт.;
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

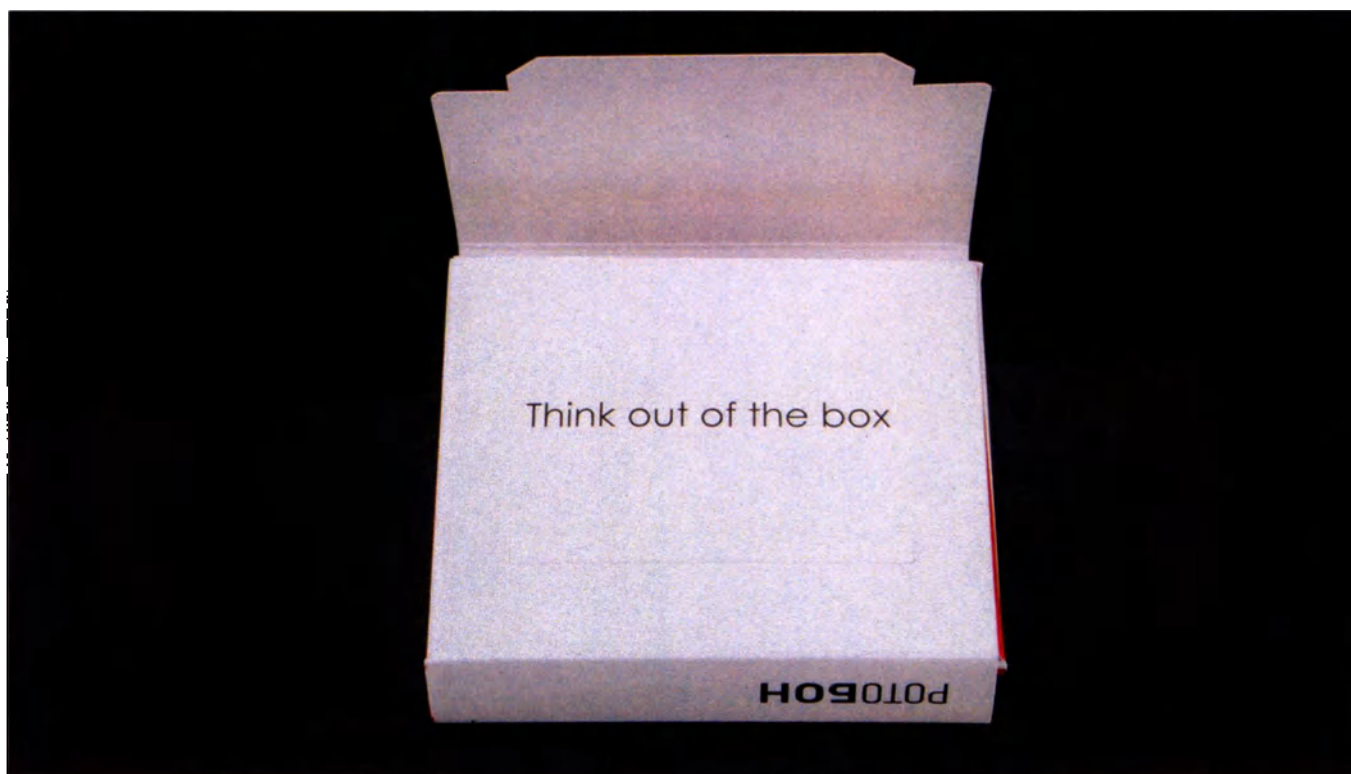


Рисунок 4.4 – Потребительская упаковка (вид сзади открытый)



Рисунок 4.5 – Потребительская упаковка (вид сзади закрытый)



ООО "СБ МЕДИКАЛ", 125466,
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Родионовская д.10 к.1 кв/оф 247

info@sbmedical.info
www.sbmedical.info

Скребок-сверло для забора аутогенной
кости РОТОБОН по ТУ 32.50.11-003-
43993997-2024 в составе:

1. Сверло центровочное – 1 шт.;
2. Скребок костный с защитным
колпачком – 1 шт.;
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Количество в коробке ____шт.

РУ № XXXXXXXXXX ОТ XX.XX.XX

Нержавеющая сталь



REF XXX.XXXX

LOT XXXX

XX-XXXX




Рисунок 5.1 – Макет этикетки для транспортной упаковки


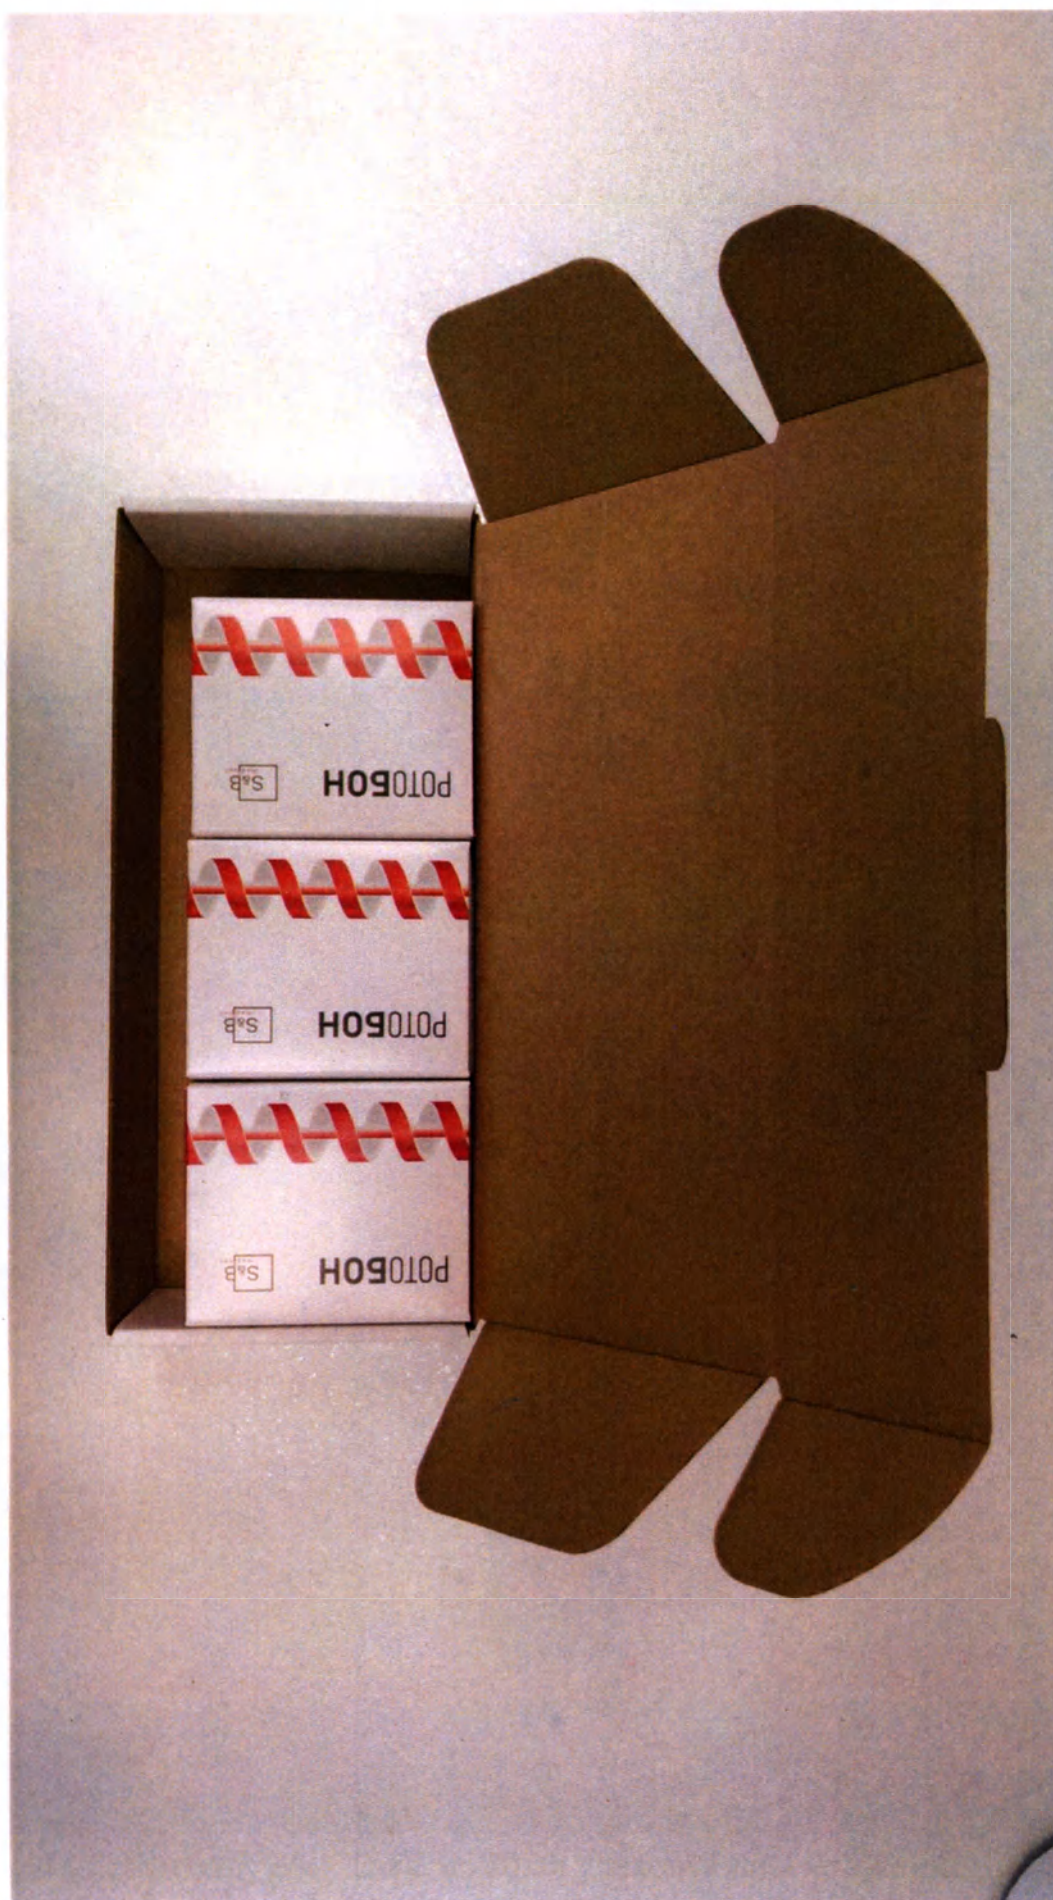


Рисунок 5.2 – Транспортная упаковка (вид внутри)

Прошито и скреплено печатью
количество (15 *пятидесять*) листов
Генеральный директор
ООО «СБ МЕДИКАЛ»



/ Балаян Л.Г./

Подпись

ФИО

