


Фотографические изображения

**Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический»
(Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и
внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в моделях,**

производства Bio-Rad Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториес, Инк.»), США

Версия 1

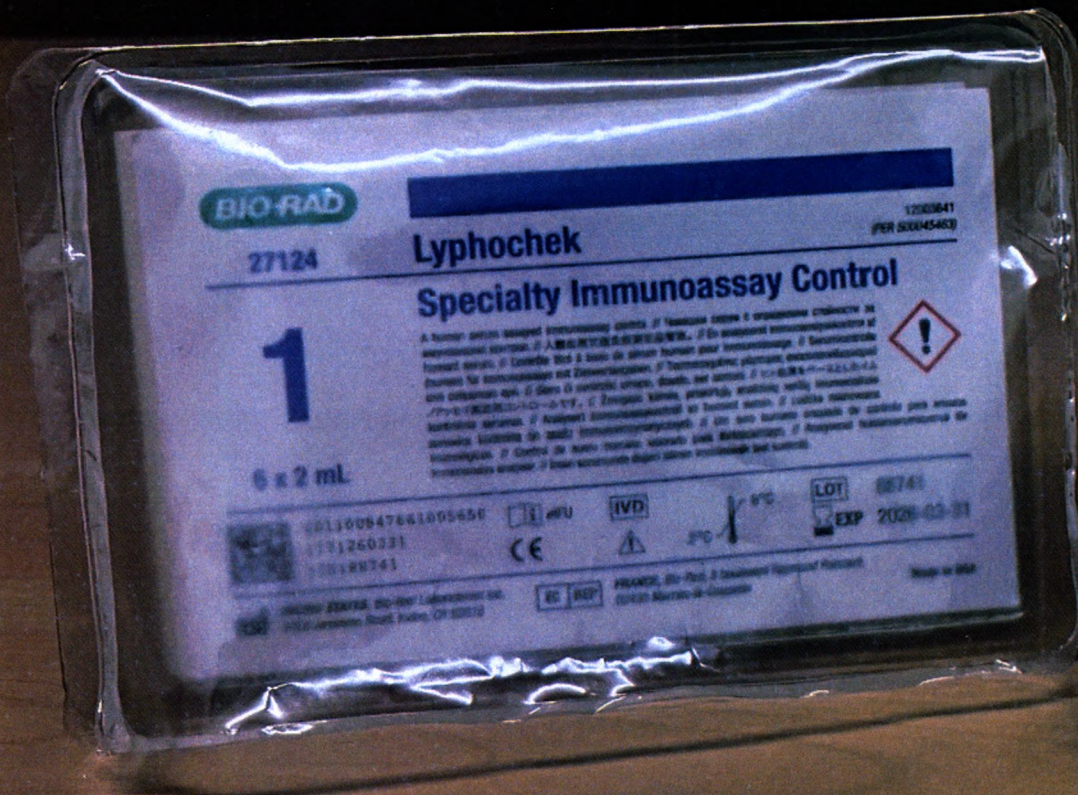

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 1, в составе: - Материал



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 1, в составе: - Материал

REF: 27124

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphochek Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 1, в составе:

- Материал контрольный Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 6 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, номер по каталогу и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Bio-Rad Laboratories, Inc., 9500 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: +7 (495) 721-14-04, e-mail: diag_support_rcis@bio-rad.com

Инструкция по применению доступна по ссылке:

<https://www.qcnet.com/ru/Документация/Инструкции>

Место производства: США

Макет маркировки этикетки на русском языке

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphochek Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 1, в составе: - Материал контрольный Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 6 шт.



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 2, в составе: - Материал



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 2, в составе: - Материал

IVD

REF: 27125

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphochek Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 2, в составе:

- Материал контрольный Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 6 шт.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, номер по каталогу и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Bio-Rad Laboratories, Inc., 9500 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: +7 (495) 721-14-04, e-mail: diag_support_rcis@bio-rad.com

Инструкция по применению доступна по ссылке:

<https://www.qcnet.com/ru/Документация/Инструкции>

Место производства: США

Макет маркировки этикетки на русском языке

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphochek Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 2, в составе: - Материал контрольный Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 6 шт.



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 3, в составе: - Материал



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 3, в составе: - Материал контрольный Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 6 шт. (флаконы)

REF: 27126

IVD

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 3, в составе:

- Материал контрольный Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 6 шт.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, номер по каталогу и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Bio-Rad Laboratories, Inc., 9500 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: +7 (495) 721-14-04, e-mail: diag_support_rcis@bio-rad.com


Инструкция по применению доступна по ссылке:

<https://www.qcnet.com/ru/Документация/Инструкции>

Место производства: США

Макет маркировки этикетки на русском языке


Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Уровень 3, в составе: - Материал контрольный Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 6 шт.

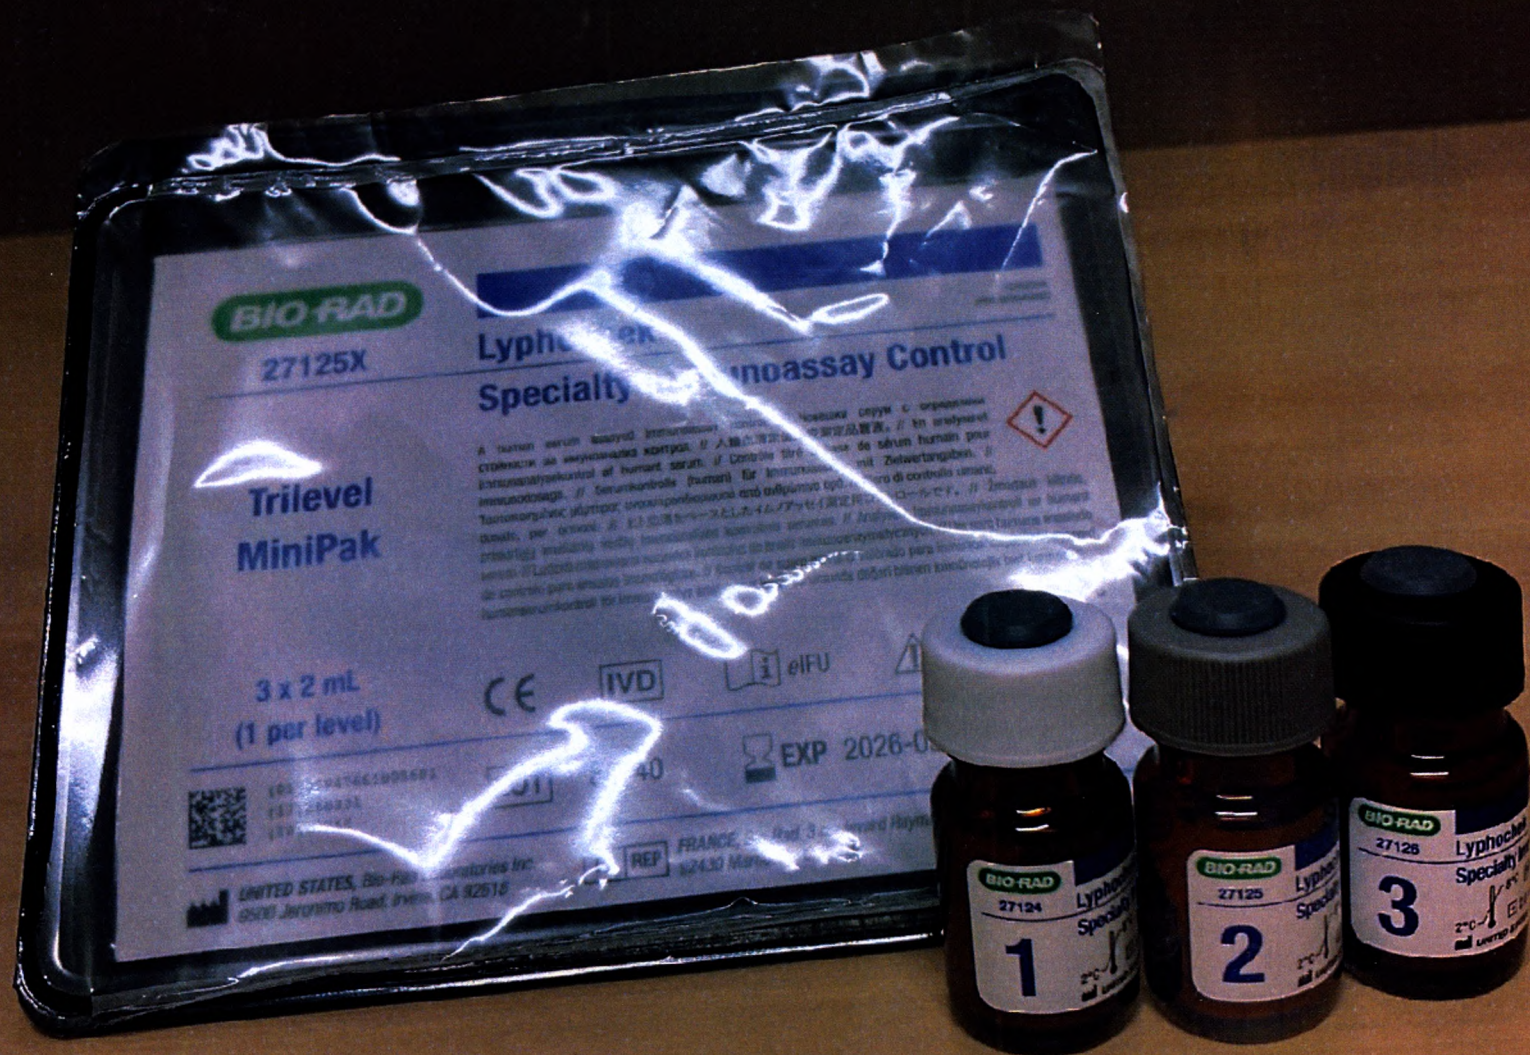

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе: 1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт. (общий вид)



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе: 1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт. (флаконы)

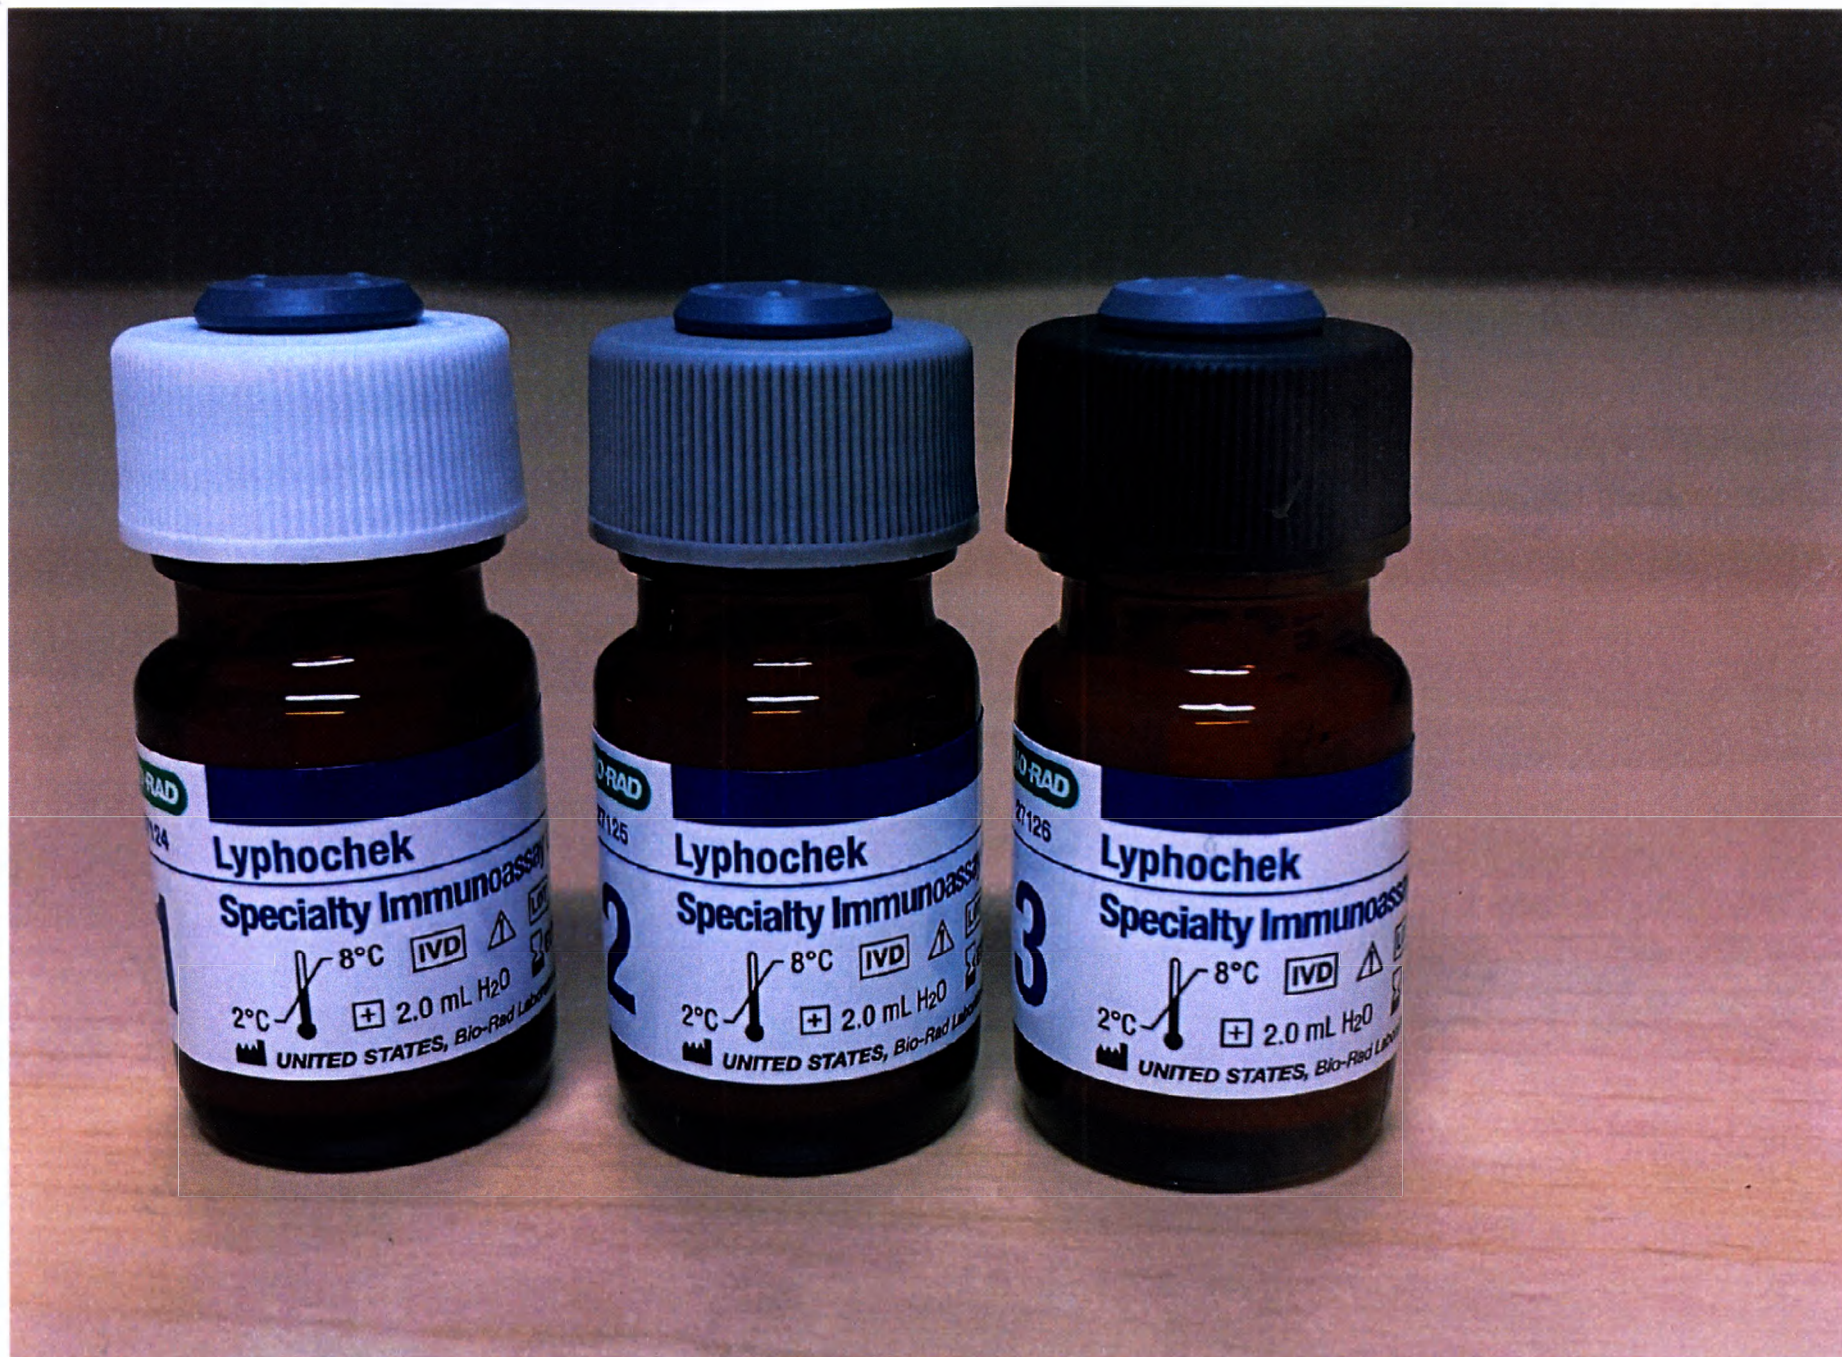

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе: 1. Уровень 1,

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт. (флаконы)



Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе: 1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт. (флаконы)



REF: 27125X

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе:

1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 1 шт.
2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт.
3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, номер по каталогу и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Bio-Rad Laboratories, Inc., 9500 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, USA

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: +7 (495) 721-14-04, e-mail: diag_support_rcis@bio-rad.com

Инструкция по применению доступна по ссылке:

<https://www.qcnet.com/ru/Документация/Инструкции>

Место производства: США

Макет маркировки этикетки на русском языке

Материал контрольный многоуровневый «Липочек Контроль Специальный Иммунохимический» (Lyphocheck Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для контроля качества и внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, модель Trilevel MiniPak, в составе: 1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 1 шт. 3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 1 шт.

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 15 листа «об»

