


Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), вид сзади

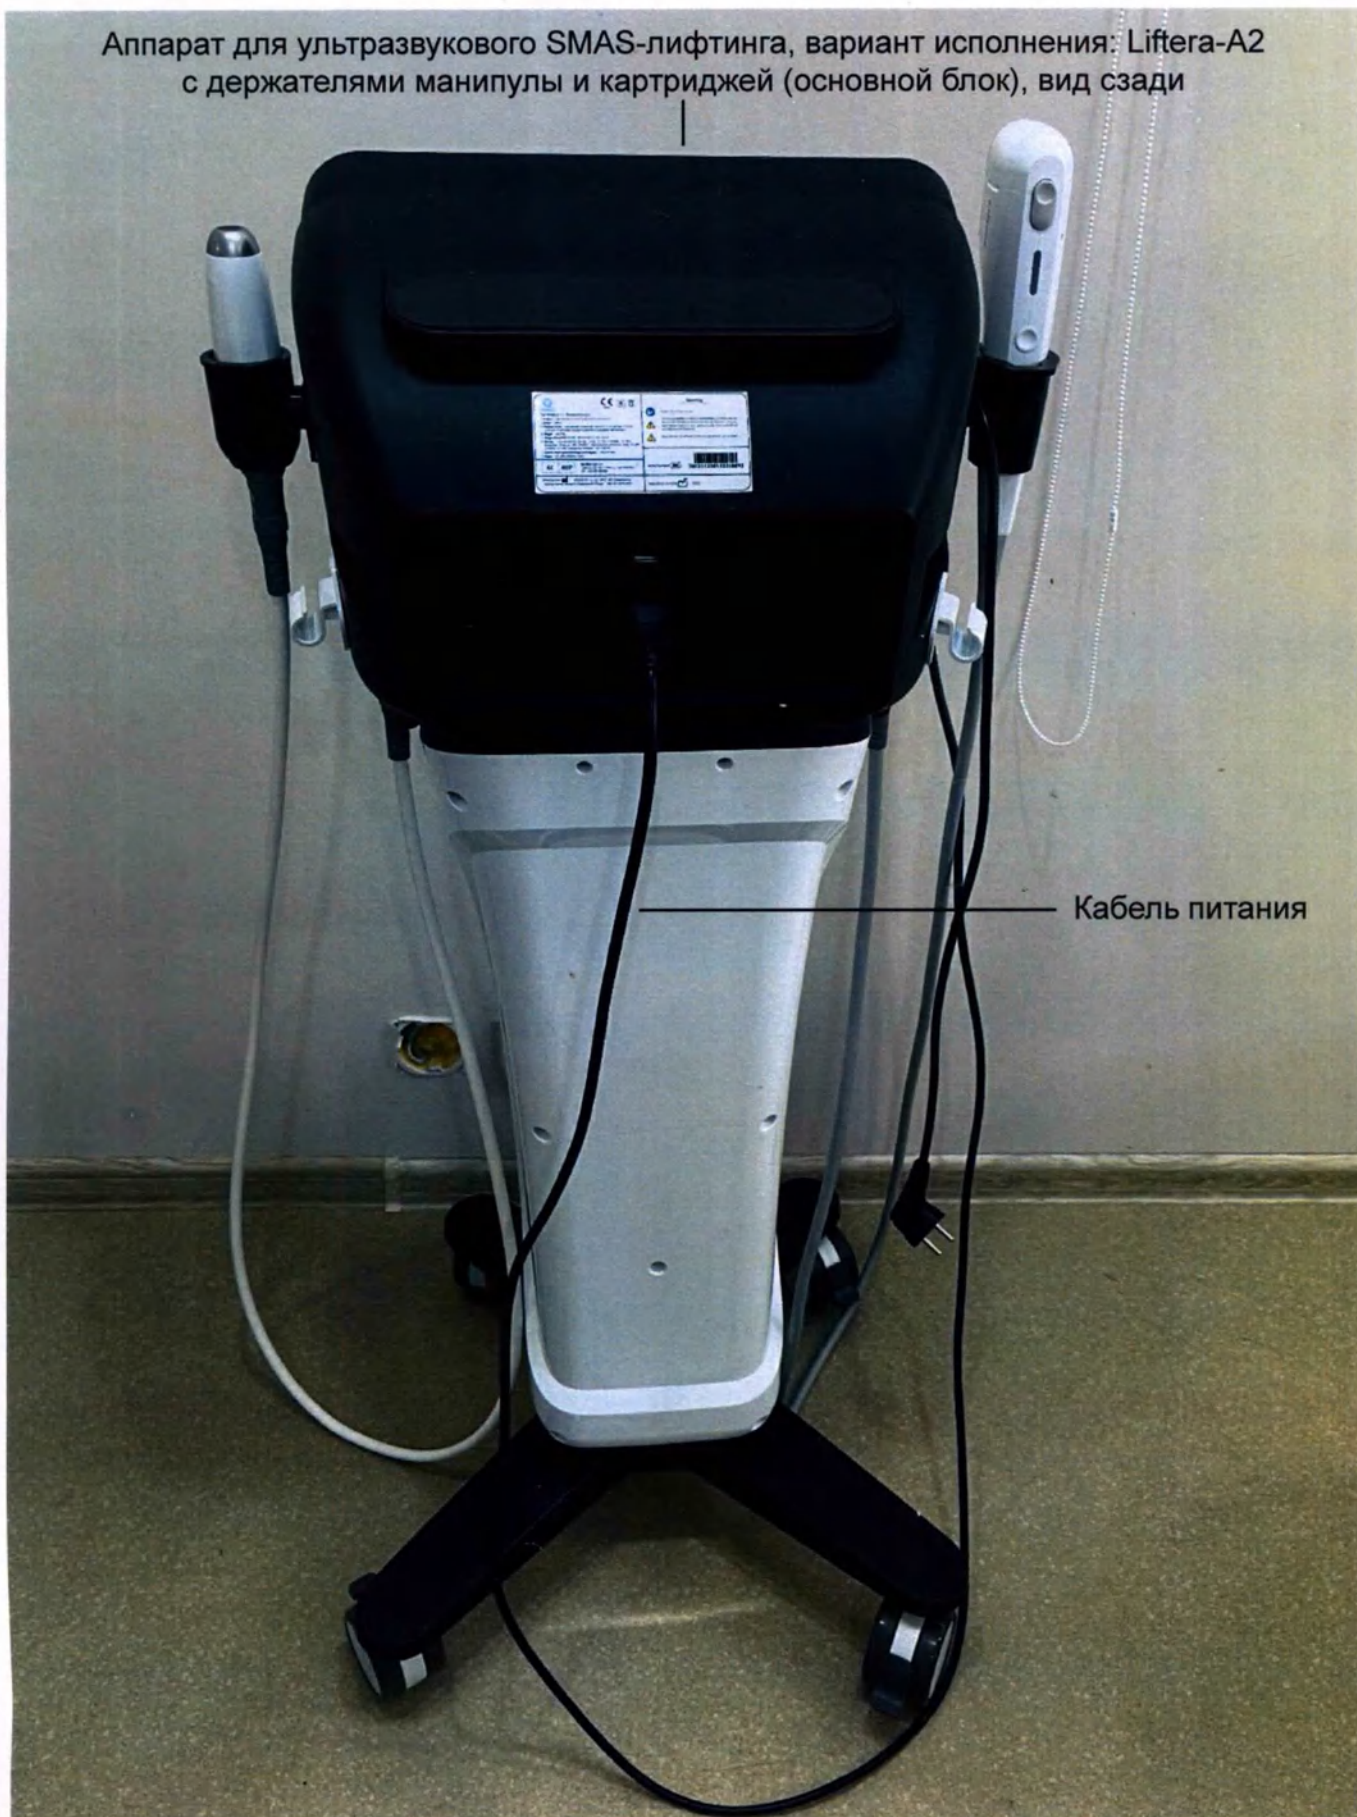

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), вид сзади



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

**ASTERASYS**
YOUR PARTNER for HEALTHCARE

1) **Product** : High intensity focused ultrasound surgical unit

2) **Model** : Liftera-A2

3) **Usage and Storage** : Refer to user manual

4) **Electric shock protection type and degree** :
Class I, Type BF applied part

5) **Rating** : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 300 VA

6) **Non-continuous operation** :
On time Max. 10min., Off time Min. 5min

※ This product is "medical device"

Warning

 Keep product at room temperature.

Read and understand user's manual before using the product.

This product is a consumable and discard after uses. It is strictly prohibited unauthorized reuses and the manufacturer won't be responsible for any kind of damage or malfunction of the product.

Do NOT disassemble. This will cause in permanent Failure and avoid warranty.

Made in Korea





ASTERASYS Co., Ltd.
#1005 #508 #313, 25, Seongsuil-ro 4-gil,
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-1833-7010 E-mail: info@asterasys.com

(01)08809619890468 (10)20081K1
(11)231120 (21)8001

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), серийный номер

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок),
маркировка на русском языке

**ASTERASYS**
YOUR PARTNER IN HEALTHCARE

1) **Продукт:** Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга
2) **Модель:** Liftera-A2
3) **Условия работы и хранения:** см. руководство пользователя
4) **Тип и степень защиты от поражения электрическим током:** Класс I, рабочая часть типа BF
5) **Номинал:** 100–240 В~, 50/60 Гц, 300 ВА
6) **Режим работы:** Непрерывный. Время работы одного картриджа до 10 мин., пауза 5 мин. После смены рабочего картриджа, аппарат продолжает работу в нормальном режиме.
Ж Продукт является медицинским изделием

Предупреждение

- Храните продукт при комнатной температуре.
- Перед использованием продукта прочтите и усвойте руководство пользователя.
- Этот продукт является расходным материалом и выбрасывается после использования.
- Несанкционированное повторное использование строго запрещено, и производитель не несет ответственности за любые повреждения или неисправности продукта.
- НЕ разбирайте. Это приведет к необратимому выходу из строя и аннулированию гарантии.

Сделано в Корее

ASTERASYS Co., Ltd.
#1005 #508 #313 25, Seongsuil-ro 4-gil
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-1833-7010 E-mail: info@asterasys.com

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Картридж Liftera-A2
для линий
1,5 мм



Картридж Liftera-A2
для линий
3,0 мм



Картридж Liftera-A2
для линий
4,5 мм




Картридж
Liftera-A2
для точек 4,5 мм



Картридж
Liftera-A2
для точек 3,0 мм



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

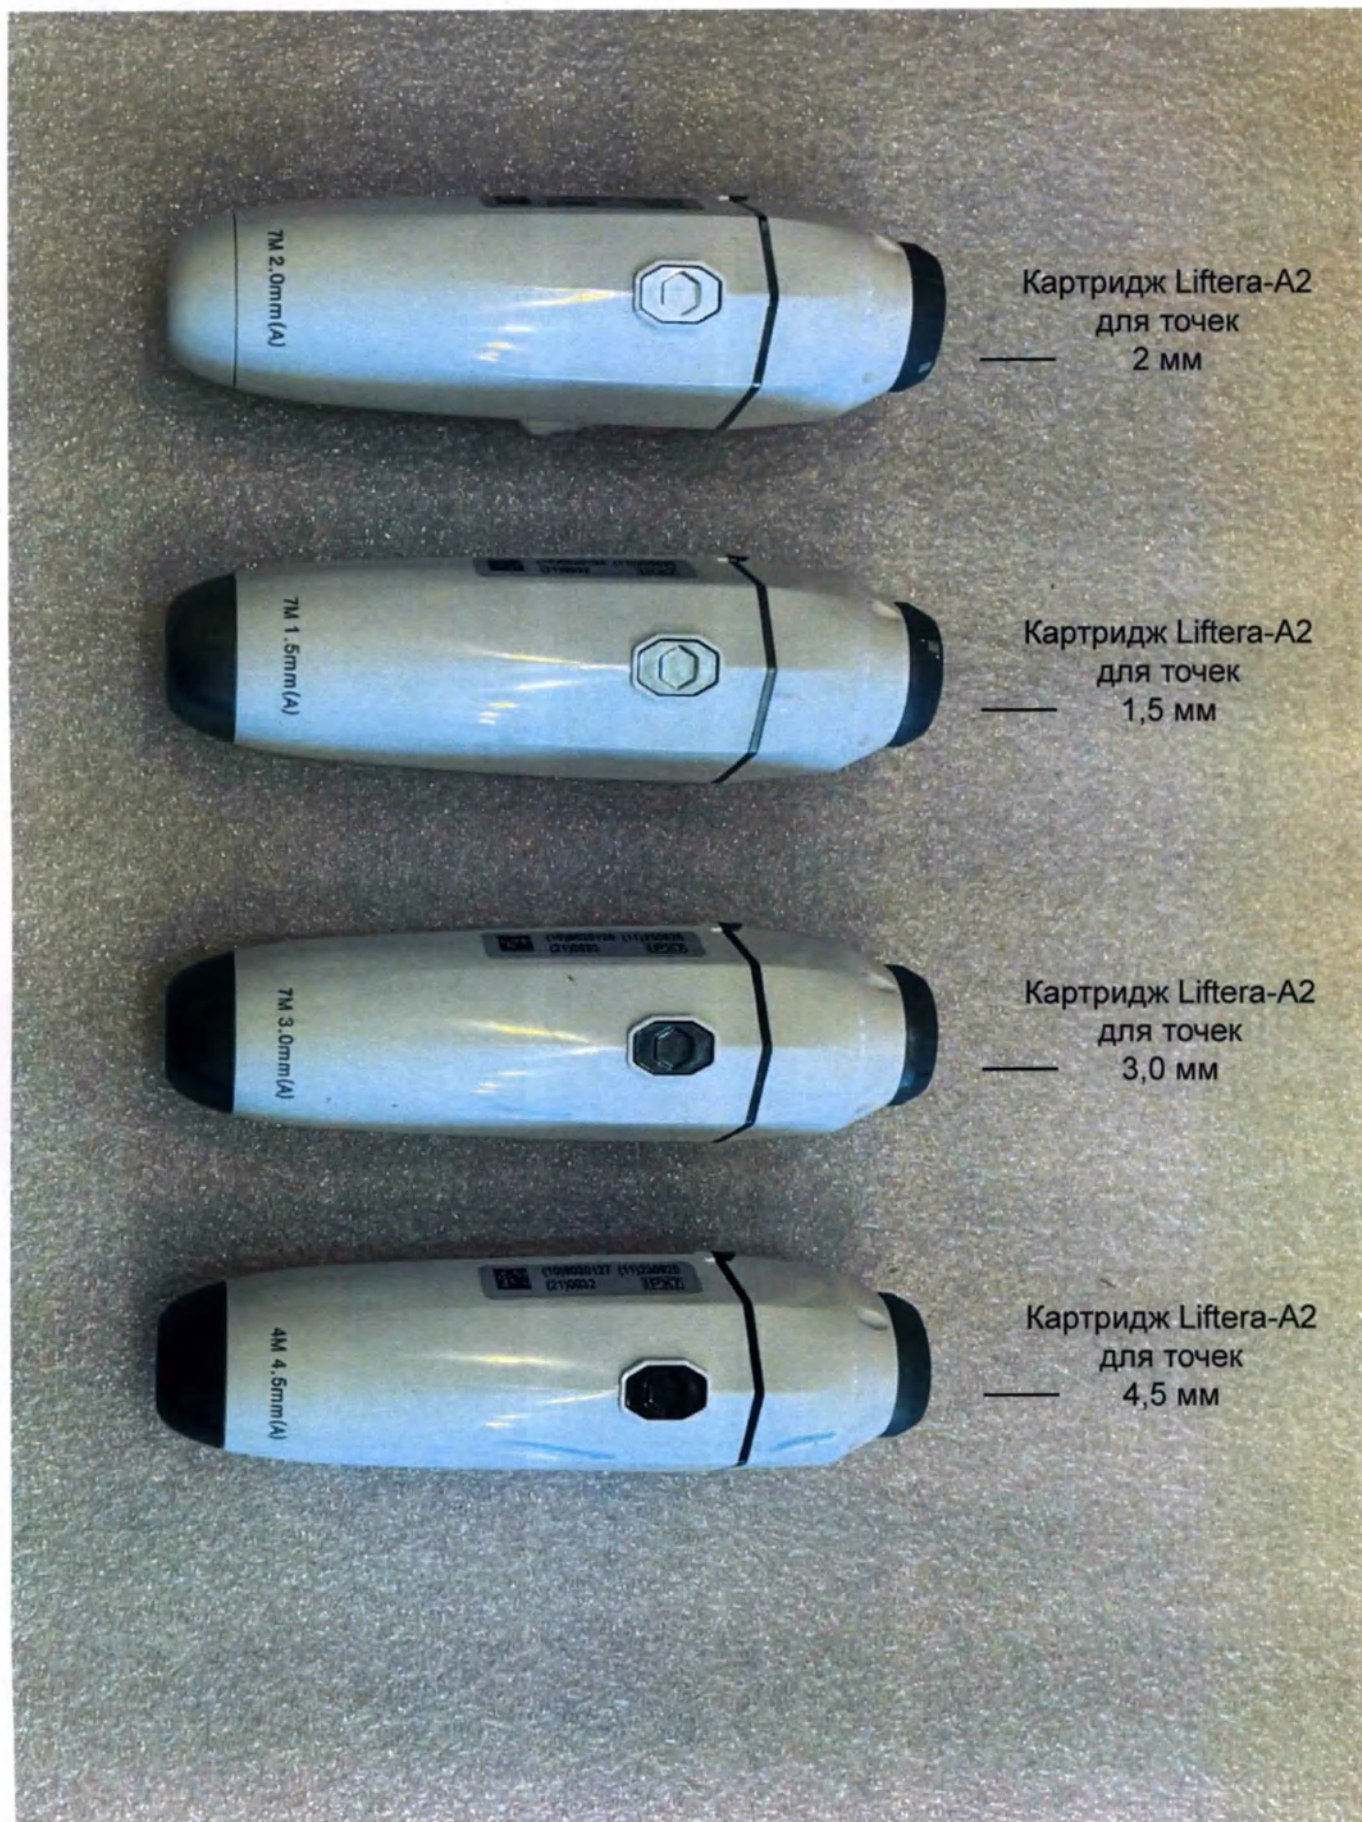

Liftera-A2

Аппарат для ультразвукового
SMAS-лифтинга

Руководство пользователя



ASTERASYS



ASTERASYS Co., Ltd.
#1005, #508, #313, 25, Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu, Seoul,
04781 Republic of Korea,

Tel + 82-1833-7010
Fax + 82-2-6953-0599
Версия Ver.1.0.1

Website <http://www.asterasys.com>
E-mail info@asterasys.com
Дата 22.08.2023

© 2023. Asterasys

Все права зарезервированы. Воспроизводство целиком или частями в любой форме или любым способом, электронным или механическим, запрещено без письменного согласия владельца авторских прав

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2


Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A2
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка






Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2





Model name	Liftera-A2		
Manufacturing License number	No. 5479		
Manufacturing Item License Number	No. 16-425		
Date of Manufacture		Years	Month
Manufacturing number			
Packing unit	1 Q'ty		
Company name / Nationality	ASTERASYS Co., Ltd. / Korea		
Address	 #1005, #508, #313, 25 Seongsuil-ro 4 gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea		
Contact	TEL : +82-1833-7010 FAX : +82-6953-0599		
※ This product is "medical device" Made in Korea			











Handle with care

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2

Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Тележка для транспортировки аппарата, упаковка

MADE IN KOREA

Trolley for Liftera-A2
Asterasys Co., Ltd.,
Republic of Korea

Сделано в Корее

Тележка для транспортировки аппарата
Asterasys Co., Ltd.,
Республика Корея

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A2


Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Всего 14 листов
Генеральный директор
ООО «ГК СпортМедИмпорт»
Ефимова А.В.



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

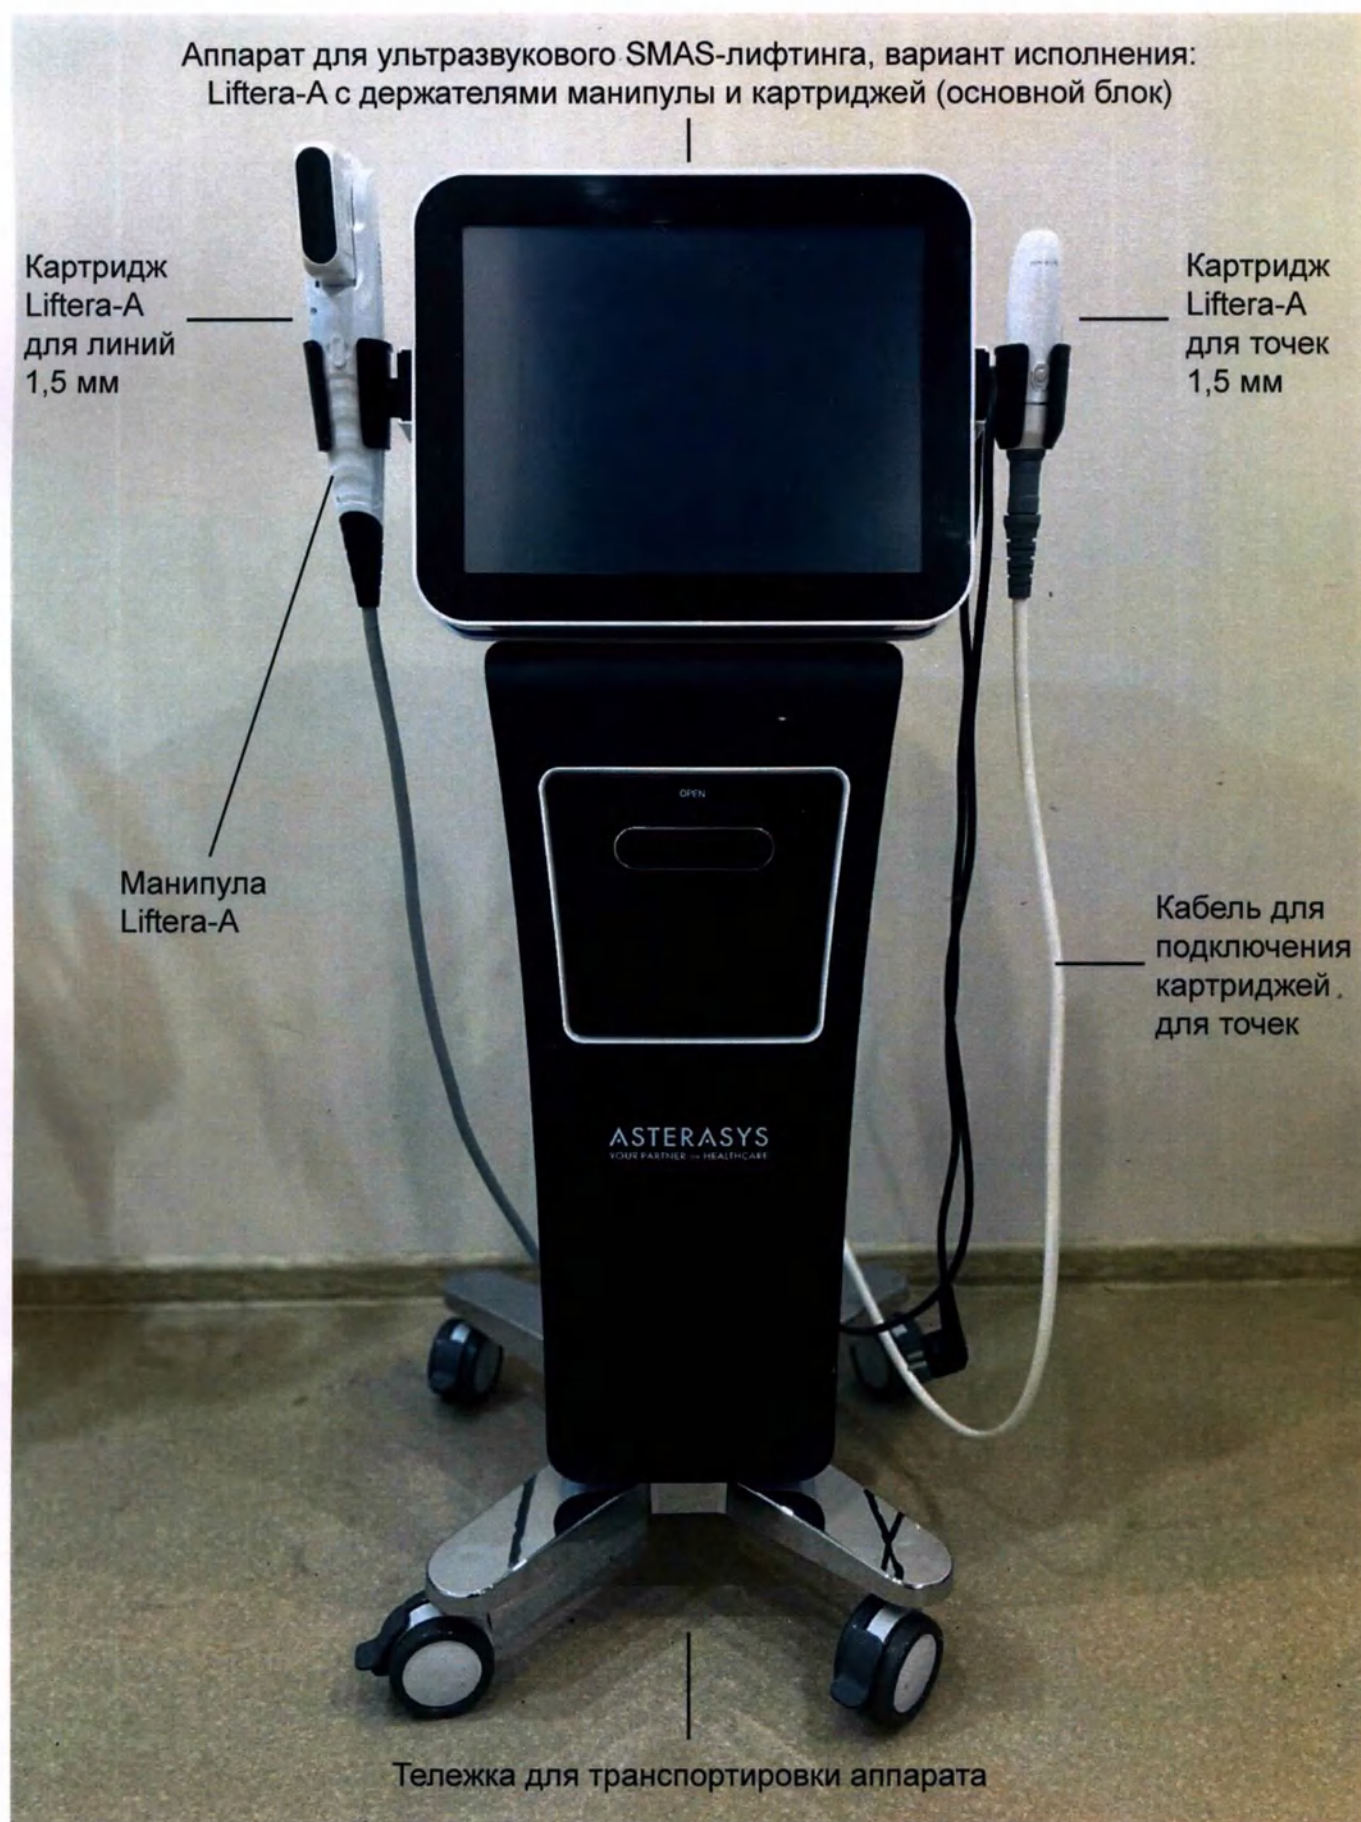

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A




Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A с держателями манипулы и картриджей (основной блок), серийный номер

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A
с держателями манипулы и картриджей (основной блок),
маркировка на русском языке

 ASTERASYS YOUR PARTNER IN HEALTHCARE	Предупреждение
1) Продукт: Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга 2) Модель: Liftera-A 3) Условия работы и хранения: см. руководство пользователя 4) Тип и степень защиты от поражения электрическим током: Класс I, рабочая часть типа BF 5) Мощность: 100-240 В~, 50/60 Гц, 300 ВА. 6) Время работы: Непрерывительный. Время работы одного картриджа до 10 мин., пауза 5 мин. После смены рабочего картриджа, аппарат продолжает работу в нормальном режиме. Ж. Продукт является медицинским изделием	 • Храните продукт при комнатной температуре. • Перед использованием продукта прочтите и усвойте руководство пользователя. • Этот продукт является расходным материалом и выбрасывается после использования. • Несанкционированное повторное использование строго запрещено, и производитель не несет ответственности за любые повреждения или неисправности продукта. • НЕ разбирайте. Это приведет к необратимому выходу из строя и аннулированию гарантии. Сделано в Корее
                         	

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

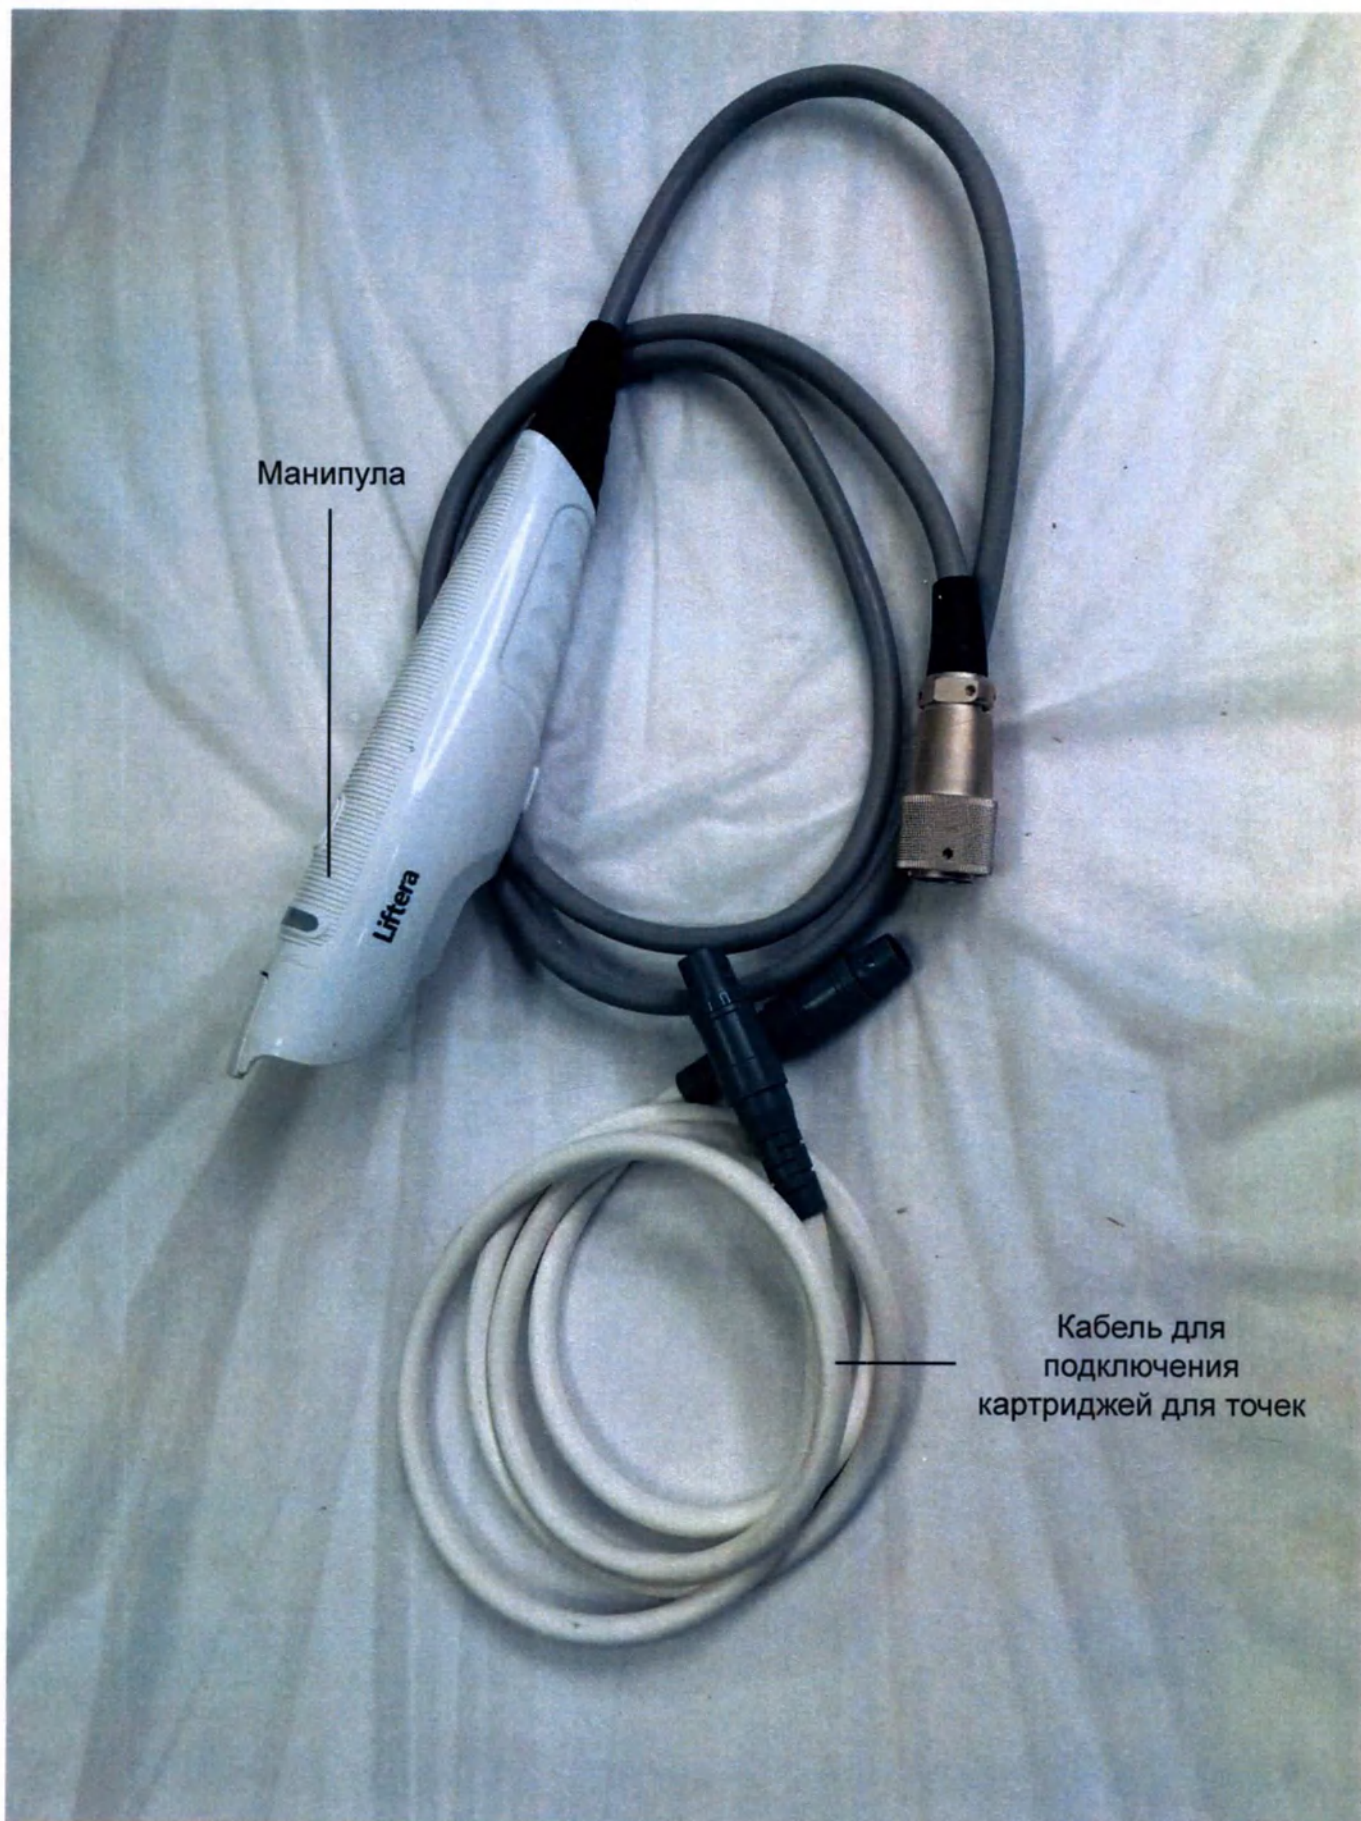

Манипула

Кабель для
подключения
картриджей для точек

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A



Кабель питания

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Картридж Liftera-A для точек
(различной глубины)



Картридж Liftera-A
для точек 13 мм

Картридж Liftera-A
для точек 10 мм

Картридж Liftera-A
для точек 7 мм



Картридж
Liftera-A
для точек
3,0 мм

Картридж
Liftera-A
для точек
2 мм

Картридж
Liftera-A
для точек
1,5 мм

Картридж
Liftera-A
для точек
4,5 мм

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Картридж Liftera-A для линий
(различной глубины)

Картридж
Liftera-A
для линий
10 мм



Картридж
Liftera-A
для линий
13 мм



Картридж
Liftera-A
для линий
4,5 мм



Картридж
Liftera-A
для линий
7 мм



Картридж
Liftera-A
для линий
1,5 мм



Картридж
Liftera-A
для линий
3,0 мм



Liftera-A

Аппарат для ультразвукового
SMAS-лифтинга

Руководство пользователя



ASTERASYS



ASTERASYS Co., Ltd.
#1005, #508, #313, 25, Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu, Seoul,
04781 Republic of Korea,

Tel + 82-1833-7010
Fax + 82-2-6953-0599
Версия Ver.7.2.4

Website <http://www.asterasys.com>
E-mail info@asterasys.com
Дата 22.08.2023

© 2023. Asterasys

Все права зарезервированы. Воспроизводство целиком или частями в любой форме или любым способом, электронным или механическим, запрещено без письменного согласия владельца авторских прав

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга,
вариант исполнения: Liftera-A
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-A с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Model name	Liftera-A		
Manufacturing license number	No. 5479		
Manufacturing Item License Number	No. 16-425		
Date of Manufacture	Years Month		
Manufacturing number	0108809819890231 (10)20080K2 111221114 210012		
Packing unit	1 Q'ty		
Company name / Nationalty	ASTERASYS Co.,Ltd / Korea		
Address	#1005,#508,#313,25 Seongsuil-ro 4-gil,Seongdong-gu, Seoul, Requblic of Korea		
Contact	TEL : +82-1833-7010 FAX : +82-2-6953-0599		
European Agent	JaviTech e.k. Sachsenhausener Straße 16, 65824 Schwalbach am Taunus, Germany		
0068 ※ This product is "medical device" Made in korea			Handle with care

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Тележка для транспортировки аппарата, упаковка

MADE IN KOREA

Trolley for Liftera-A/V
Asterasys Co., Ltd.,
Republic of Korea

Сделано в Корее

Тележка для транспортировки аппарата
Asterasys Co., Ltd.,
Республика Корея

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-A

Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Всего 14 листов
Генеральный директор
ООО «ГК СпортМедИмг»
Ефимова А.В.



» **Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V**

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-V
с держателем картриджей (основной блок)



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-V
с держателем картриджей (основной блок), серийный номер

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-V
с держателем картриджей (основной блок),
маркировка на русском языке



ASTERASYS

YOUR PARTNER for HEALTHCARE

- 1) **Продукт:** Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга
- 2) **Модель:** Liftera-V
- 3) **Условия работы и хранения:** см. руководство пользователя
- 4) **Предохранитель (на входе):** T4AN, 250В
- 5) **Номинал:** 100-240 В~, 50/60 Гц, 300 ВА.
- 6) **Режим работы:** Непродолжительный. Время работы одного картриджа до 10 мин., пауза 5 мин. После смены рабочего картриджа, аппарат продолжает работу в нормальном режиме.

✕ Продукт является медицинским изделием

Сделано в Корее



ASTERASYS Co., Ltd.

#1005 #508 #313, 25, Seongsuil-ro 4-gil,
Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea
Tel: +82-1833-7010 E-mail: info@asterasys.com
Website: http://www.asterasys.com

Предупреждение



- Перед использованием продукта прочтите и усвойте руководство пользователя.
- Этот продукт является расходным материалом и выбрасывается после использования. Несанкционированное повторное использование строго запрещено, и производитель не несет ответственности за любые повреждения или неисправности продукта.
- Будьте осторожны, не допускайте попадания внутрь оборудования жидкостей, например воды.



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Картридж Liftera-V для точек
(различной глубины)

Картридж
Liftera-V
для точек
13 мм

Картридж
Liftera-V
для точек
10 мм

Картридж
Liftera-V
для точек
7 мм



Картридж
Liftera-V
для точек
3,0 мм

Картридж
Liftera-V
для точек
2 мм

Картридж
Liftera-V
для точек
1,5 мм

Картридж
Liftera-V
для точек
4,5 мм

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V



Тележка для
транспортировки аппарата

Liftera-V

Аппарат для ультразвукового
SMAS-лифтинга

Руководство пользователя



ASTERASYS Co., Ltd.
#1005, #508, #313, 25, Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu, Seoul,
04781 Republic of Korea,

Tel + 82-1833-7010
Fax + 82-2-6953-0599
Версия Ver.1.0.2

Website <http://www.asterasys.com>
E-mail info@asterasys.com
Дата 22.08.2023

© 2019. Asterasys

Все права зарезервированы. Воспроизводство целиком или частями в любой форме или любым способом, электронным или механическим, запрещено без письменного согласия владельца авторских прав

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-V
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка



Liftera V

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения: Liftera-V
с держателями манипулы и картриджей (основной блок), упаковка



Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Model name	Liftera-V		
Manufacturing license number	No. 5479		
Manufacturing Item License Number	No. 20-684		
Date of Manufacture	Years Month		
Manufacturing number	0110800819840055 (12)80008C1 111280320 (2)10085		
Packing unit	1 Q'ty		
Company name / Nationalty	ASTERASYS Co.,Ltd / Korea		
Address	#1005,#508,#313,25 Seongsuil-ro 4-gil, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea		
Contact	TEL : +82-1833-7010 FAX : +82-2-6953-0599		
European Agent	JaviTech e.k. Sachsenhauser Straße 16, 65824 Schwalbach am Taunus, Germany		
※ This product is "medical device"		Handle with care	
Made in Korea			

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Тележка для транспортировки аппарата, упаковка

MADE IN KOREA

**Trolley for Liftera-A/V
Asterasys Co., Ltd.,
Republic of Korea**

Сделано в Корее

**Тележка для транспортировки аппарата
Asterasys Co., Ltd.,
Республика Корея**

Аппарат для ультразвукового SMAS-лифтинга, вариант исполнения Liftera-V

Тележка для транспортировки аппарата, упаковка



Всего 13 листов
Генеральный директор
ООО «ГК СпортМедИмп»
Ефимова А.В.

