

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО "ЦКБ ИУС"

А.В. Горячев

22" декабря 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

«СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ IC-GOR по ТУ
АИТЛ.466928.025»

1)




2)



СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ IC-GOR по ТУ АИТЛ.466928.025. Изделие в разобранном виде в кейсе для хранения и переноски.

- 1 - при комплектации с сервисным блоком;
- 2 - при комплектации без сервисного блока.

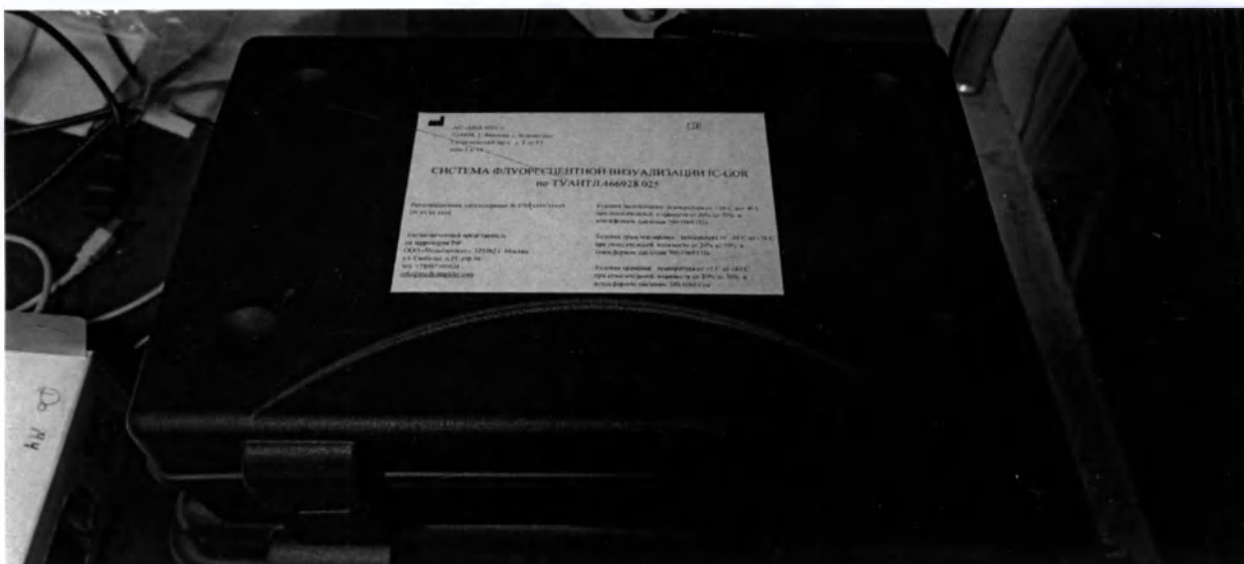

СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ IC-GOR по ТУ АИТЛ.466928.025. Маркировка на верхней крышке Кейса для хранения и переноски, DGCASE 10-02/Кейса для хранения и переноски DGCASE 50-02.

	АО "ЦКБ ИУС" 124498, г. Москва, г. Зеленоград. Георгиевский пр-т, д. 5, эт. 5Т пом. I ком. 14	
СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ IC-GOR по ТУ АИТЛ.466928.025		
Регистрационное удостоверение № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx	Условия эксплуатации: температура воздуха от +10 °С до +40 °С при относительной влажности от 20% до 70% и атмосферном давлении 700 - 1060 ГПа.	
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МедКомплект», 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 36	Условия транспортировки: температура воздуха от -20 °С до +50 °С при относительной влажности от 20% до 70% и атмосферном давлении 700 - 1060 ГПа.	
Тел. +78007700426 info@medkomplekt.com	Условия хранения: температура воздуха от +5 °С до +40 °С при относительной влажности от 20% до 70% и атмосферном давлении 700 - 1060 ГПа.	

СИСТЕМА ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ IC-GOR по ТУ АИТЛ.466928.025. Макет маркировки.



Кейс для хранения и переноски DG CASE 10-02/ Кейс для хранения и переноски DG CASE 50-02

Примечание: внешний вид кейсов идентичен. Кейс выбирается в зависимости от комплектации: – кейс DG CASE 10-02 (при комплектации без сервисного блока, кейс DG CASE 50-02 (при комплектации с сервисным блоком).



Кейс для хранения и переноски, DG CASE 10-02/ Кейс для хранения и переноски DG CASE 50-02. Маркировка на корпусе(логотип).



Кейс для хранения и переноски, DGCASE 10-02/ Кейс для хранения и переноски DGCASE 50-02. Маркировка на корпусе (сбоку).


Примечание: Кейс для хранения и переноски, DGCASE 10-02 маркируется идентичным образом.




Камера IC-GOR АИТЛ.468179.008. Маркировка на корпусе.



Камера IC-GOR АИТЛ.468179.008.

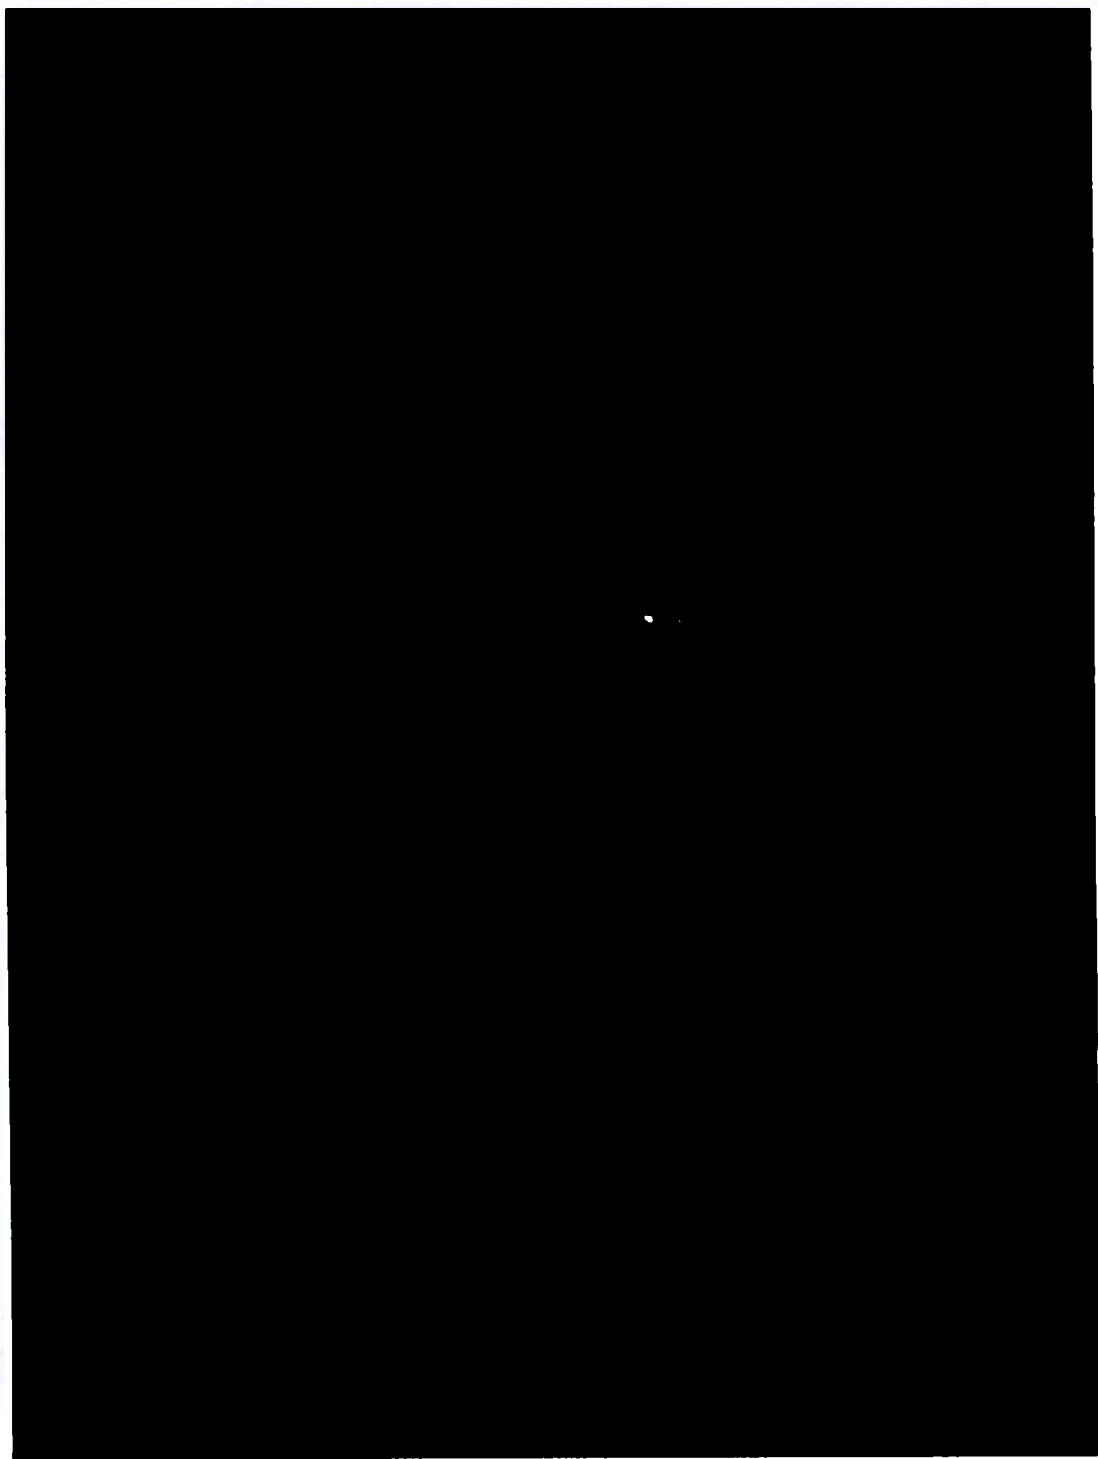


Блок сопряжения АИТЛ.436234.014. Маркировка на корпусе.

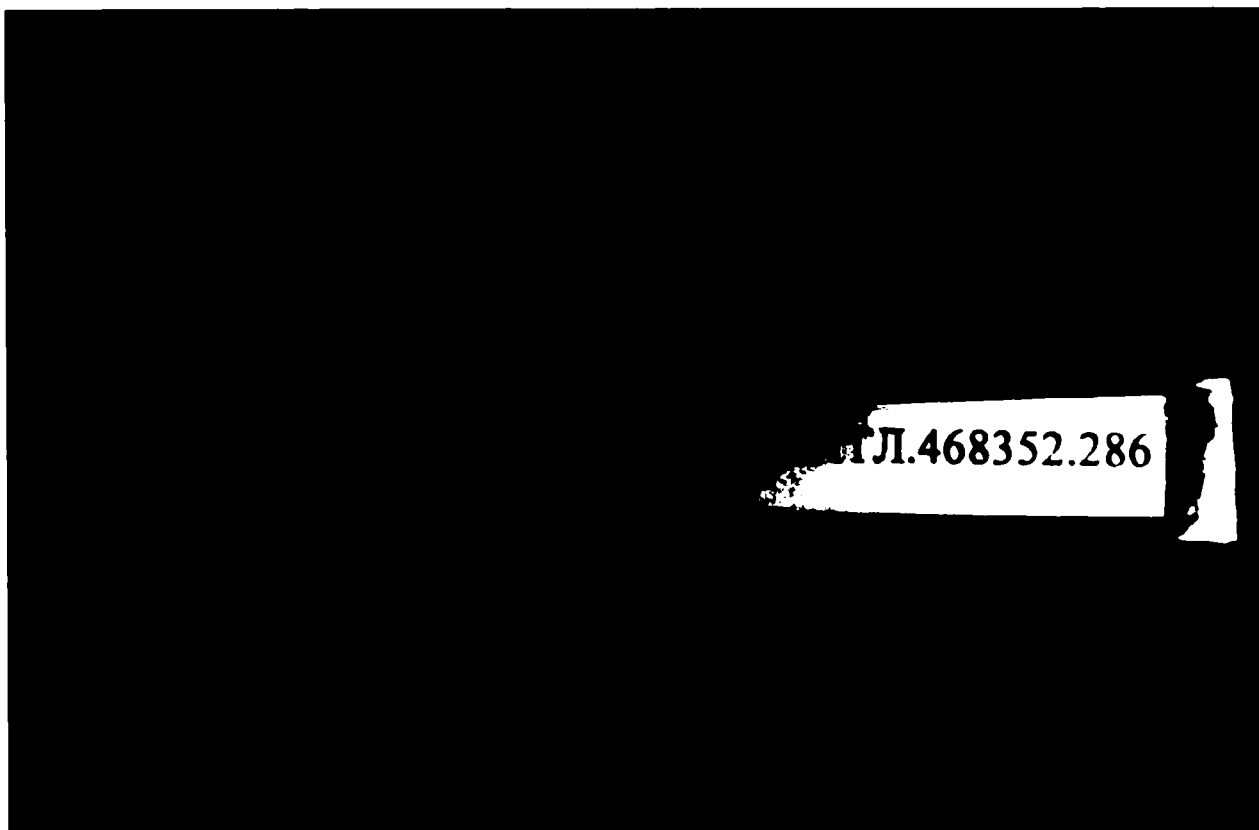


Кабель камеры АИТЛ.468352.286. Маркировка.



Кабель для подключения внешнего монитора Gimberd VGA-VGA 1,5 м.
Маркировка

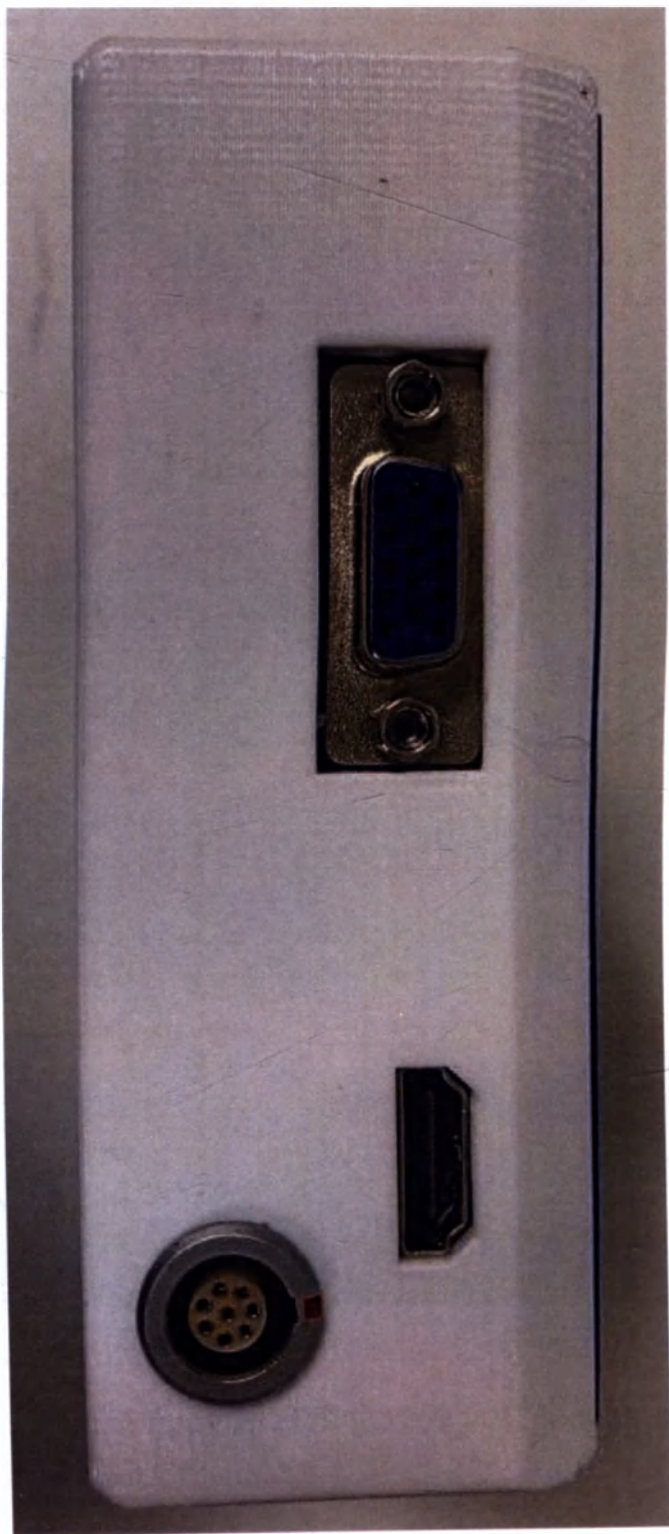

Сервисный блок АИТЛ.463269.001. Разъемы.

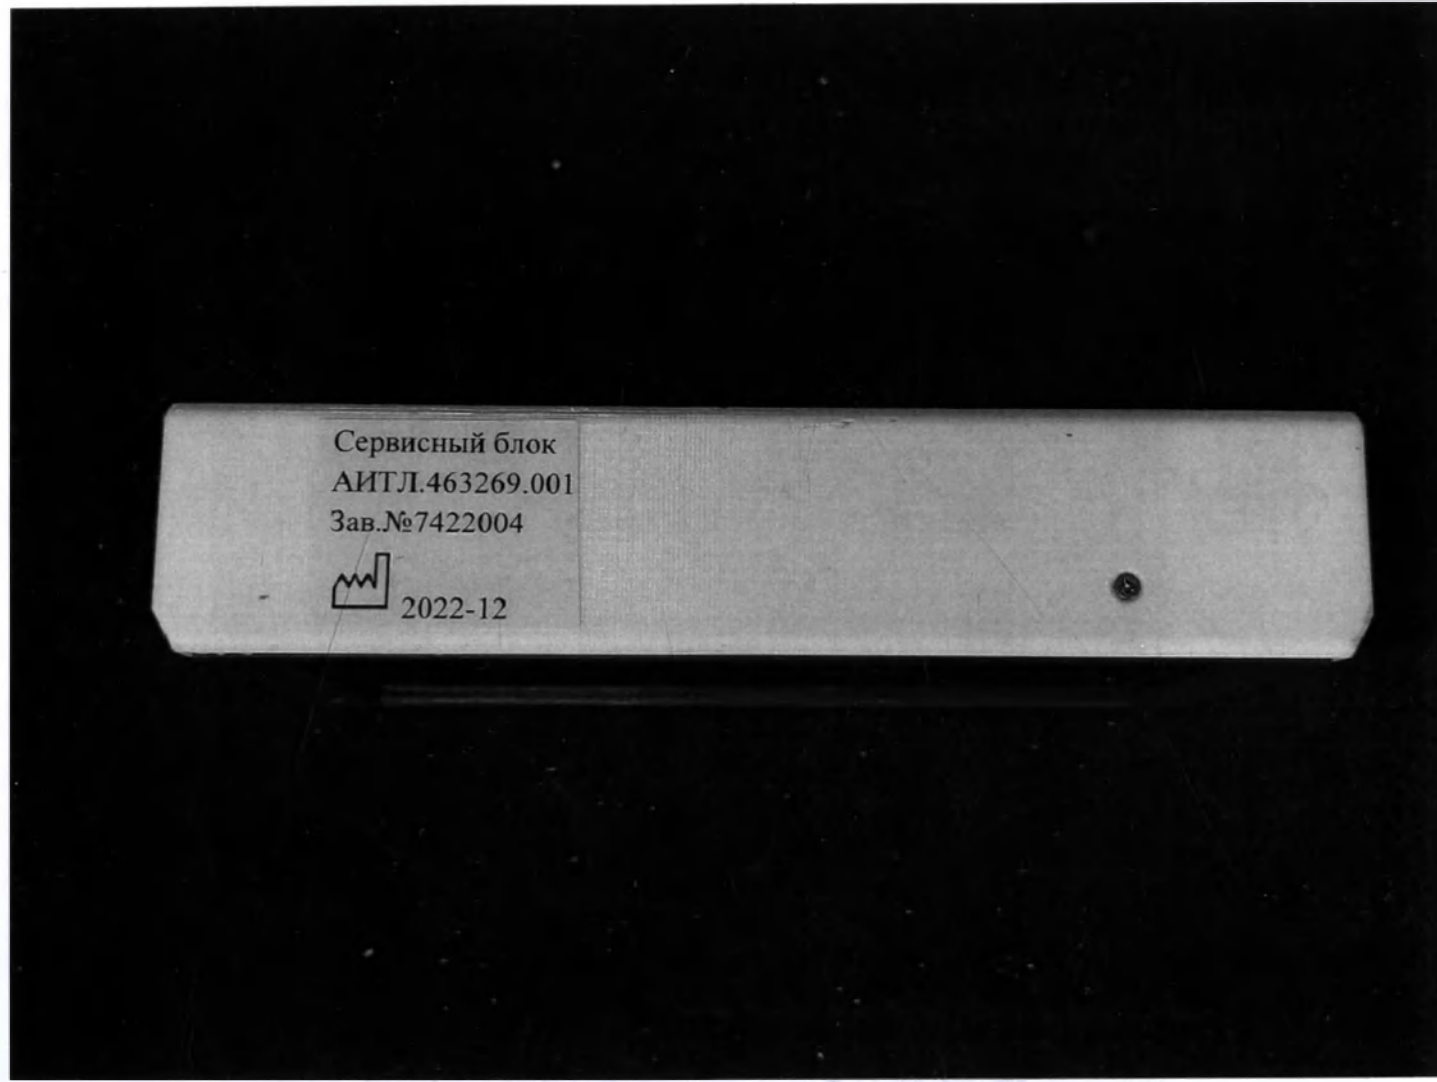

Сервисный блок АИТЛ.463269.001. Маркировка.



Сервисный блок АИТЛ.463269.001.



Зарядное устройство TOP-LT72



Кабель питания.



Кабель подключения внешнего монитора Geplink HDMI-HDMI 1,5 м

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 16
листов

Генеральный директор АО "ЦКБ
ИУС"

А.В. Горячев А.В. Горячев

