


Фотографические изображения общего вида  
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления  
иммуноглобулинов класса G к вирусу гриппа А» "ИФА-Грипп А - IgG" с  
принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению




Стандартный бланк для построения калибровочного графика при полуколичественном учете результатов ИФА

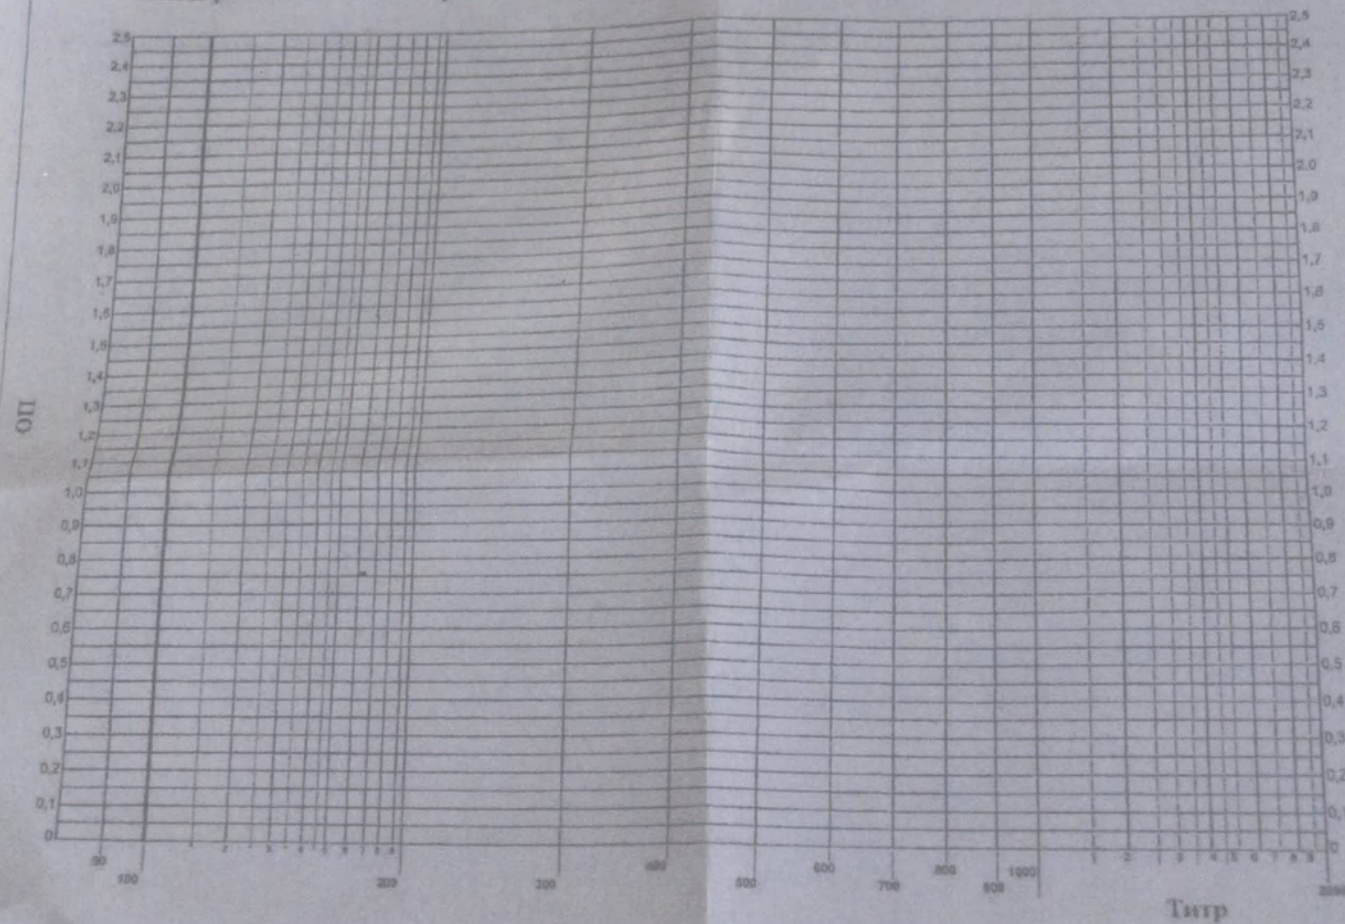

Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

Лист № 2  
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"  
Гашенко Т.Ю.  
"18" 08 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ЗАО "ЭКОЛАБ"

2017

ЗАО "ЭКОлаб"

## ИФА-Грипп А-IgG

## Состав набора

1 шт.

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (1,2 мл)

1 фл. (13 мл)

1 фл. (13 мл)

**2 фл. (по 40 мл)**

1 фл. (16 мл)

**1 фл. (12,5 мл)**

1 фл. (15 мл)

1 шт.

4 шт.

16 שט

4 WT.

B14



**ЭКОлаб** ЗАО "ЭКОлаб"  
ИФА-Грипп А-IgG  
Иммуносорбент  
с. 04  
Годен до: 2017.10

 ЭКОлаб      ЗАО "ЭКОлаб"  
**ПР(х25)**  
 с. 04      • 40 мл      2017  
 Годен до: 2017.10       W6938051  


 **ЭКОлаб**      3AQ ЭКОлаб®  
**РПРО**  
 с. 04      15 мл  
 Годен до: 2017.10

ЗАО "ЭКОлаб"      ЗАО "ЭКОлаб"

**ПРО**

с. 04      15 мл

Годен до: 2017.09





ЭКОлаб ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 04 13 мл

Годен до: 2017.10

276

1529031

1529031


ЗАО «ЗКОЛ»

**Стоп-реагент**

с. 04      12,5 мл

Годен до: 2017.10


81002001




ИФА-Грипп А-IgG  
Конъюгат  
с. 04 13 мл  
Годен до: 2017.10

ИОН-Групп А-IgG  
K<sub>2</sub>  
п/тп 1:400  
с. 04 1,2 мл  
Годеи до: 2017.10



Юрина Т.В.