

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2020 г

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
антител класса М к вирусу гепатита А

ИФА-антиВГА-IgM

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные

Состав набора

Иммуносorbент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (0,5 мл)
АГ, инактивированный	1 фл. (5,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (1,2 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РРК	1 фл. (4,8 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая пленка для планшетов

4 шт.
4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и HCV отсутствуют

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиВГА-IgM

ТУ 9398-026-70423725-2020


РУ №ФСР 2009/06382 от 21.06.18

Каталожный № 02.15











Серия 01 Контрольный № 04

Дата изготовления: 2020.01

Годеи до: 2021.01





Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов "Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса М к вирусу гепатита А" "ИФА-антиВГА-IgM" с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению.

Серия 01 от 09.2016 г.

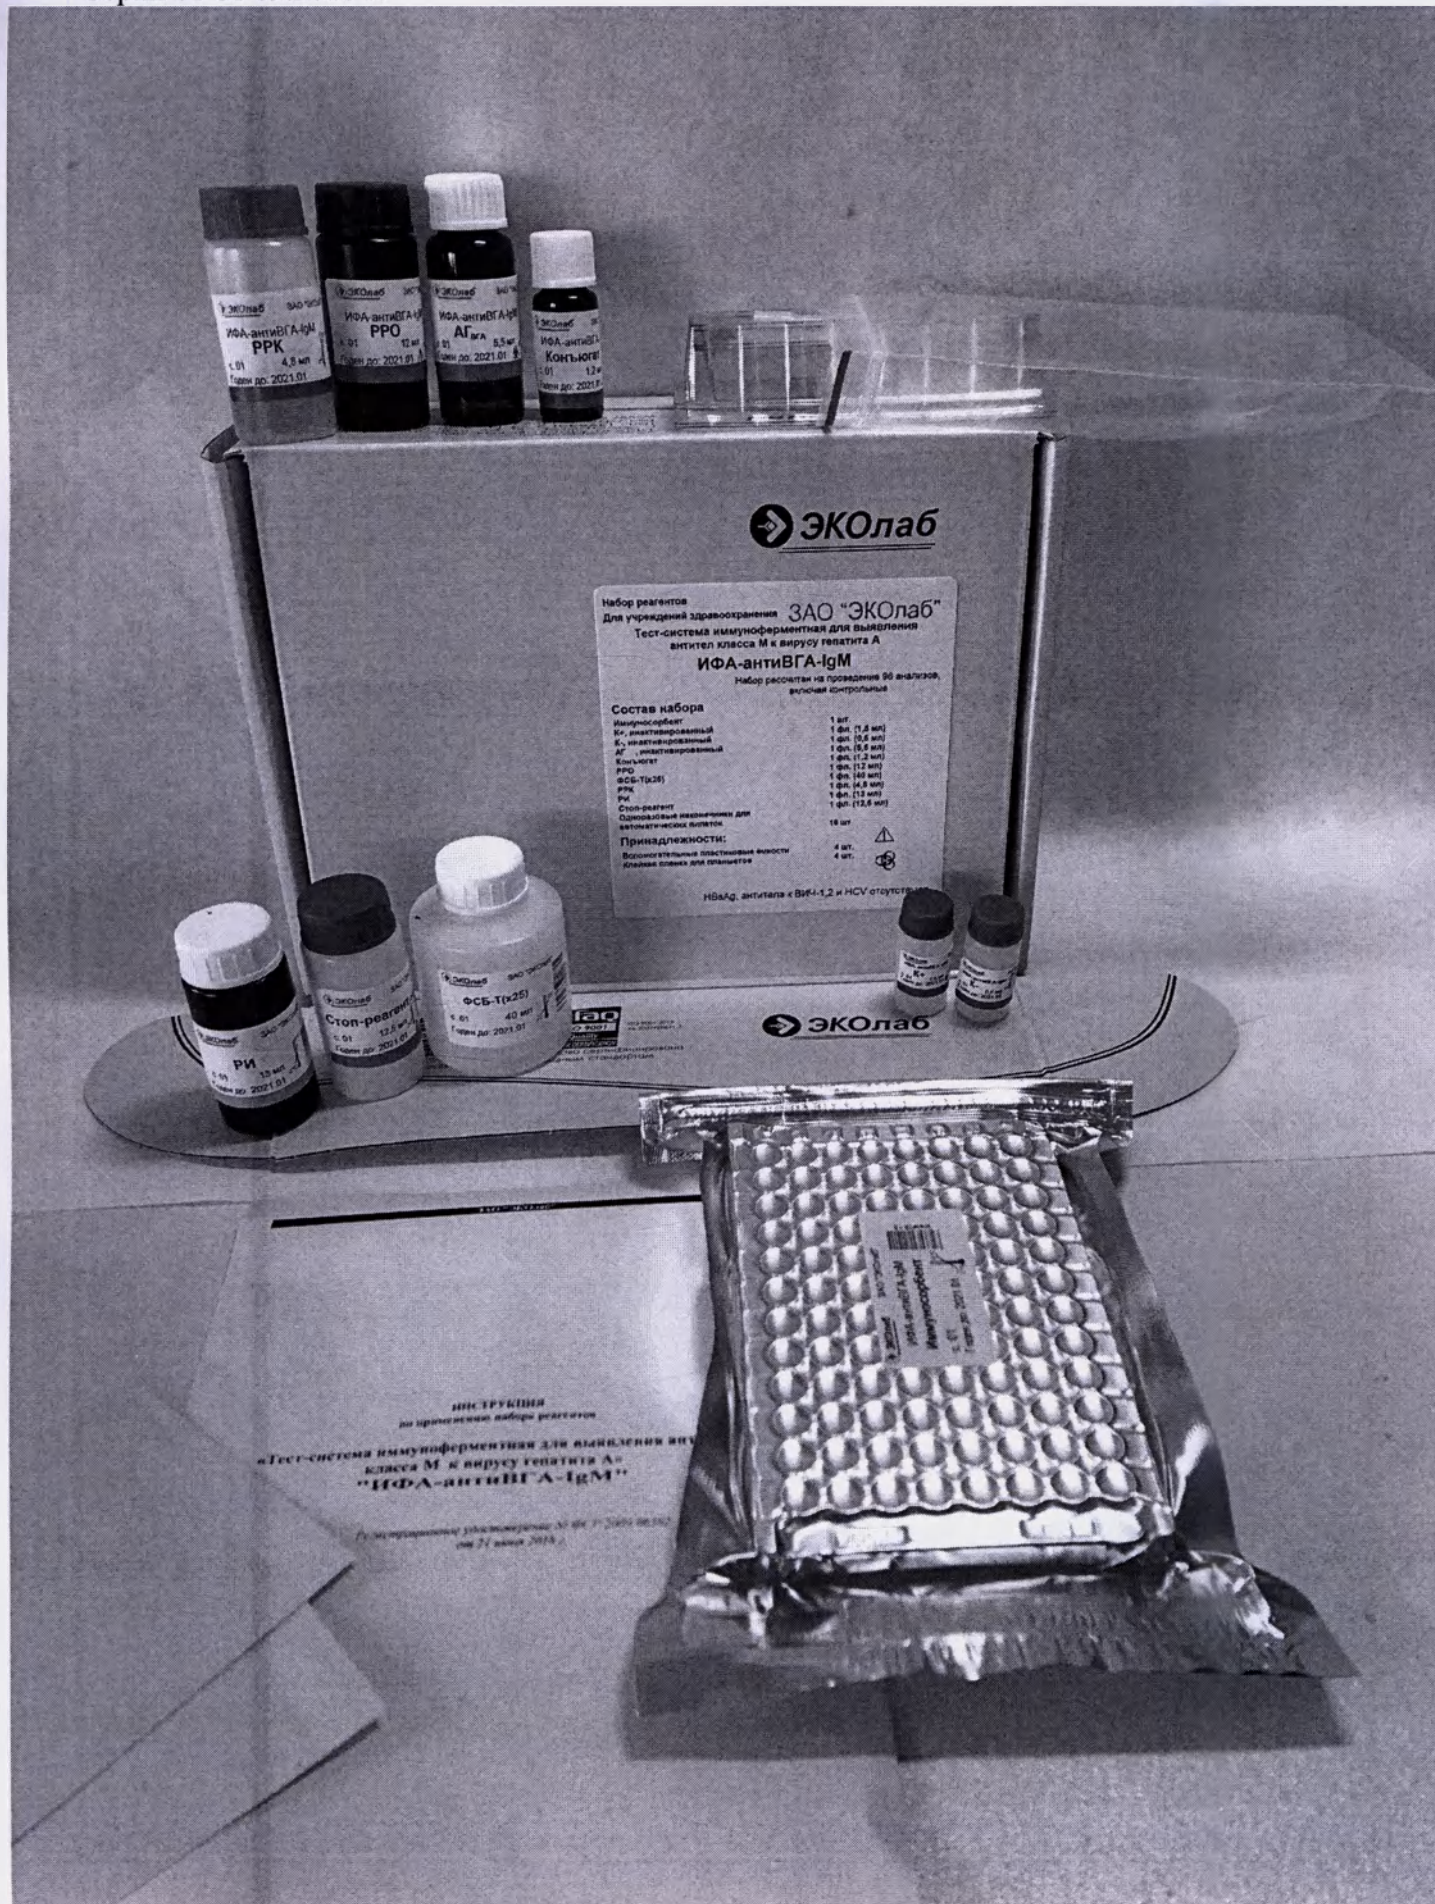

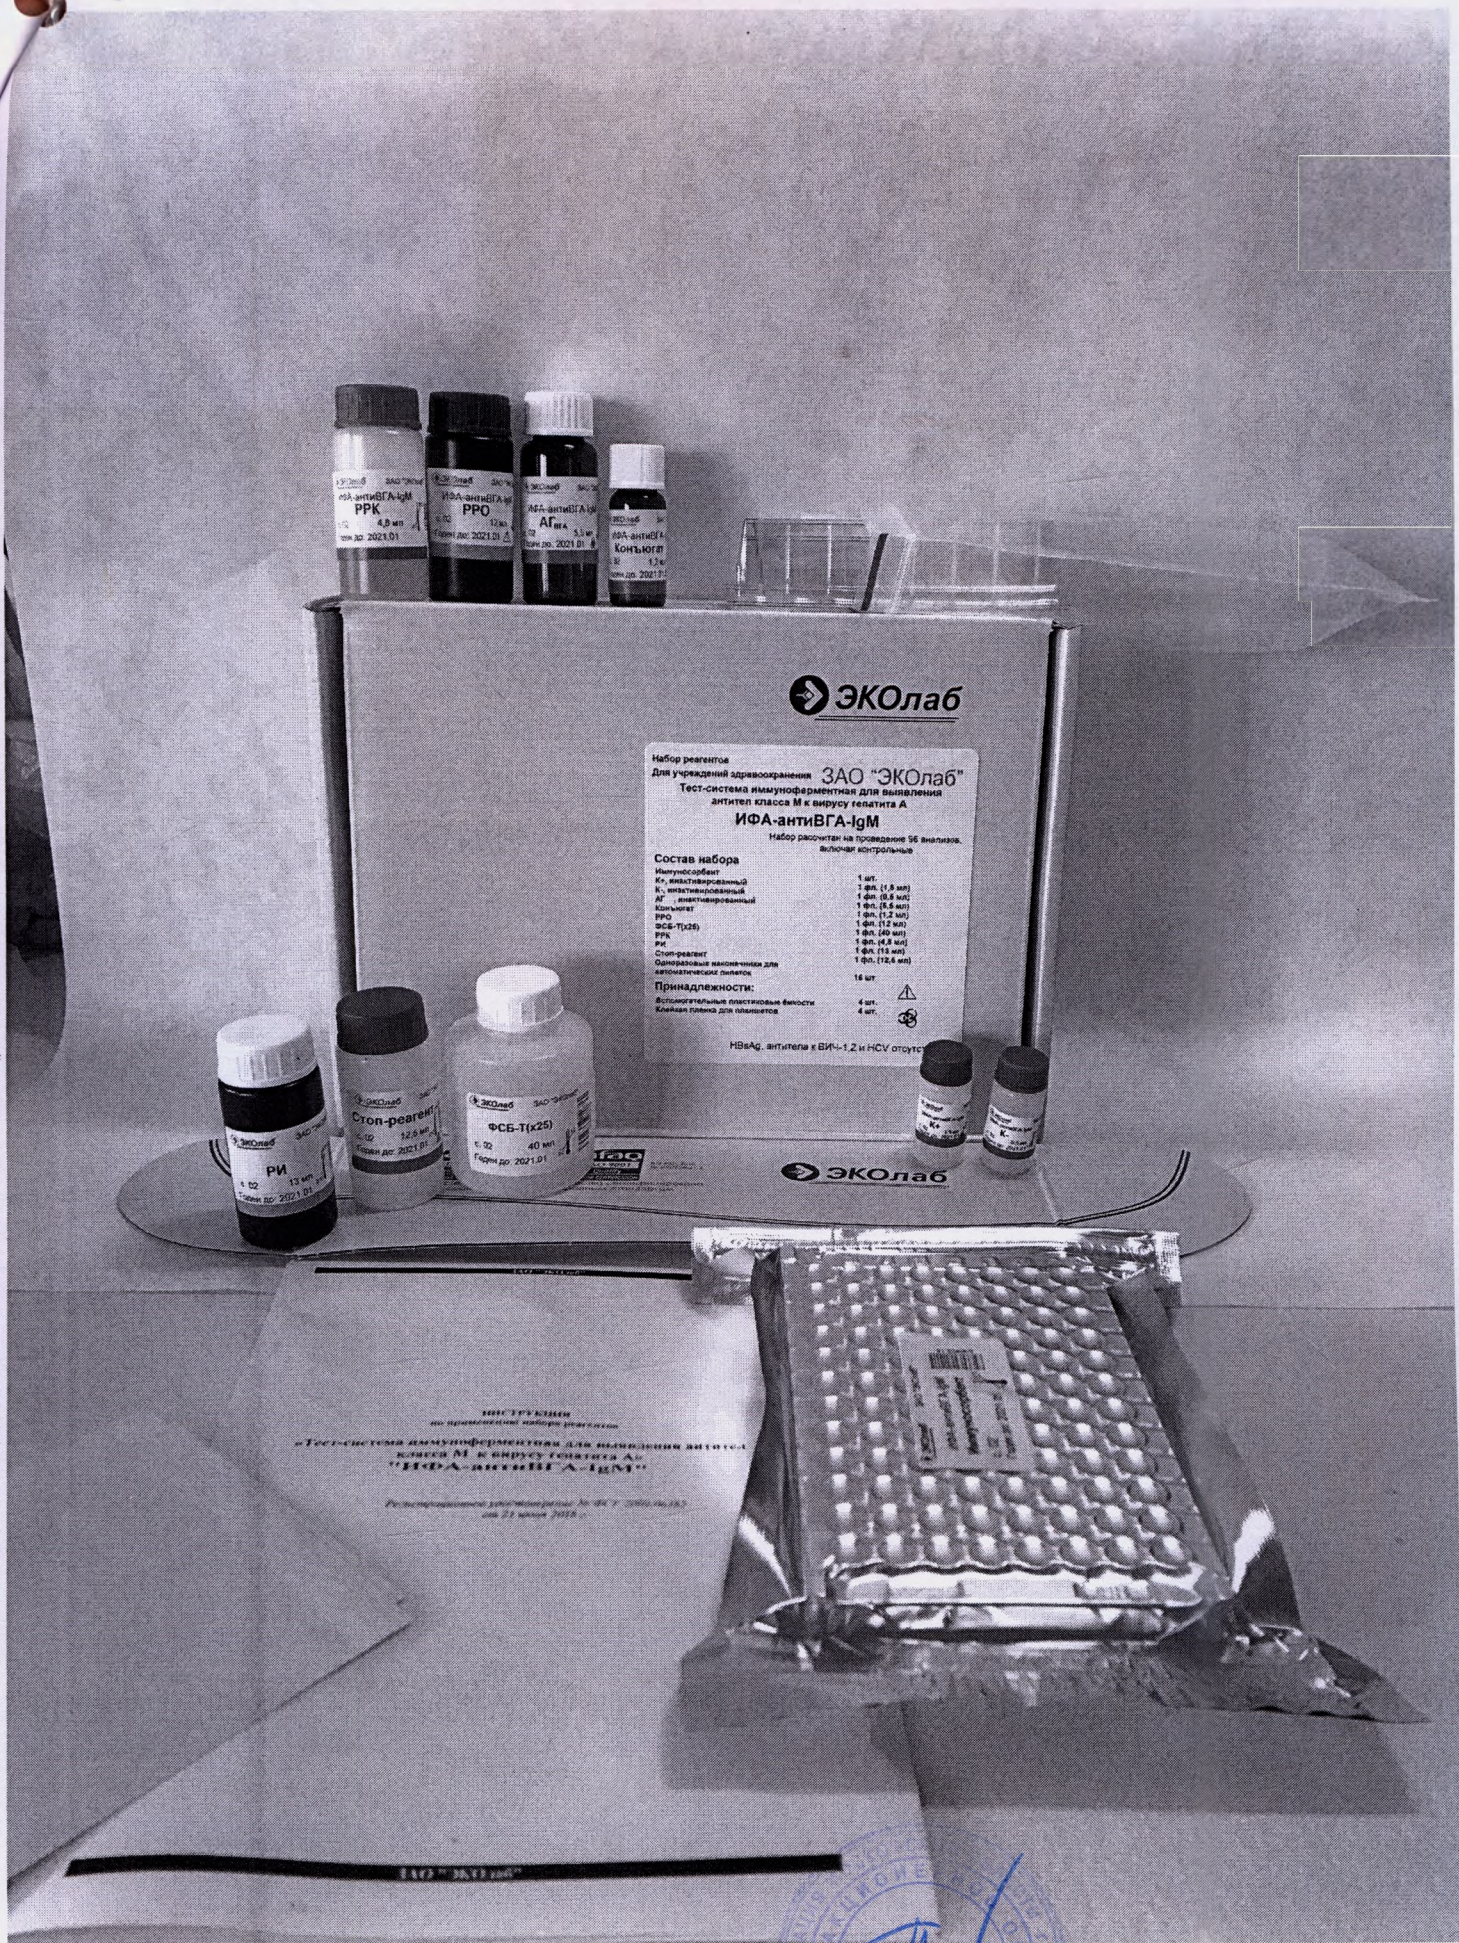

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

2 (два) лист а

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

24 " 12 Борисов В.Ю.
2020 г.

