



Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу гриппа Б» "ИФА-Грипп Б- IgG" с
принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению.

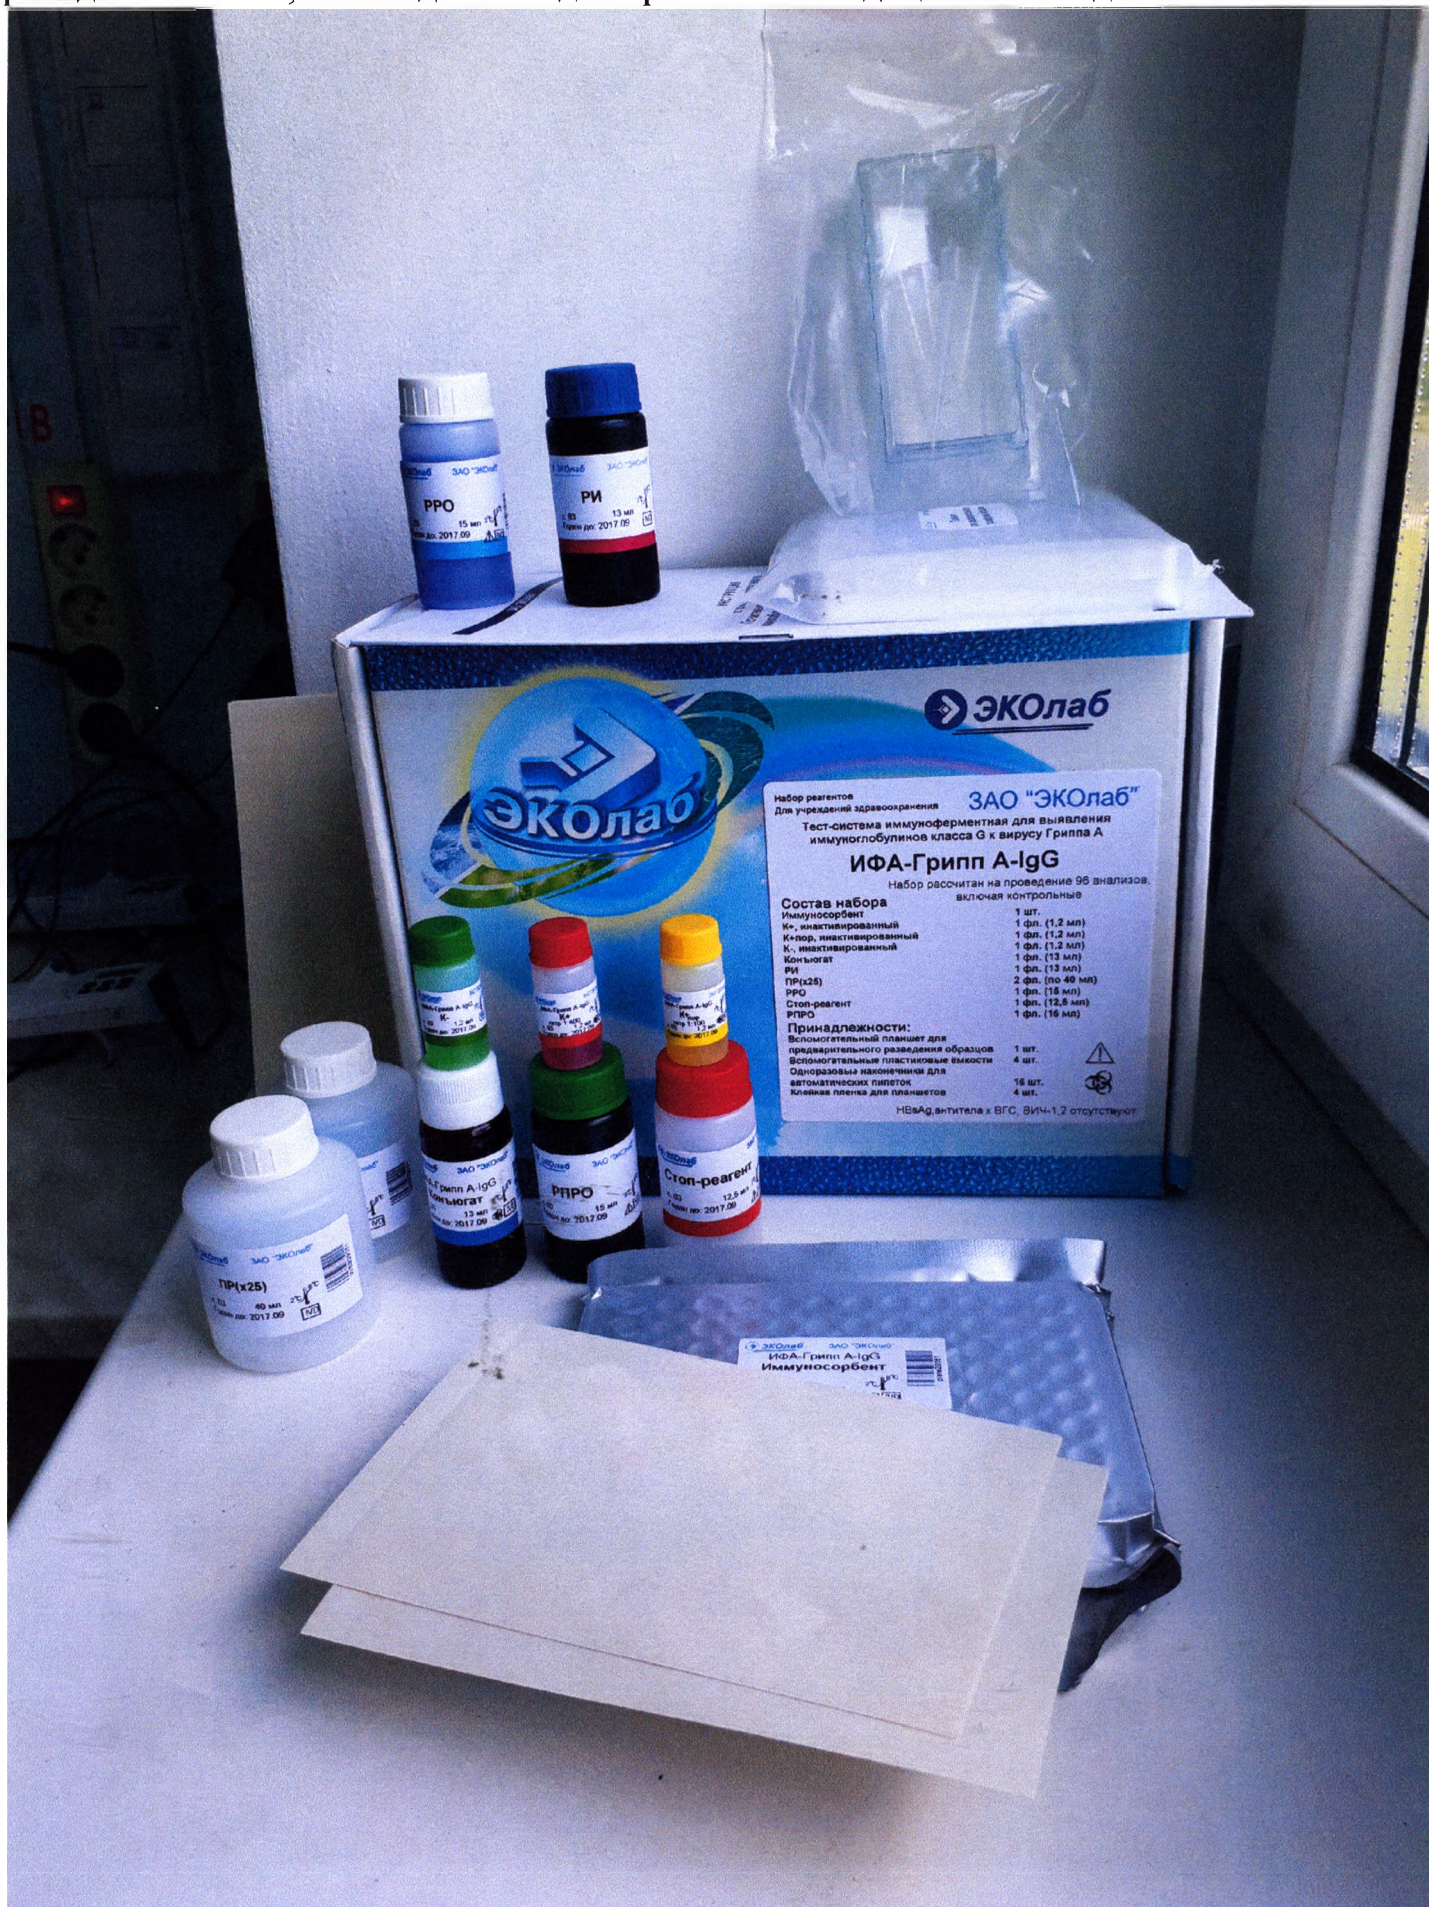

Стандартный бланк калибровочного графика

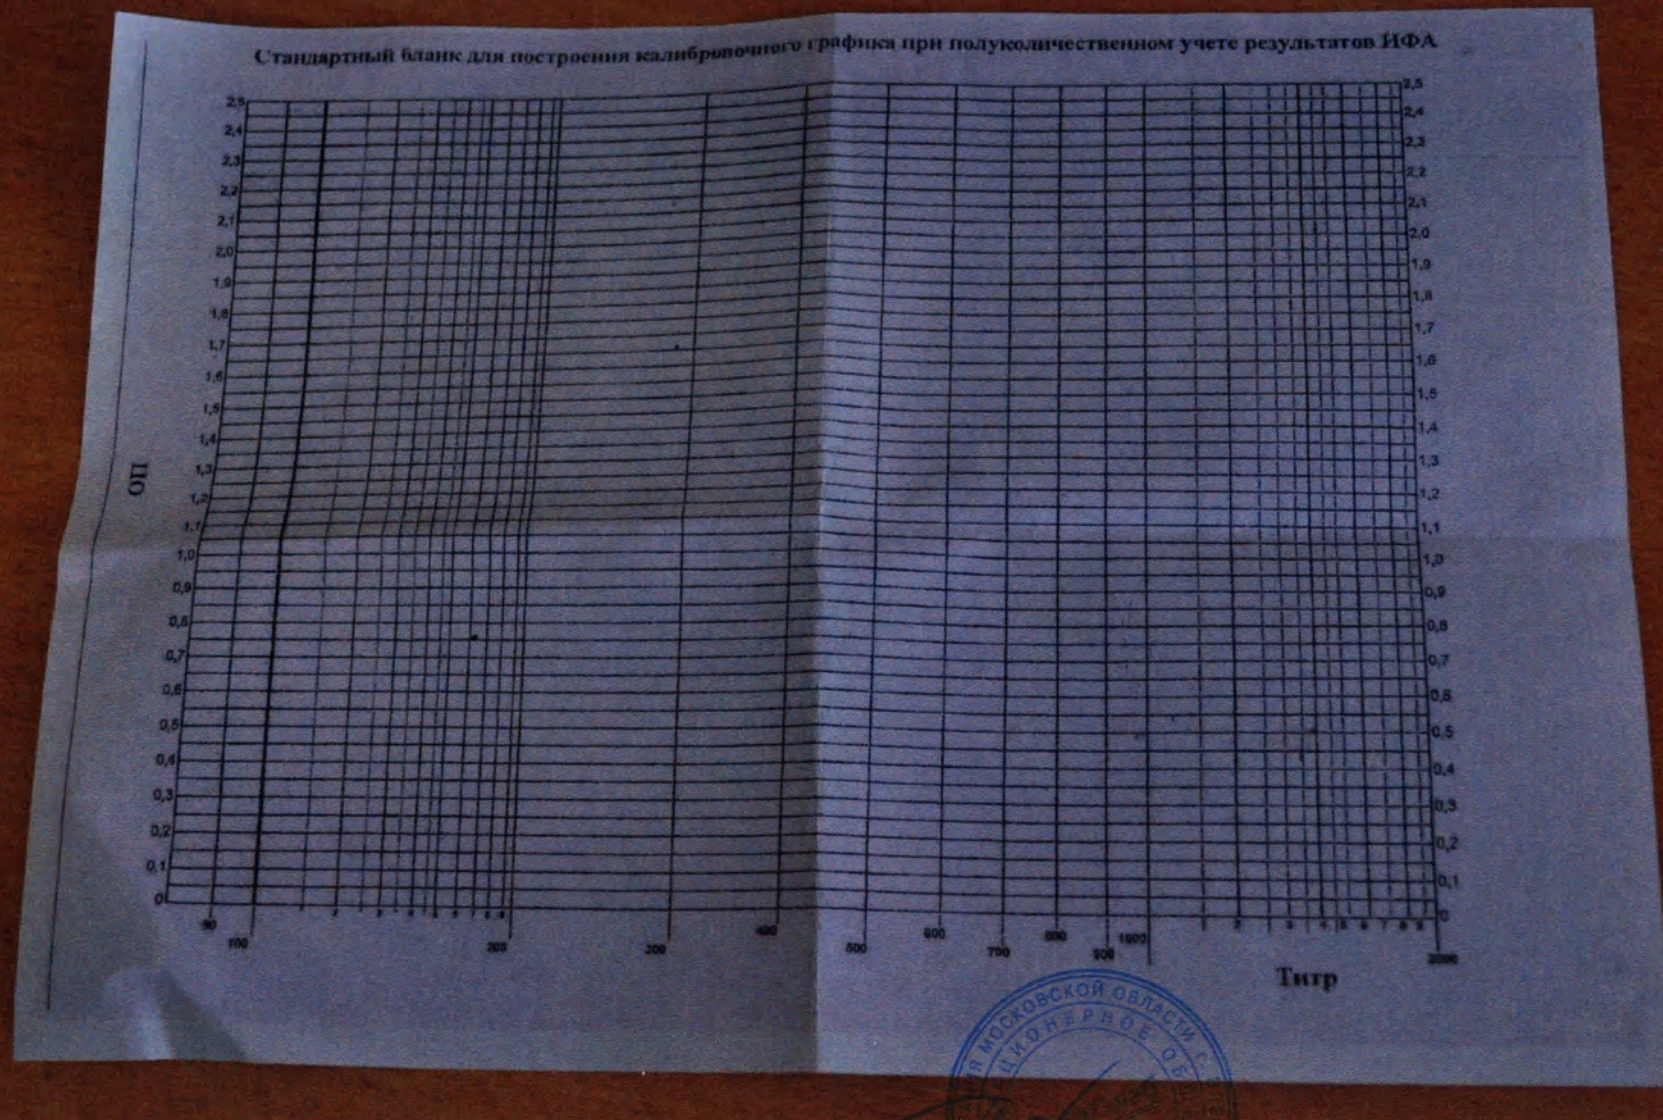

прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист а

Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"07"

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 11 " 05 20 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к вирусу Гриппа B

ИФА-Грипп B-IgG

Набор рассчитан на проведение 96 анализов,
включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
K+, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K+пор, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (1,2 мл)
Конъюгат	1 фл. (13 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ПР(x25)	2 фл. (по 40 мл)
РПРО	1 фл. (16 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
РПРО	1 фл. (16 мл)

Принадлежности:

Вспомогательный планшет для предварительного разведения образцов	1 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-Грипп B-IgG

ТУ 9398-232-70423725-2016

РУ №

Каталожный № 29.06.1


Серия 04 Контрольный № 340

Дата изготовления: 2016.10

Годеи до: 2017.10



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

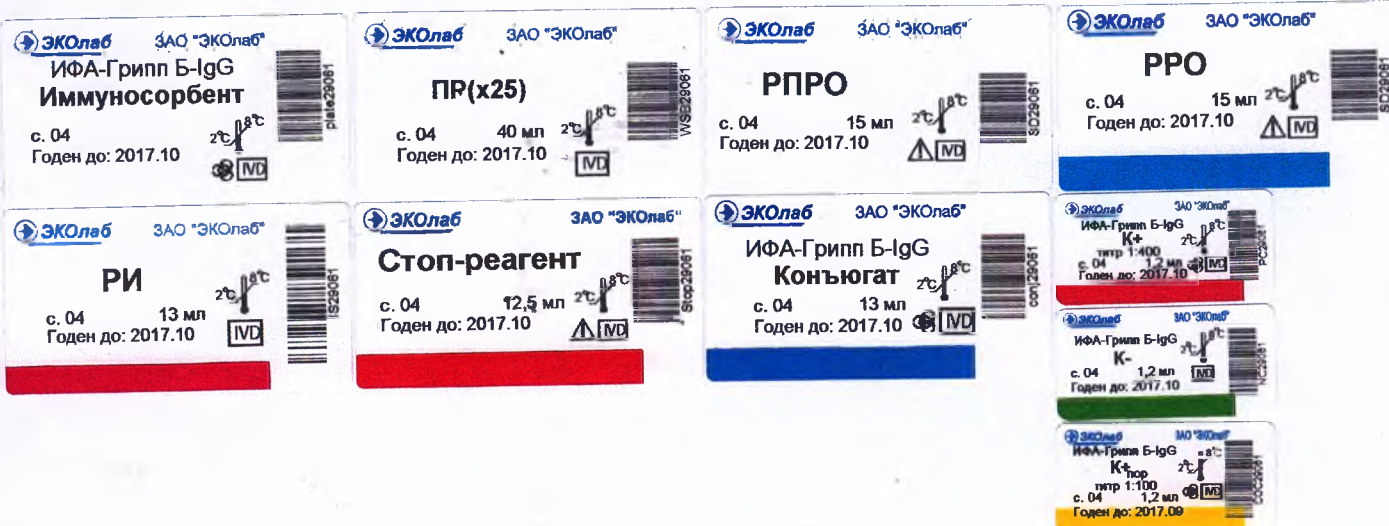

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Осинская А.Д.

Юрина Т.В.