



Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая для качественного определения МВ-фракции креатинкиназы
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека» «ИХА-КК-МВ».
Комплект №1

Серия 03 от 2019.01.

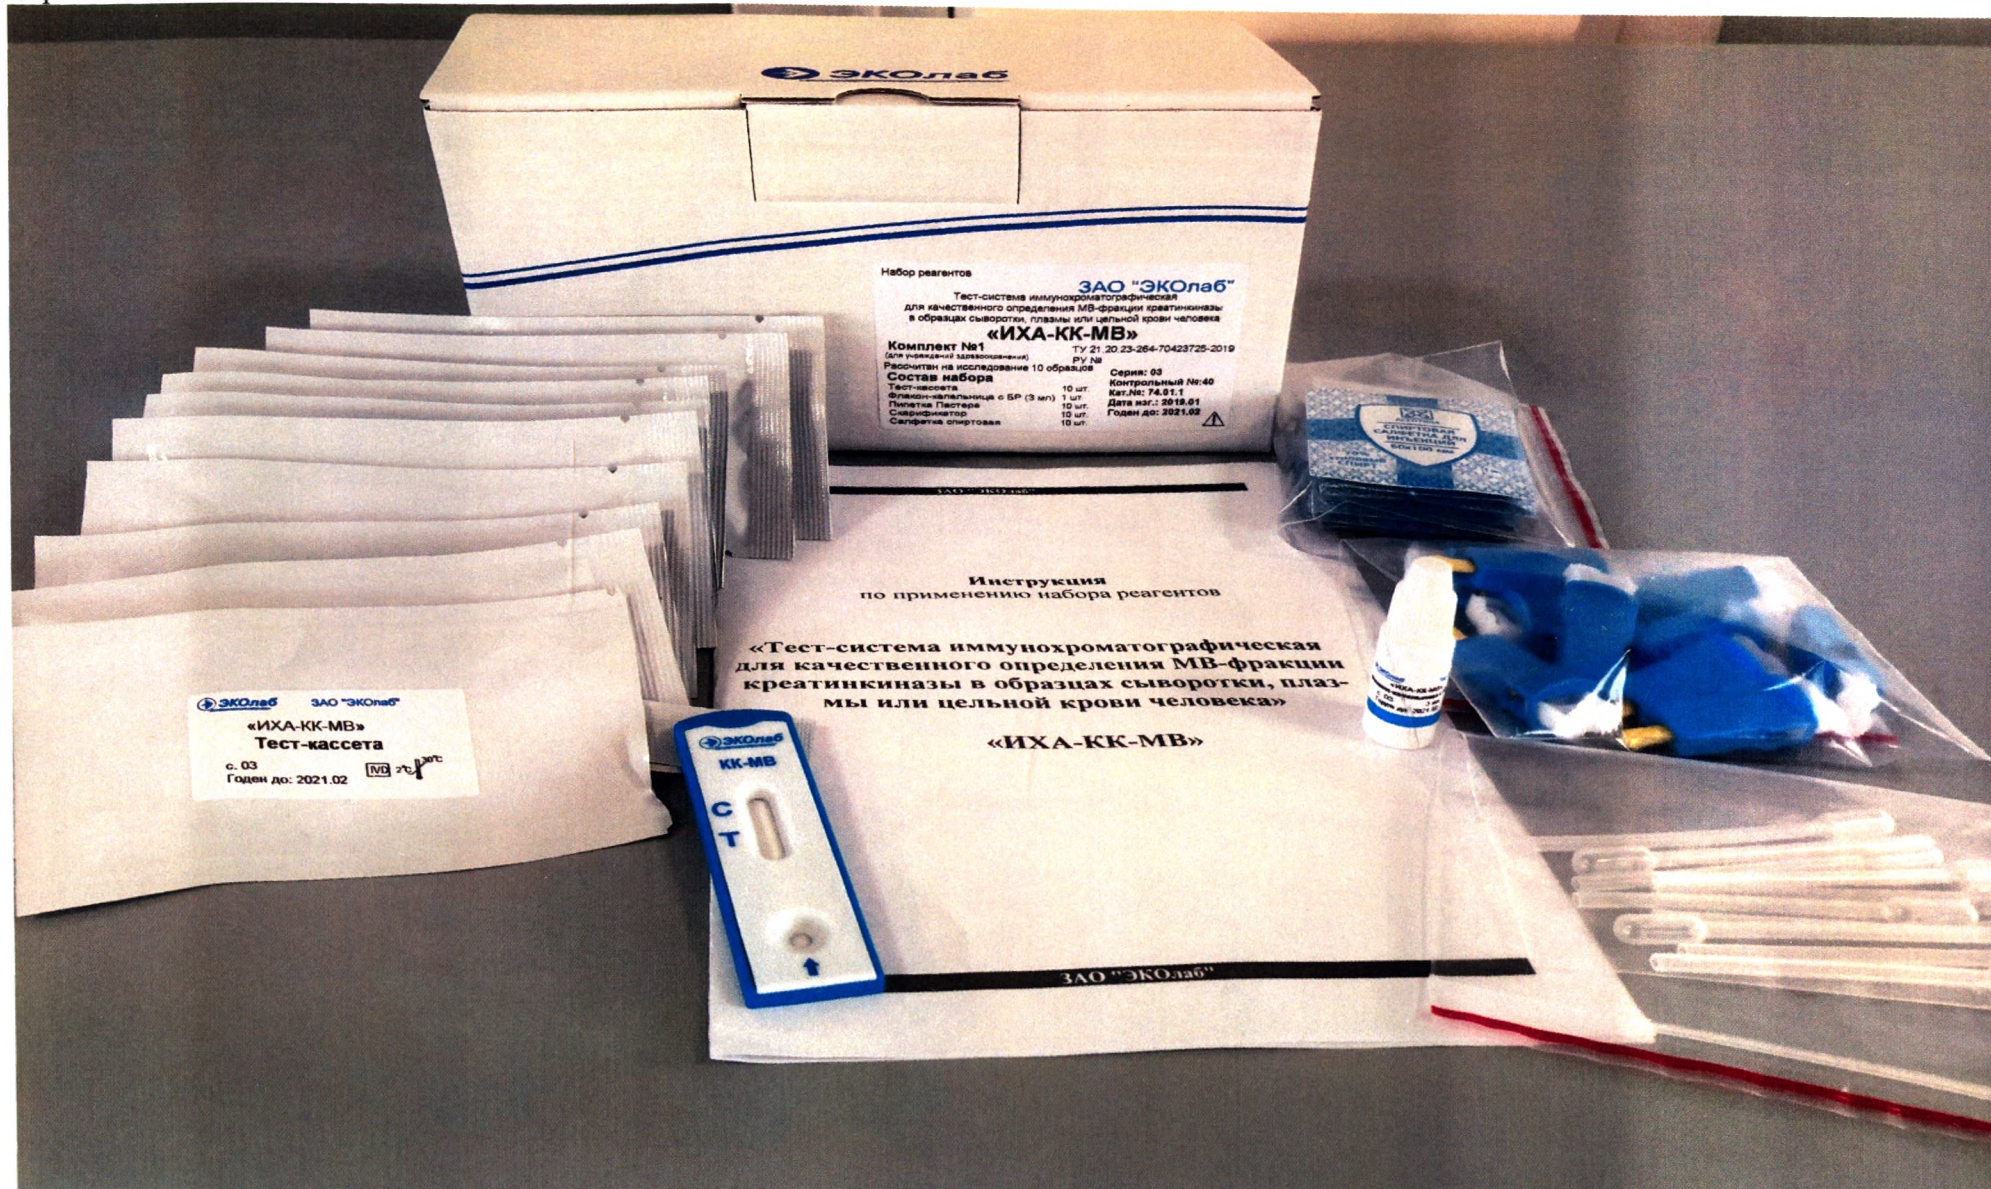

Серия 02 от 2019.01.

Комплект №2

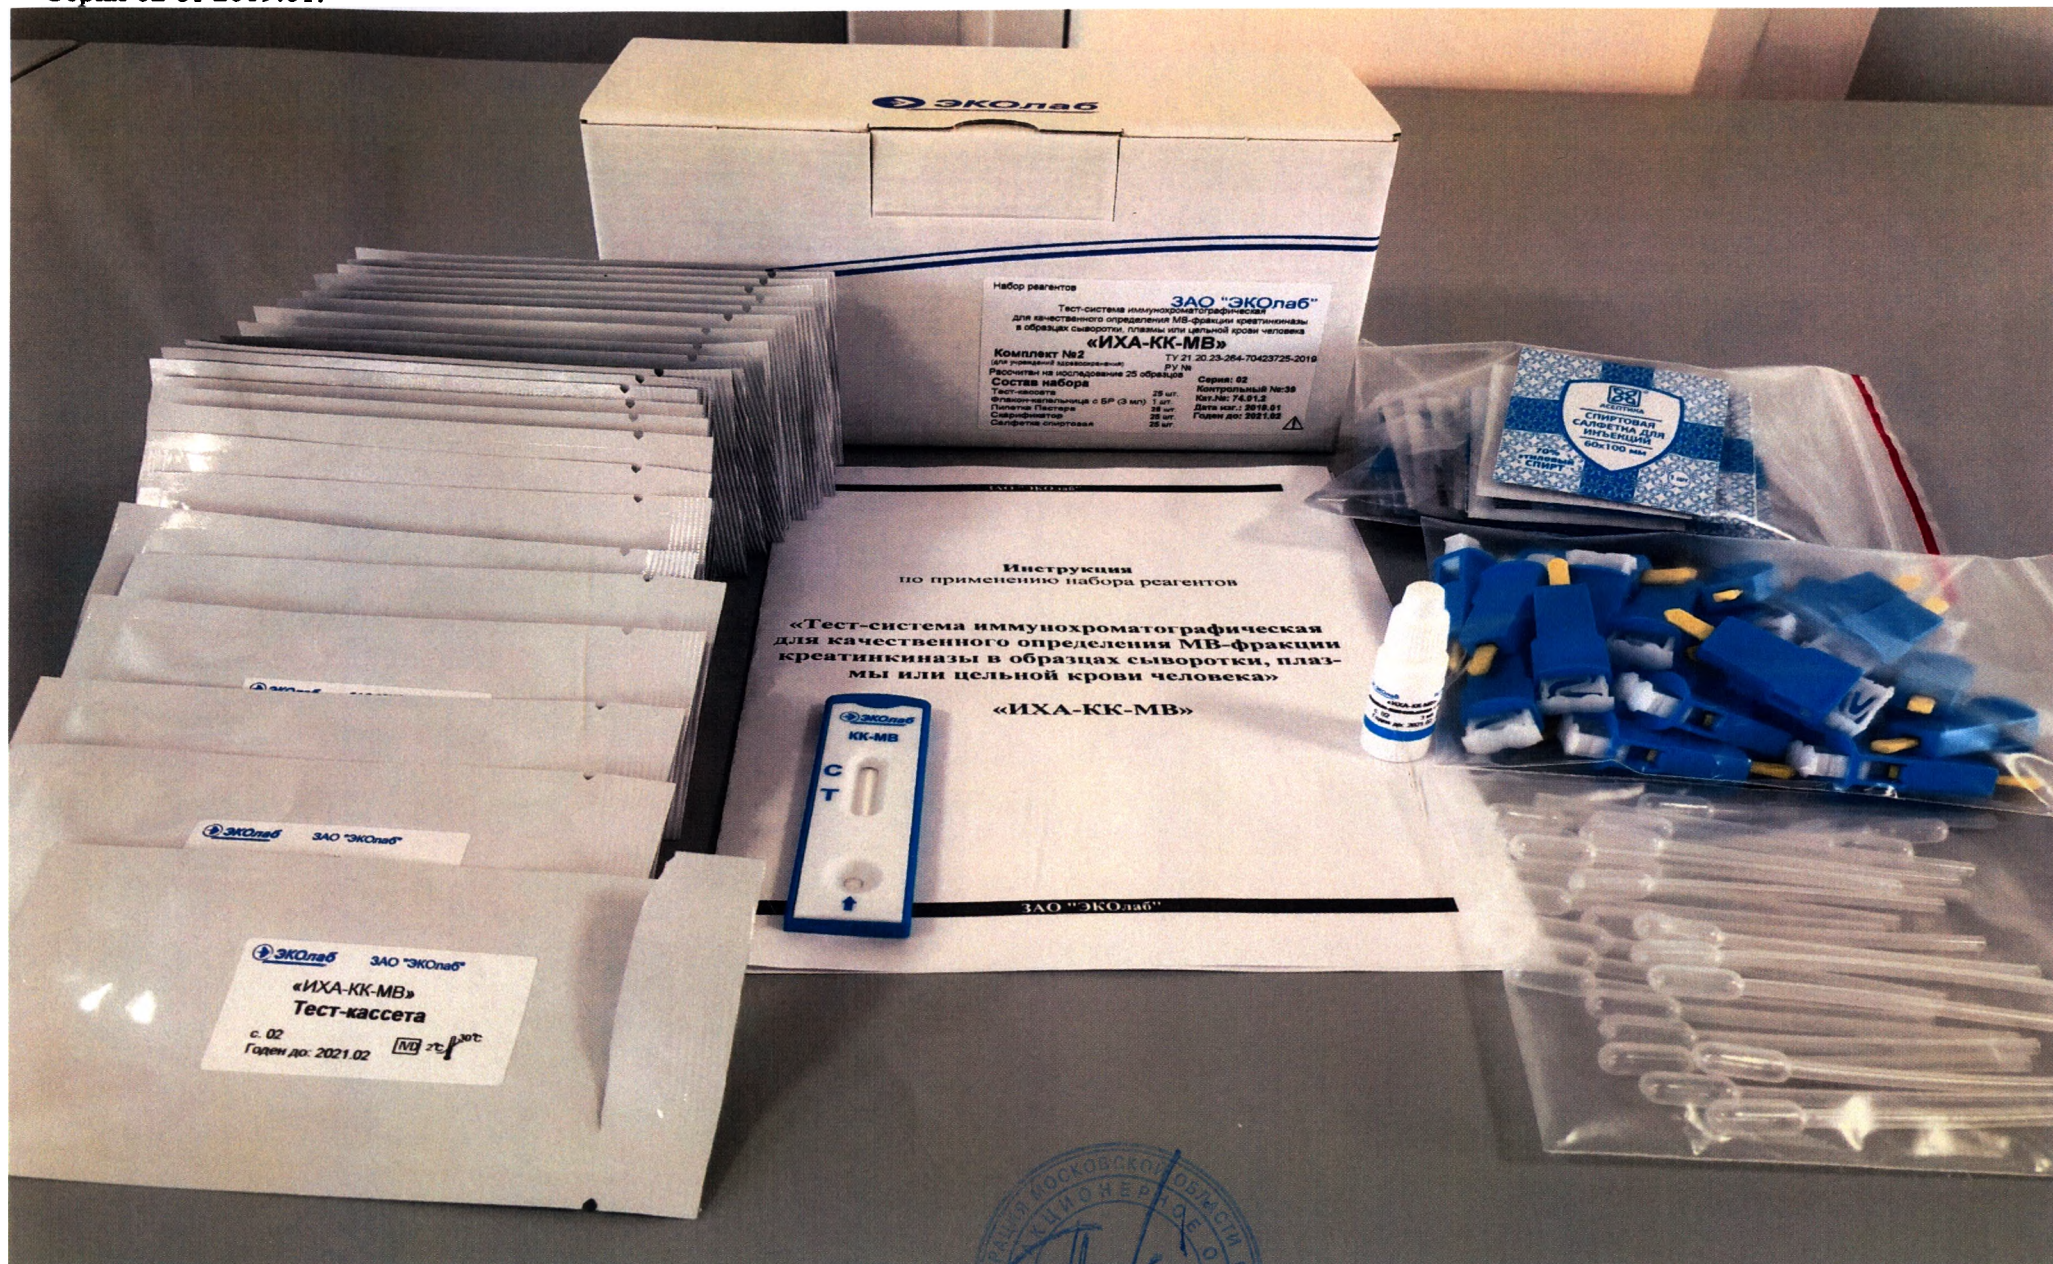

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"10" 08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
« 20 » г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения МВ-фракции креатинкиназы
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«ИХА-КК-МВ»

Комплект №1

(для учреждений здравоохранения)

ТУ 21.20.23-264-70423725-2019

РУ №

Рассчитан на исследование 10 образцов

Состав набора

Тест-кассета	10 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл)	1 шт.
Пипетка Пастера	10 шт.
Скарификатор	10 шт.
Салфетка спиртовая	10 шт.

Серия: 01

Контрольный №:38

Кат.№: 74.01.1

Дата изг.: 2019.01

Годен до: 2021.02



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.


ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-КК-МВ»

Тест-кассета

с. 01

Годен до: 2021.02



Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
« 20 » г.

Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»
Тест-система иммунохроматографическая
для качественного определения МВ-фракции креатинкиназы
в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«ИХА-КК-МВ»

Комплект №2 (для учреждений здравоохранения)
ТУ 21.20.23-264-70423725-2019
Рассчитан на исследование 25 образцов
Состав набора
Тест-кассета 25 шт.
Флакон-капельница с БР (3 мл) 1 шт.
Пипетка Пастера 25 шт.
Скарификатор 25 шт.
Салфетка спиртовая 25 шт.

Серия: 02
Контрольный №:39
Кат.№: 74.01.1
Дата изг.: 2019.01
Голен до: 2021.02



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб»
«ИХА-КК-МВ»
Тест-кассета
с. 02
Голен до: 2021.02

ЗАО «ЭКОлаб»
«ИХА-КК-МВ»
Флакон-капельница с БР 3 мл
с. 02
Голен до: 2021.02

Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.

"10" 06 2019 г.