


Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного
определения аутоантител к тиреопероксидазе
в сыворотке (плазме) крови»
"ИФА-ат-ТПО"

Серия 01, дата изготовления 2022.02., годен до 2023.08



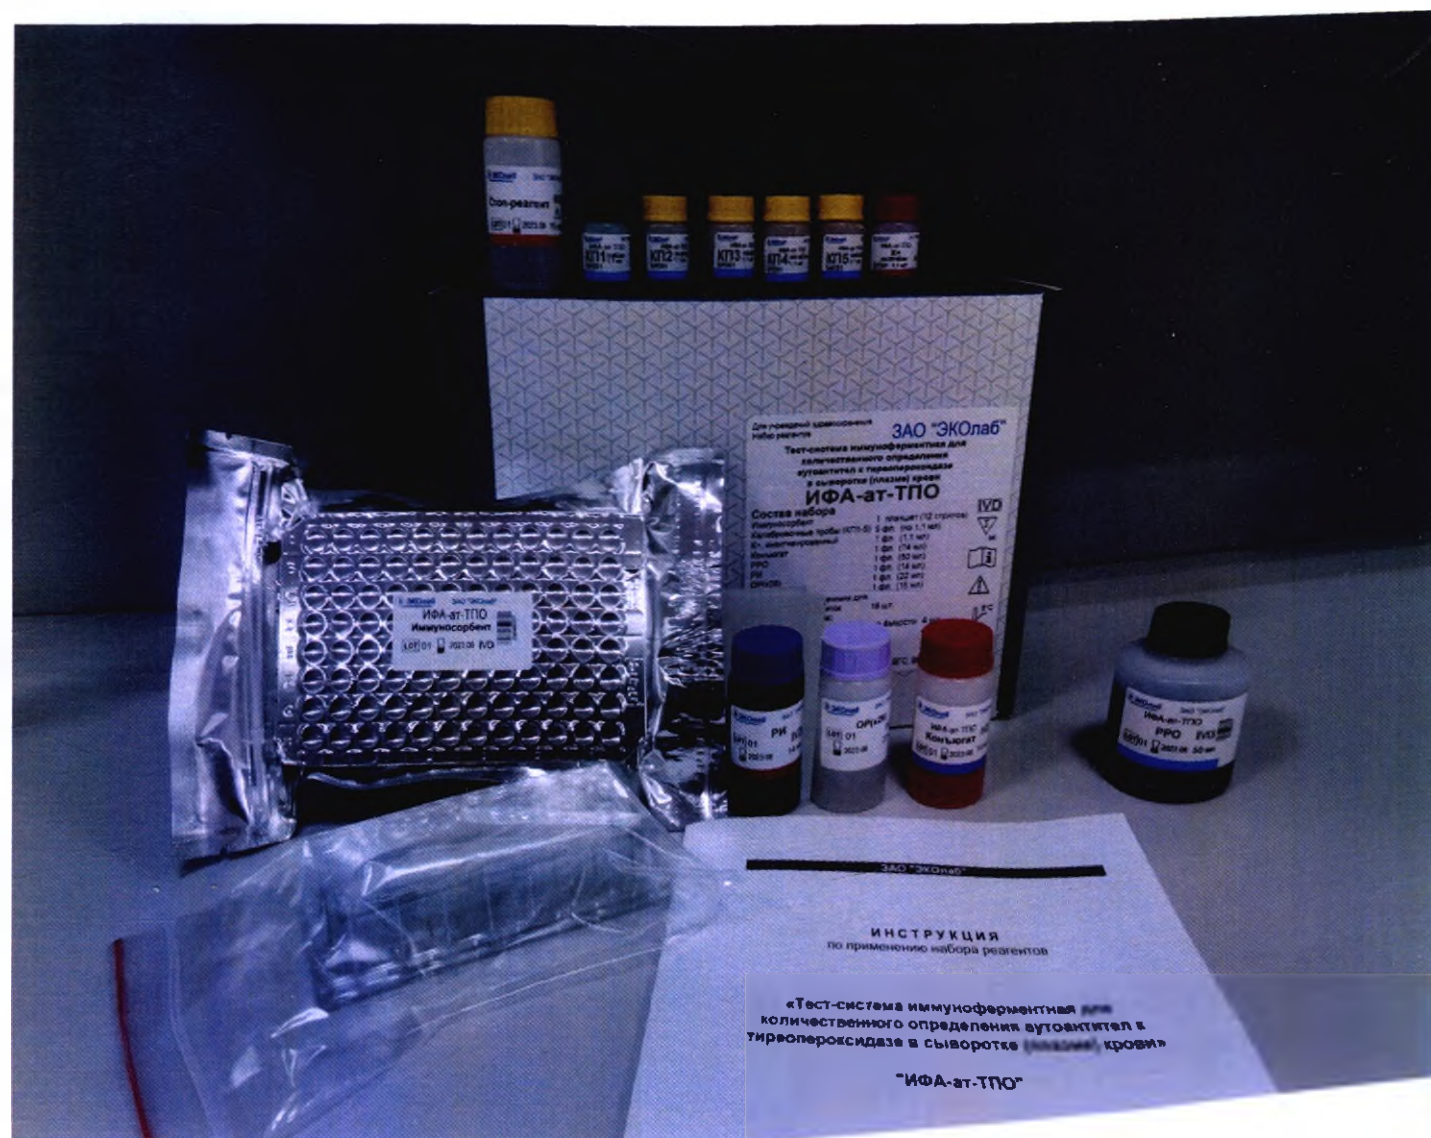

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"15" 12 2022 г.



Фотографическое изображение коробки (общий вид и вид сбоку) набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме) крови» "ИФА-ат-ТПО"



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

«03» 20 2017 г.

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для
количественного определения
аутоантител к тиреопероксидазе
в сыворотке (плазме) крови

ИФА-ат-ТПО

Состав набора

Иммунсорбент	1 планшет (12 стрипов)
Калибровочные пробы (КП1-5)	5 фл. (по 1,1 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (1,1 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
PPO	1 фл. (50 мл)
PI	1 фл. (14 мл)
OP(x26)	1 фл. (22 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (15 мл)
Наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



ИФА-ат-ТПО
КП1 0 МЕ/мл
1,1 мл

ИФА-ат-ТПО
КП2 30 МЕ/мл
1,1 мл

ИФА-ат-ТПО
КП3 100 МЕ/мл
1,1 мл

ИФА-ат-ТПО
КП4 300 МЕ/мл
1,1 мл

ИФА-ат-ТПО
КП5 1000 МЕ/мл
1,1 мл

ИФА-ат-ТПО
К+
1,1 мл

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-ат-ТПО
Конъюгат

14 мл

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-ат-ТПО
Иммунсорбент

1 шт.

HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения

ИФА-ат-ТПО

ТУ 21.20.23-320-70423725-2022

LOT **
REF 60.07

Контрольный № ***



ЗАО «ЭКОлаб»

PI

14 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

OP(x26)

22 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-ат-ТПО

PPO

50 мл

ЗАО «ЭКОлаб»

Стоп-реагент

15 мл

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК



Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.