


**Фотографическое изображение коробки (не в сборе) набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для количественного определения
аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке (плазме) крови»
"ИФА-ат-ТГ"**

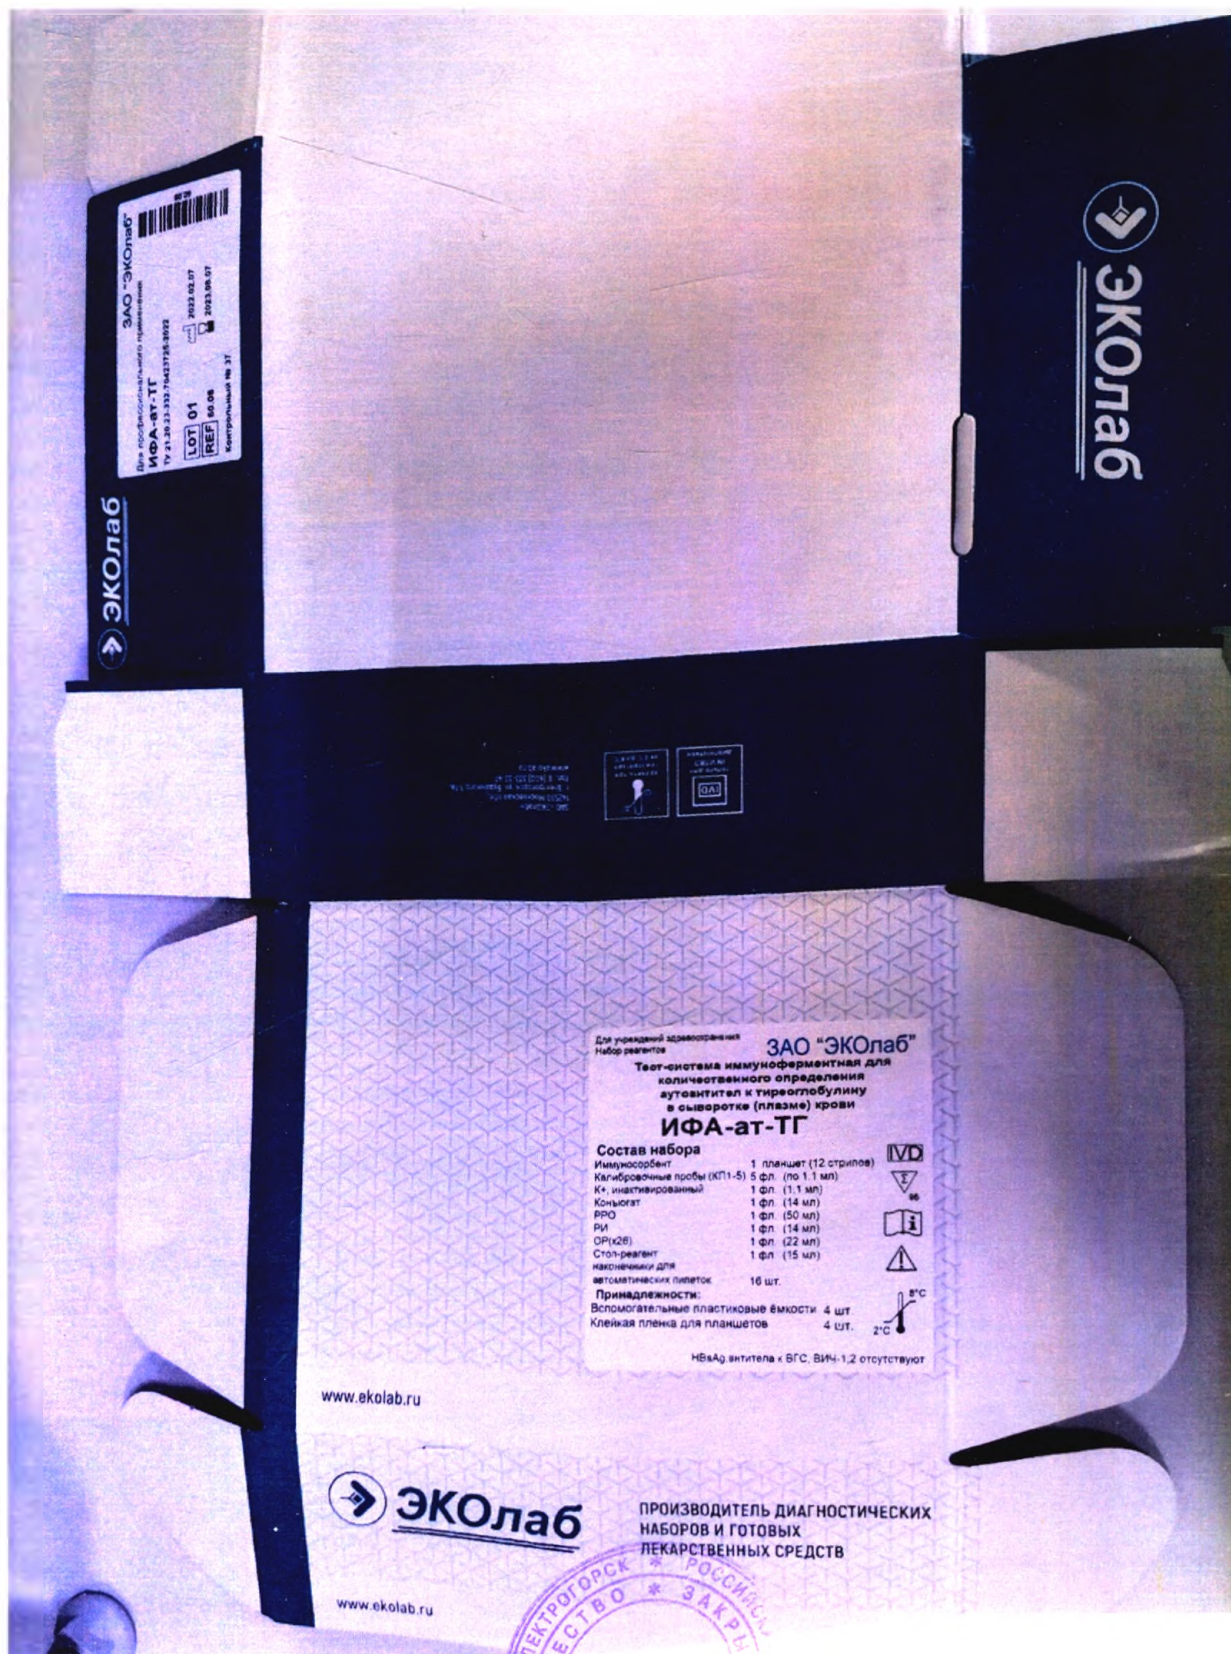


Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного определения
аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке (плазме) крови»
"ИФА-ат-ТГ"

Серия 01, дата изготовления 2022.02., годен до 2023.08

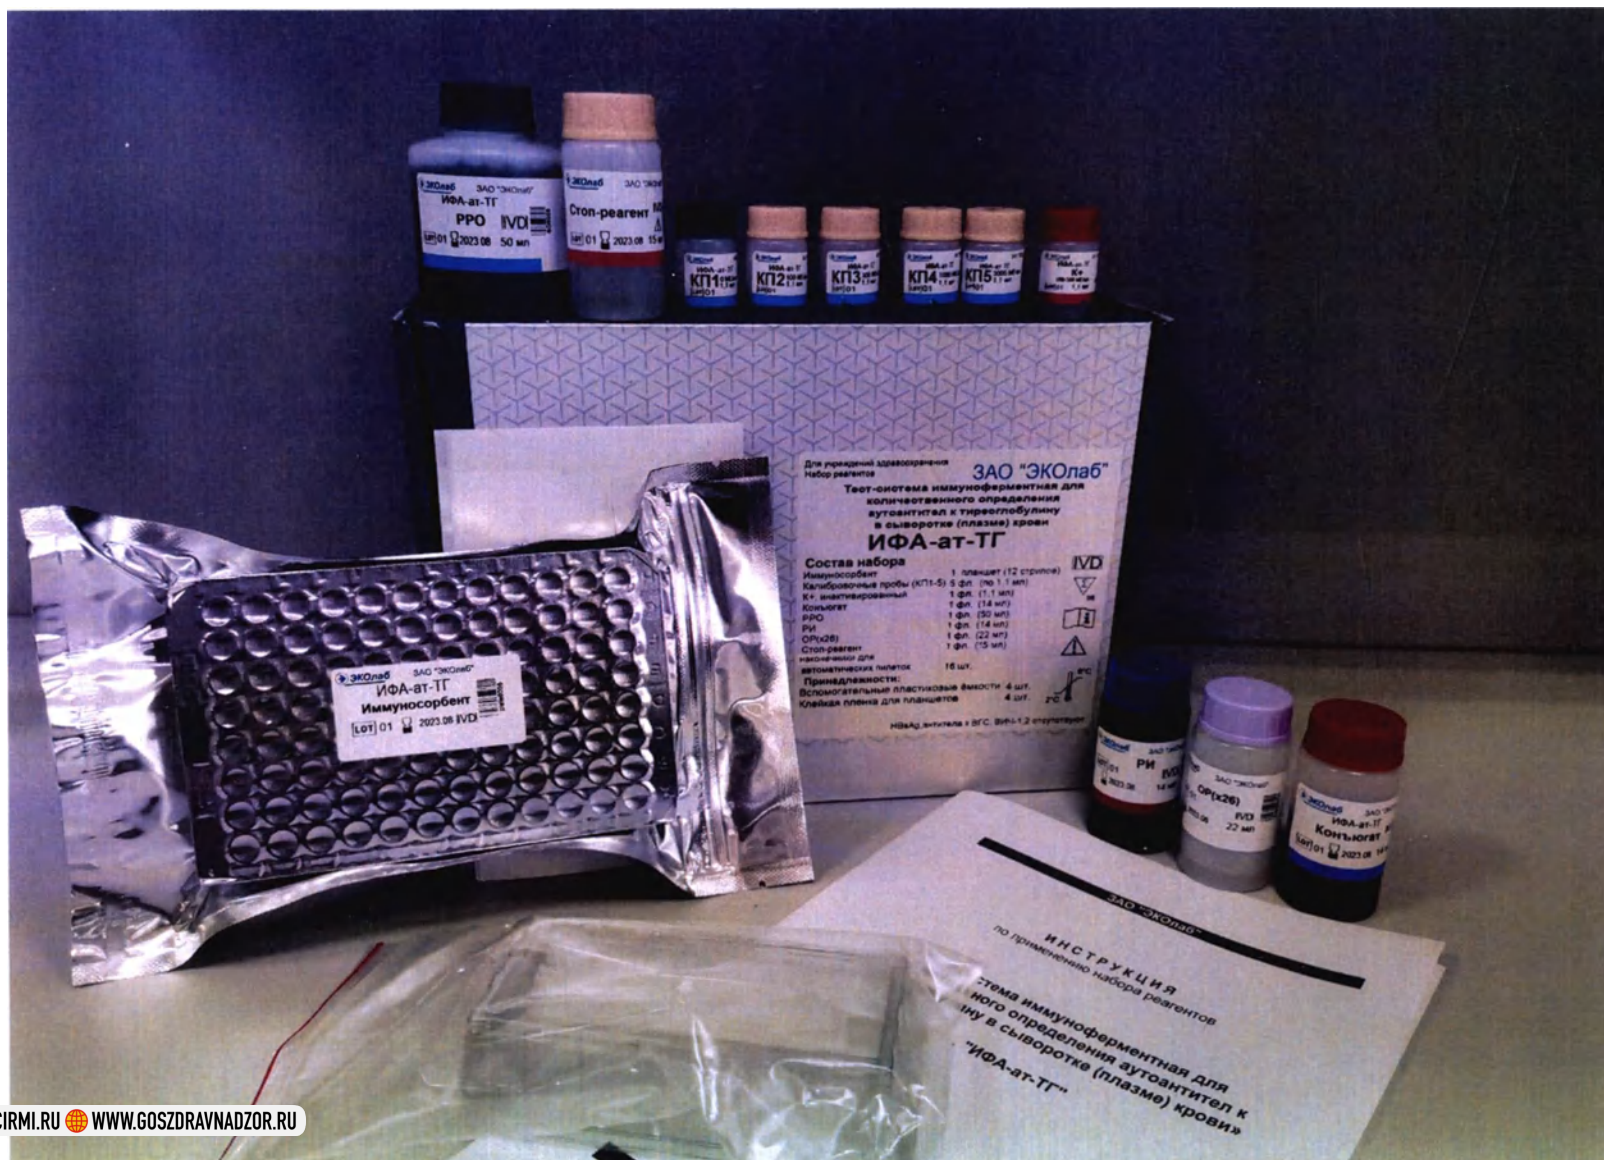

[illegible]

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

_____ лист _____
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
"27" _____ 2022 г.



Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

ЗАО "ЭКОлаб"

**Тест-система иммуноферментная для
количественного определения
аутоантител к тиреоглобулину
в сыворотке (плазме) крови
ИФА-ат-ТГ**

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет (12 стрипов)
Калибровочные пробы (КП1-5)	5 фл. (по 1.1 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (1.1 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (50 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
ОР(х26)	1 фл. (22 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (15 мл)

Наконечники для

автоматических пипеток

16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости

4 шт.

Клейкая пленка для планшетов

4 шт.

IVD



НВsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-ат-ТГ

ТУ 21.20.23-332-70423725-2022

LOT **

REF 60.08



Контрольный № ***



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"
Т.Ю. Гашенко
2012

ИФА ат-ТГ
КП1 0 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
КП2 100 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
КП3 300 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
КП4 1000 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
КП5 2000 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
К+ 200 ME/ml
1.1 ml

ИФА ат-ТГ
Конъюгат
14 мл

ИФА-ат-ТГ
Иммуносорбент

РИ
14 мл

ОР(х26)
22 мл

ИФА-ат-ТГ
РРО
50 мл

Стоп-реагент
15 мл

Директор производства ДП

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

