



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального директора ООО «АРКРЭЙ»
по вопросам качества и регуляторным



Семенова М.Ю.

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов AUTION EYE для контроля качества и калибровки
анализатора осадка мочи AUTION EYE AI-4510

2024

Наименование медицинского изделия:

Набор реагентов AUTION EYE для контроля качества и калибровки анализатора осадка мочи AUTION EYE AI-4510

Разработчик:

ARKRAY Factory, Inc. / «АРКРЭЙ Фэктори, Инк.», Япония.

1480, Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония (1480, Koji, Konan-cho Koka-shi, Shiga 520-3306 JAPAN)

Тел. +81-74-886-58-33

Факс +81-75-662-89-79

e-mail: info@arkray.co.jp

Производитель:

ARKRAY Factory, Inc. / «АРКРЭЙ Фэктори, Инк.», Япония.

1480, Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония (1480, Koji, Konan-cho Koka-shi, Shiga 520-3306 JAPAN)

Тел. +81-74-886-58-33

Факс +81-75-662-89-79

e-mail: info@arkray.co.jp

Место производства:

ARKRAY Industry, Inc. (АРКРЭЙ Индастри, Инк.), Lot 22 Phase 1A, First Philippine Industrial Park, Brgy. Sta. Anastacia, Santo Tomas, Batangas 4234, PHILIPPINES (Лот 22 Фаза 1А, Фэст Филиппин Индастриал Парк, Барангей Ста. Анастасия, Санто Томас, Батангас 4234, Филиппины).

Уполномоченный представитель производителя:


Общество с ограниченной ответственностью «АРКРЭЙ» (ООО «АРКРЭЙ»)


Адрес места нахождения: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303

Тел./факс +7-496-219-10-14

Тел. +7-499-703-34-92


e-mail: info@arkrayrussia.ru

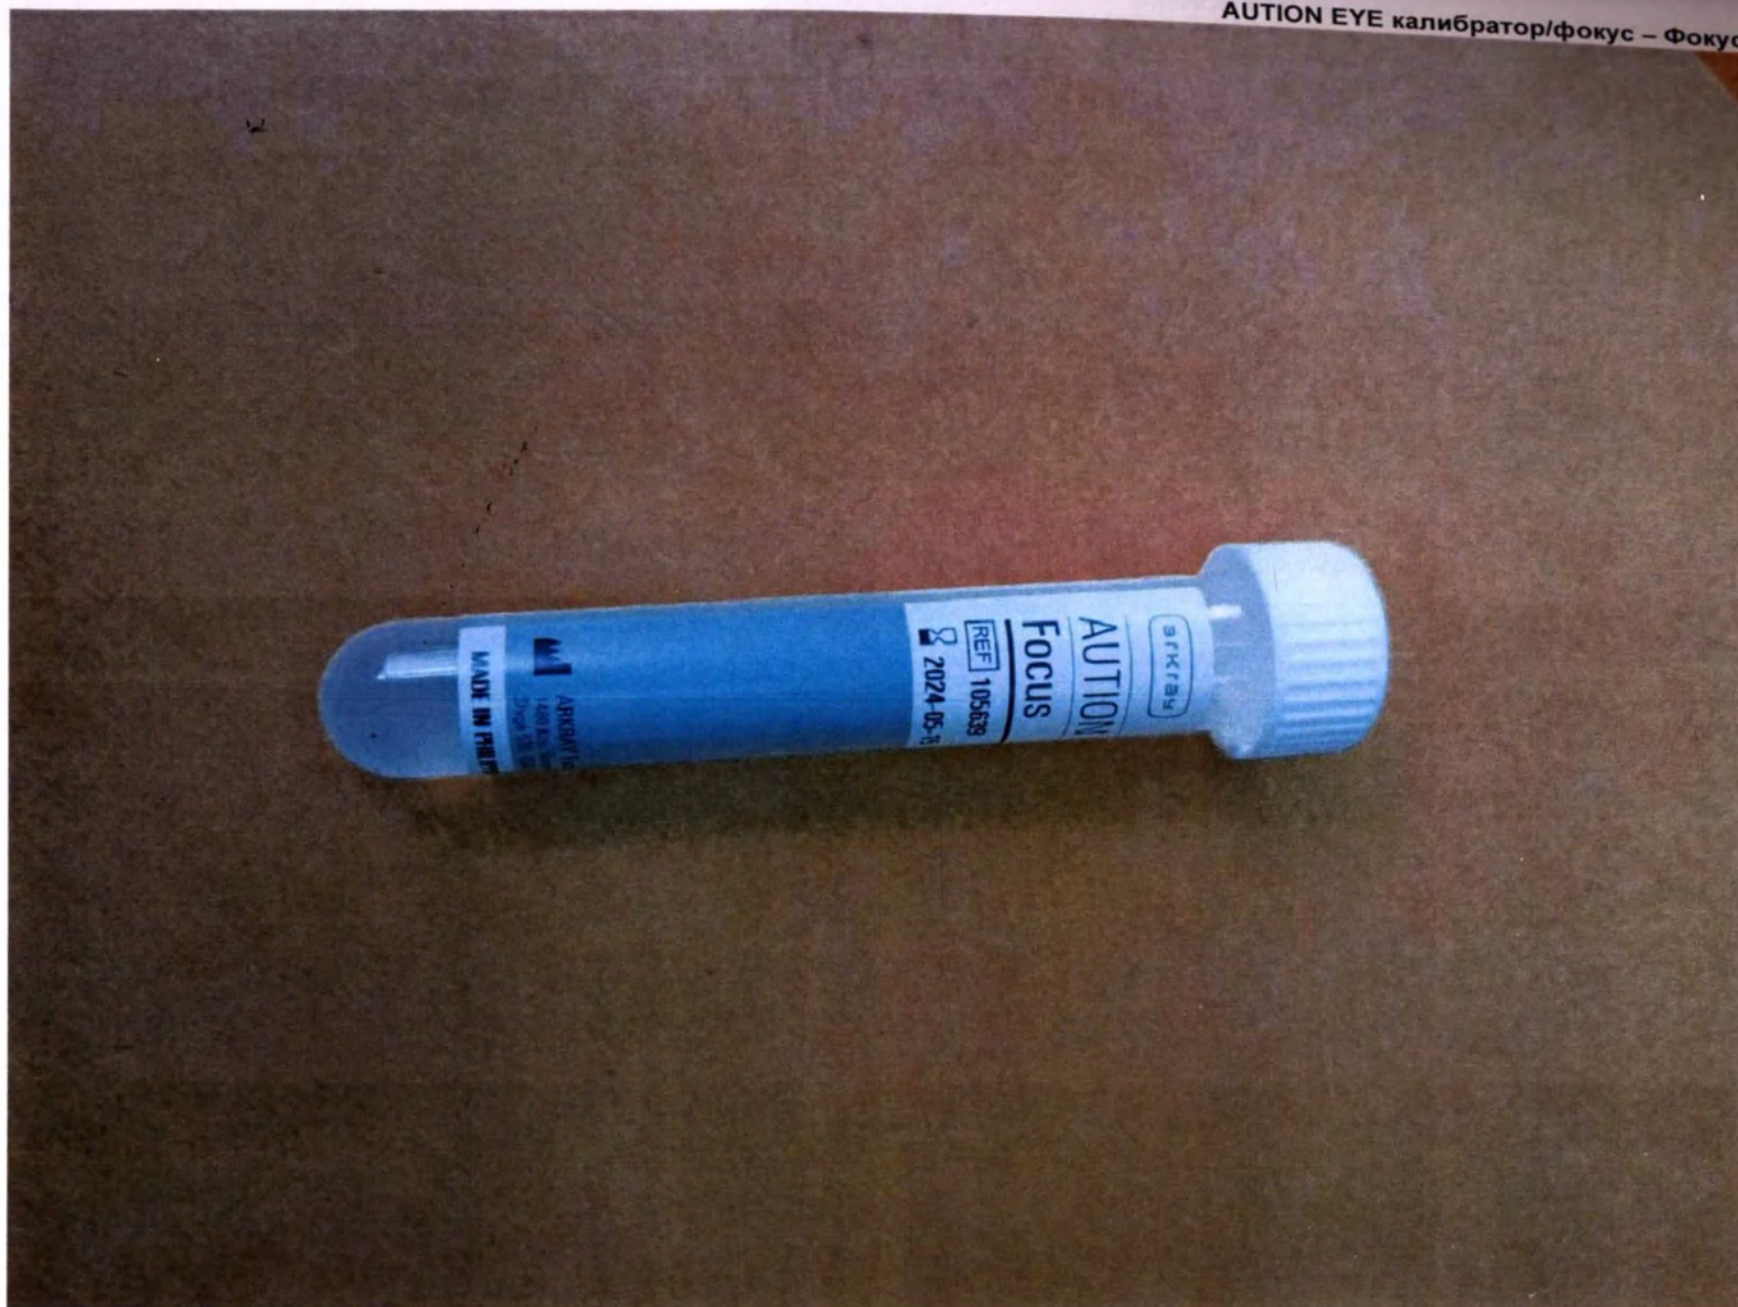


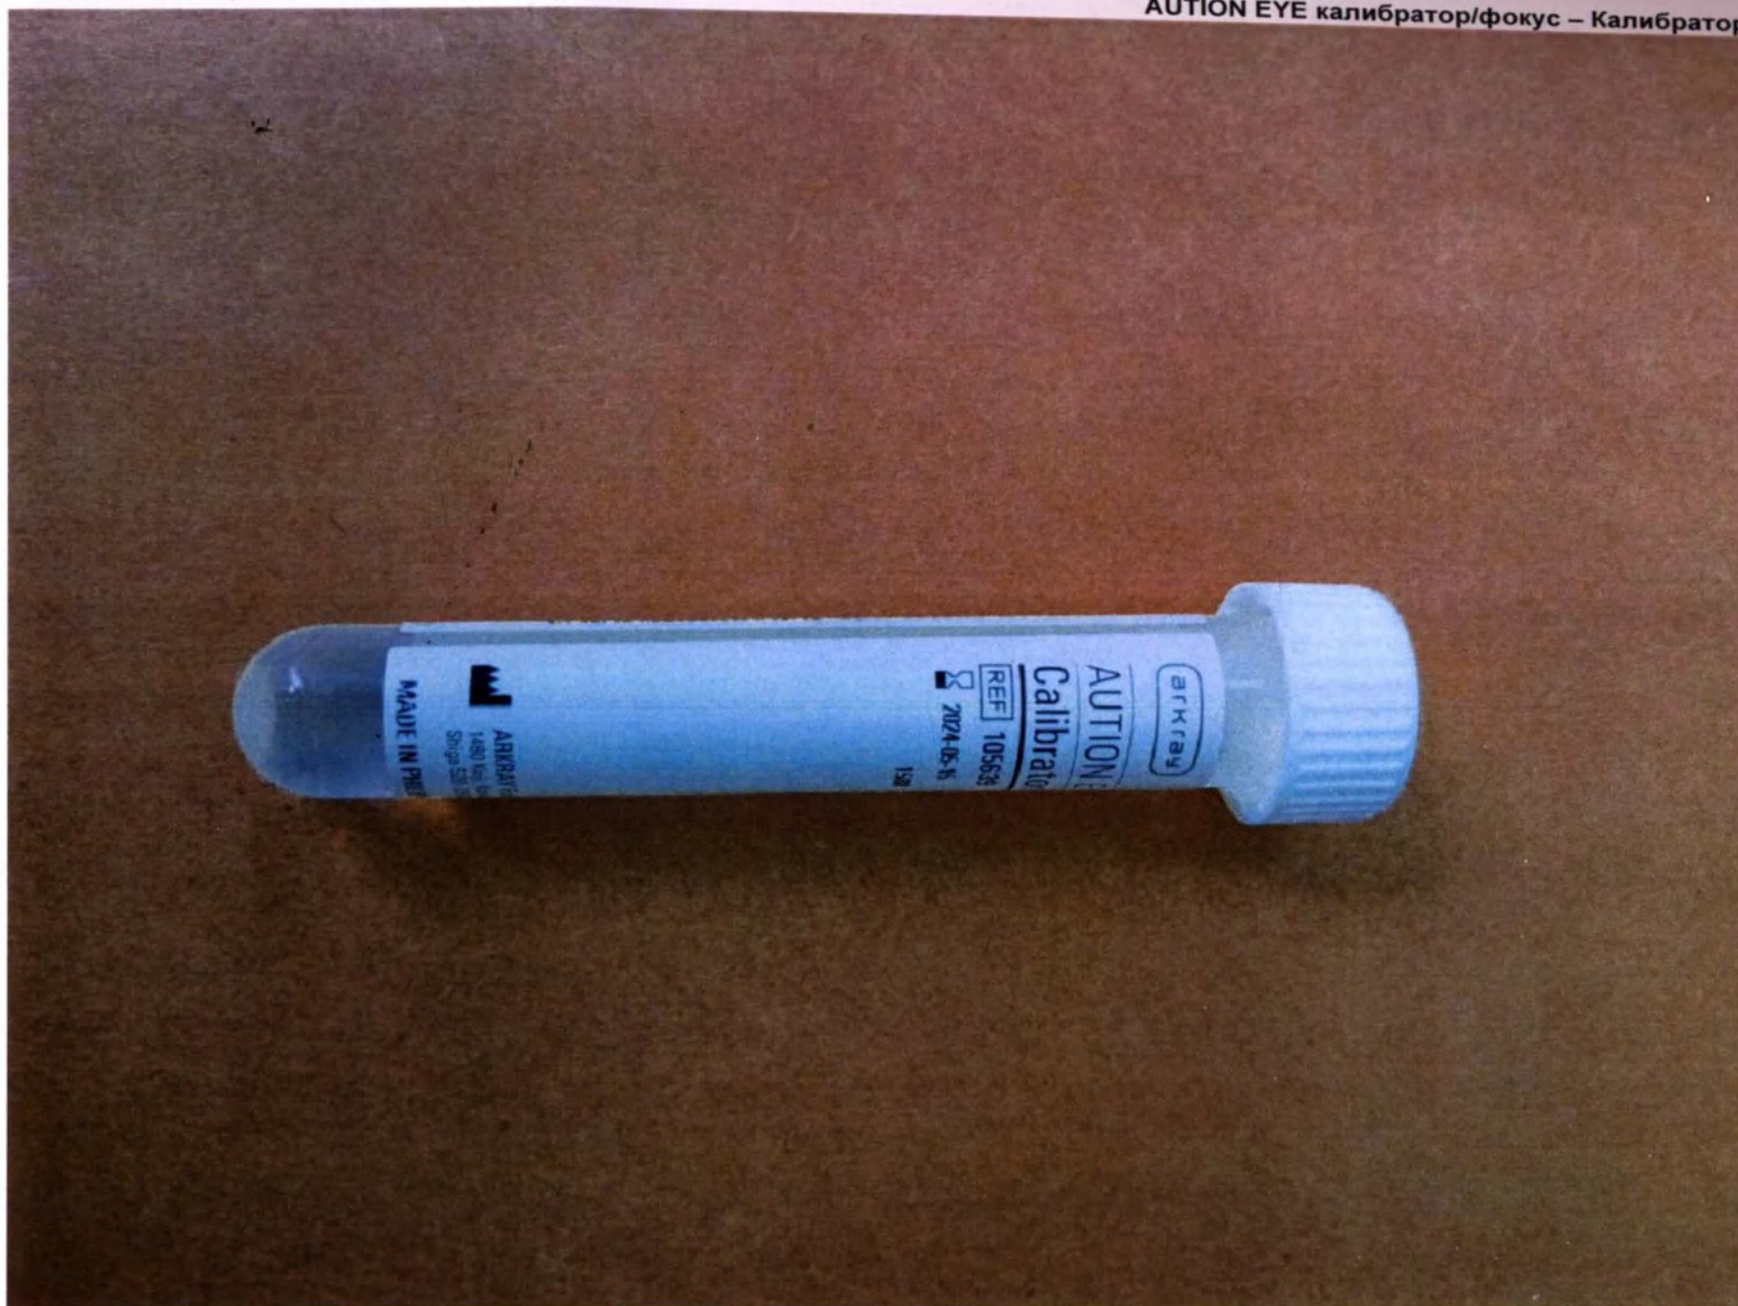







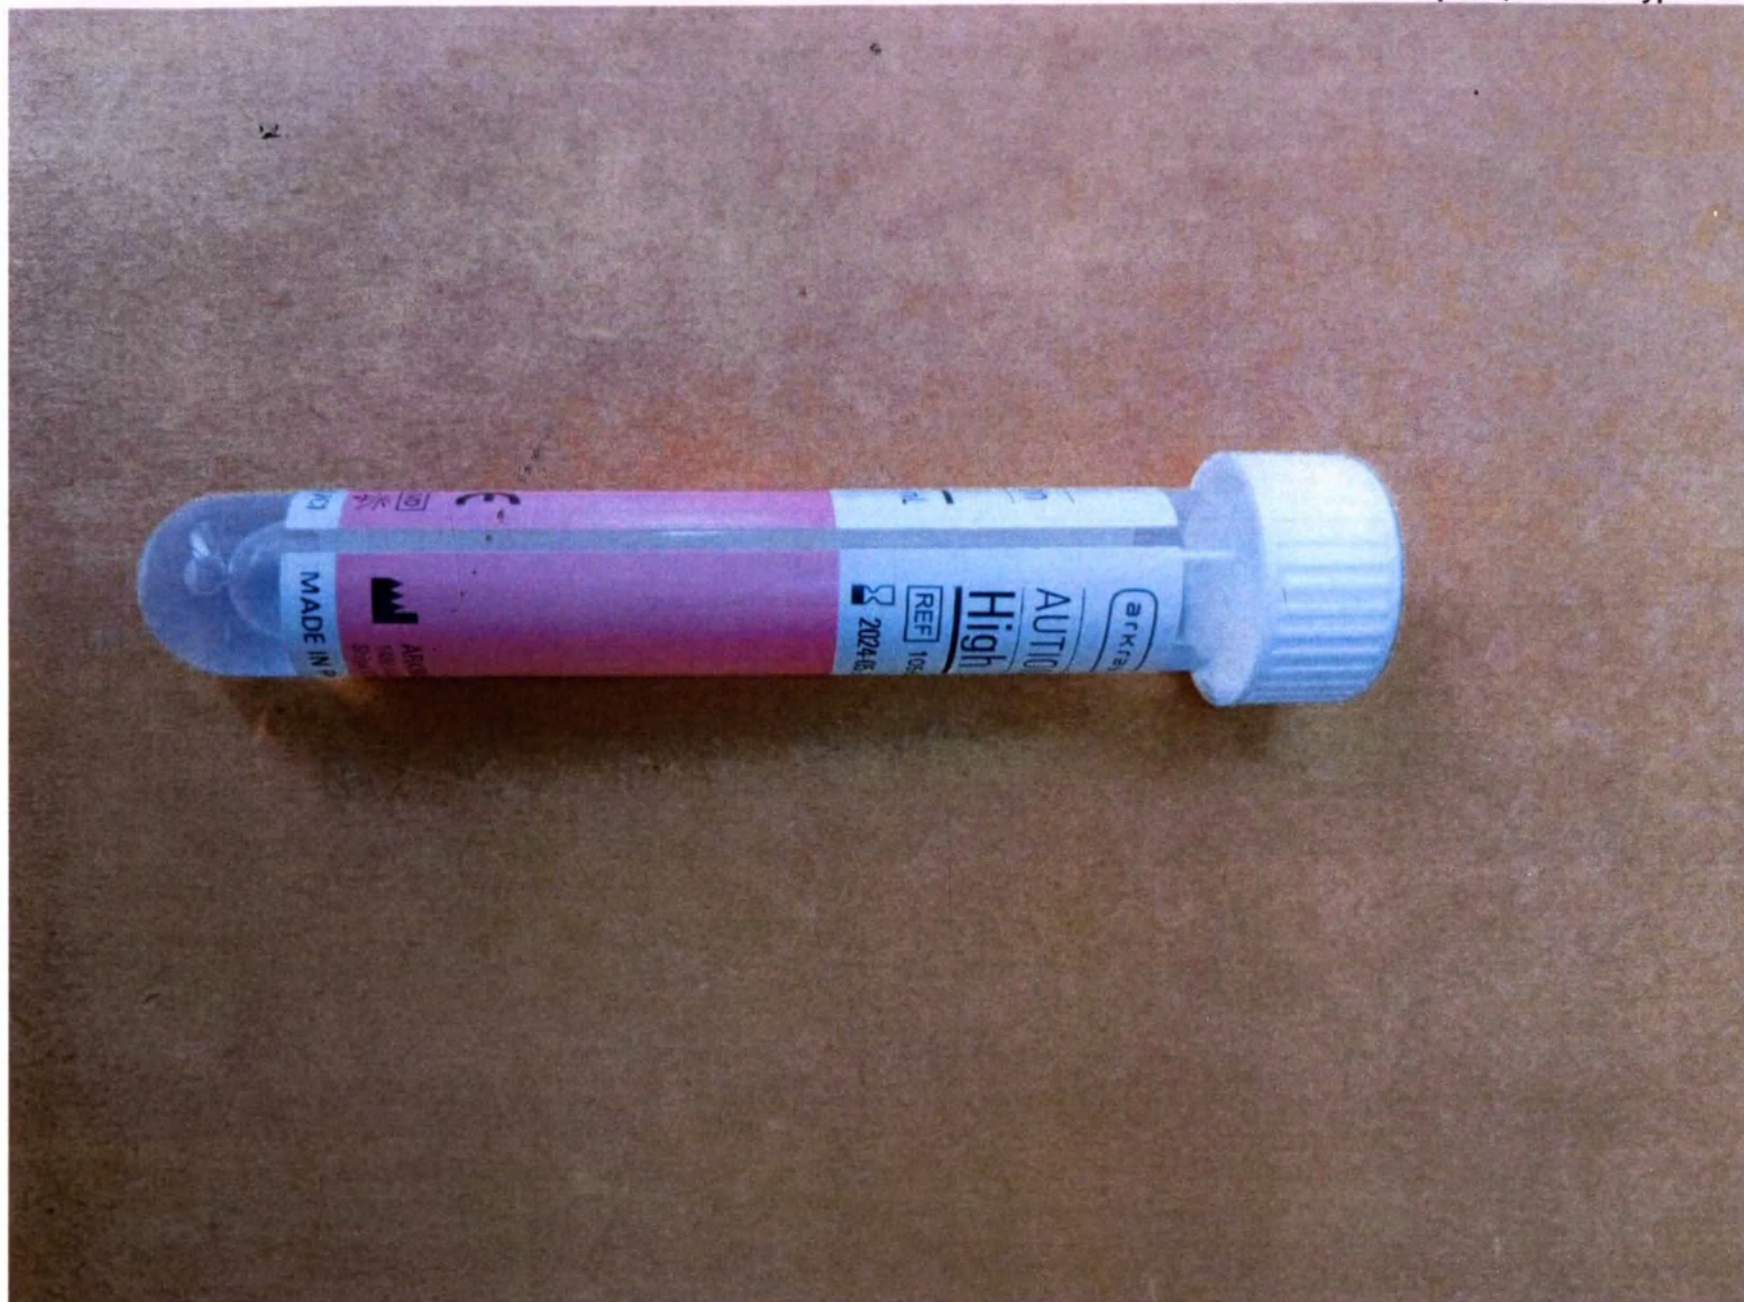


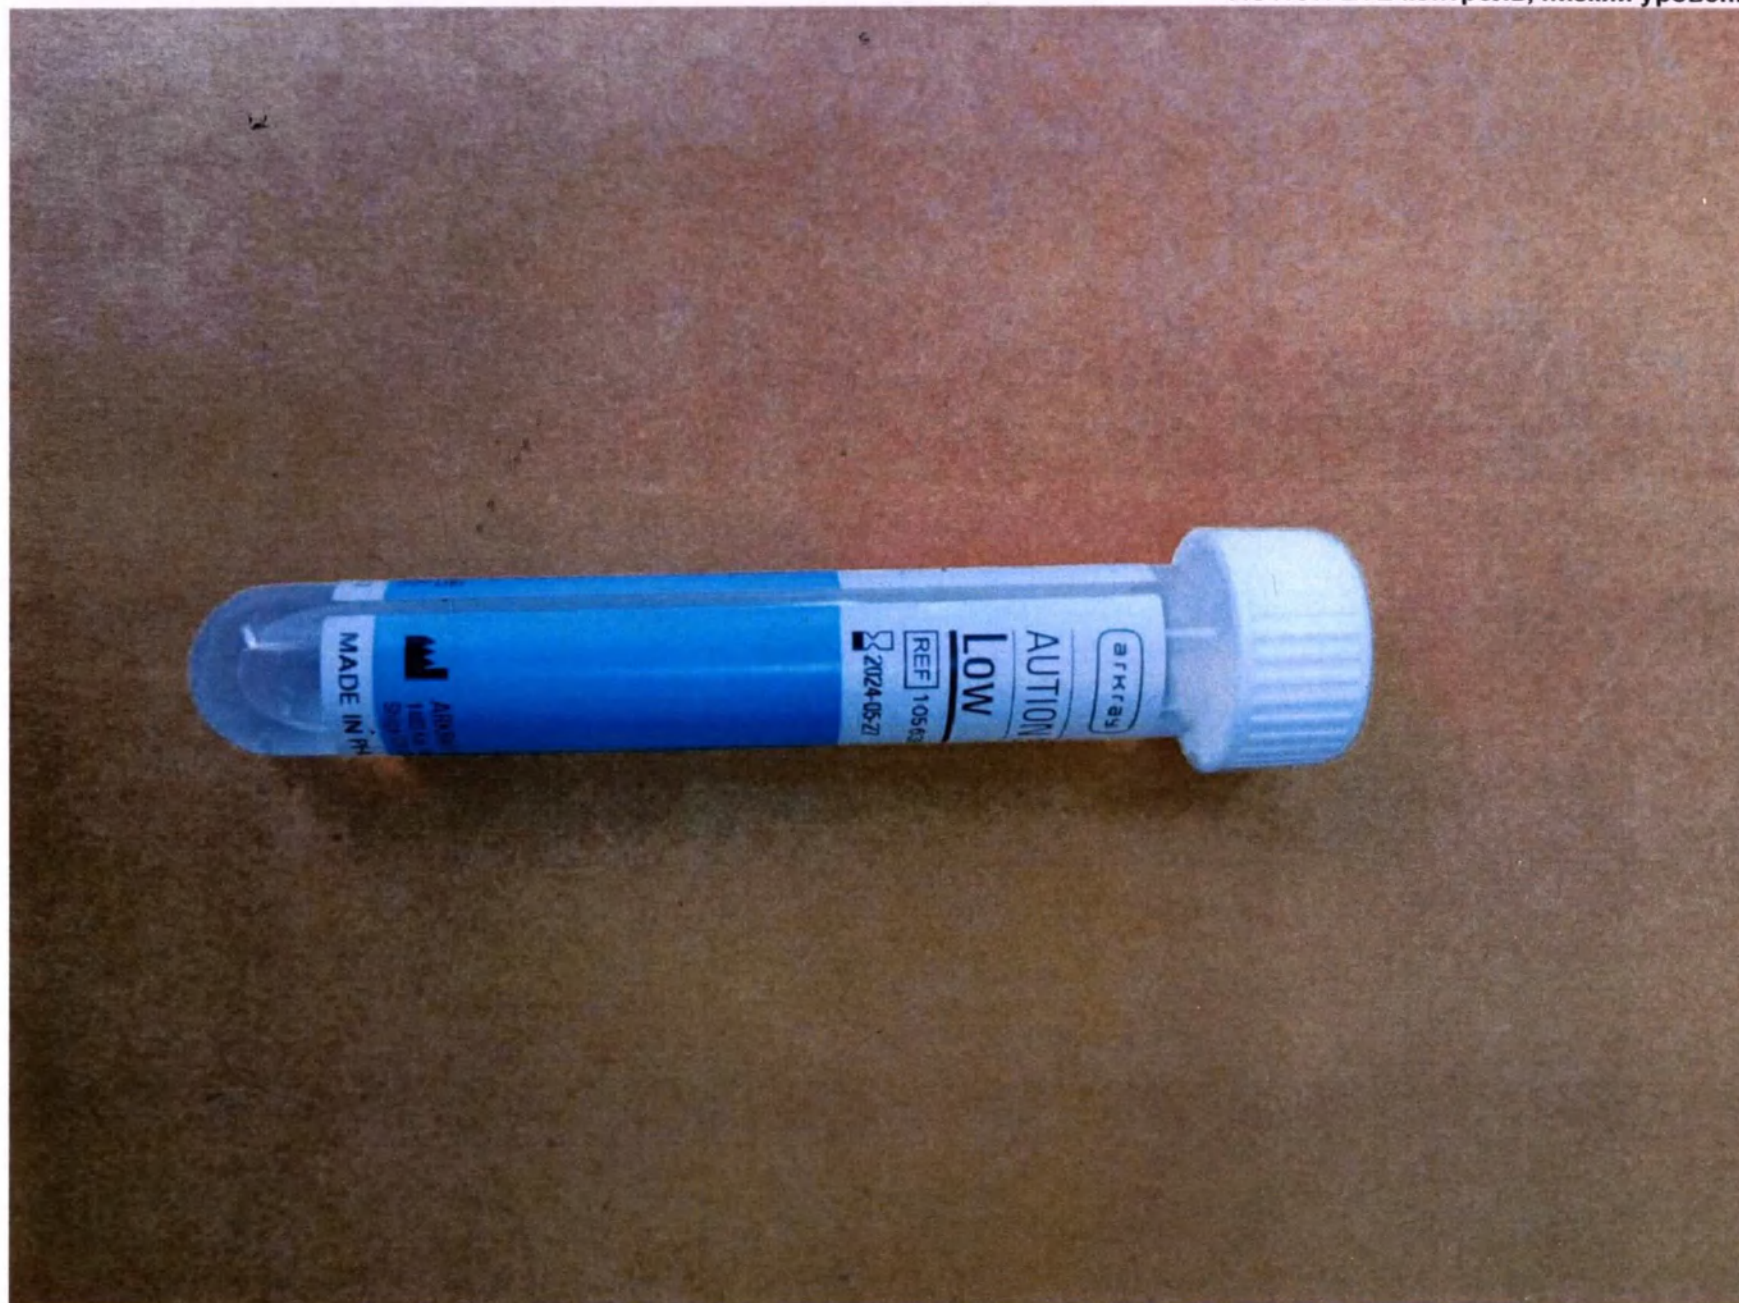




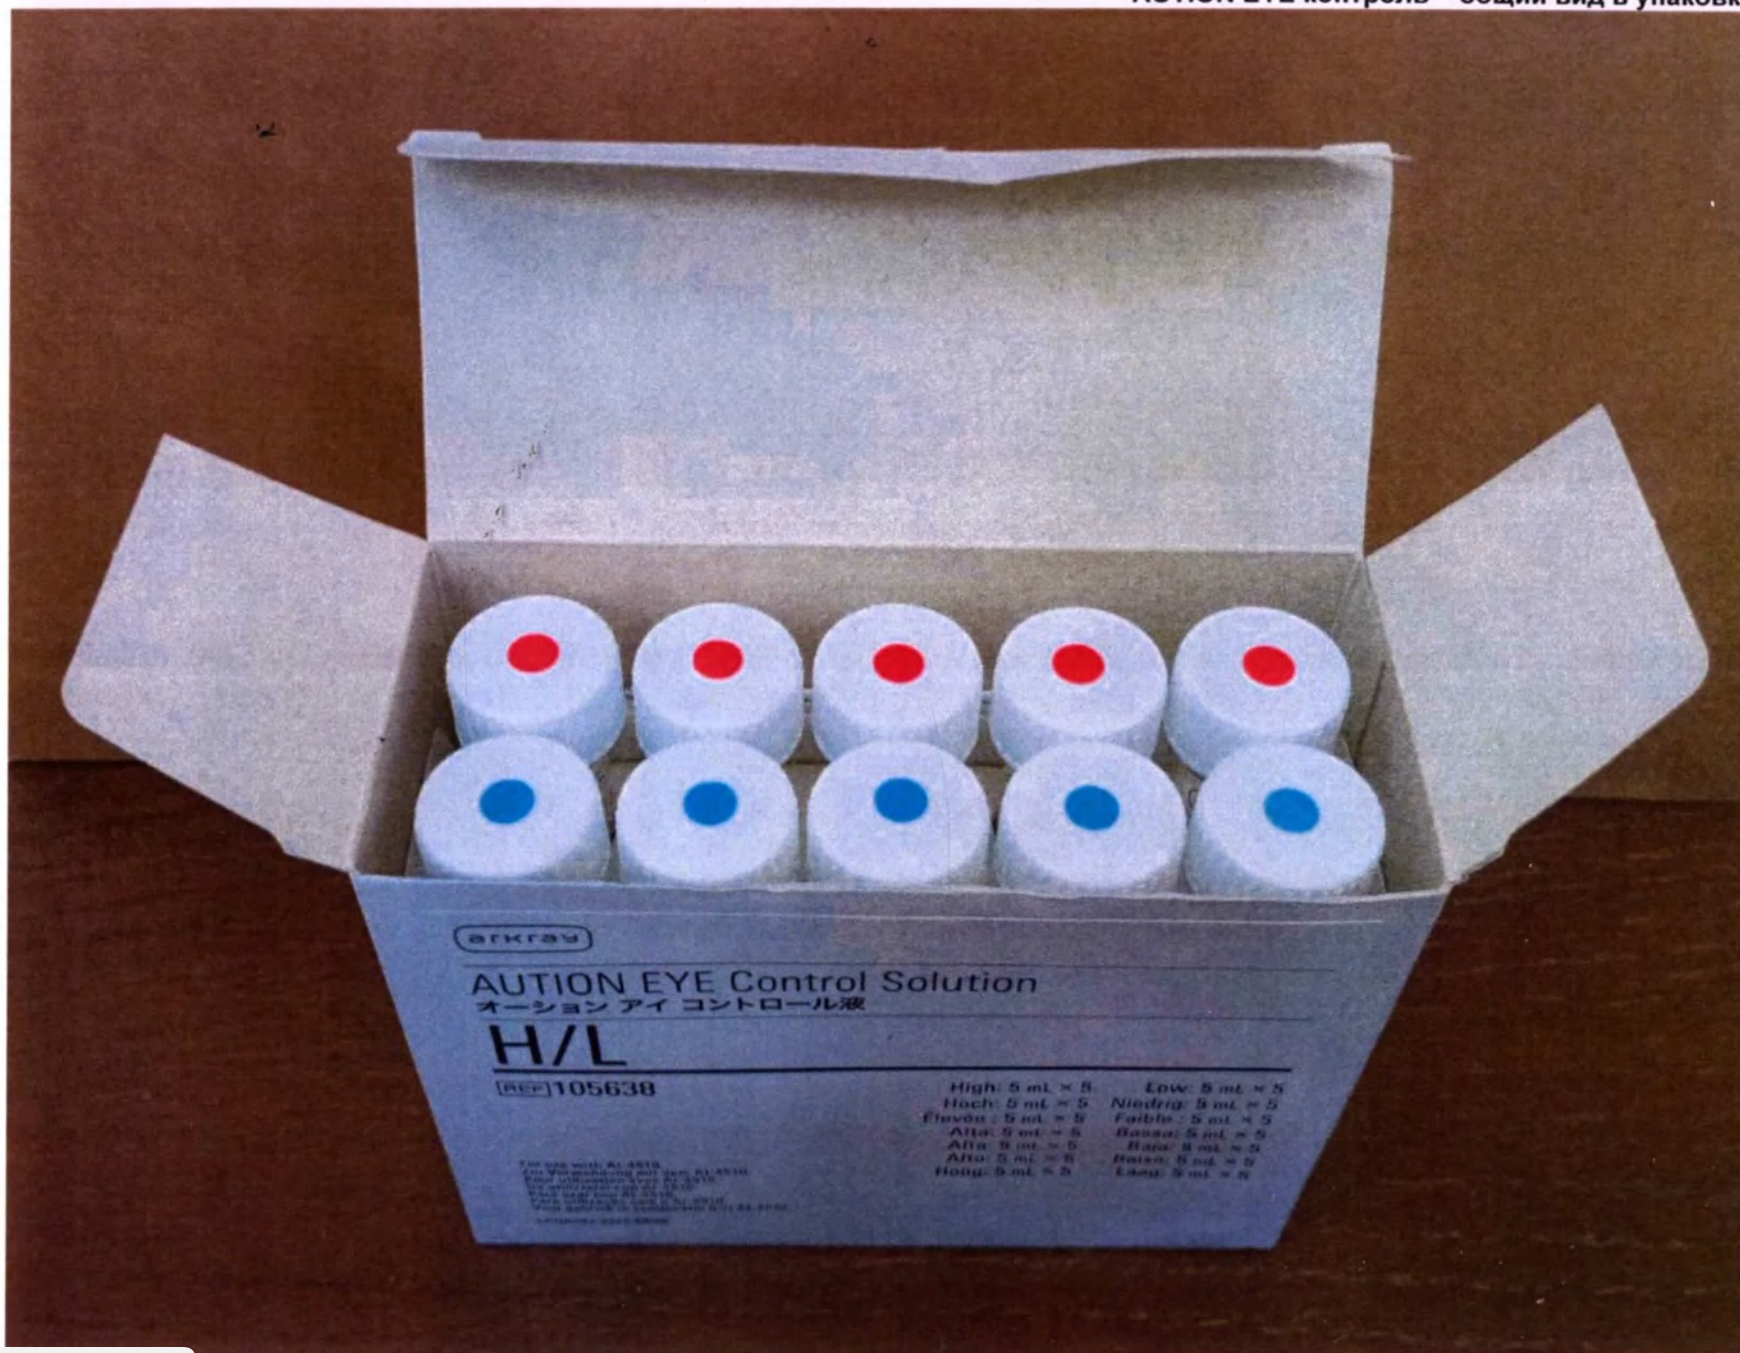

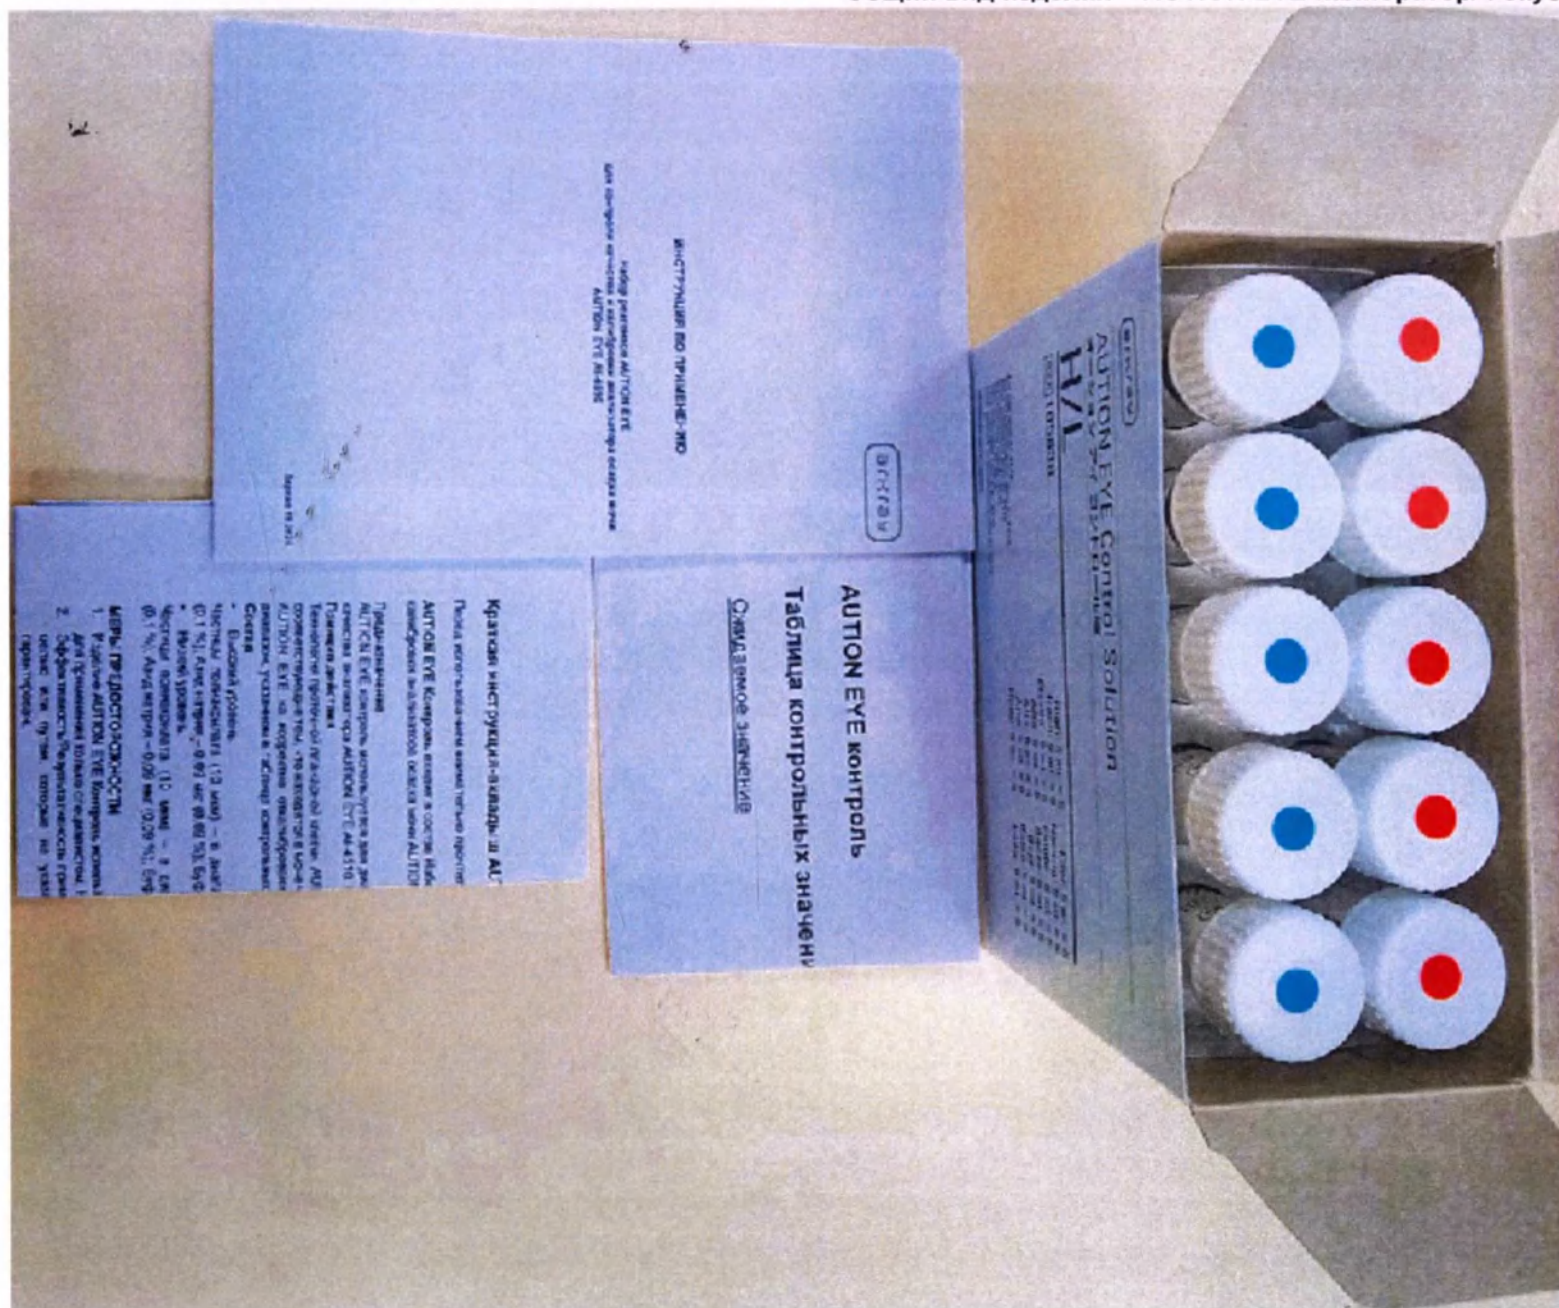

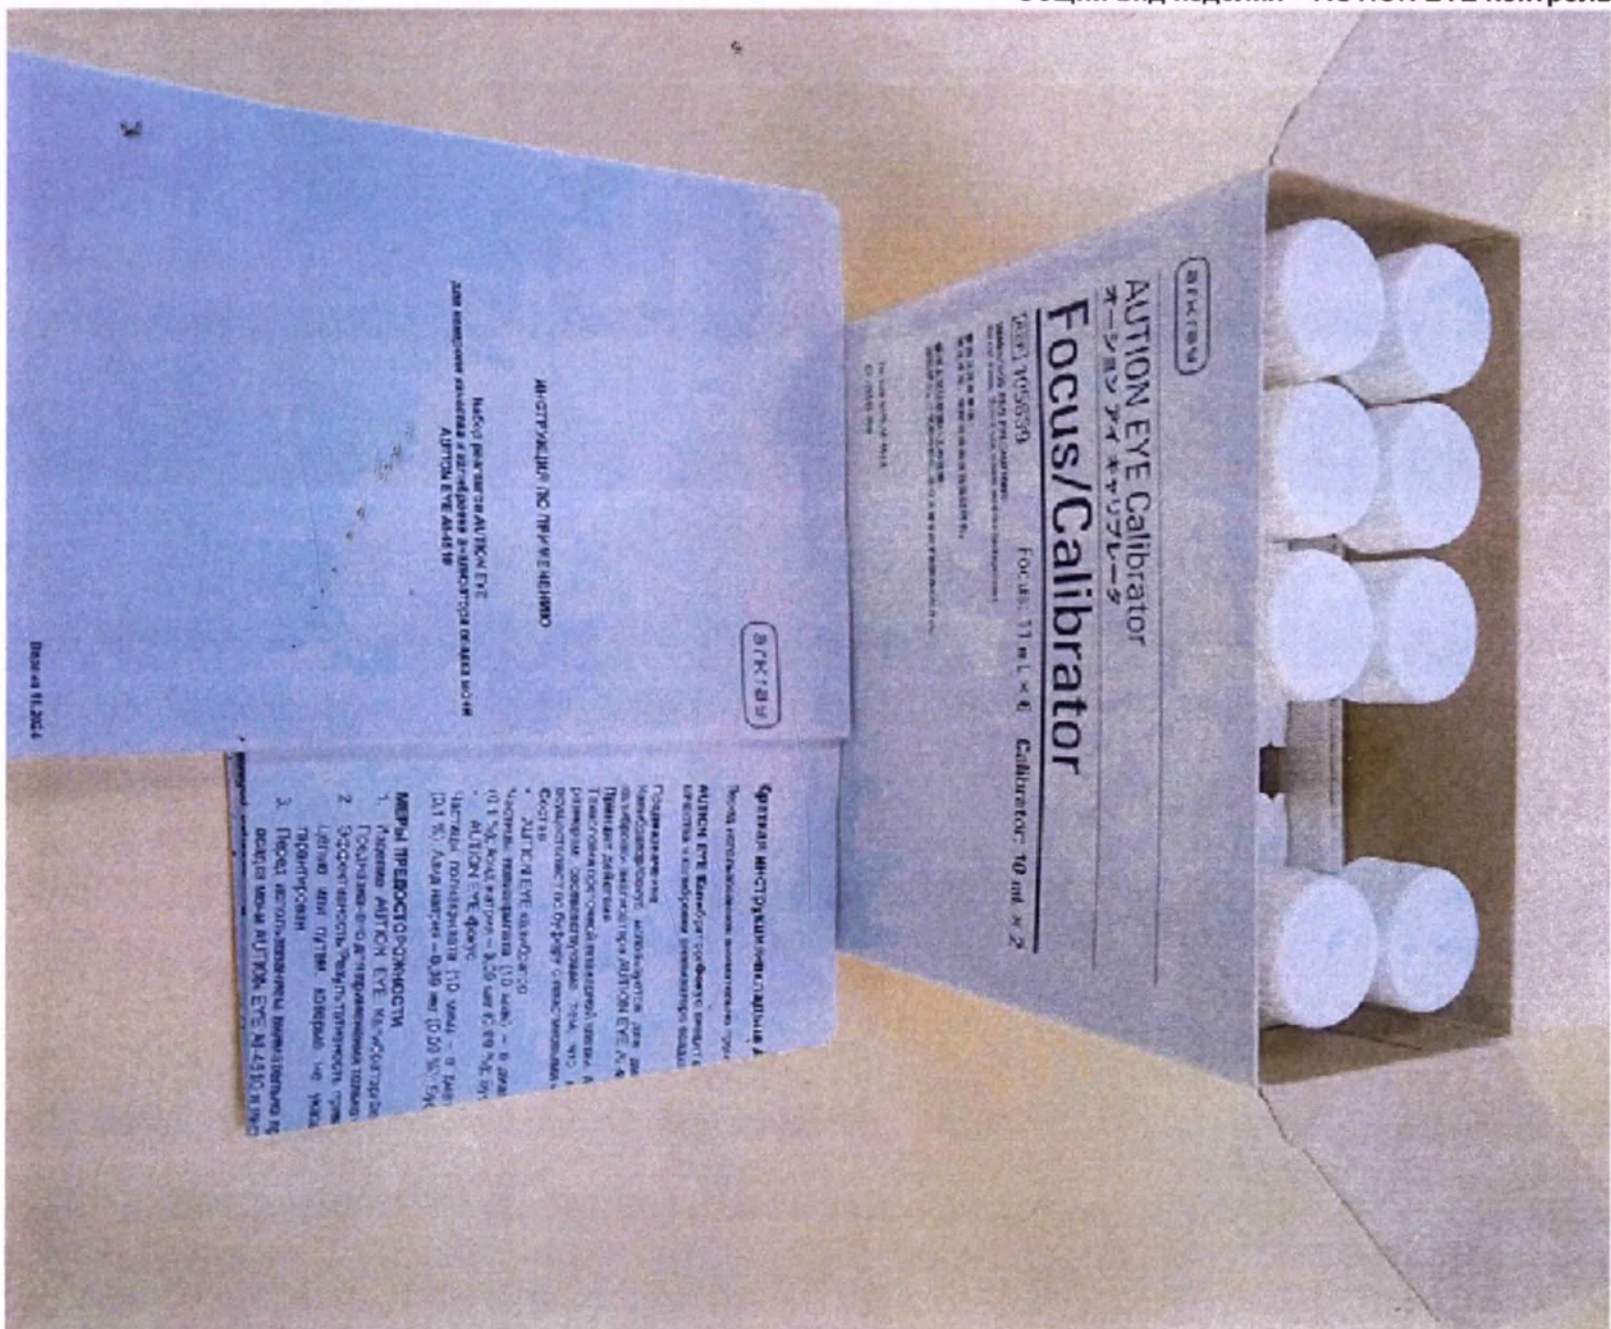

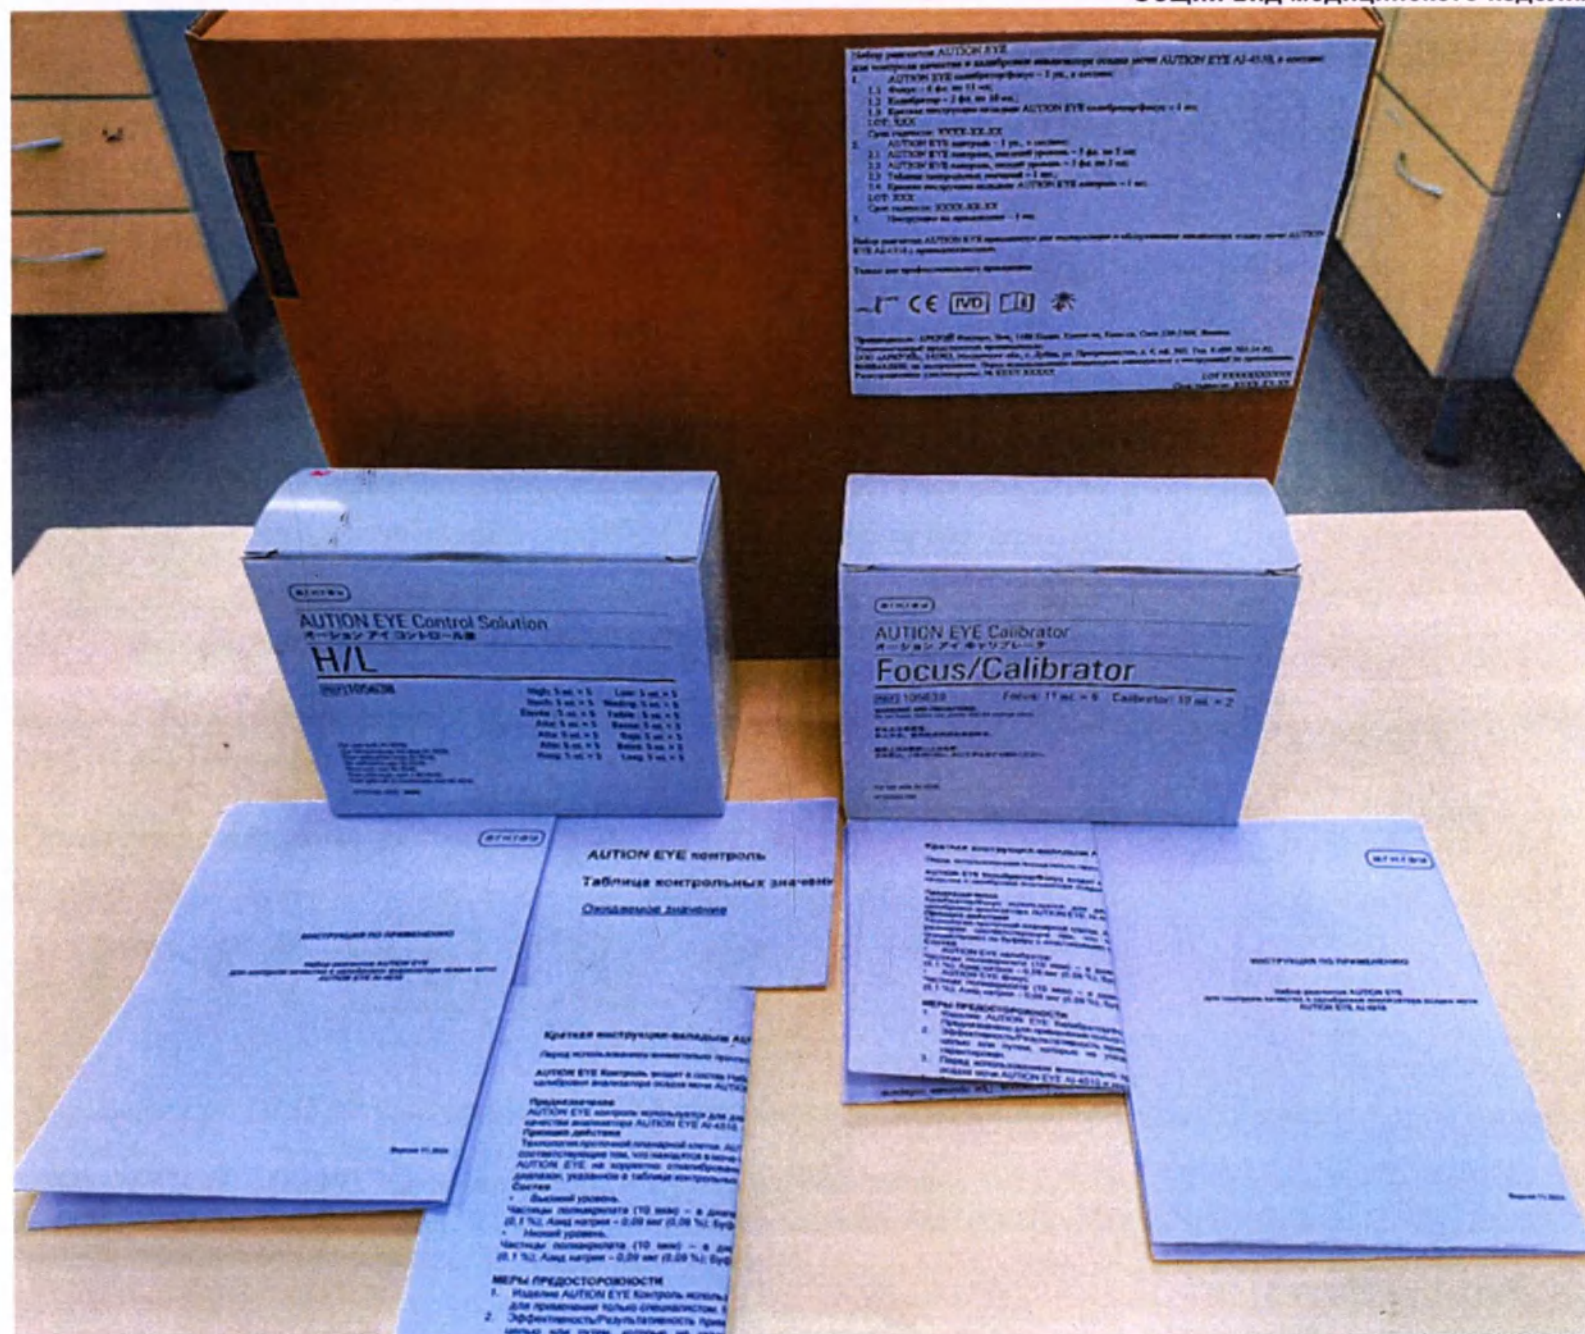

Набор реагентов AUTION EYE

для контроля качества и калибровки анализатора осадка мочи AUTION EYE AI-4510, в составе:

1. AUTION EYE калибратор/фокус – 1 уп., в составе:
 - 1.1 Фокус – 6 фл. по 11 мл;
 - 1.2 Калибратор – 2 фл. по 10 мл.;
 - 1.3 Краткая инструкция-вкладыш AUTION EYE калибратор/фокус – 1 шт.LOT: XXX
Срок годности: XXXX-XX-XX
2. AUTION EYE контроль – 1 уп., в составе:
 - 2.1 AUTION EYE контроль, высокий уровень – 5 фл. по 5 мл;
 - 2.2 AUTION EYE контроль, низкий уровень – 5 фл. по 5 мл;
 - 2.3 Таблица контрольных значений – 1 шт.;
 - 2.4 Краткая инструкция-вкладыш AUTION EYE контроль – 1 шт.LOT: XXX
Срок годности: XXXX-XX-XX
3. Инструкция по применению – 1 шт.

Набор реагентов AUTION EYE применяется для эксплуатации и обслуживания анализатора осадка мочи AUTION EYE AI-4510 с принадлежностями.

Только для профессионального применения.



Производитель: АРКРЭЙ Фэктори, Инк, 1480 Кодзи, Конан-чо, Кока-си, Сига 520-3306, Япония.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «АРКРЭЙ», 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, оф. 303. Тел. 8-499-703-34-92.

ВНИМАНИЕ: не замораживать. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Регистрационное удостоверение: № XXXX XXXXX

LOT XXXXXXXXXXXXX

Срок годности: XXXX-XX-XX

Пронумеровано и прошнуровано

14 листа (ов)

Зам. директора по вопросам обеспечения
качества и регуляторным ООО АРКРЭЙ

Геметова М.Ю.



12.12.2024