

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека



В.Г. Акимкин

« 11 » *ноября* 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

**Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК
из биологического материала
«МАГНО-сорб»**



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала

«МАГНО-сорб»

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-200

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	107 мл x 1
Компонент А	1,0 мл x 1
Раствор для отмывки 5	75 мл x 2
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8

2 °C 25 °C



REF K3-1061-100

LOT 25.02.24


2024-02-25

2025-05-25


Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:


Фотография комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб»
формы 1 после вскрытия внешней упаковки (коробка)

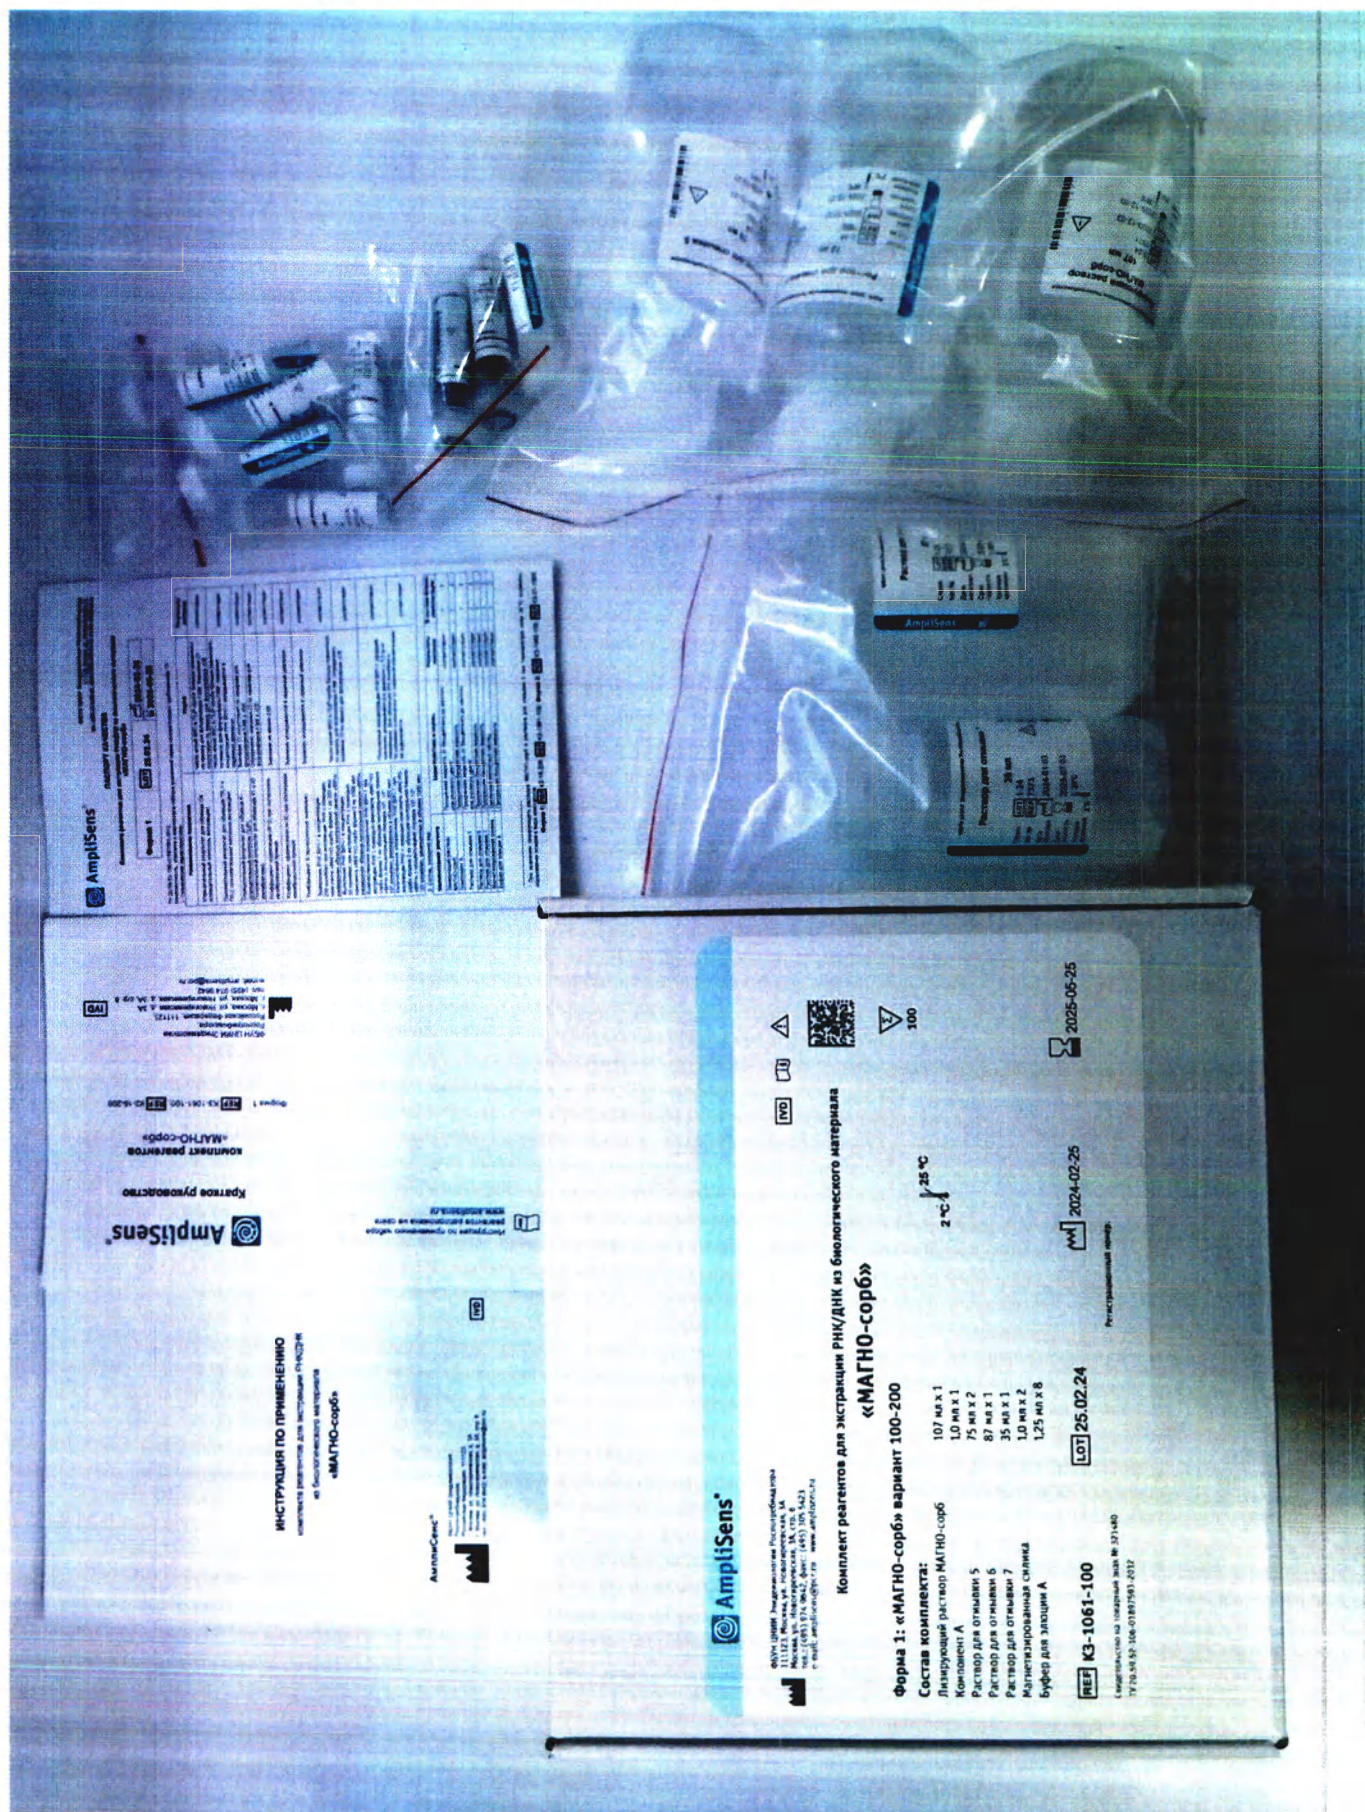

«МАГНО-сорб» формы 1 (пакет с замком Zip-Lock).

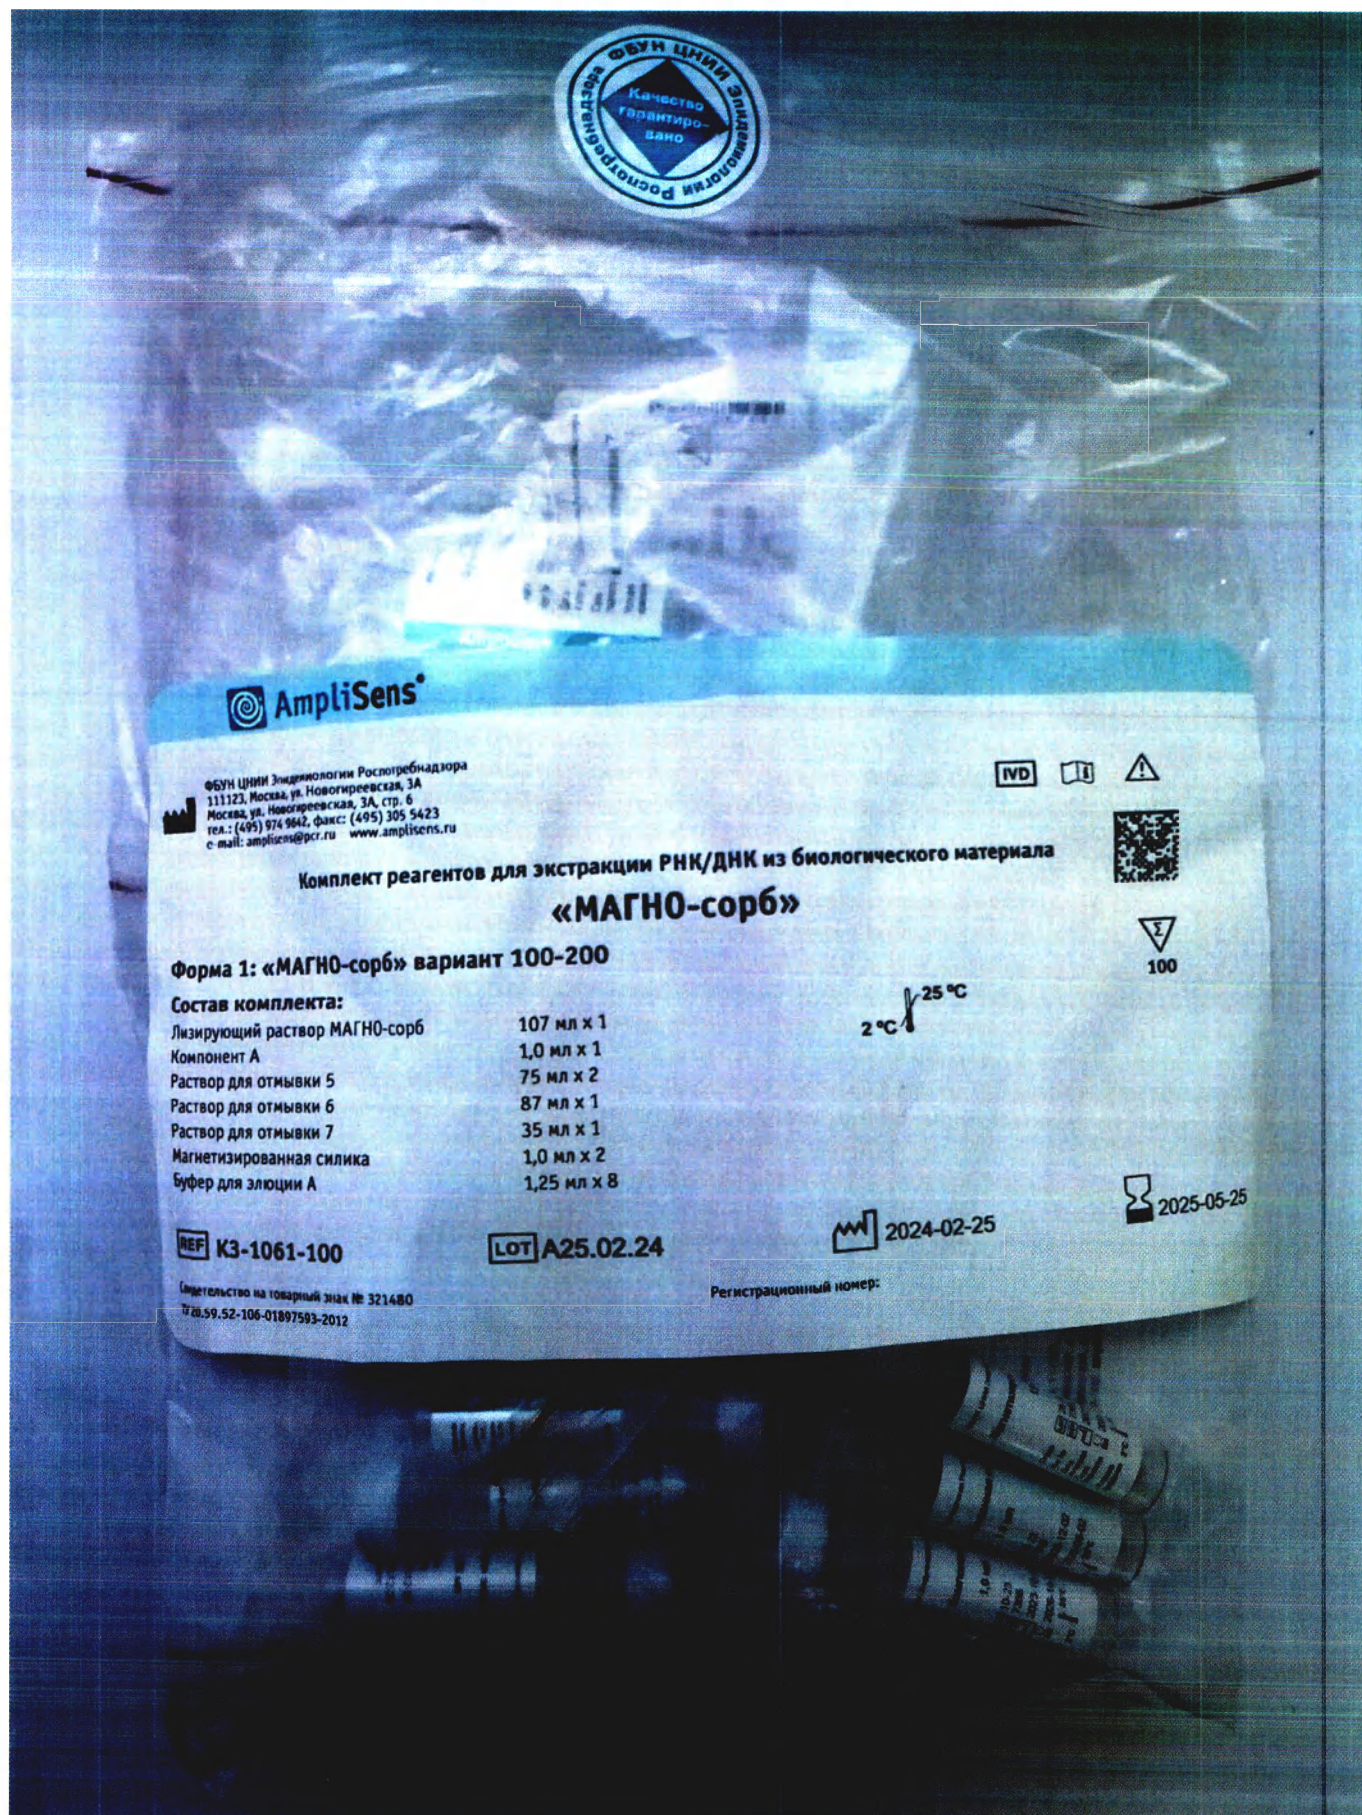


Формы 1 после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock).

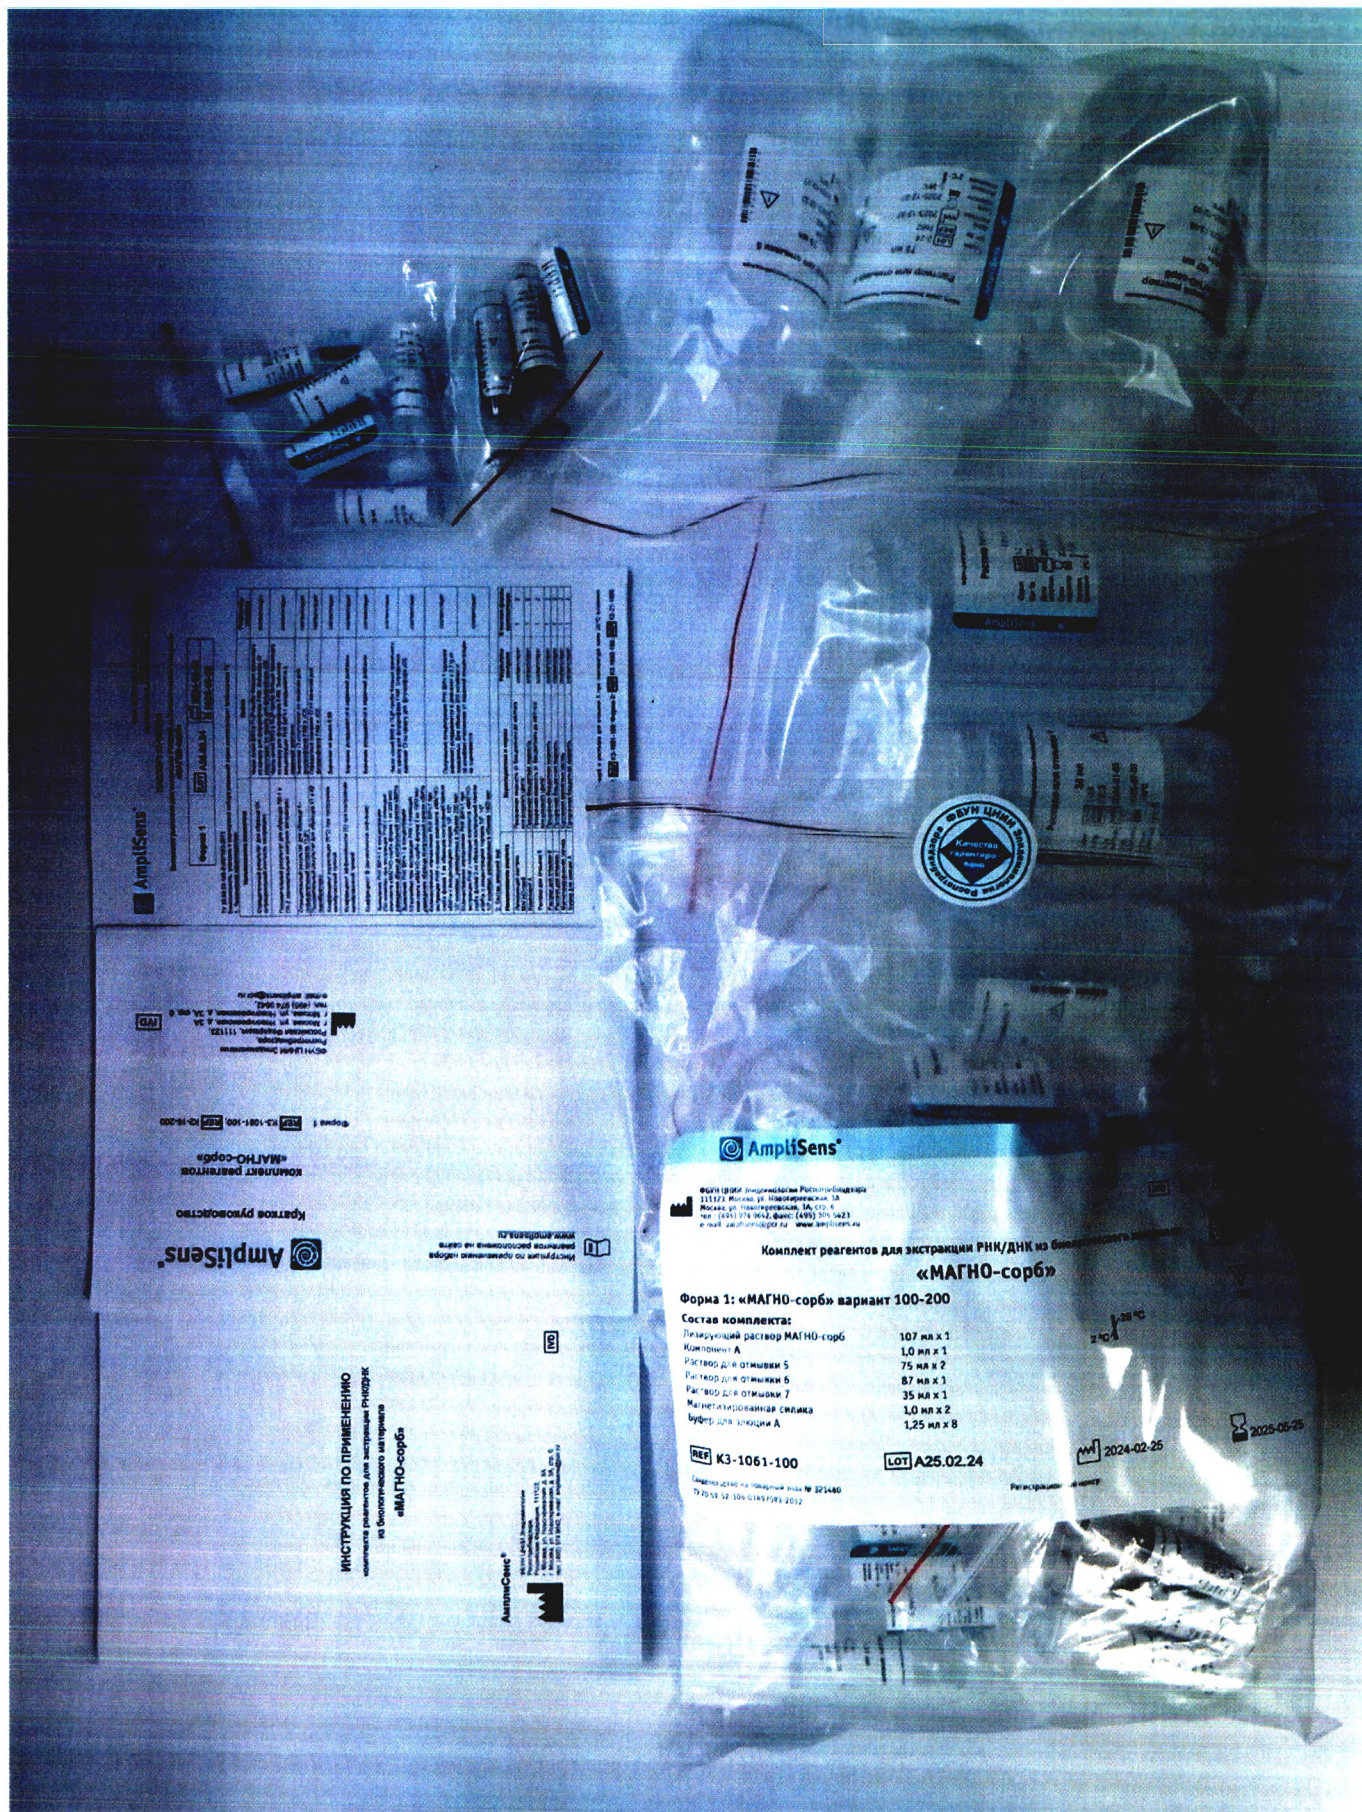



Фотографии реагентов, входящих в состав комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 1.



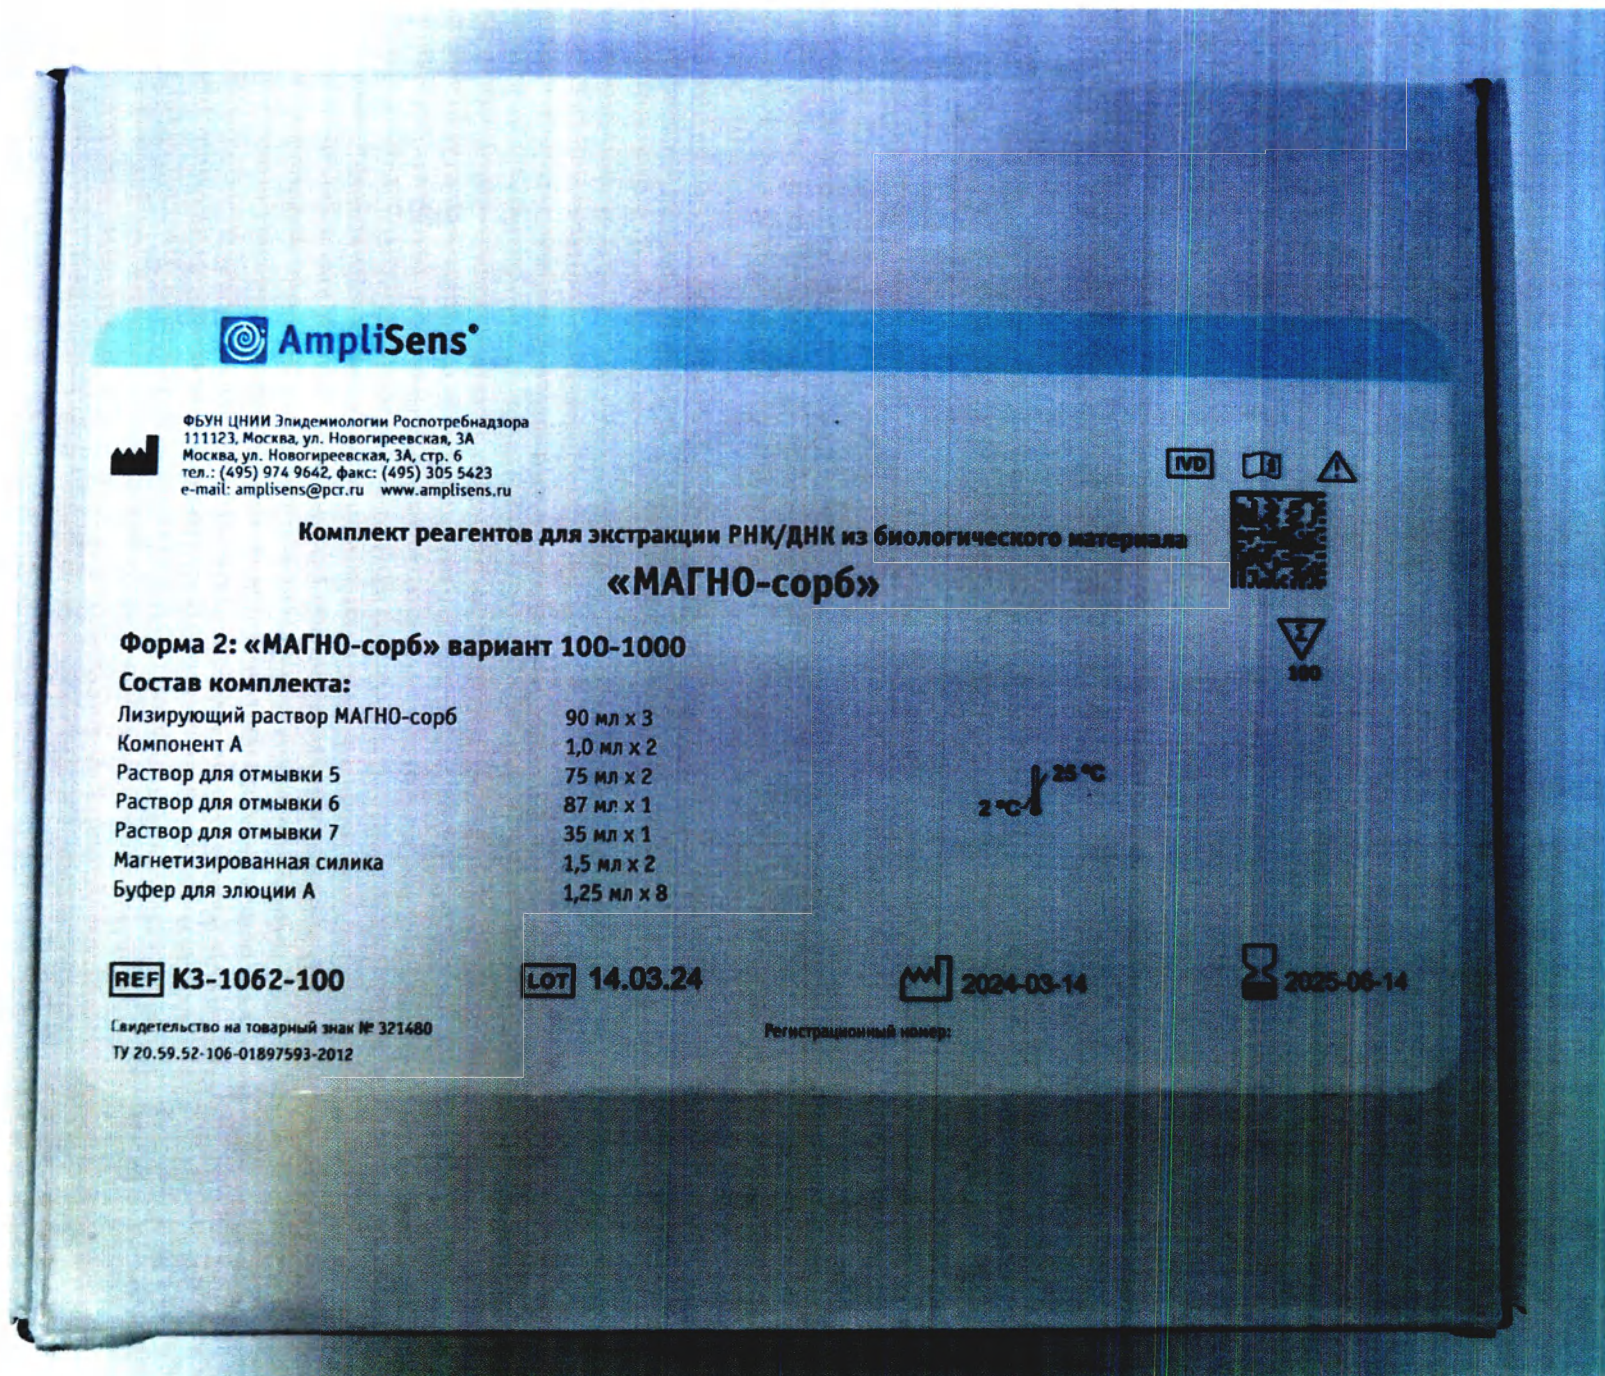

Фотография комплекта реактивов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 2 после вскрытия внешней упаковки (коробка).

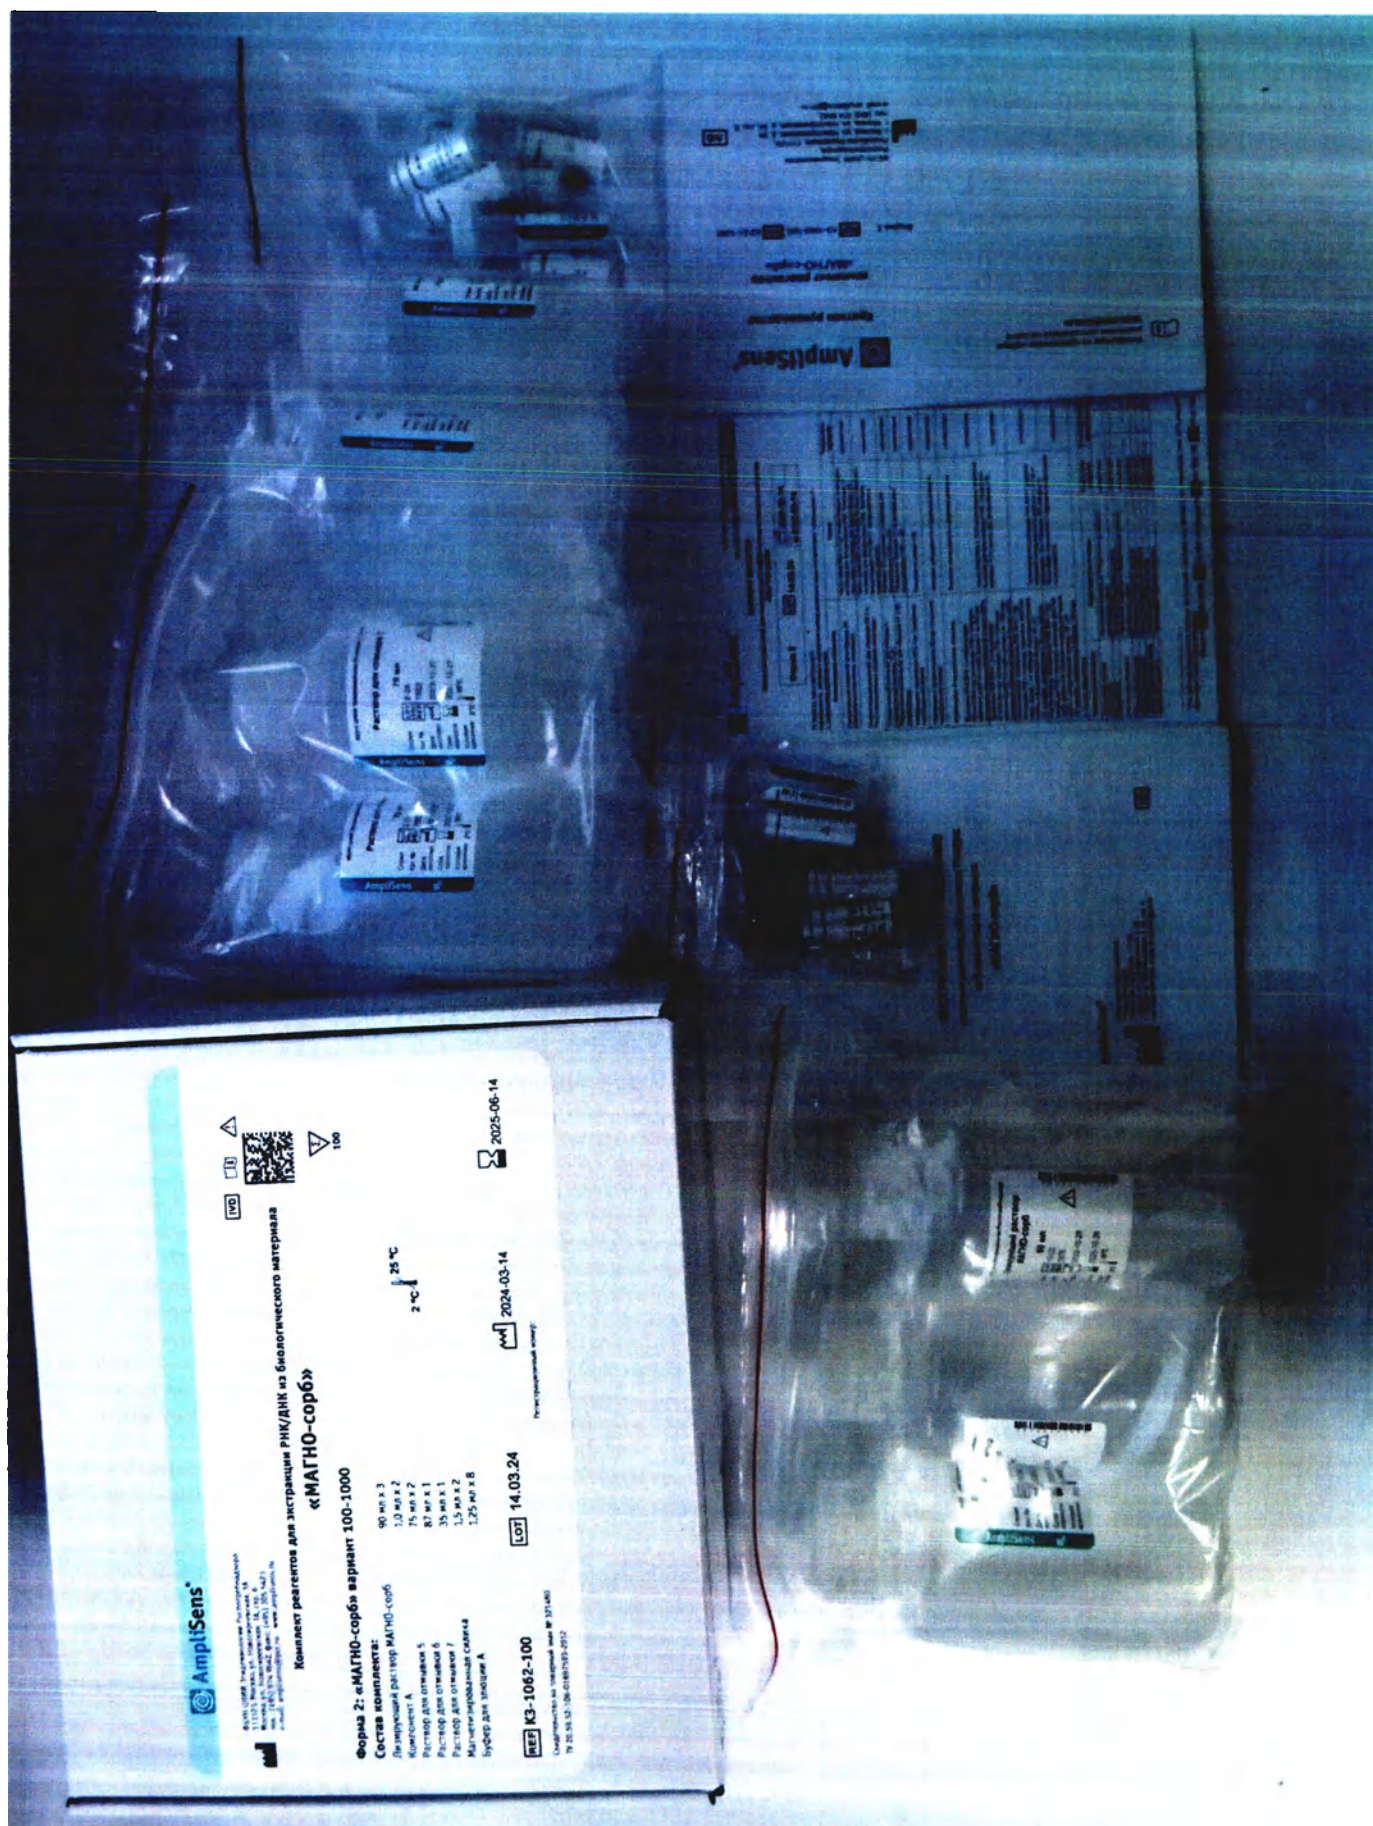

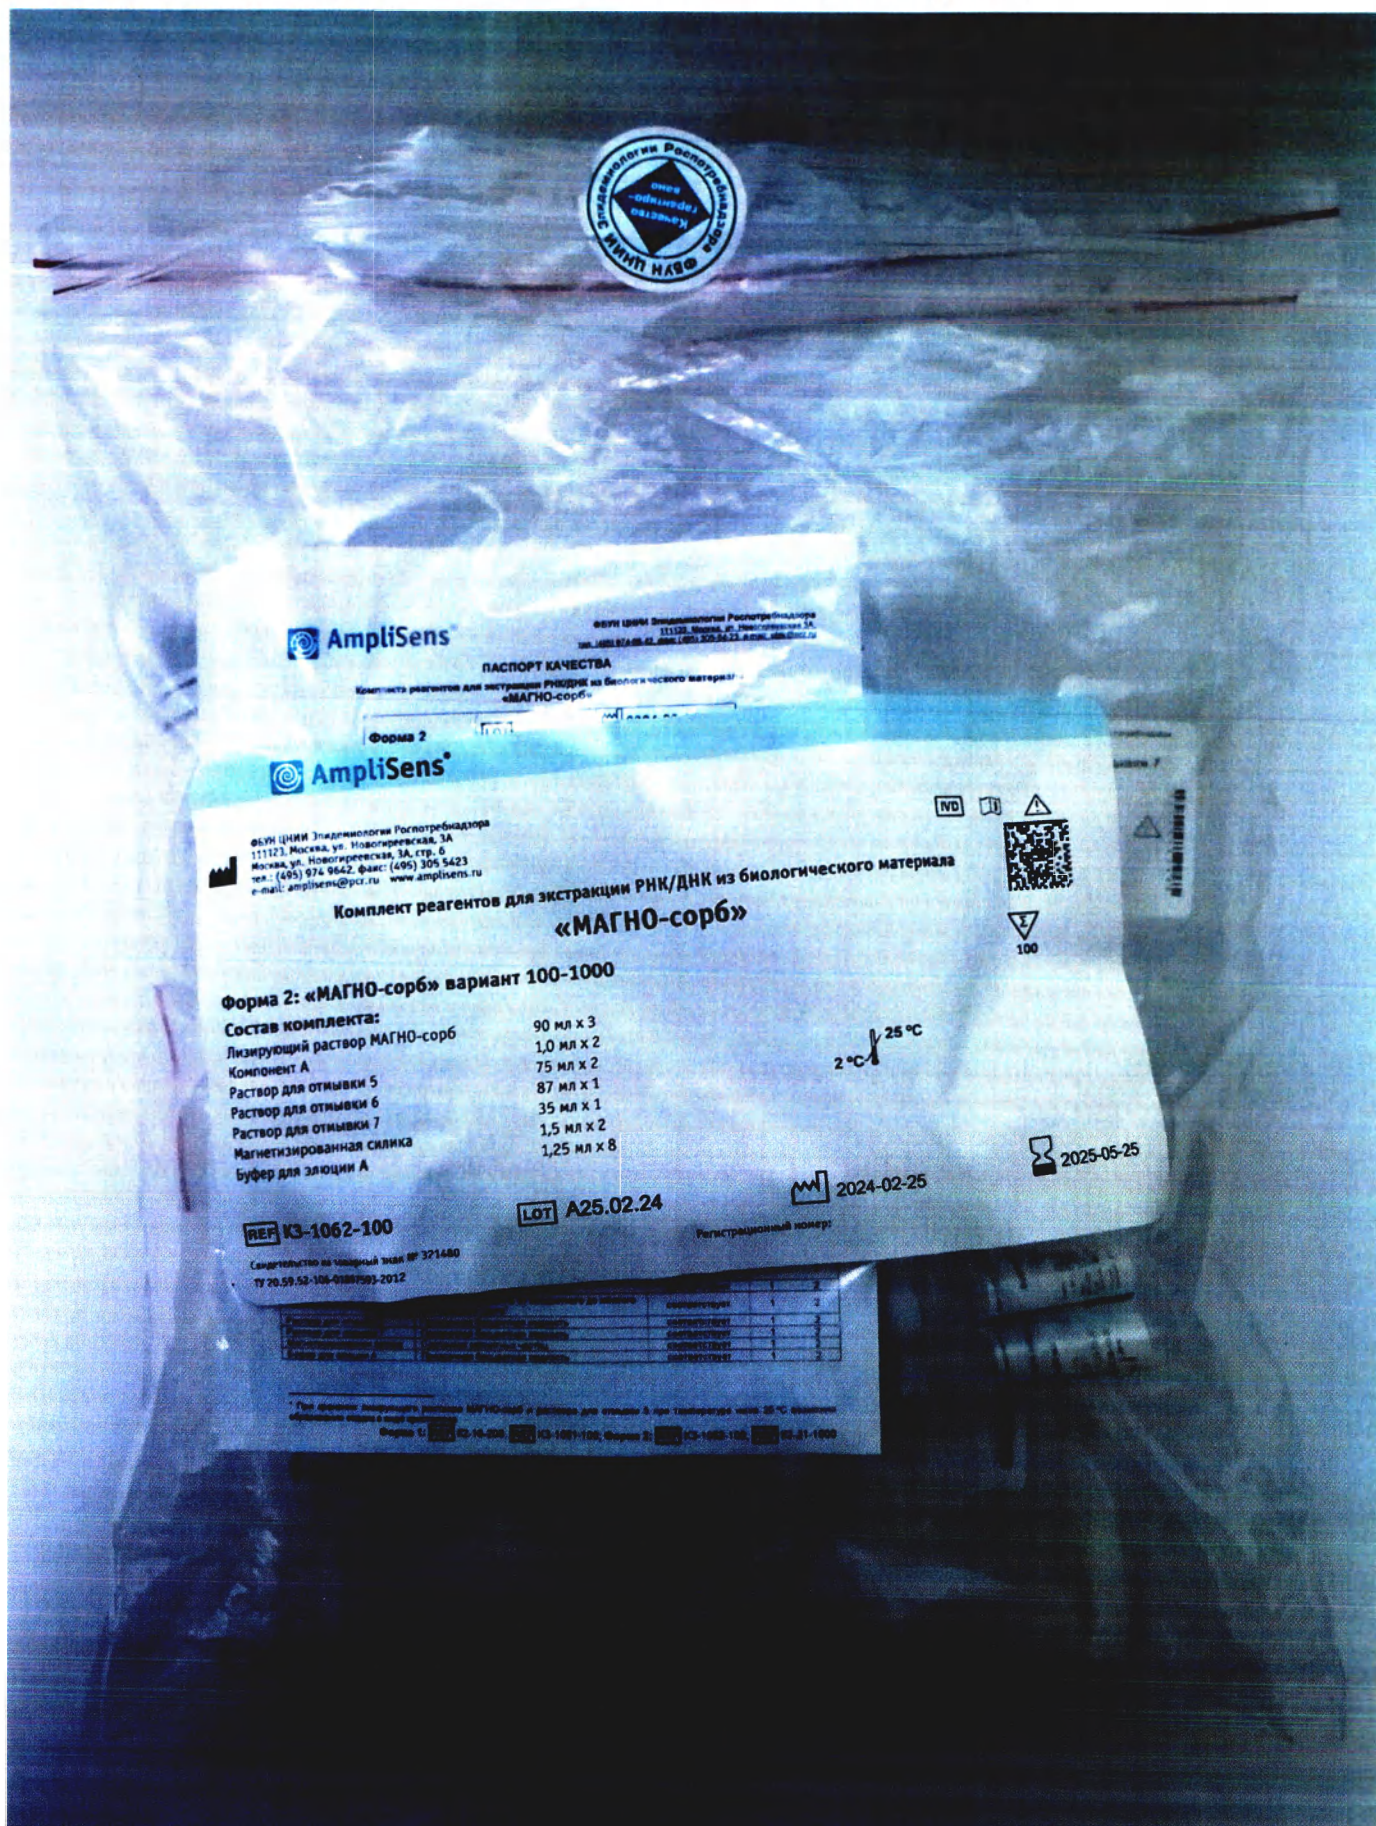

Фотографии реагентов, входящих в комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 2.





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
 Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
 e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru




Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб»



Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100-100М

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	40 мл x 1
Компонент А	0,5 мл x 1
Раствор для отмывки 5	60 мл x 1
Раствор для отмывки 4	60 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 1
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8



REF K3-1063-100

LOT 25.02.24


EXP 2024-02-25

EXP 2025-05-25


Свидетельство на товарный знак № 321480
 ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:


Фотография комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 3 после вскрытия внешней упаковки (коробка).

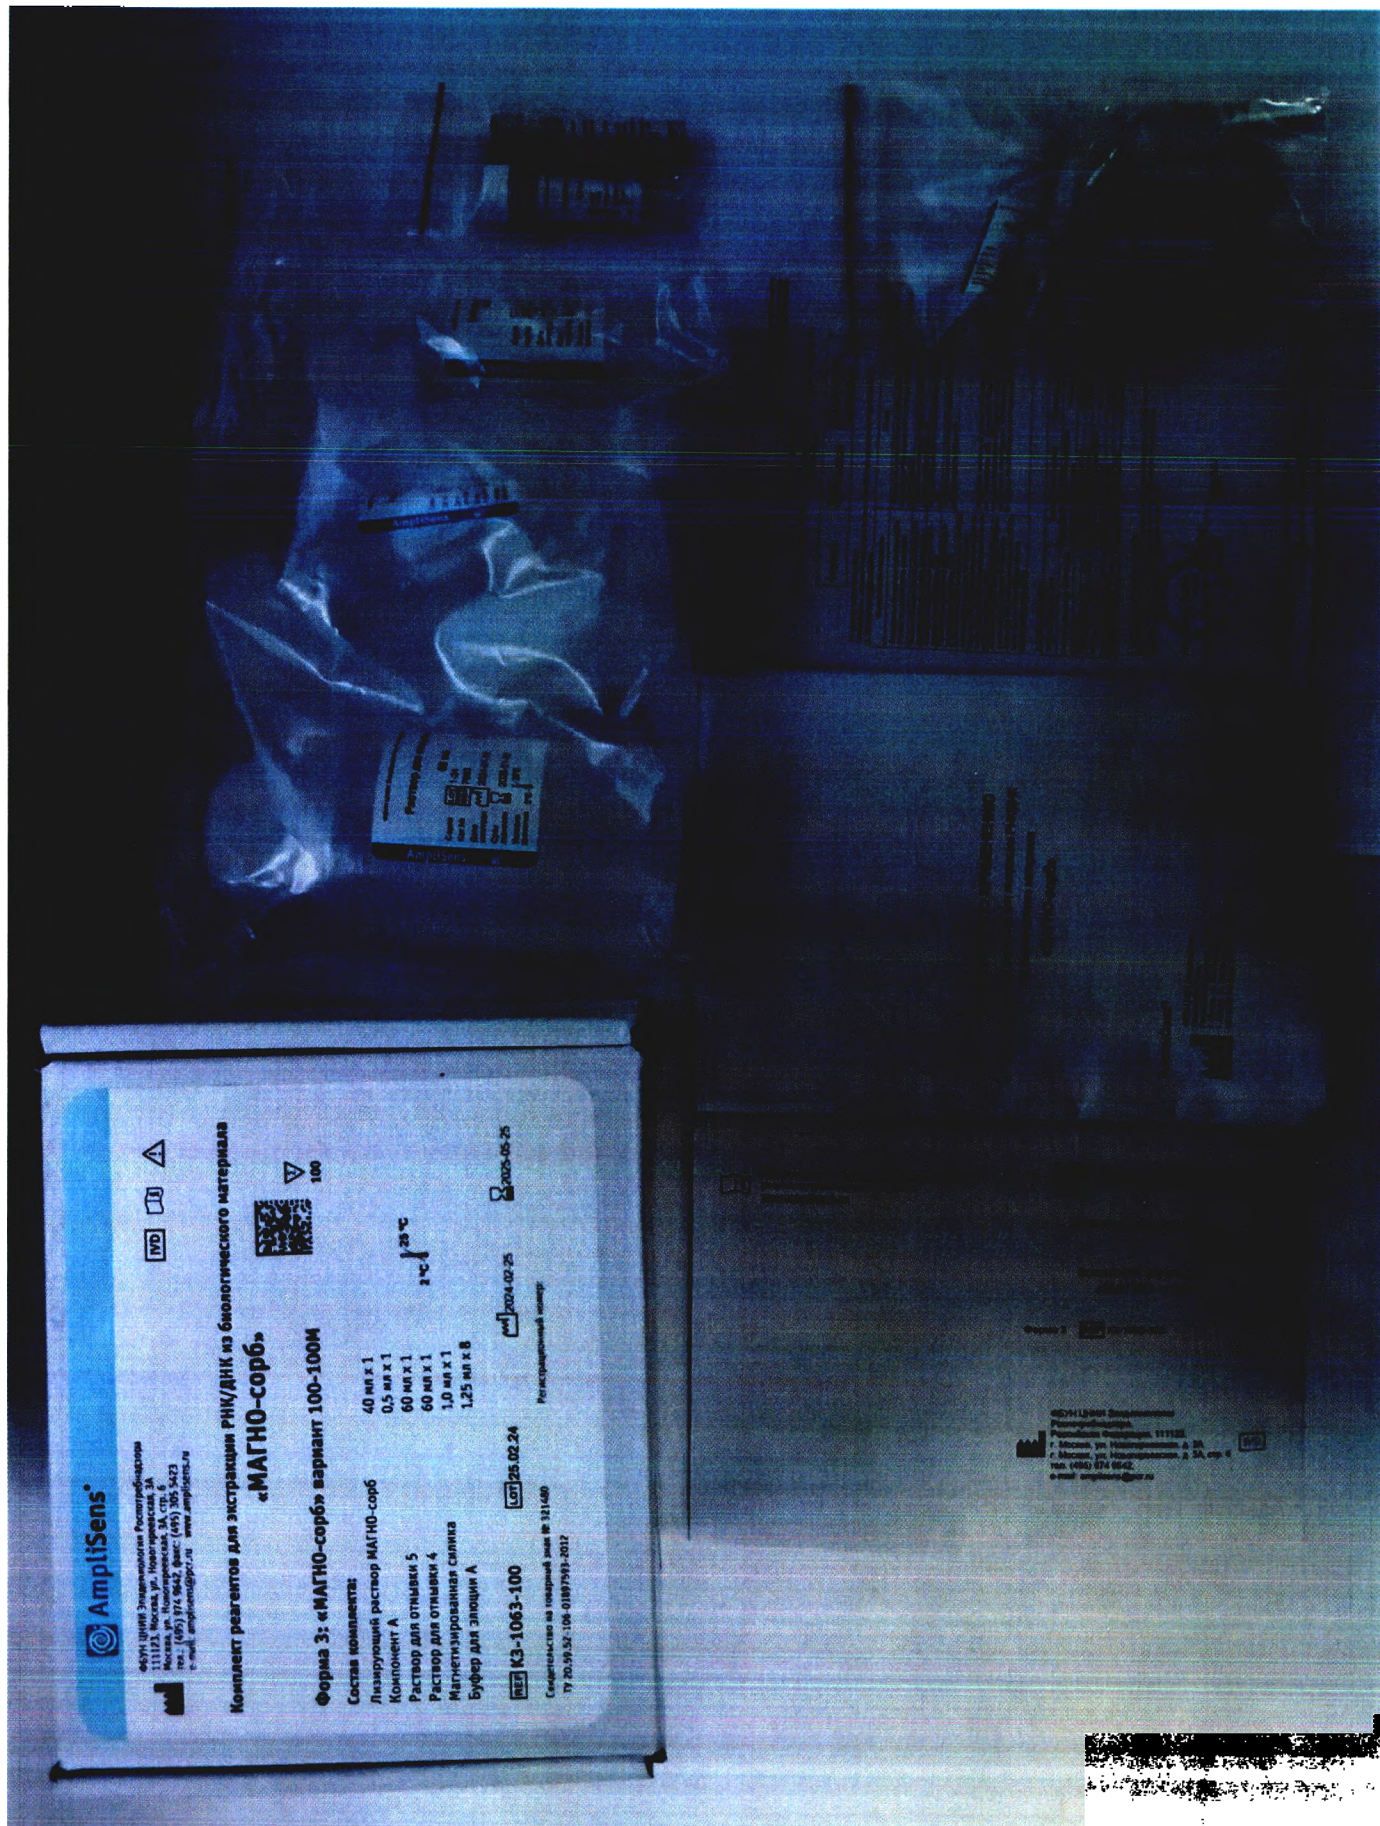

Фотография внешней упаковки комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб» формы 3 (пакет с замком Zip-Lock).

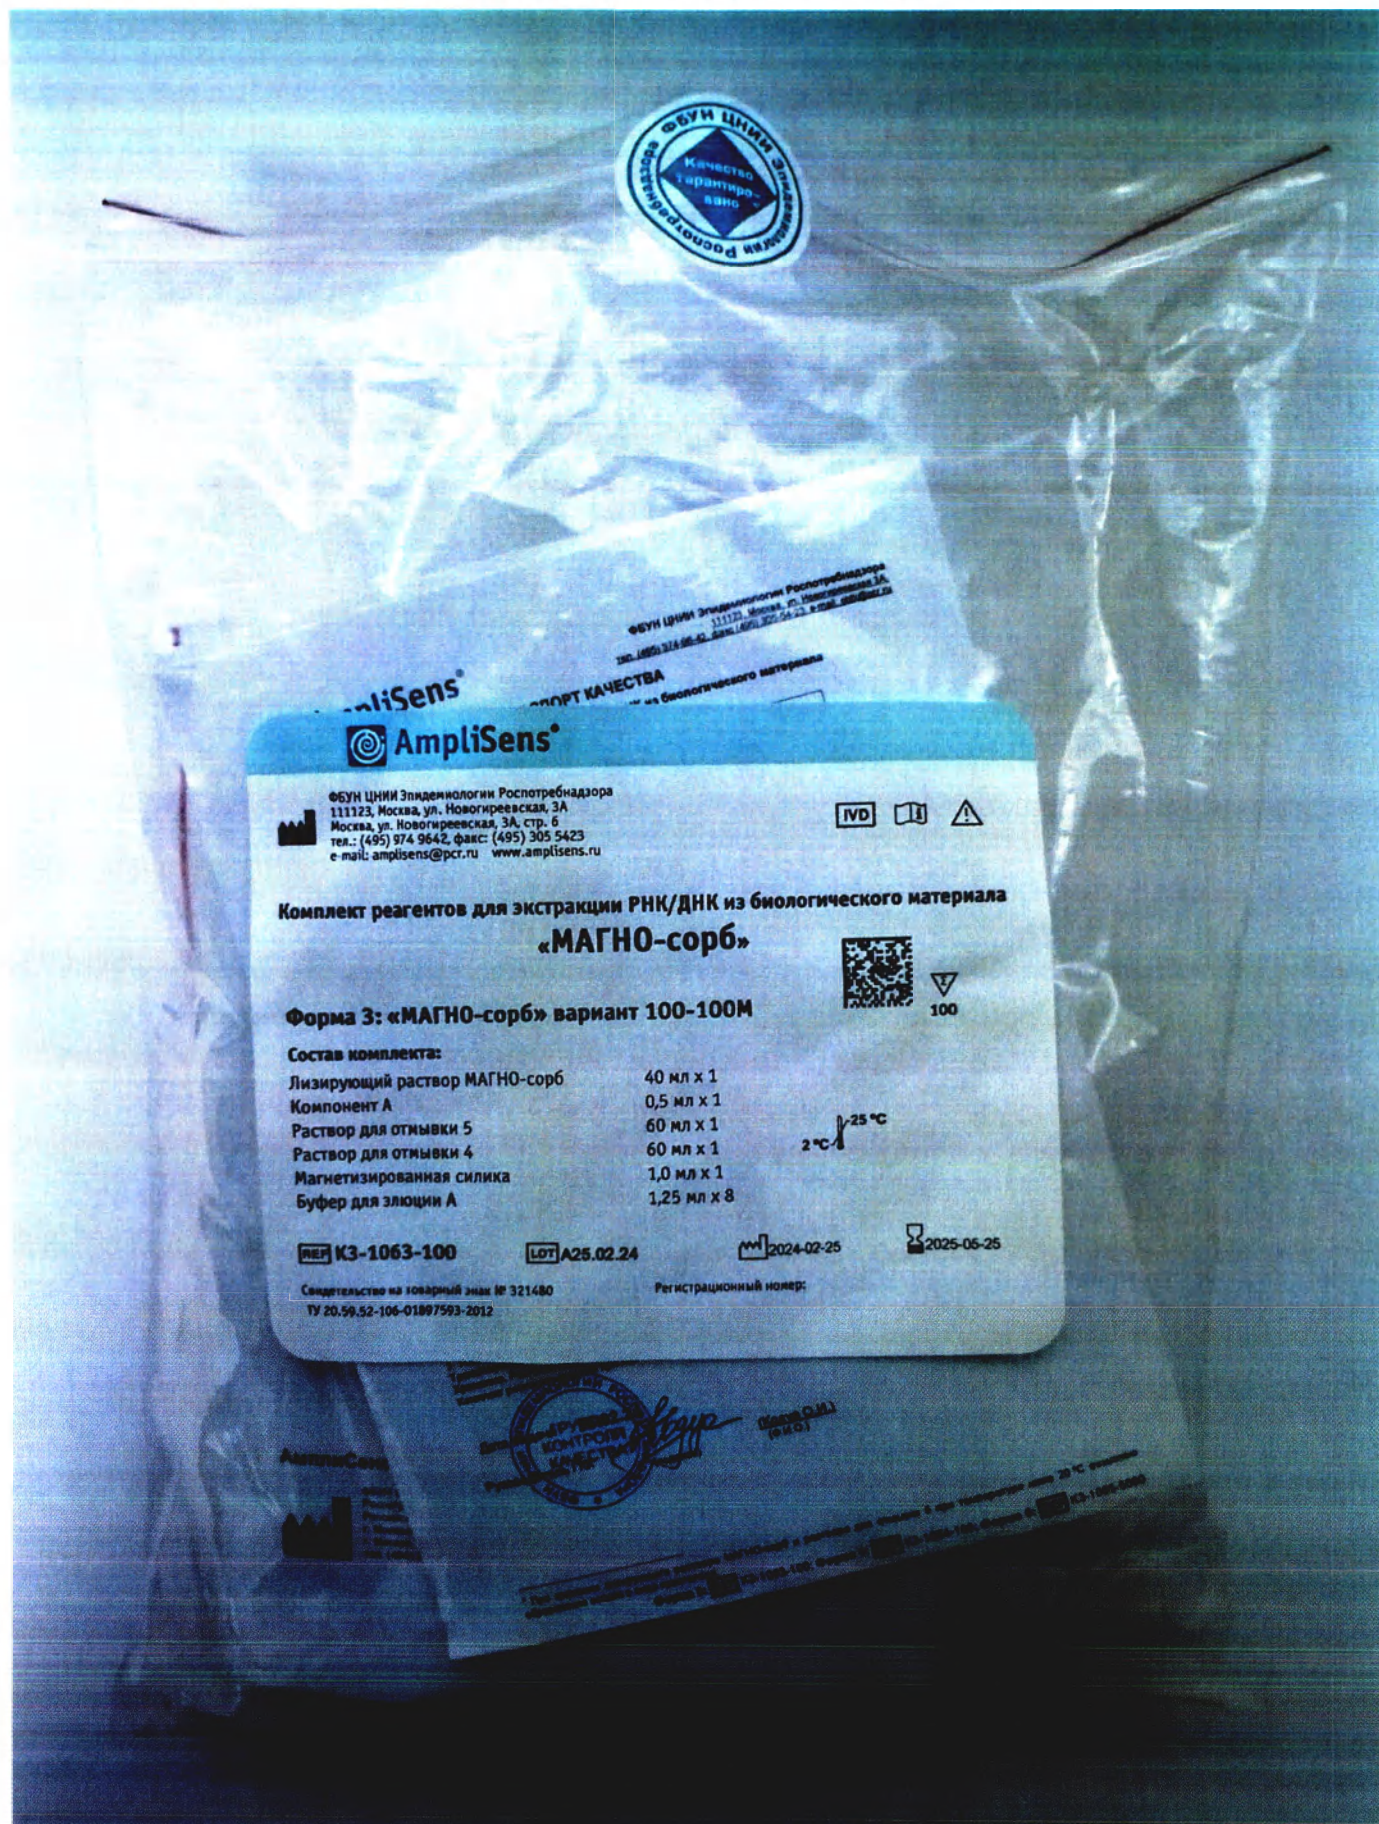

Фотография комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 3 после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock).

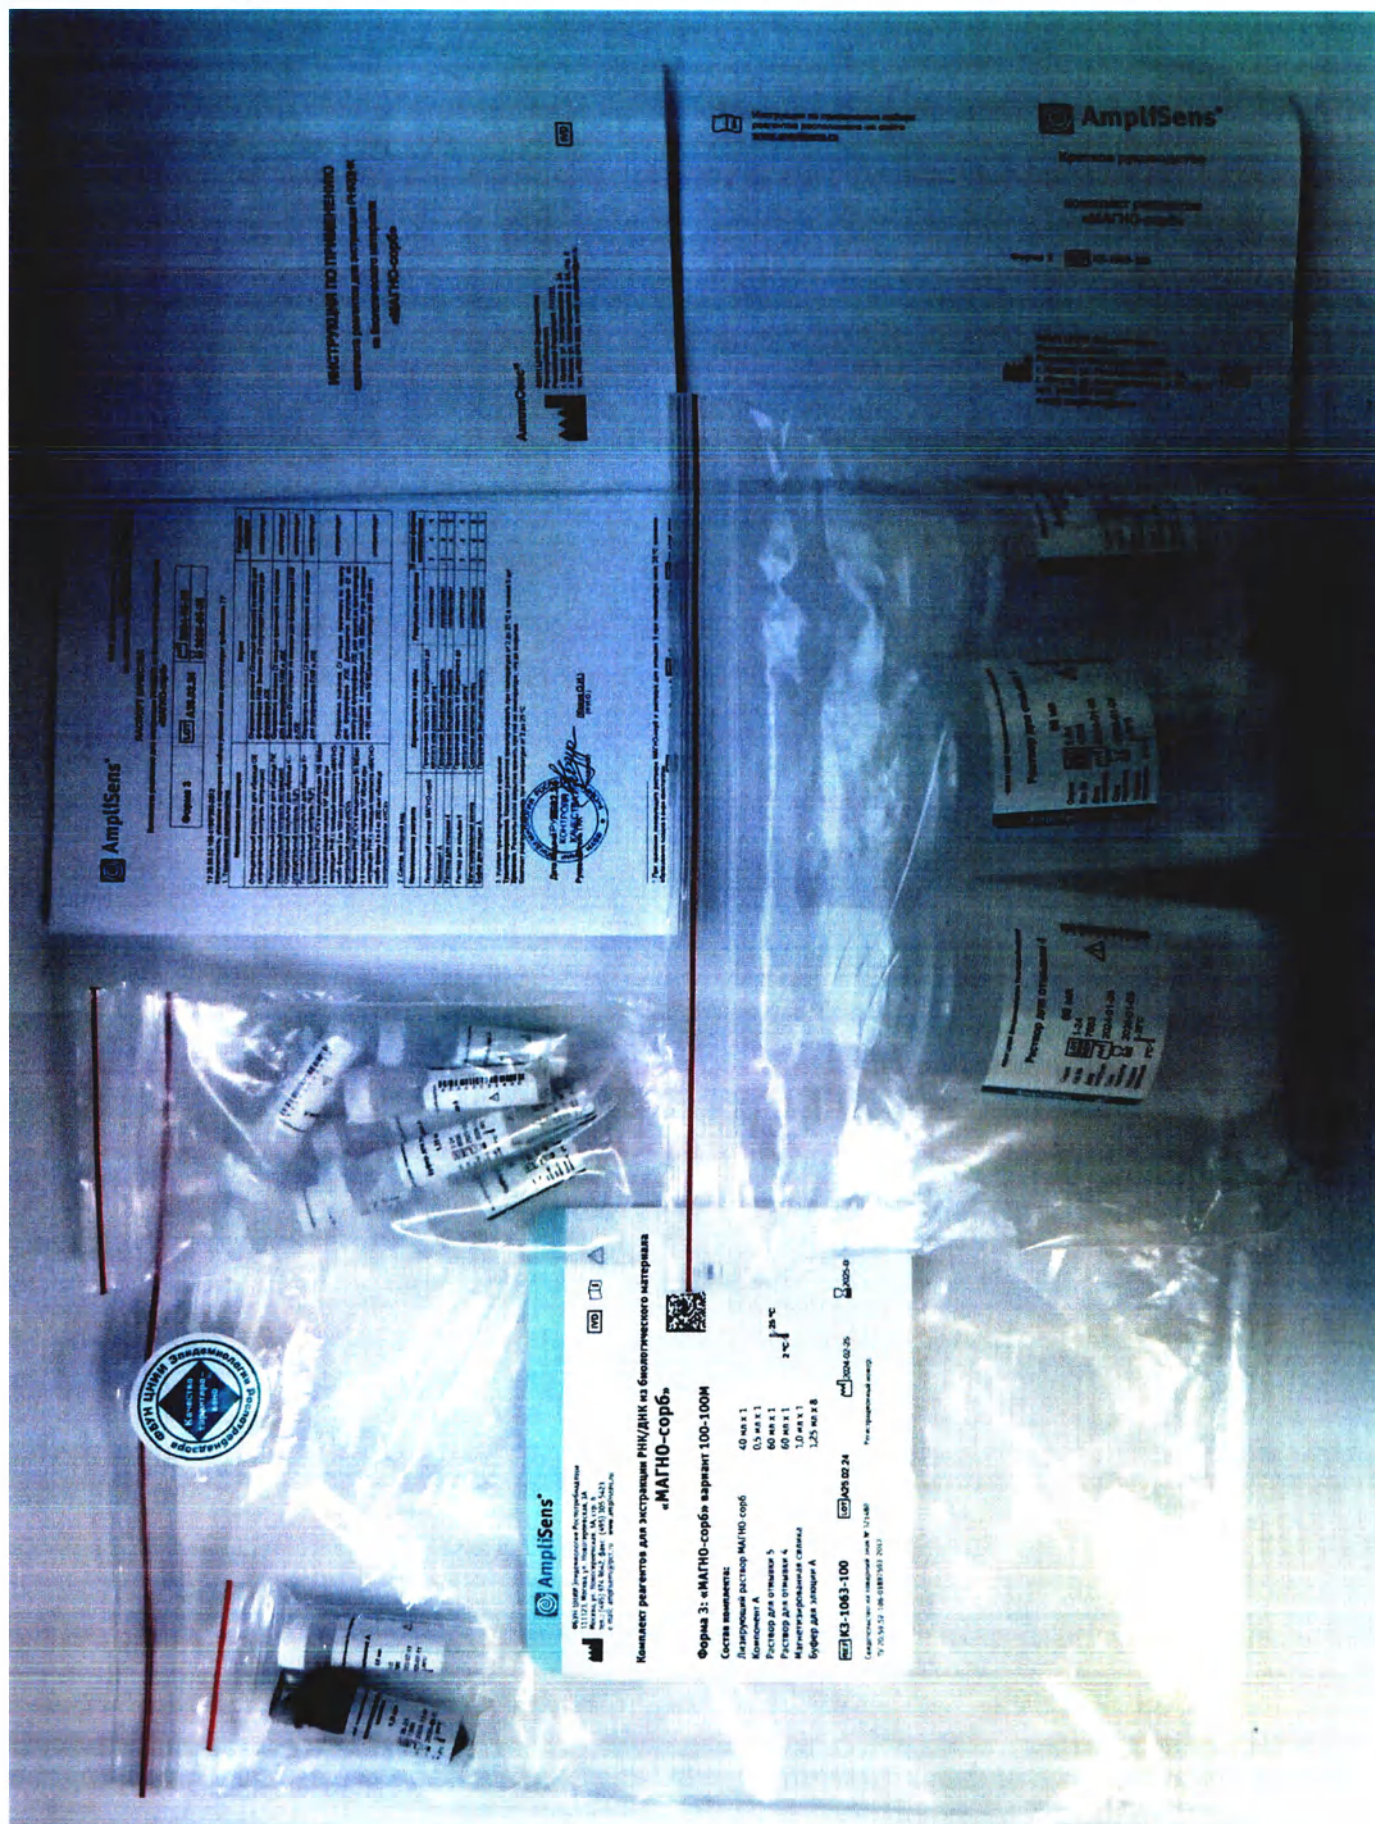

Фотографии реагентов, входящих в состав комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 3.





ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала

«МАГНО-сорб»

Форма 4: «МАГНО-сорб» вариант 100-200М



100



Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	70 мл x 1
Компонент А	1,0 мл x 1
Раствор для отмывки 5	60 мл x 1
Раствор для отмывки 4	60 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8

2 °C 25 °C

REF K3-1064-100


LOT 25.02.24

2024-02-25


2025-05-25

Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:

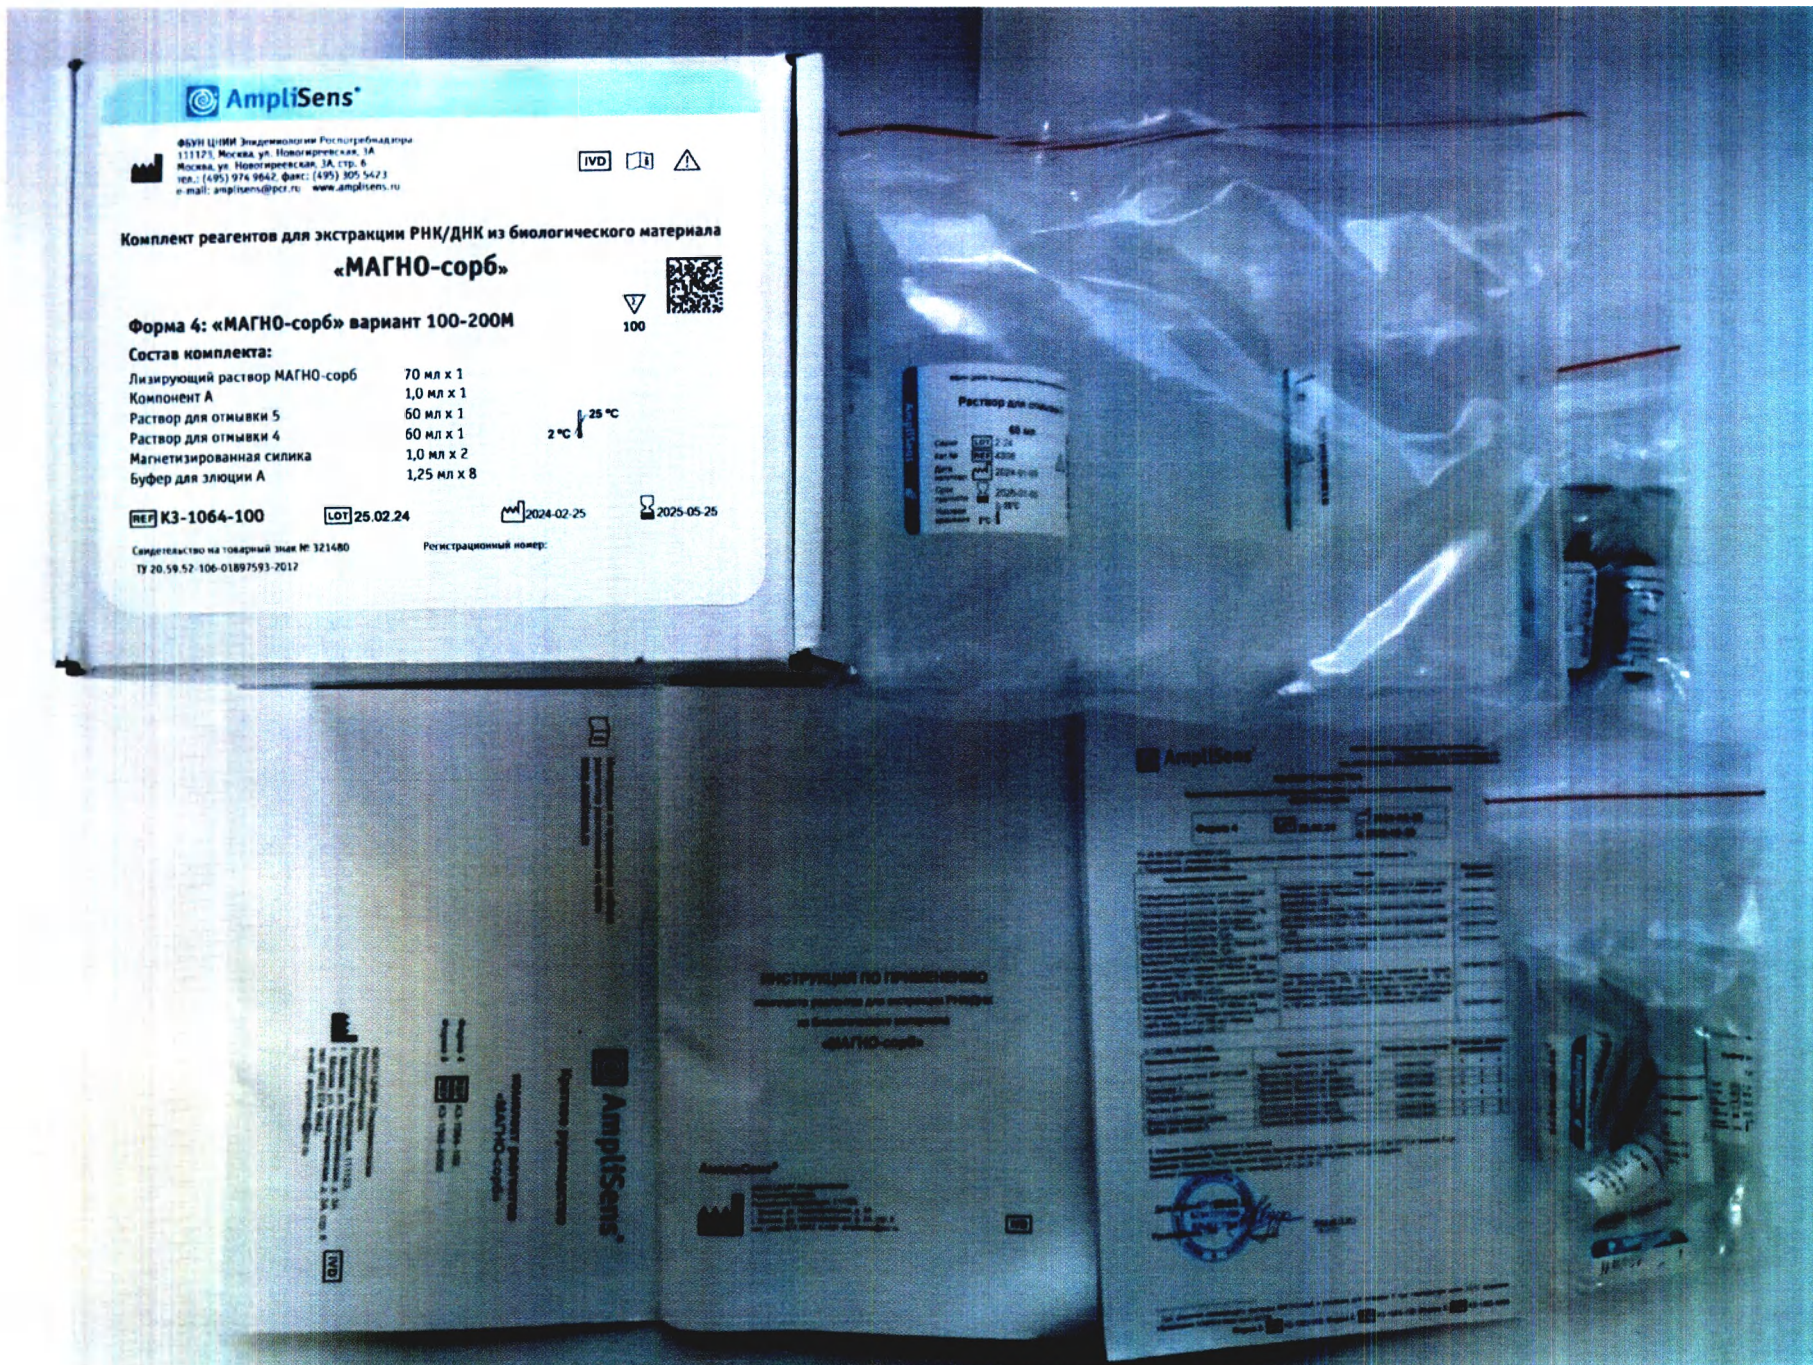

Фотография внешней упаковки комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 4 (пакет с замком Zip-Lock).

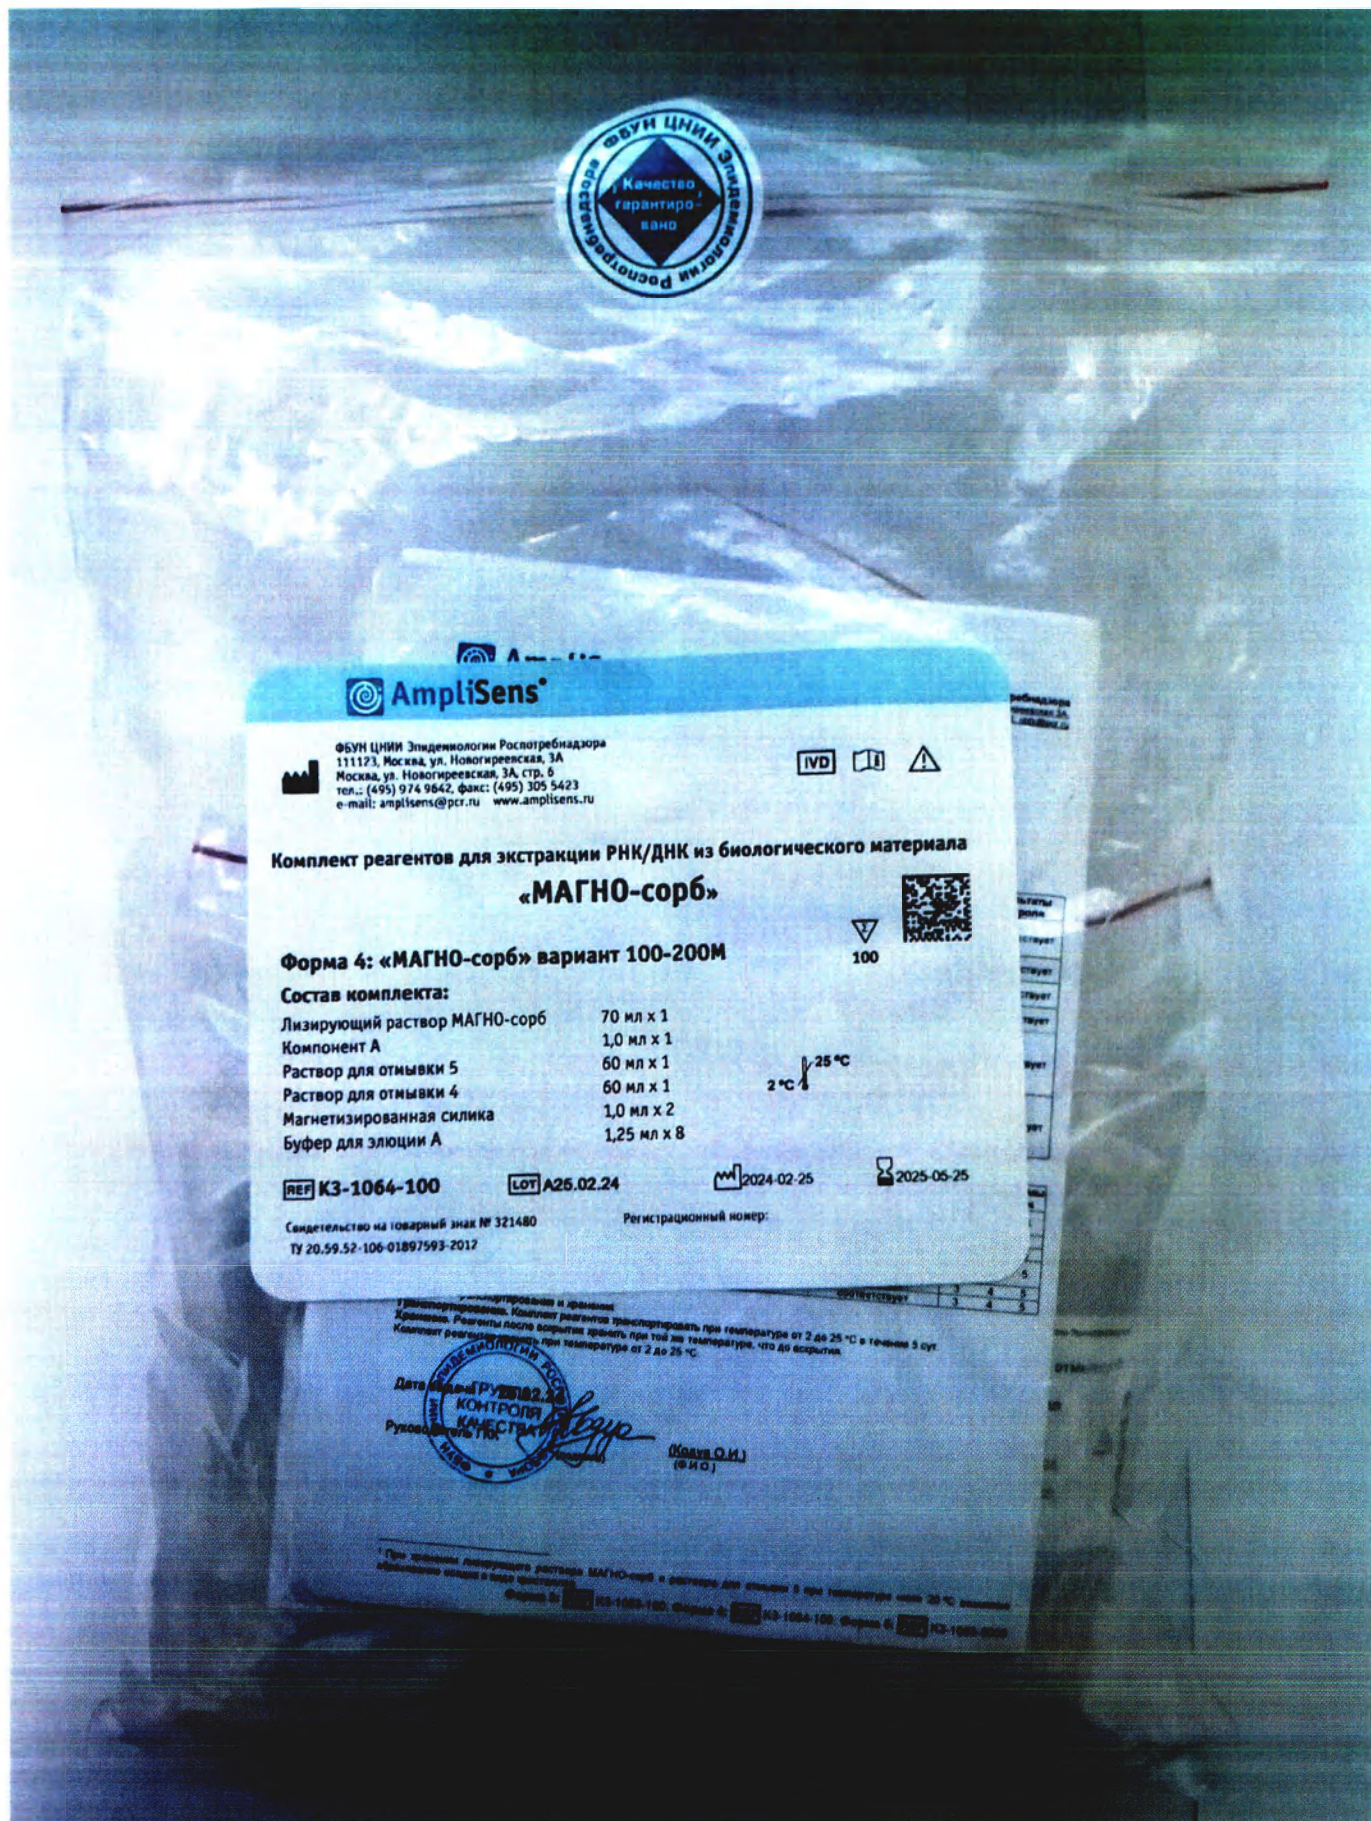

Фотография комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 4 после вскрытия внешней упаковки (пакет с замком Zip-Lock).




Фотографии реагентов, входящих в состав комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб» формы 4.



Фотография комплекта реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб»
Формы 5 после вскрытия внешней упаковки (коробка)



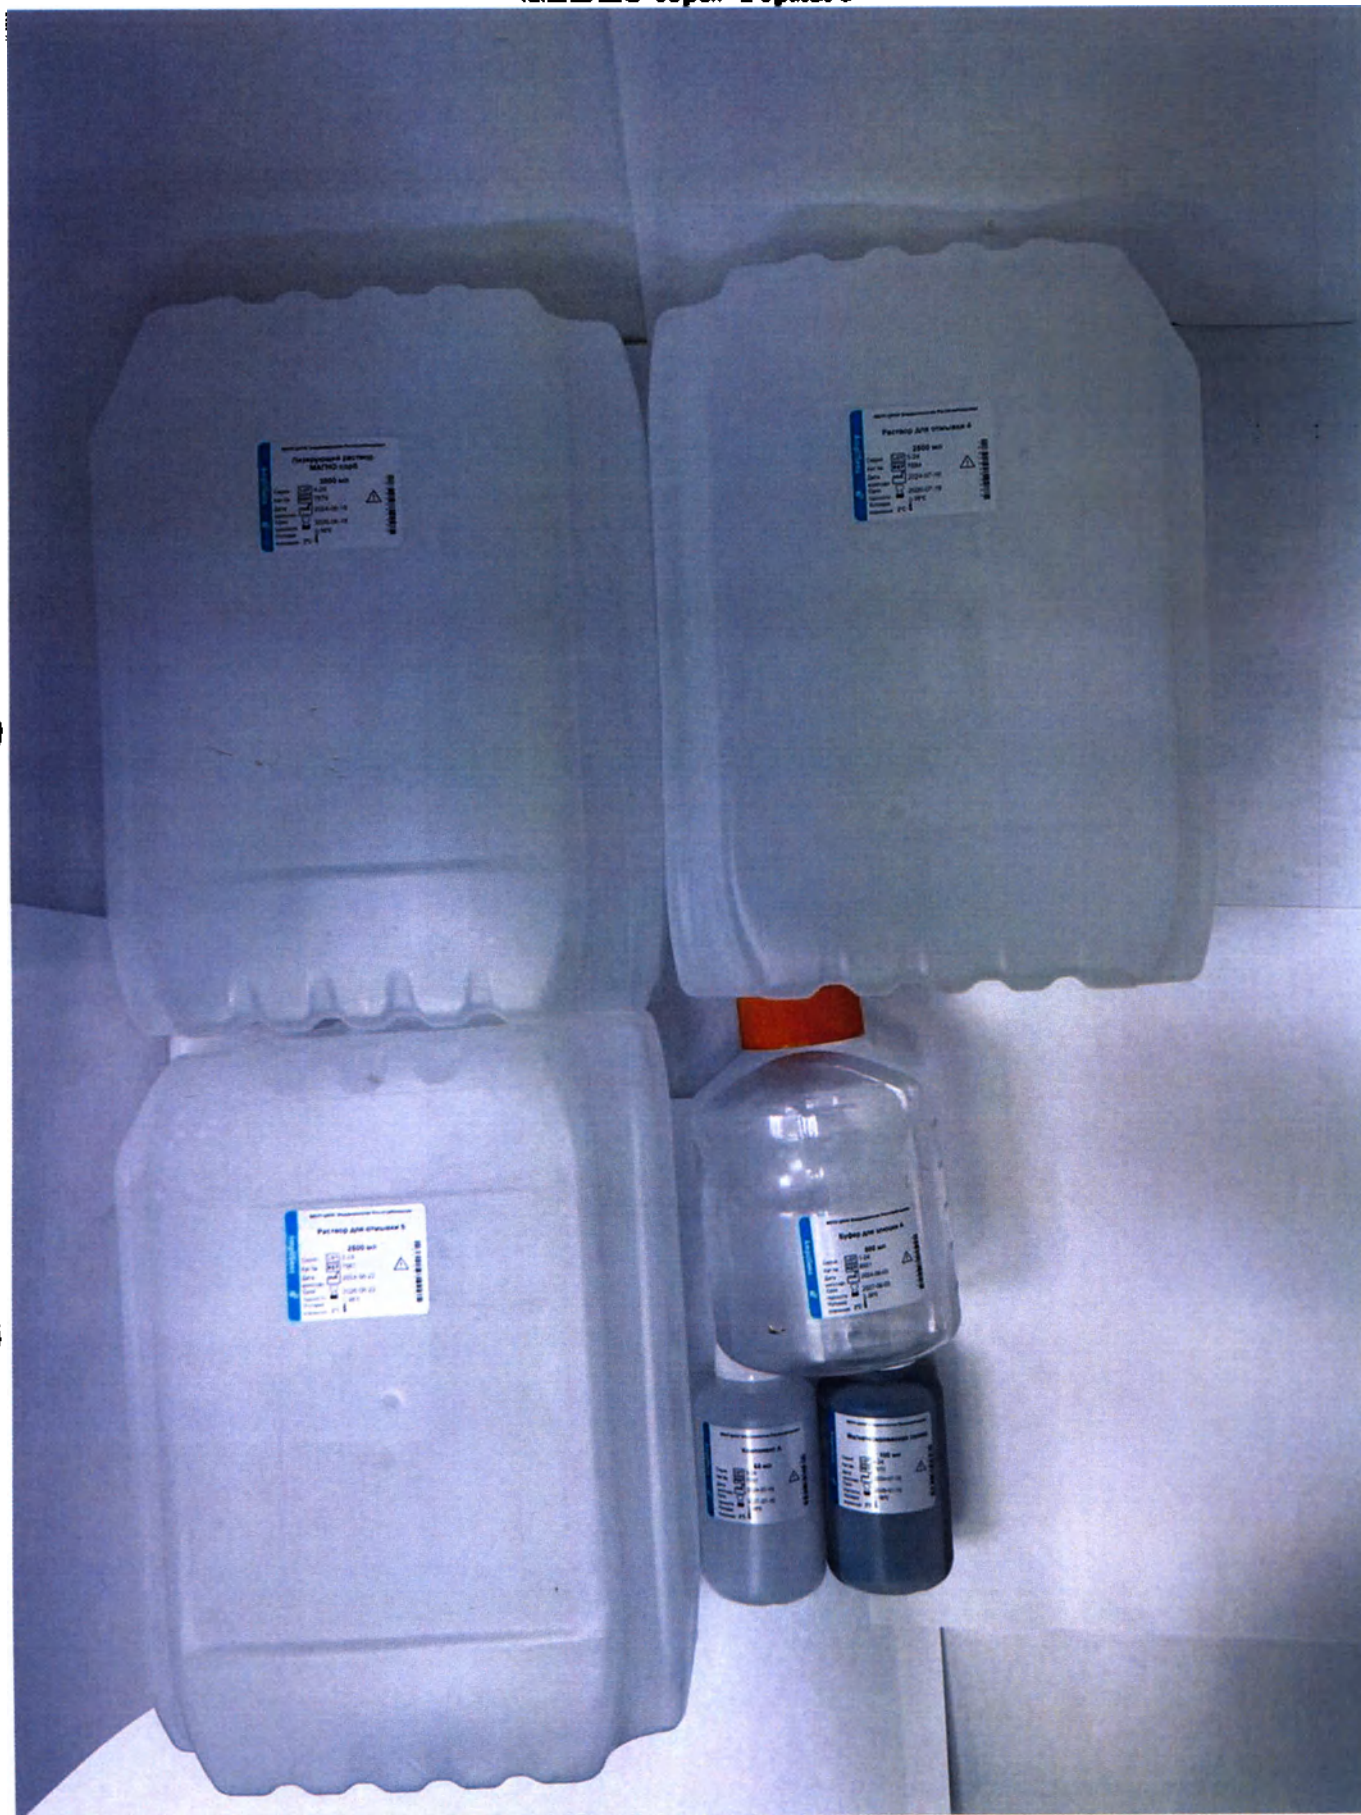

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 24
двадцать четыре лист а

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

« 25 » 11 2024 г. А.О.Лисицына

М.П.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека



В.Г. Акимкин

« 21 » ноября

20 24 г.

Макет маркировки медицинского изделия

«Комплект реагентов для экстракции

РНК/ДНК из биологического материала

«МАГНО-сорб»

Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-200»

На 3 листах

Маркировка комплекта реагентов Форма 1



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб»



Форма 1: «МАГНО-сорб» вариант 100-200

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	107 мл x 1
Компонент А	1,0 мл x 1
Раствор для отмывки 5	75 мл x 2
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8

25 °C
2 °C



Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта реагентов Форма 1


Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	
Компонент А	
Раствор для отмывки 5	

Раствор для отмывки 6	
Раствор для отмывки 7	
Магнетизированная силика	
Буфер для элюции А	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

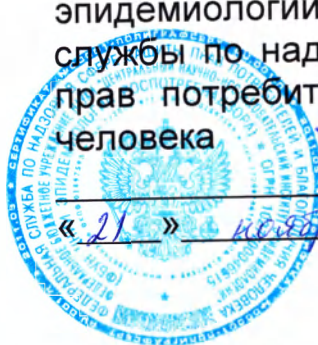

В.Г. Акимкин

« 21 » *ноября* 20*24* г.

Макет маркировки медицинского изделия

**«Комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»**

Форма 2: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000»

На 3 листах

Маркировка комплекта реагентов Форма 2



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала «МАГНО-сорб»



Форма 2: «МАГНО-сорб» вариант 100-1000

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	90 мл x 3
Компонент А	1,0 мл x 2
Раствор для отмывки 5	75 мл x 2
Раствор для отмывки 6	87 мл x 1
Раствор для отмывки 7	35 мл x 1
Магнетизированная силика	1,5 мл x 2
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8

25 °C
2 °C



Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта реагентов Форма 2

Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	
Компонент А	
Раствор для отмывки 5	

Раствор для отмывки 6	
Раствор для отмывки 7	
Магнетизированная силика	
Буфер для элюции А	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека



В.Г. Акимкин

« 21 » ноября 2024 г.

Макет маркировки медицинского изделия

«Комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»

Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100-100М»

На 3 листах

Маркировка комплекта реагентов Форма 3



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
 111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
 Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
 тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
 e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru





**Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»**

Форма 3: «МАГНО-сорб» вариант 100-100М

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	40 мл x 1
Компонент А	0,5 мл x 1
Раствор для отмывки 5	60 мл x 1
Раствор для отмывки 4	60 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 1
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8






2 °C — 25 °C









Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта реагентов Форма 3

Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	
Компонент А	
Раствор для отмывки 5	

Раствор для отмывки 4	
Магнетизированная силика	
Буфер для элюции А	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека



В.Г. Акимкин

«21» ноября 2024 г.

Макет маркировки медицинского изделия

«Комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»

Форма 4: «МАГНО-сорб» вариант 100-200М»

На 3 листах

Маркировка комплекта реагентов Форма 4







ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru

Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»

Форма 4: «МАГНО-сорб» вариант 100-200М

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	70 мл x 1
Компонент А	1,0 мл x 1
Раствор для отмывки 5	60 мл x 1
Раствор для отмывки 4	60 мл x 1
Магнетизированная силика	1,0 мл x 2
Буфер для элюции А	1,25 мл x 8












Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01897593-2012

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта реагентов Форма 4


Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	
Компонент А	
Раствор для отмывки 5	

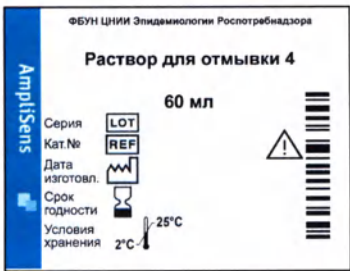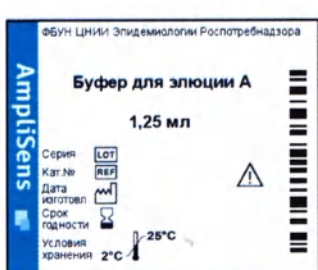Раствор для отмывки 4	
Магнетизированная силика	
Буфер для элюции А	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного
учреждения науки «Центральный
научно-исследовательский институт
эпидемиологии» Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека

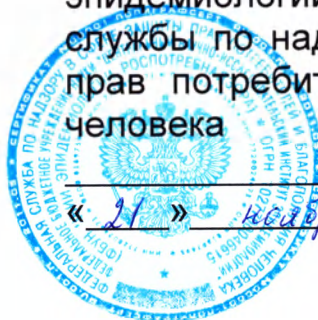

В.Г. Акимкин

« 21 » ноября 20 24 г.

Макет маркировки медицинского изделия

«Комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»

Форма 5: «МАГНО-сорб» вариант 5000-200М»

На 3 листах

Маркировка комплекта реагентов Форма 5



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



**Комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала
«МАГНО-сорб»**

Форма 5: «МАГНО-сорб» вариант 5000-200М

5000

Состав комплекта:

Лизирующий раствор МАГНО-сорб	3000 мл x 1
Компонент А	65 мл x 1
Раствор для отмывки 5	2500 мл x 1
Раствор для отмывки 4	2500 мл x 1
Магнетизированная силика	100 мл x 1
Буфер для элюции А	500 мл x 1

25 °C
2 °C




Свидетельство на товарный знак № 321480
ТУ 20.59.52-106-01697593-2012

Регистрационный номер:

Маркировка реагентов, входящих в состав комплекта реагентов Форма 5

Наименование реагента	Маркировка
Лизирующий раствор МАГНО-сорб	
Компонент А	
Раствор для отмывки 5	

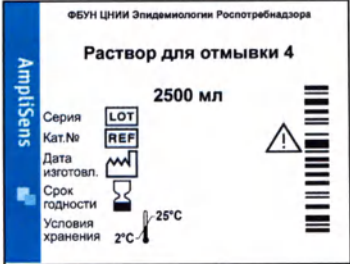Раствор для отмывки 4	
Магнетизированная силика	
Буфер для элюции А	

Допускается нанесение машиночитаемой маркировки на изделия для обеспечения их идентификации и прослеживаемости.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 15
пятидесять лист 08

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 188/23 от 16.11.2023 г.)

Лисицына А.О.Лисицына
« 25 » 11 20 24 г.

М.П.

