


Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для качественного выявления антител класса М к SARS-CoV-2» «ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М»

Комплект №1

серия 01, дата изготовления 2021.04.23, годен до 2023.04.23

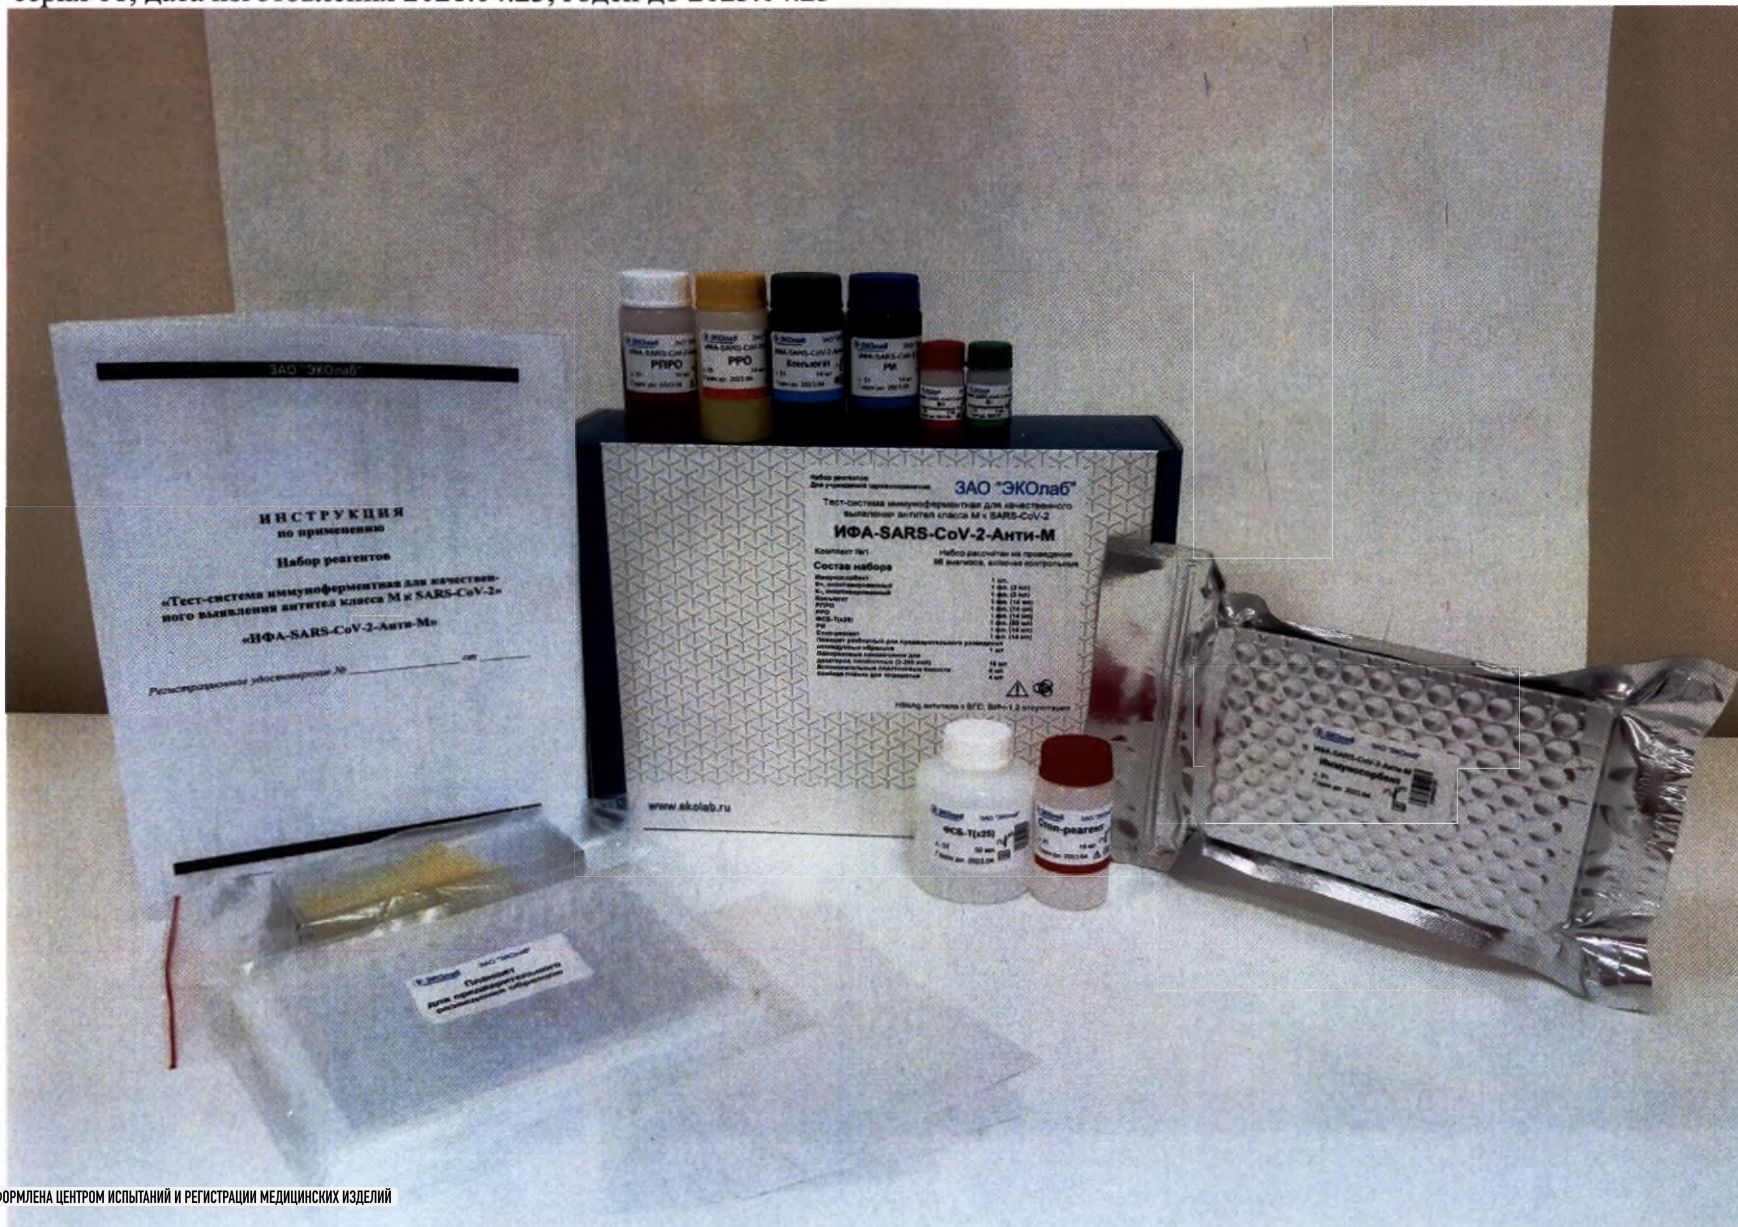

Комплект №1

серия 03, дата изготовления 2021.04.26, годен до 2023.04.26

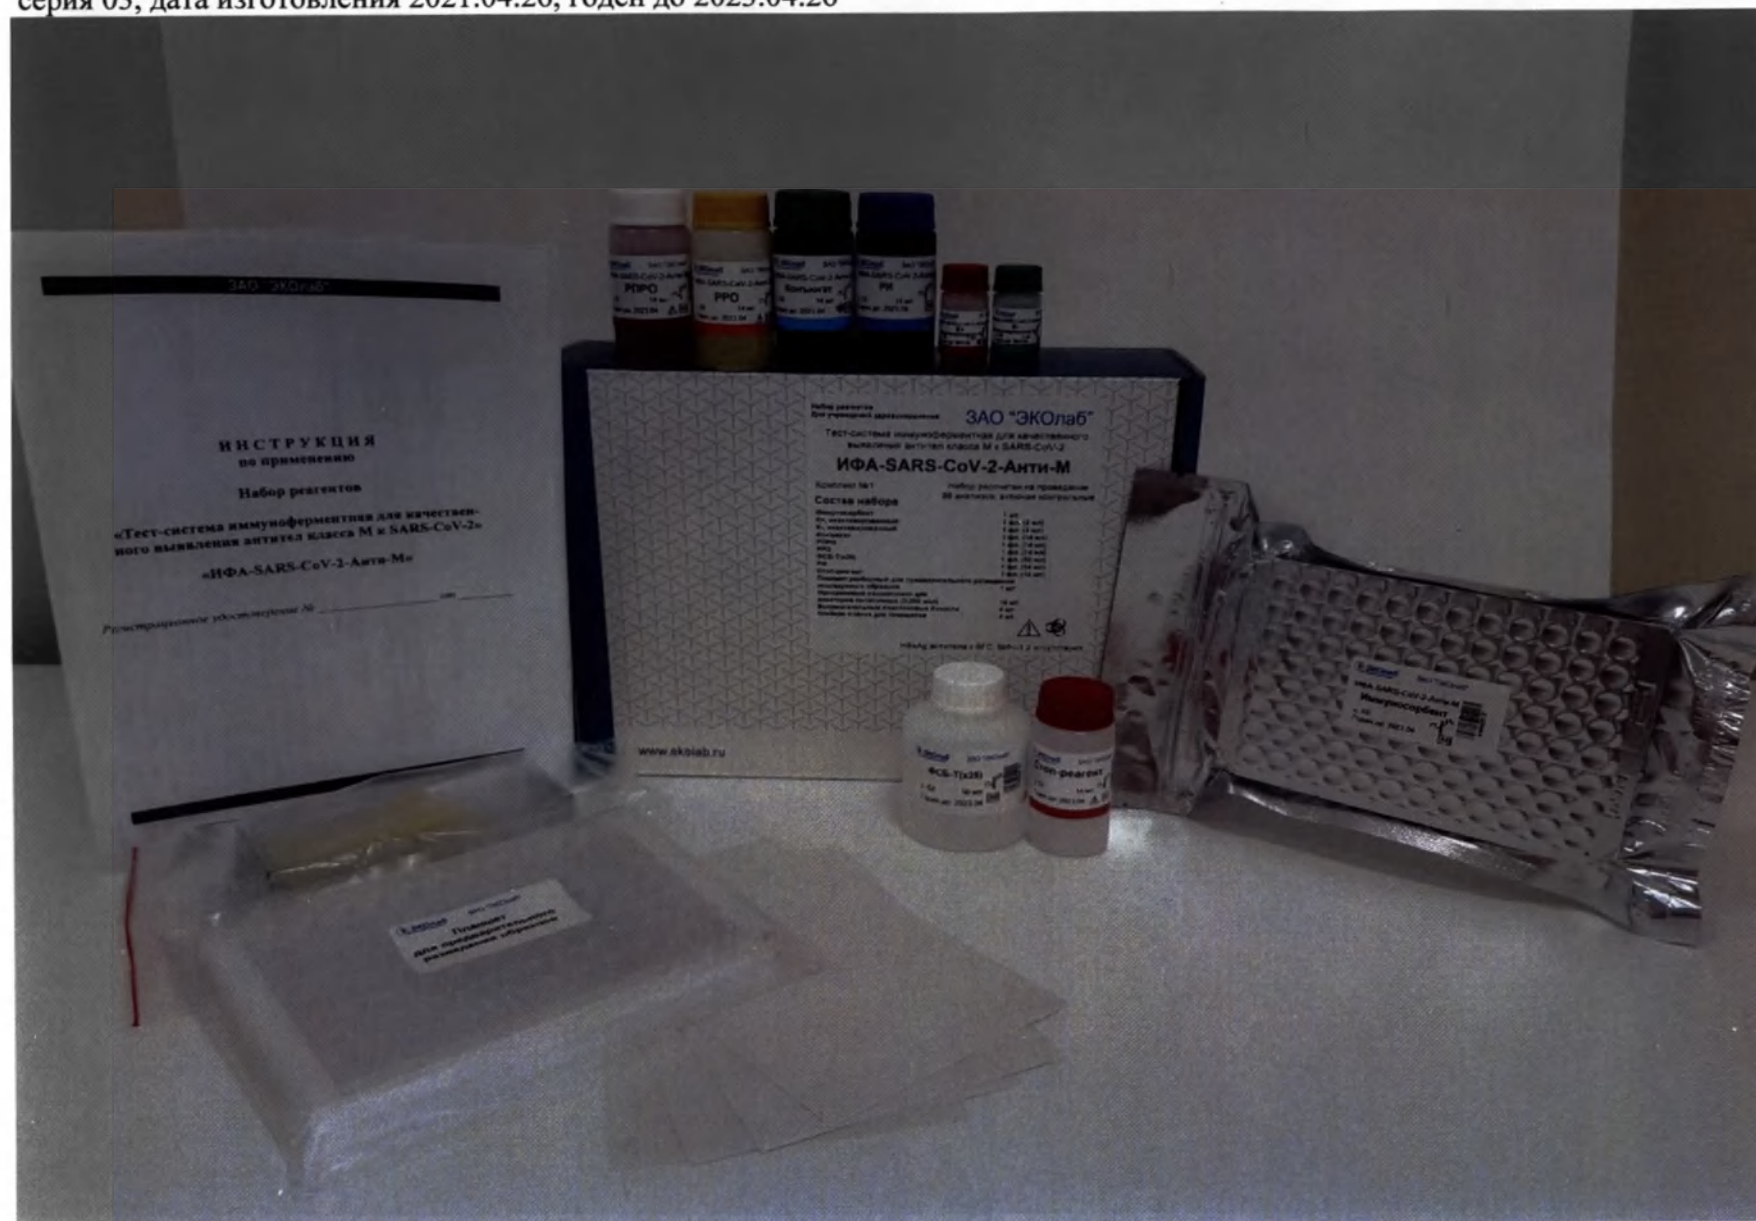


Фото коробки (не в сборе) набора реагентов
«Тест-система иммуноферментная для качественного выявления антител класса М к SARS-CoV-2»
«ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М»



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

5 лист 06

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для качественного
выявления антител класса М к SARS-CoV-2


ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (2 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (50 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (2-200 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

ТУ 21.20.23-316-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 22.12.1 Комплект №1

Серия № 01 Контрольный № 1008

Дата изготовления: 2021.04.23

Годеи до: 2023.04.23



22.12.1

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2021 год.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
РПРО
с. 01 14 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
РРО
с. 01 14 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
Конъюгат
с. 01 14 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
РИ
с. 01 14 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
Иммуносорбент
с. 01
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
К+
с. 01 2 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
ФСБ-Т(x25)
с. 01 50 мл
Годеи до: 2023.04

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"
ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М
Стоп-реагент
с. 01 14 мл
Годеи до: 2023.04

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
«только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор производства ДП:

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК:

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для качественного
выявления антител класса М к SARS-CoV-2


ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (2 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	1 фл. (14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (50 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (2-200 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

ТУ 21.20.23-316-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 22.12.1 Комплект №1

Серия № 03 Контрольный № 1021

Дата изготовления: 2021.04.26

Годен до: 2023.04.26










УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2021 год.

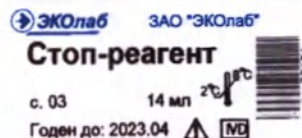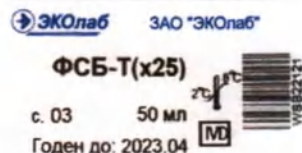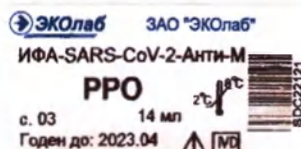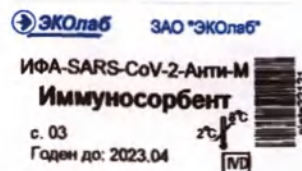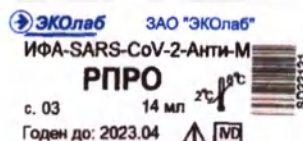

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
«только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор производства ДП:

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК:

Мишуткина Я.В.



Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для качественного
выявления антител класса М к SARS-CoV-2

ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение
480 анализов, включая контрольные


Состав набора

Иммунсорбент
К+, инактивированный
К-, инактивированный
Конъюгат
РПРО
РРО
ФСБ-Т(х25)
РИ

5 шт.
3 фл. (по 4 мл)
3 фл. (по 4 мл)
6 фл. (по 14 мл)
1 фл. (70 мл)
6 фл. (по 14 мл)
2 фл. (по 100 мл)
5 фл. (по 14 мл)
3 фл. (по 25 мл)

Стоп-реагент
Планшет разборный для предварительного разведения
исследуемых образцов
Одноразовые наконечники для
дозаторов пипеточных (2-200 мкл)
Вспомогательные пластиковые ёмкости
Клейкая плёнка для планшетов

32 шт.
8 шт.
8 шт.








HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2021 год.

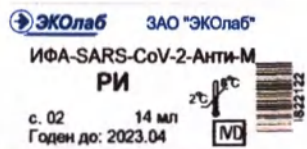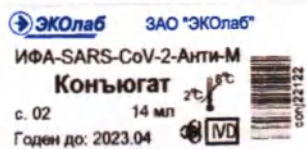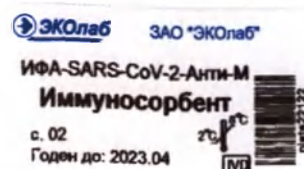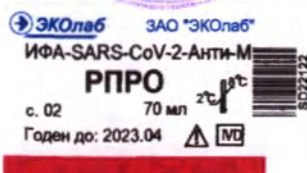

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения

ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

ТУ 21.20.23-316-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 22.12.2 Комплект №2

Серия № 02 Контрольный № 1009

Дата изготовления: 2021.04.23

Годен до: 2023.04.23



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
«только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор производства ДП:

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК:

Мишуткина Я.В.



Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для качественного
выявления антител класса М к SARS-CoV-2


ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение
480 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	5 шт.
К+, инактивированный	3 фл. (по 4 мл)
К-, инактивированный	3 фл. (по 4 мл)
Конъюгат	5 фл. (по 14 мл)
РПРО	1 фл. (70 мл)
РРО	5 фл. (по 14 мл)
ФСБ-Т(x25)	2 фл. (по 100 мл)
РИ	5 фл. (по 14 мл)
Стоп-реагент	3 фл. (по 25 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	5 шт.
Одноразовые наконечники для дозаторов пипеточных (2-200 мкл)	32 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	8 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	8 шт.











HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют



Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2021 год.

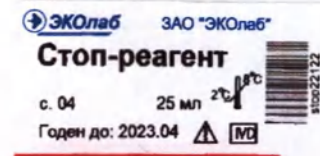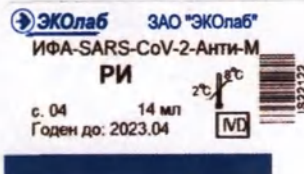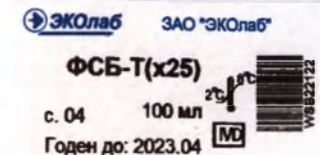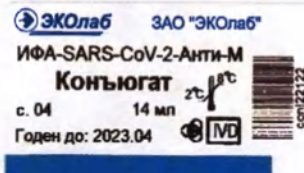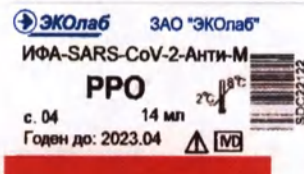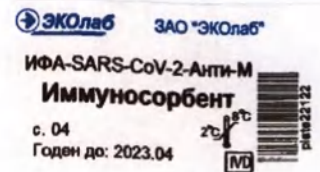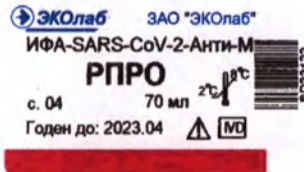

ЗАО "ЭКОлаб"

Для профессионального применения


ИФА-SARS-CoV-2-Анти-М

ТУ 21.20.23-316-70423725-2021

РУ №

Каталожный № 22.12.2 Комплект №2

Серия № 04 Контрольный № 1022



Дата изготовления: 2021.04.26

Годен до: 2023.04.26

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
«только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

Директор производства ДП:

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК:

Handwritten signature

Мишуткина Я.В.



Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 2

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"10" 2022 г.

