

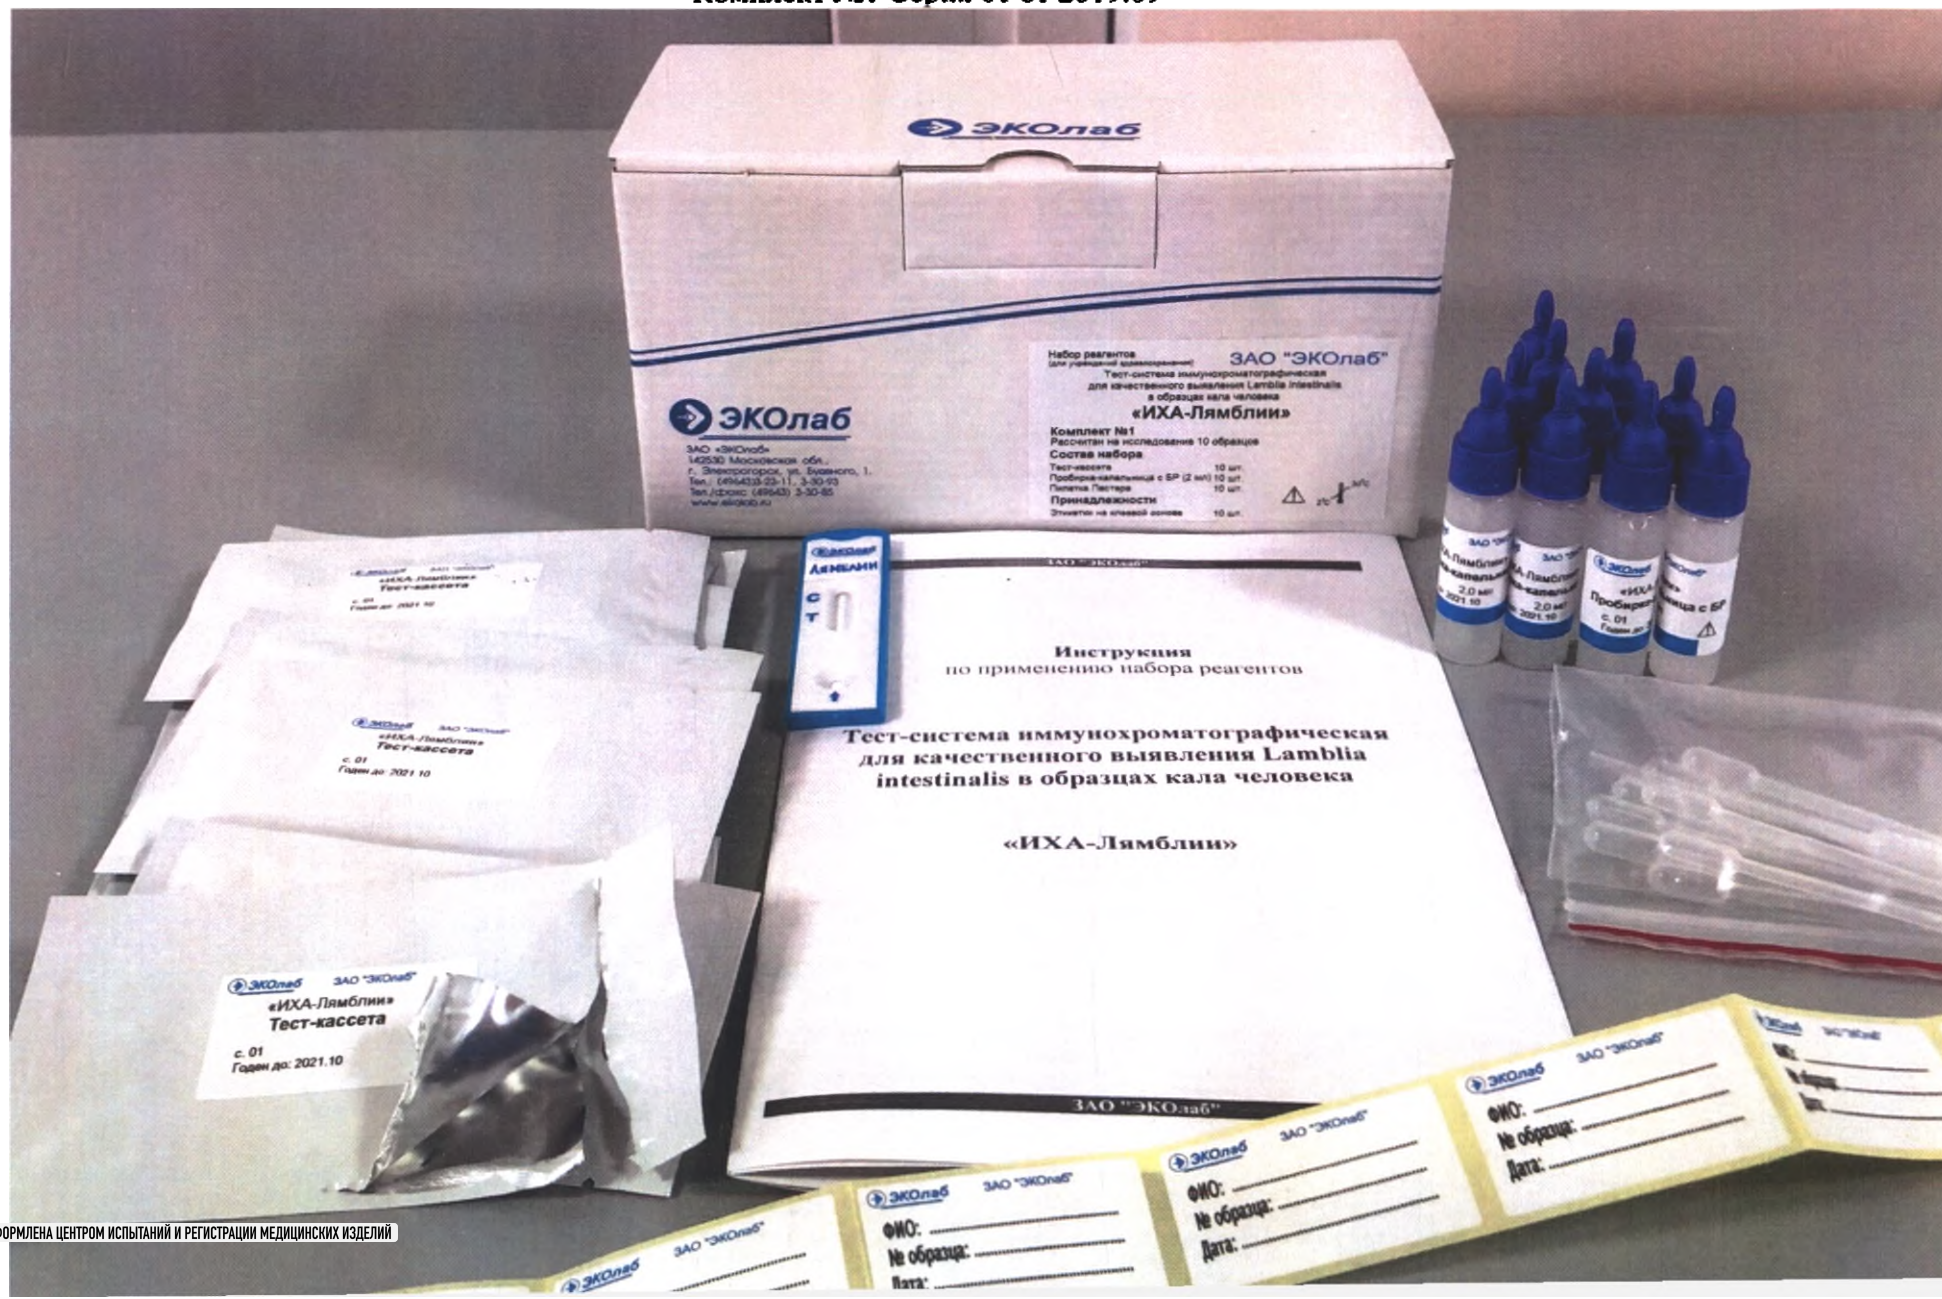
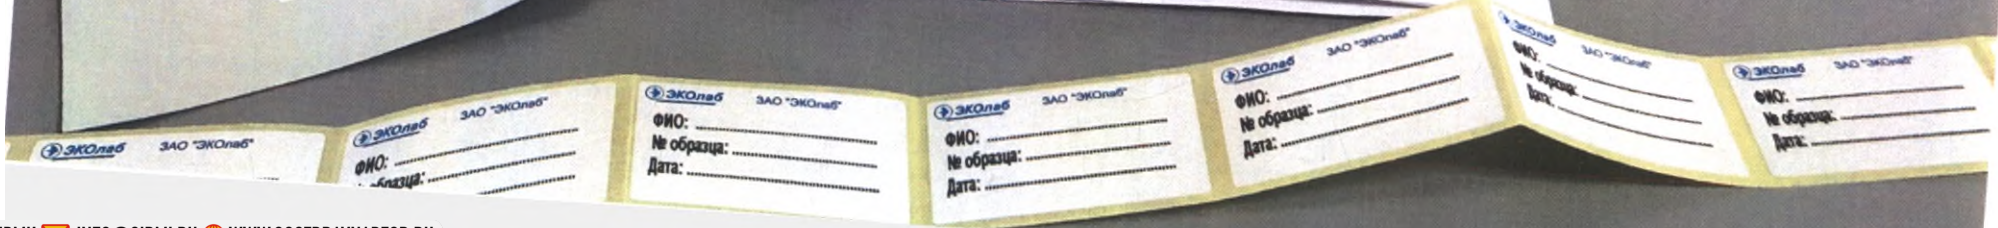
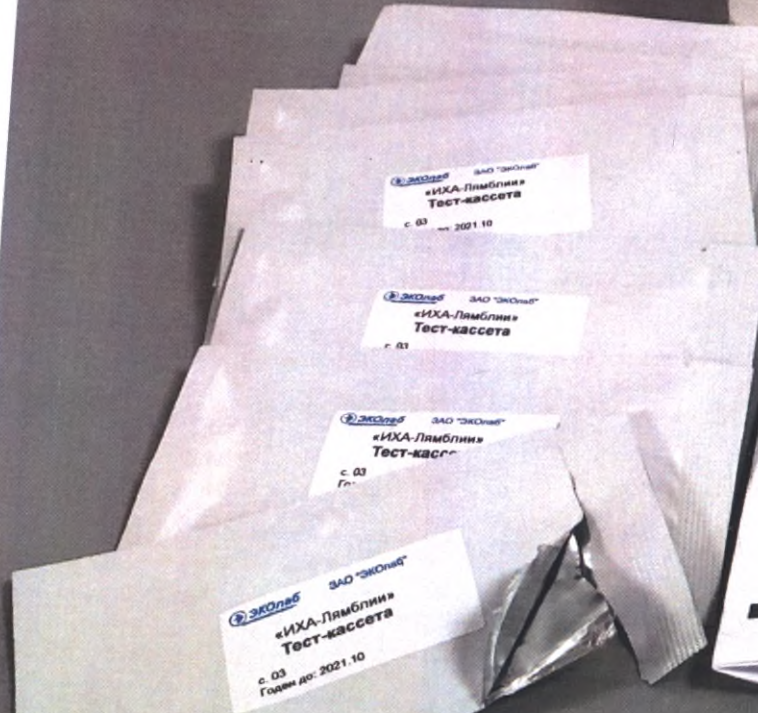



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммунохроматографическая
для качественного выявления *Lambliа intestinalis* в образцах кала человека» «ИХА-Лямблии»
Комплект №1 Серия 01 от 2019.09

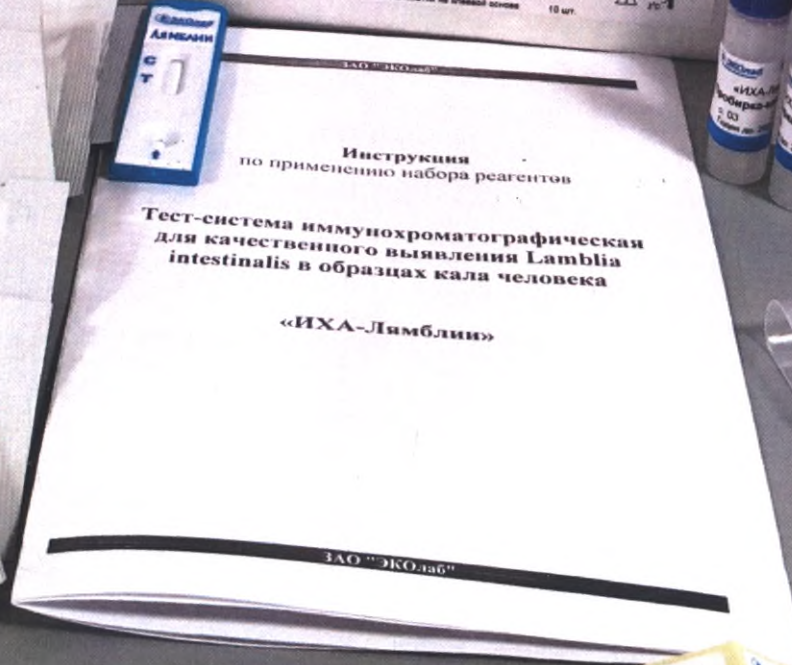



Комплект №1, Серия 03 от 2019.09.

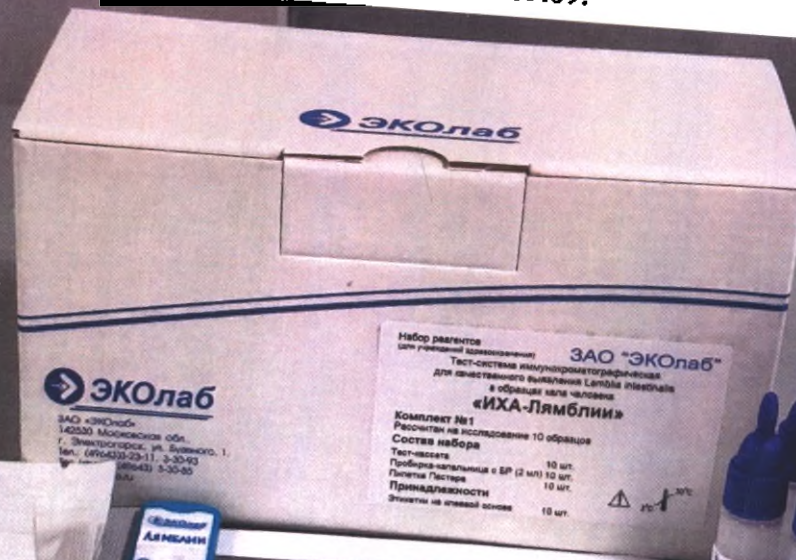


Образец упаковки

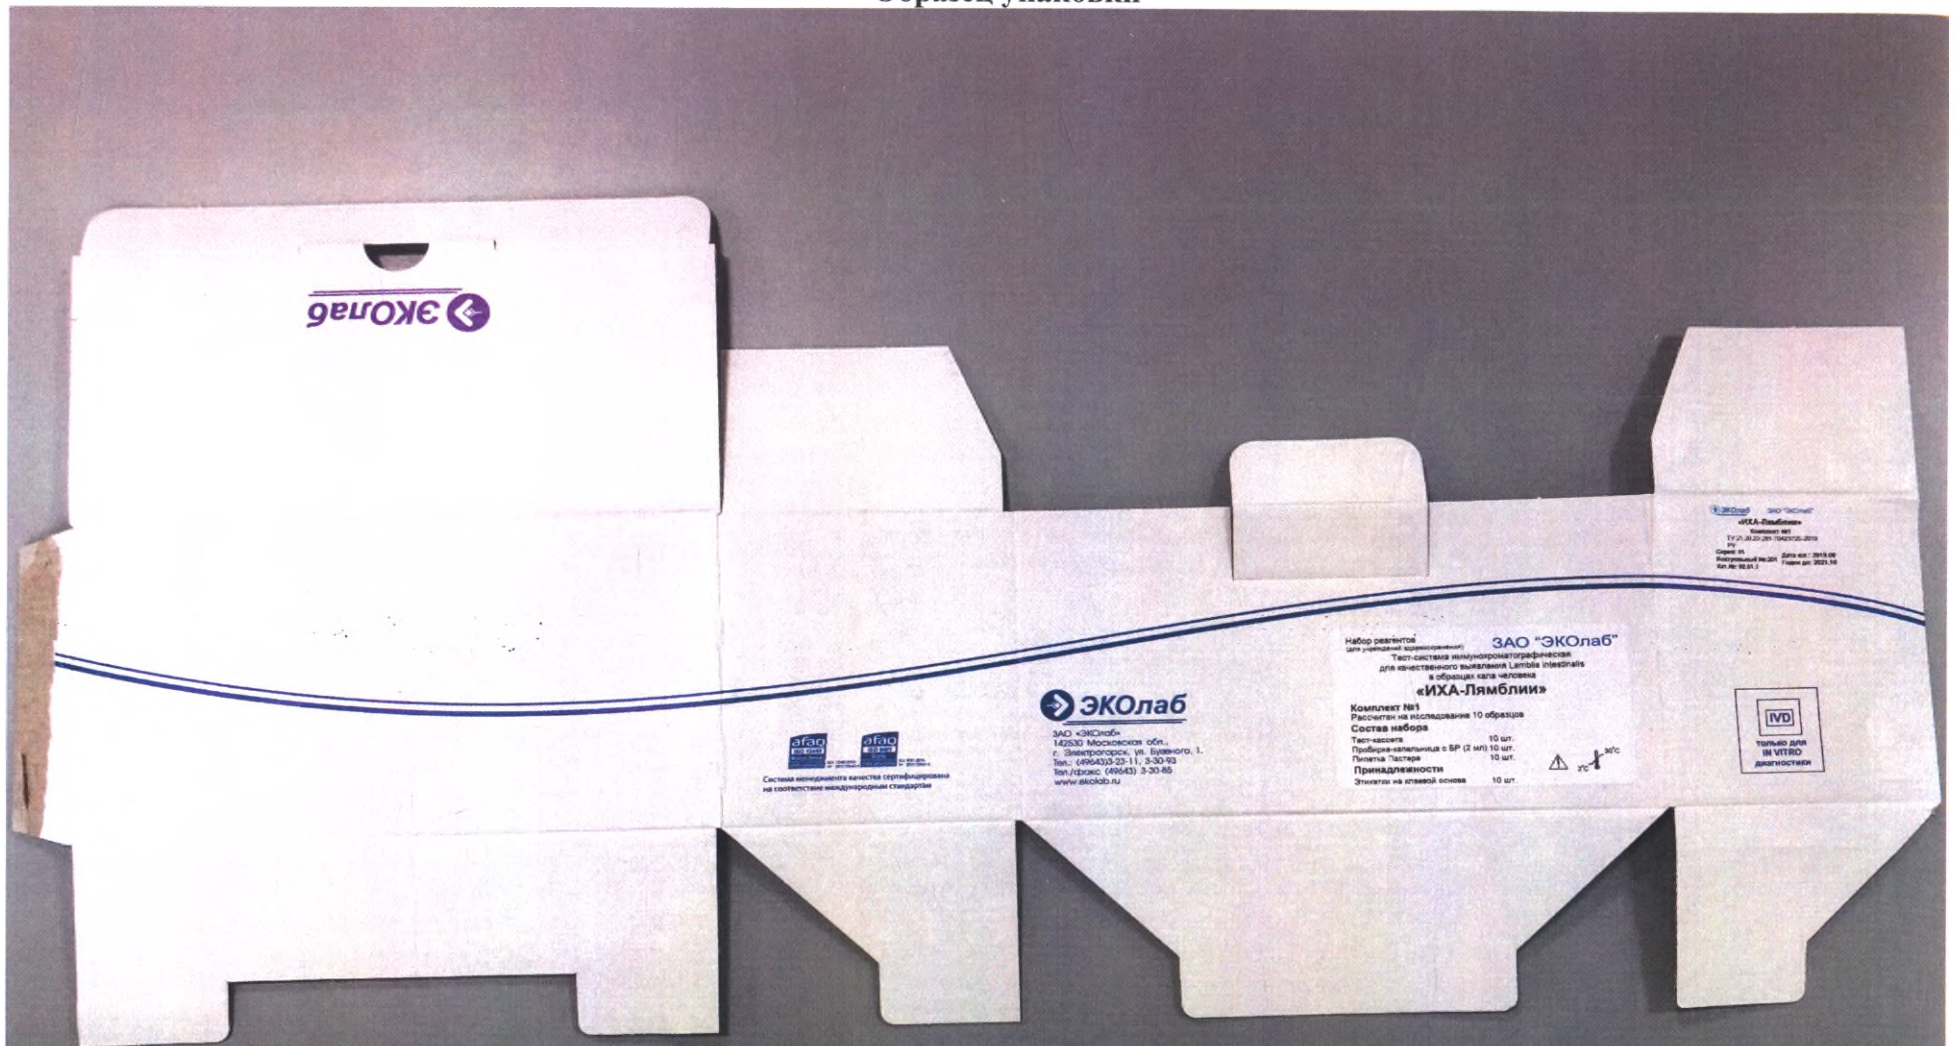

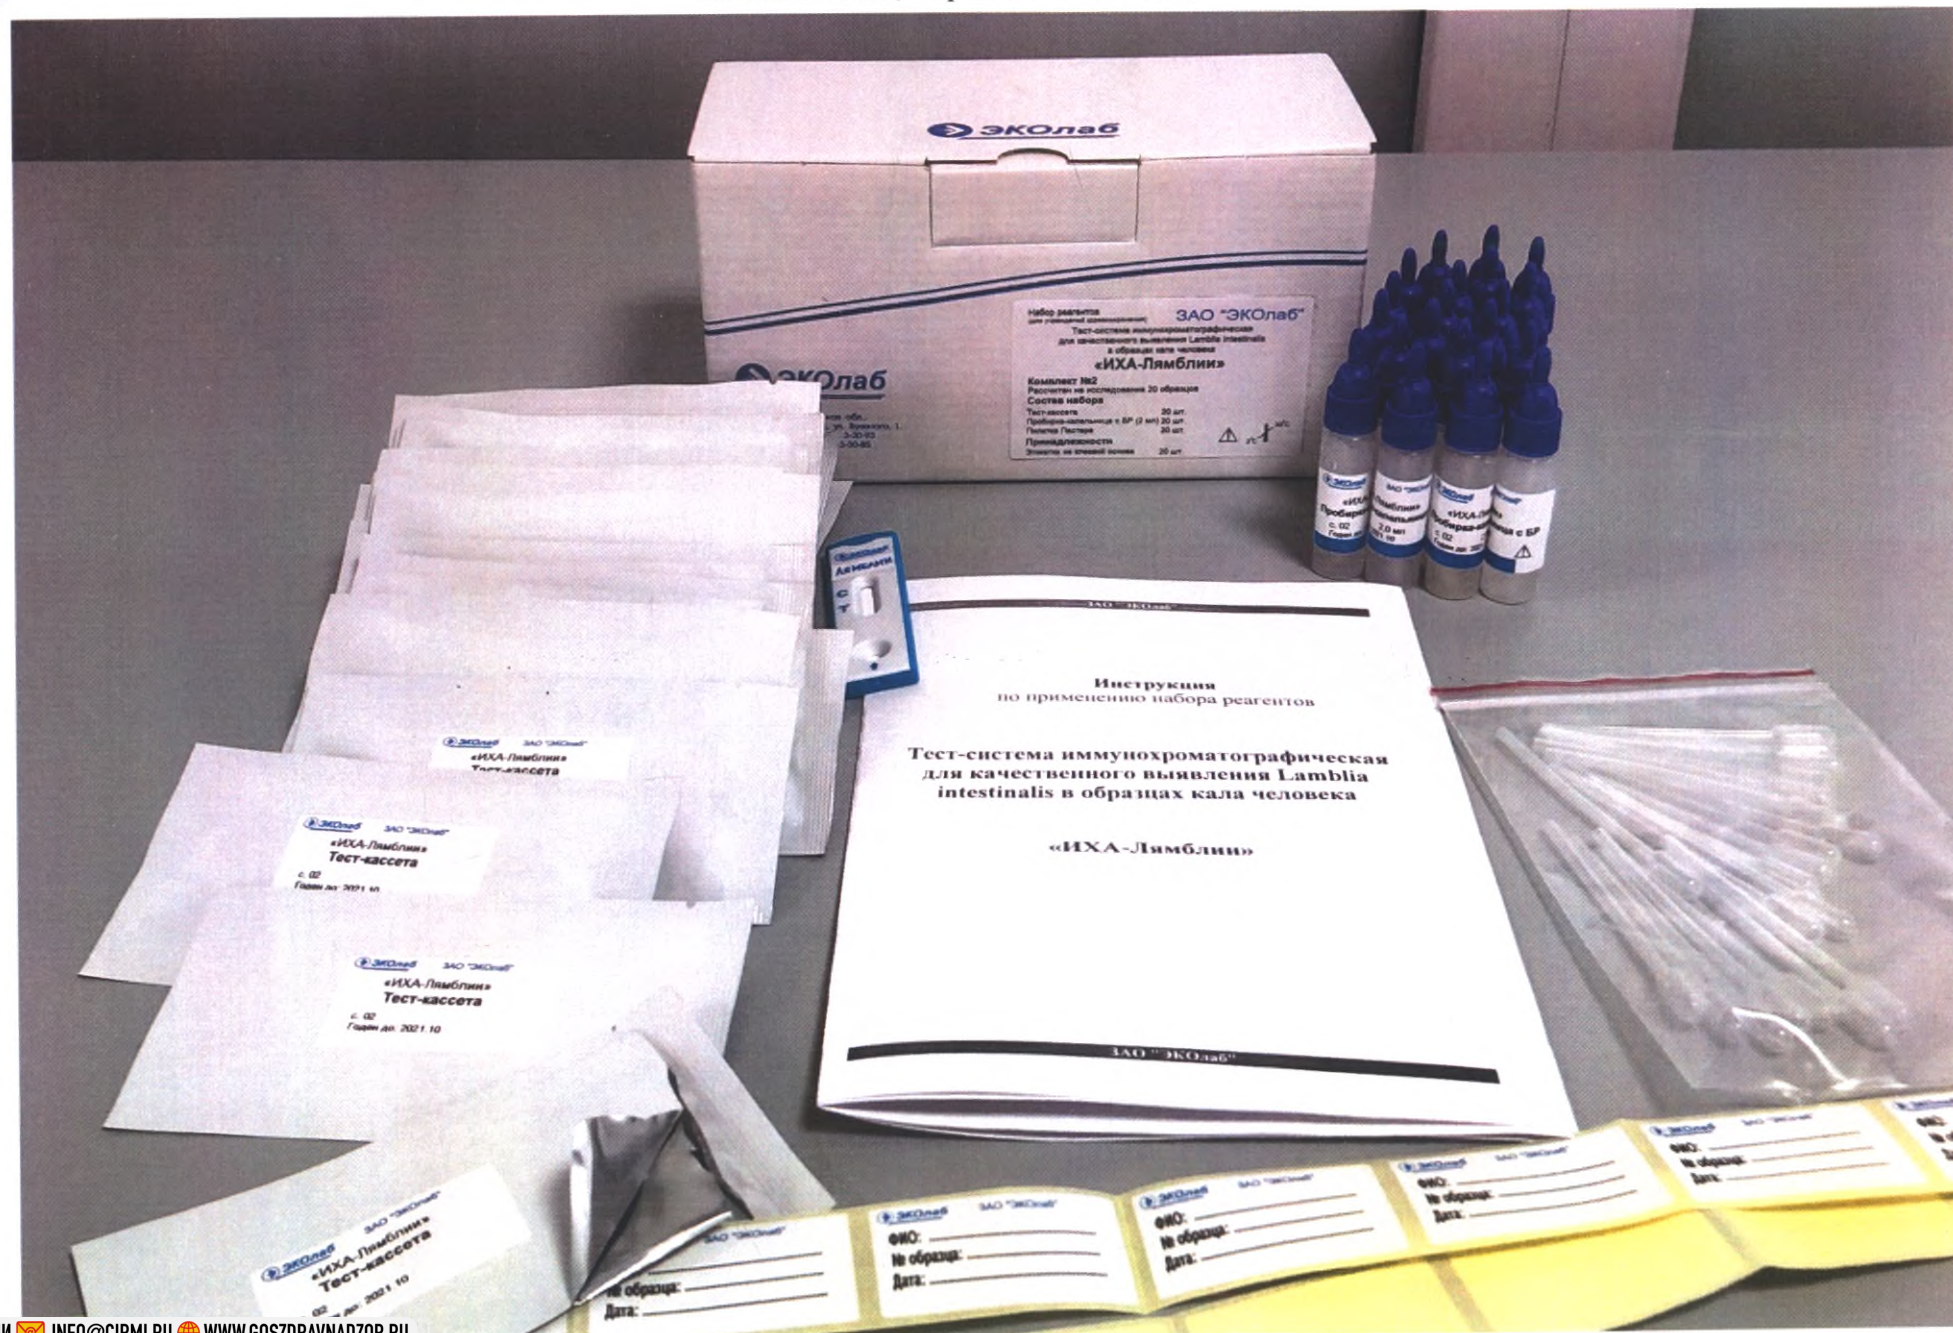

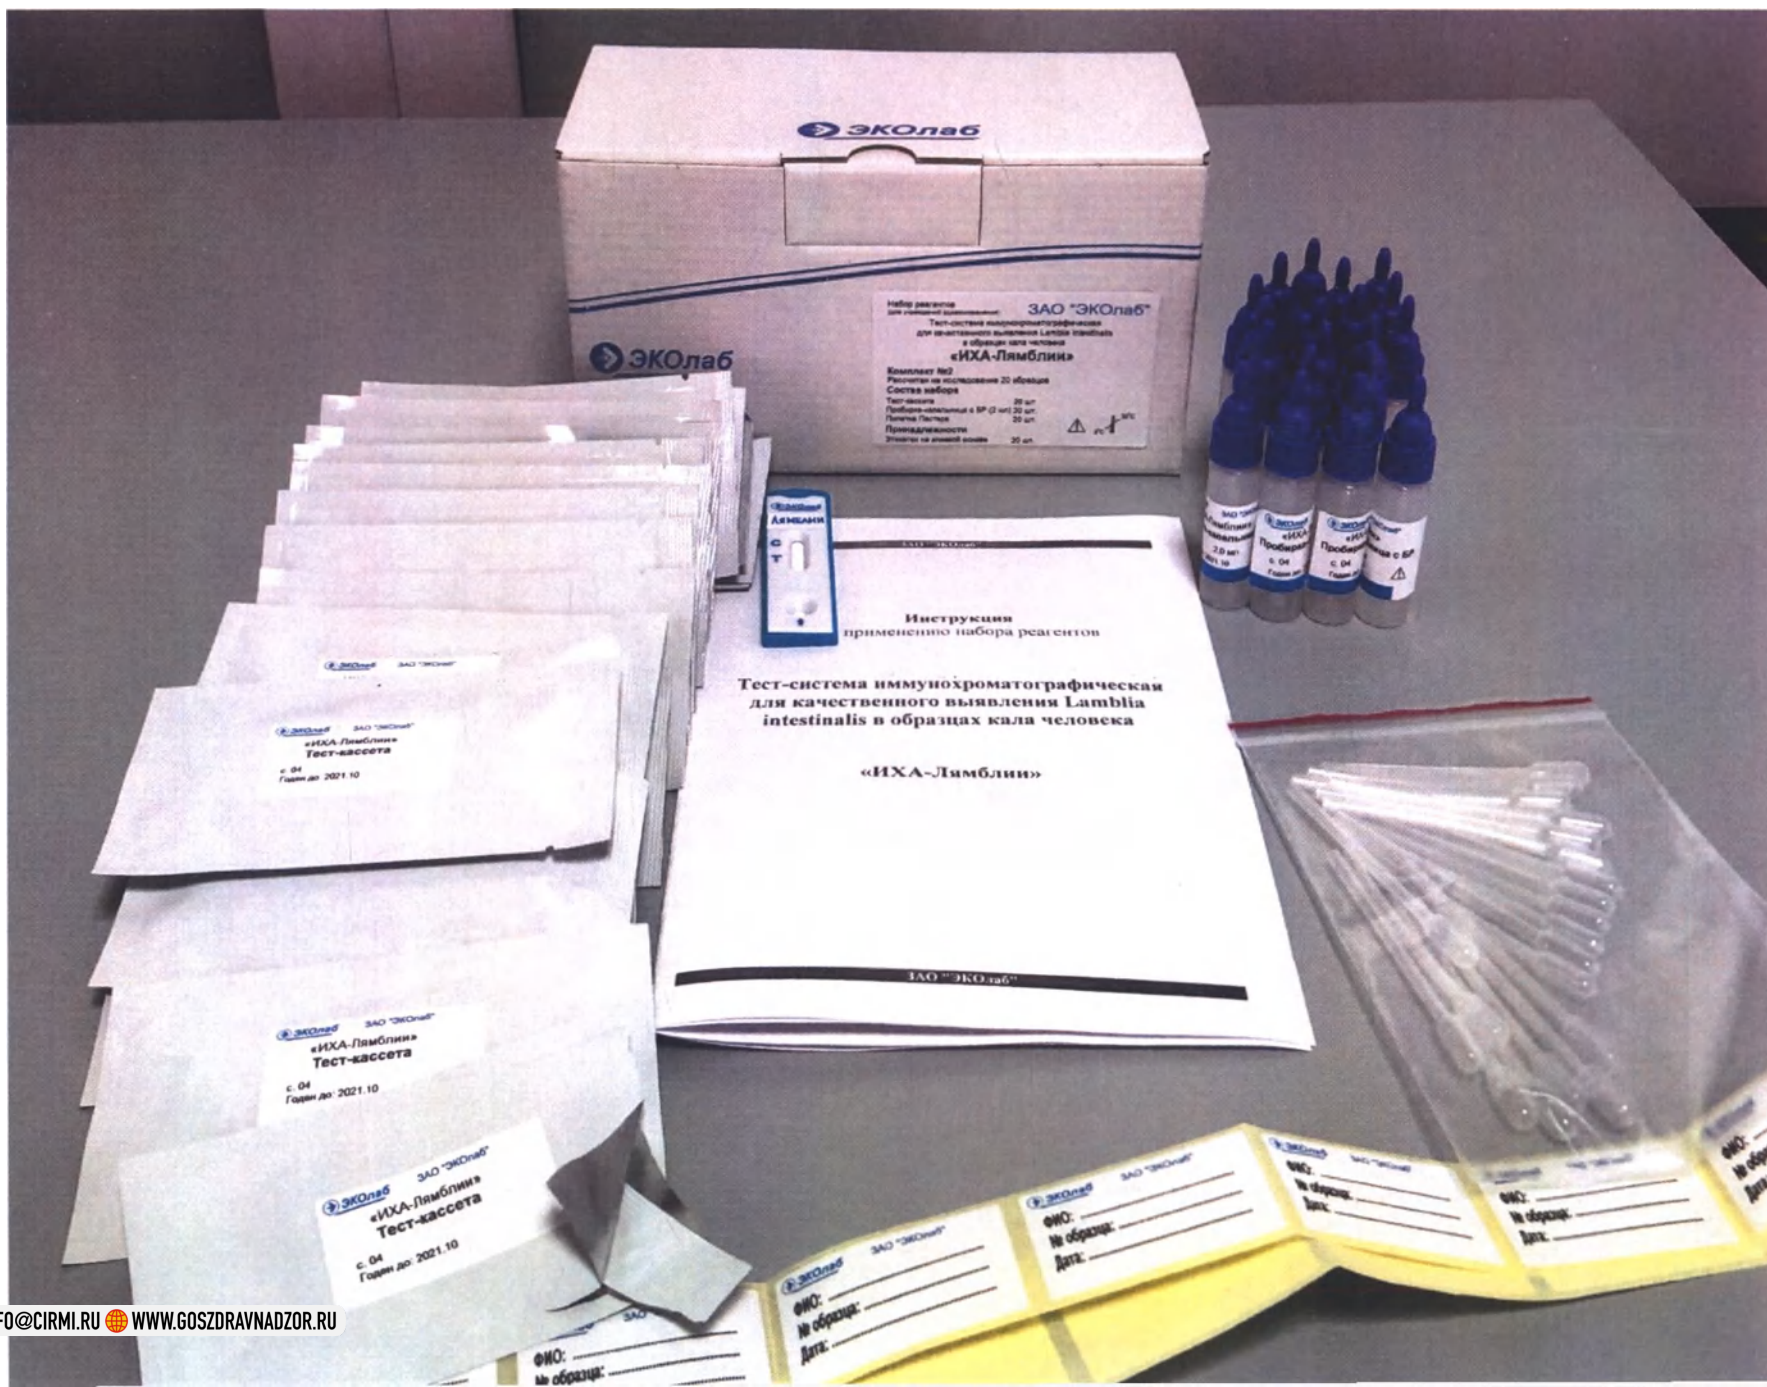

Образец упаковки

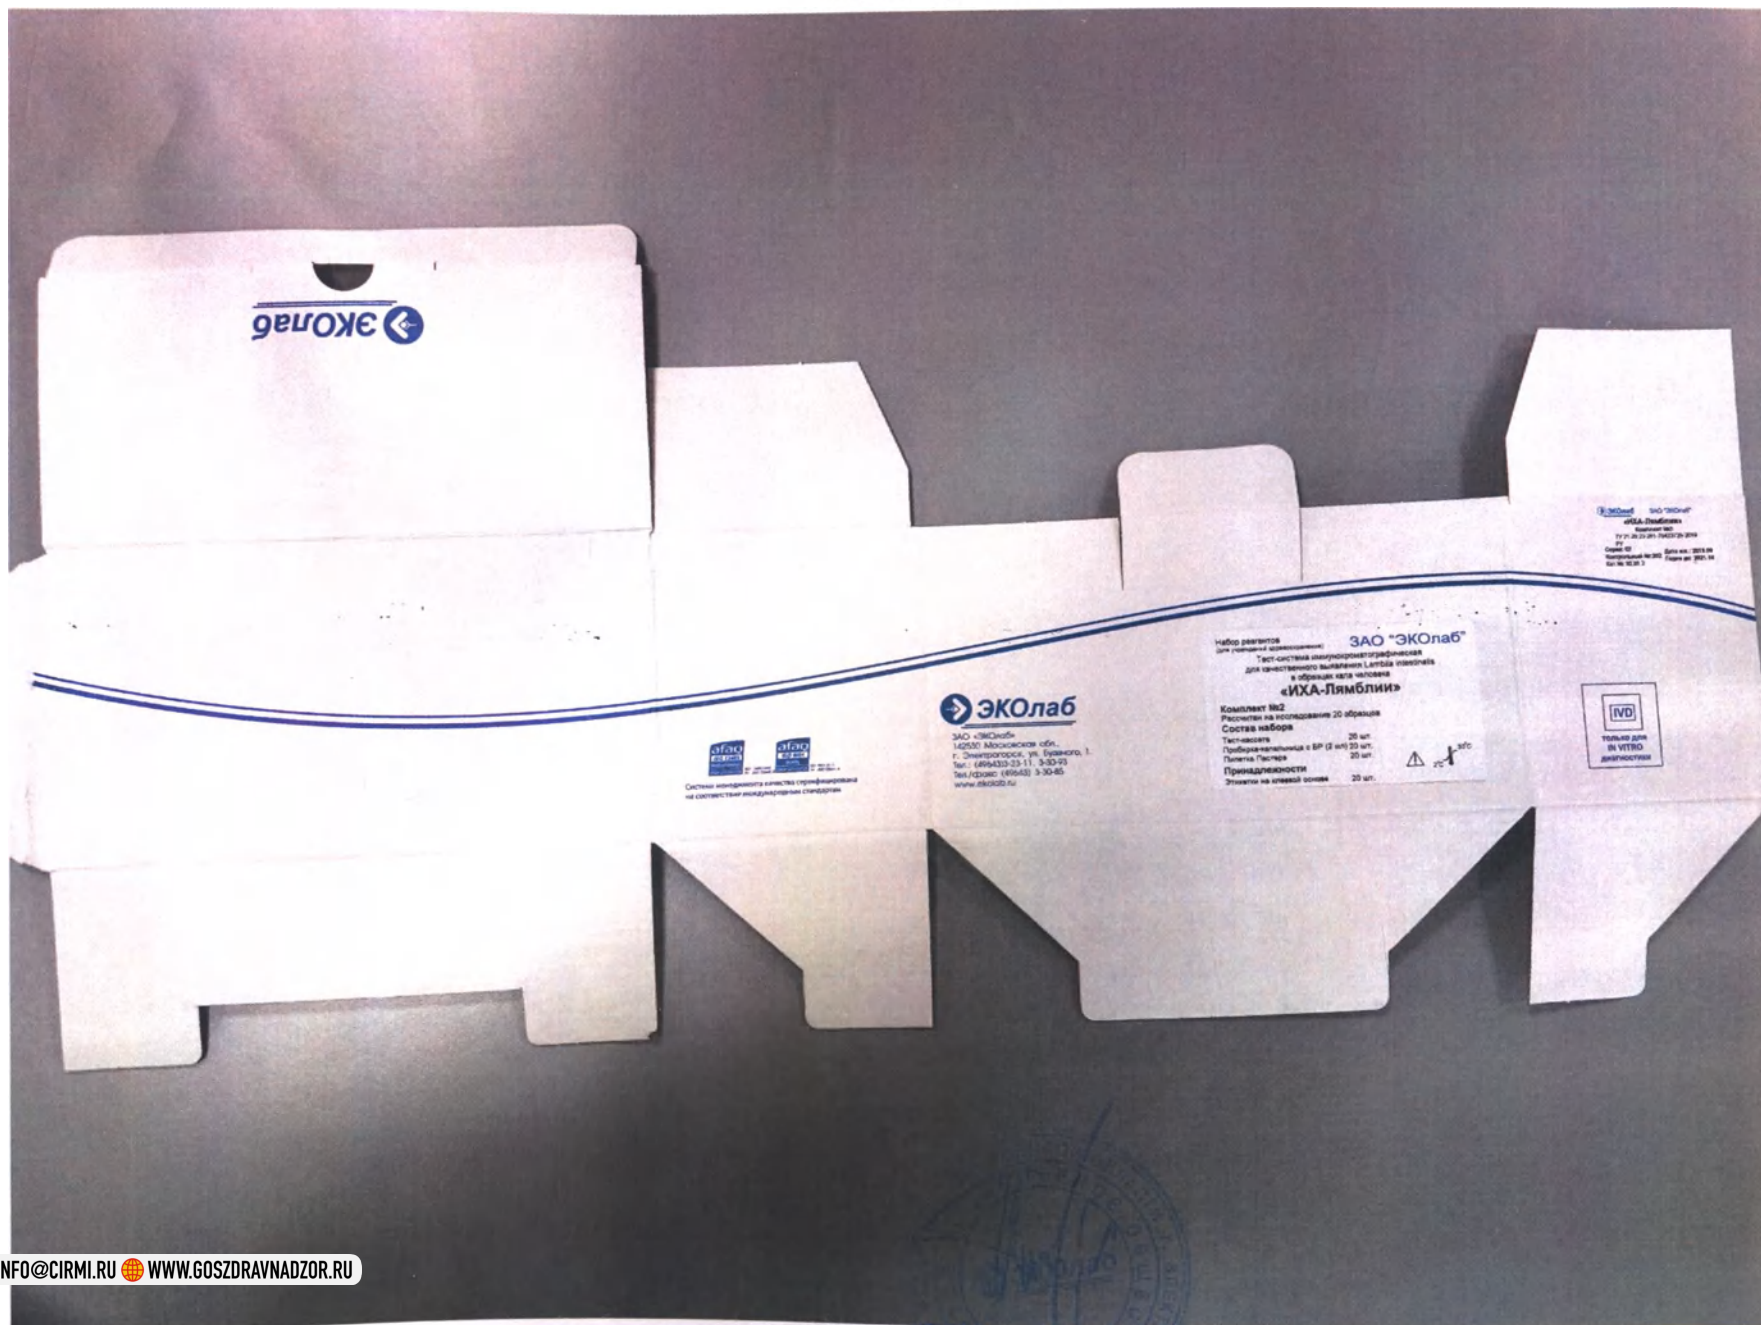

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист _____
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.
"1" _____ 2020 г.





УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«11» 06 2020 г.

Набор реагентов
(для учреждений здравоохранения)

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного выявления *Lambliа intestinalis*
в образцах кала человека

«ИХА-Лямблии»

Комплект №1

Рассчитан на исследование 10 образцов

Состав набора


Тест-кассета 10 шт.

Пробирка-капельница с БР (2 мл) 10 шт.

Пипетка Пастера 10 шт.

Принадлежности

Этикетки на клеевой основе 10 шт.



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Комплект №1

1Y 21 20 23 281 70423725-2019

ру

Серия: 01

Дата изг.: 2019.09

Контрольный №: 201

Годен до: 2021.10

Кат. №: 92.01.1

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro» диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»
Тест-кассета

с. 01

Годен до: 2021.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»
Пробирка-капельница с БР

с. 01 2,0 мл

Годен до: 2021.10



Начальник ОНР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
«11» _____ 2020 г.

Набор реагентов
(для учреждений здравоохранения)

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного выявления *Lambliа intestinalis*
в образцах кала человека

«ИХА-Лямблии»

Комплект №1

Рассчитан на исследование 10 образцов

Состав набора

Тест-кассета 10 шт

Пробирка-капельница с БР (2 мл) 10 шт

Пипетка Пастера 10 шт

Принадлежности

Этикетки на клеевой основе 10 шт



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Комплект №1

ТУ 21.20.23.281-70423/25-2019

РУ

Серия: 03

Контрольный №: 207

Кат. №: 92.01.1

Дата изг.: 2019.09

Годеи до: 2021.10

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

**«ИХА-Лямблии»
Тест-кассета**

с. 03

Годеи до: 2021.10

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

**«ИХА-Лямблии»
Пробирка-капельница с БР**

с. 03 2,0 мл

Годеи до: 2021.10



Начальник ОНР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБГК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
« 11 » 20 20 г.

Набор реагентов
(для учреждений здравоохранения)

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного выявления *Lambliа intestinalis*
в образцах кала человека

«ИХА-Лямблии»

Комплект №2

Рассчитан на исследование 20 образцов

Состав набора

Тест-кассета 20 шт.

Пробирка-капельница с БР (2 мл) 20 шт.

Пипетка Пастера 20 шт.

Принадлежности

Этикетки на клеевой основе 20 шт.



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Комплект №2

ТУ 21 20 23-281 / 0423725-2019

РУ

Серия: 02

Дата изг.: 2019.09

Контрольный №: 202

Годен до: 2021.10

Кат. №: 92.01.2

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro» диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Тест-кассета

с. 02

Годен до: 2021.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Пробирка-капельница с БР

с. 02 2,0 мл

Годен до: 2021.10



Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБТК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
« 11 » 20 11 г.

Набор реагентов
(для учреждений здравоохранения)

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммунохроматографическая
для качественного выявления *Lambliа intestinalis*
в образцах кала человека

«ИХА-Лямблии»

Комплект №2


Рассчитан на исследование 20 образцов

Состав набора

Тест-кассета 20 шт.
Пробирка-капельница с БР (2 мл) 20 шт.
Пипетка Пастера 20 шт.

Принадлежности

Этикетки на клеевой основе 20 шт.



ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Комплект №2

ТУ 21.20.23.281-70423/25-2019

сер.

Серия: 04

Контрольный №: 208

Кат. №: 92.01.2

Дата изг.: 2019.09

Годен до: 2021.10

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для «in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Тест-кассета

с. 04

Годен до: 2021.10

ЭКОлаб ЗАО «ЭКОлаб»

«ИХА-Лямблии»

Пробирка-капельница с БР

с. 04

2,0 мл

Годен до: 2021.10



Начальник ОПР

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОБГК

Амелина Е.А.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Борисов В.Ю.

"11" 06 2020 г.