



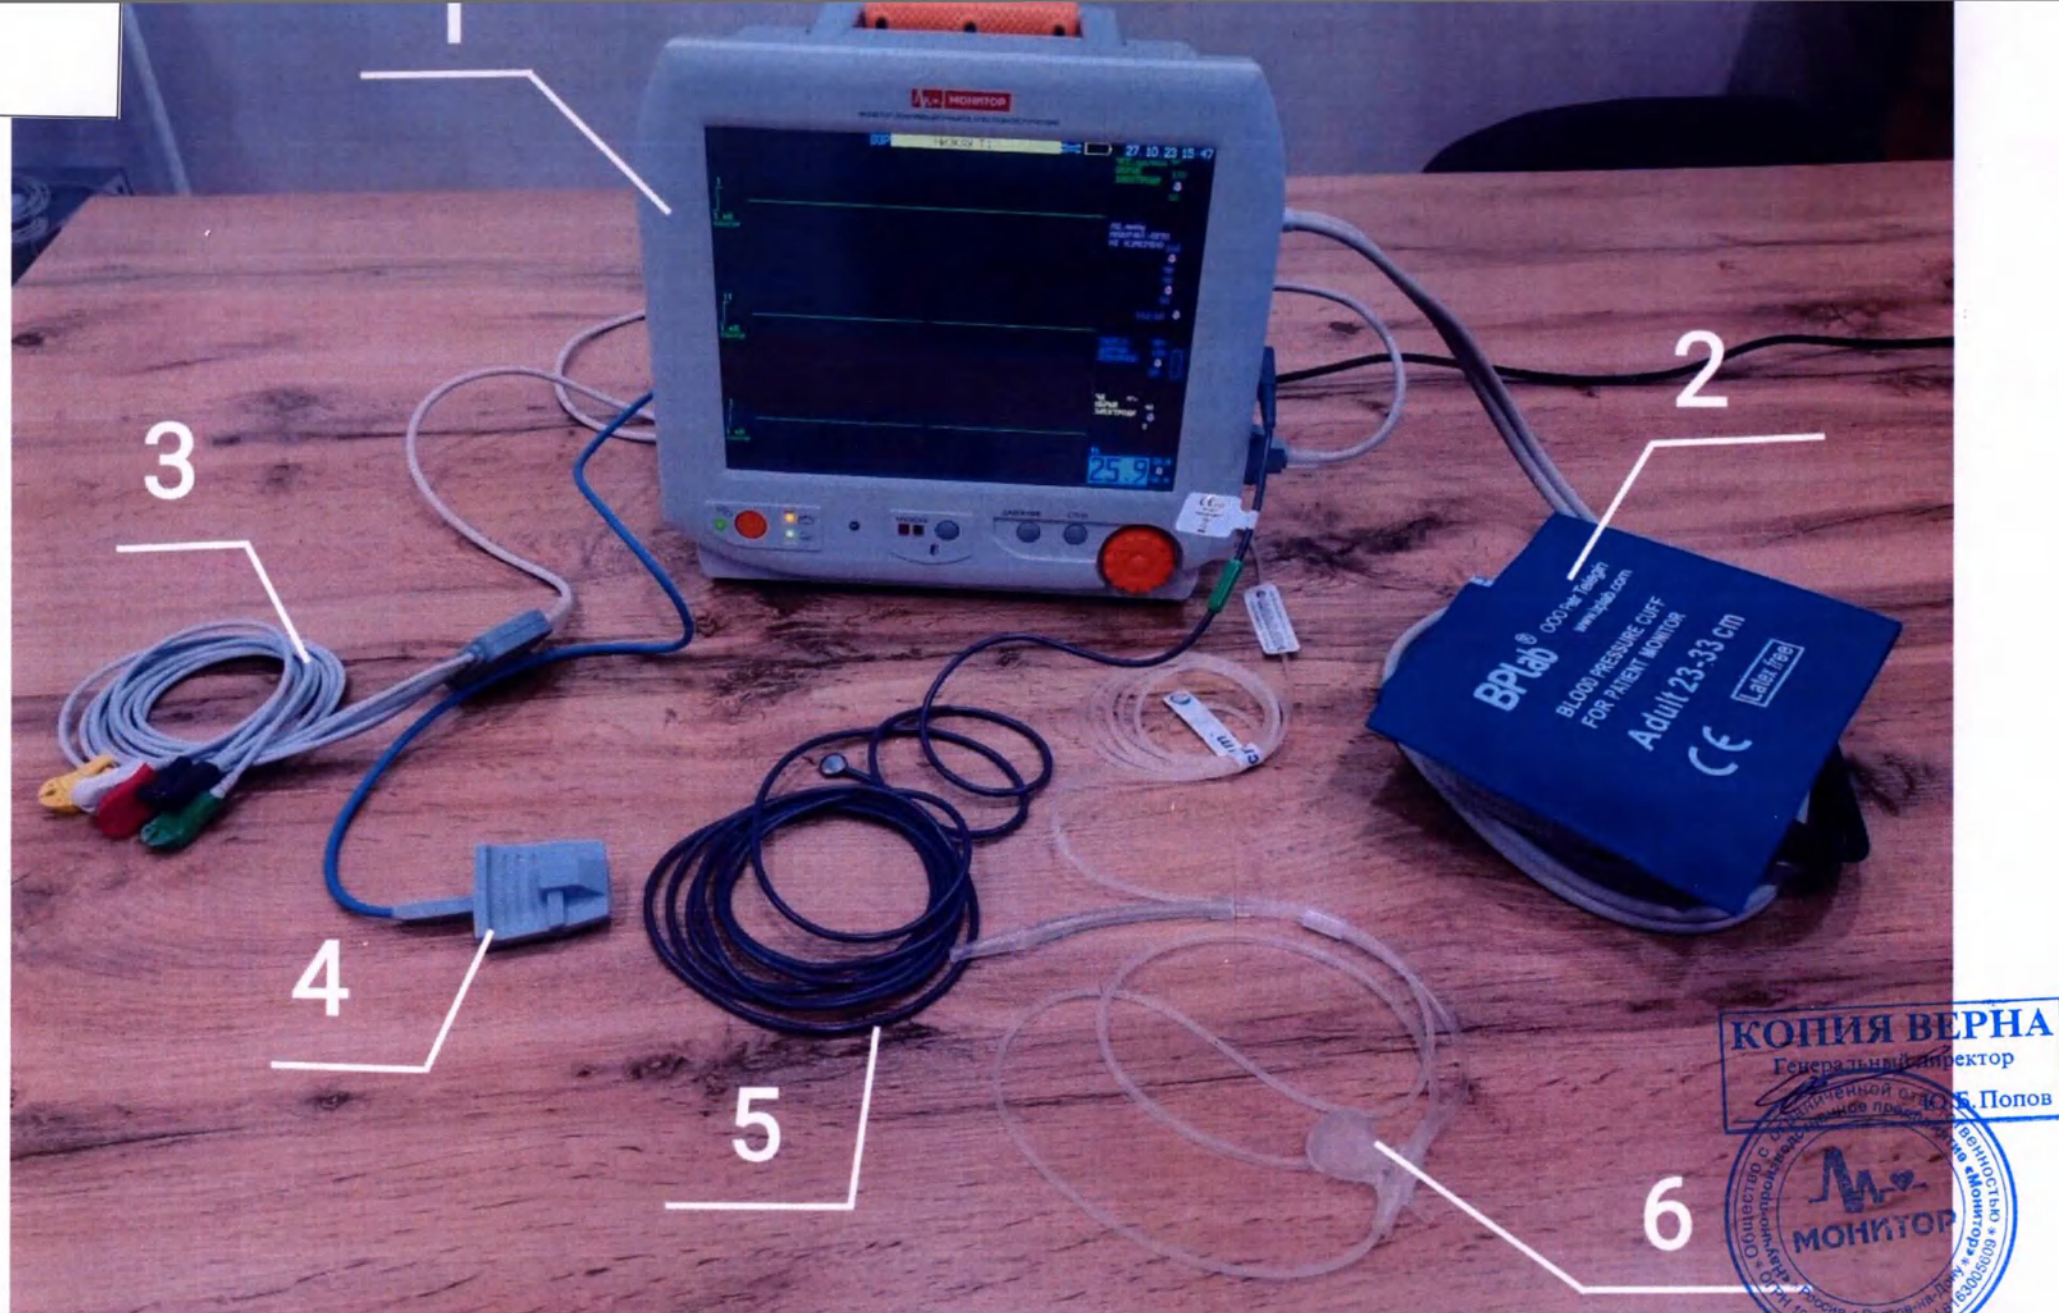

Общий вид Монитора реанимационного и анестезиологического для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д» Т0, МТЦ.82.00.100, где: 1 – блок монитора; 2 – манжета НИАД; 3 – кабель ЭКГ; 4 – датчик SpO₂; 5 – датчик температуры; 6 – одноразовая линия

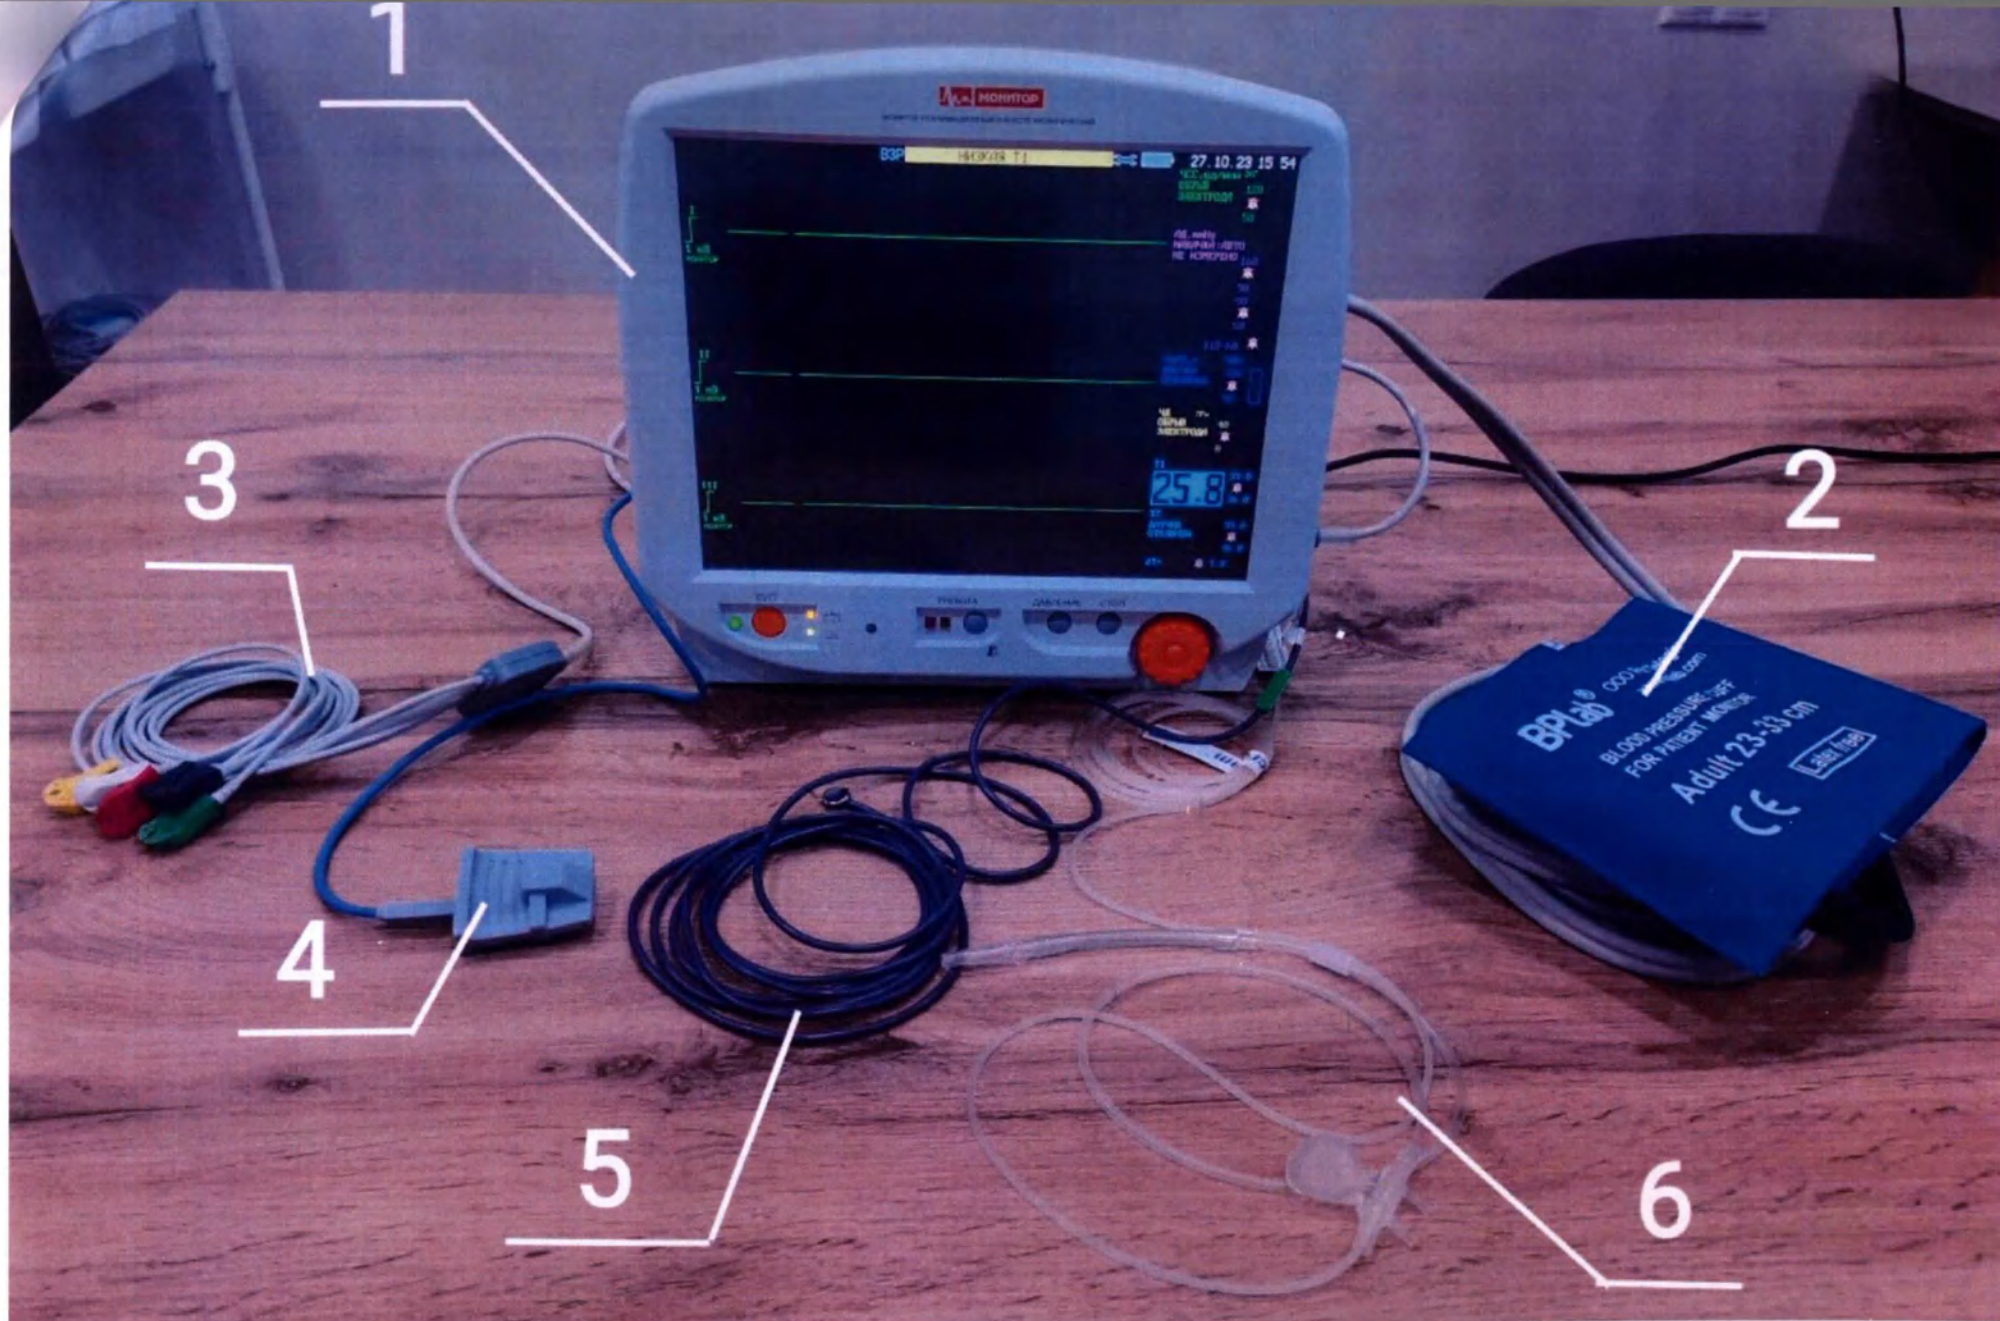

Общий вид Монитора реанимационного и анестезиологического для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д»/12, МТЦ.83.00.100, где: 1 – блок монитора; 2 – манжета НИАД; 3 – кабель ЭКГ; 4 – датчик SpO₂; 5 – датчик температуры; 6 – одноразовая линия

Генеральный директор Ю.Б. Попов
«04» *апреля* 20*18* г.





Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-"Р-Д"/10, МТЦ.82.00.100

МАРКИРОВКА



Монитор реанимационный и анестезиологический для
контроля ряда физиологических параметров
МИТАР-01-"Р-Д"/12, МТЦ.83.00.100
МАРКИРОВКА

МОНИТОР



МОНИТОР



РОССИЯ
ООО "НПГ "Монитор"
Ростов-на-Дону

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ
ООО "НПГ "Монитор"
344068, Ростов-на-Дону
ул. Краснокурская, 104а

**МОНИТОР
реанимационный
и анестезиологический**
МИТАР-01-"Р-Д"/10
ТУ 9441-002-24149103-2002

SN

номер счета

дата упаковки

20

масса 6 кг

Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля
ряда физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д»/10
МТЦ.82.00.100
УПАКОВКА



МОНИТОР



МОНИ

МОНИТОР



МОНИТОР



ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ


ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ

ООО "НПП "МОНИТОР"
344066, Ростов-на-Дону
ул. Краснокурская, 104а



РОССИЯ
ООО "НПП "Монитор"
Ростов-на-Дону

МОНИТОР
реанимационный
и анестезиологический
МИТАР-01-"Р-Д"/12
ТУ 9441-002-24149103-2002



SN

номер счета

дата упаковки

20

масса 6 кг



Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряд физиологических параметров МИТАР-01-«Р-Д»/12

МТЦ.83.00.100

УПАКОВКА



МОНИТОР




МОНИ

В данном документе прошито 7 листов

Генеральный директор Ю.Б. Попов


«04» октября 2017



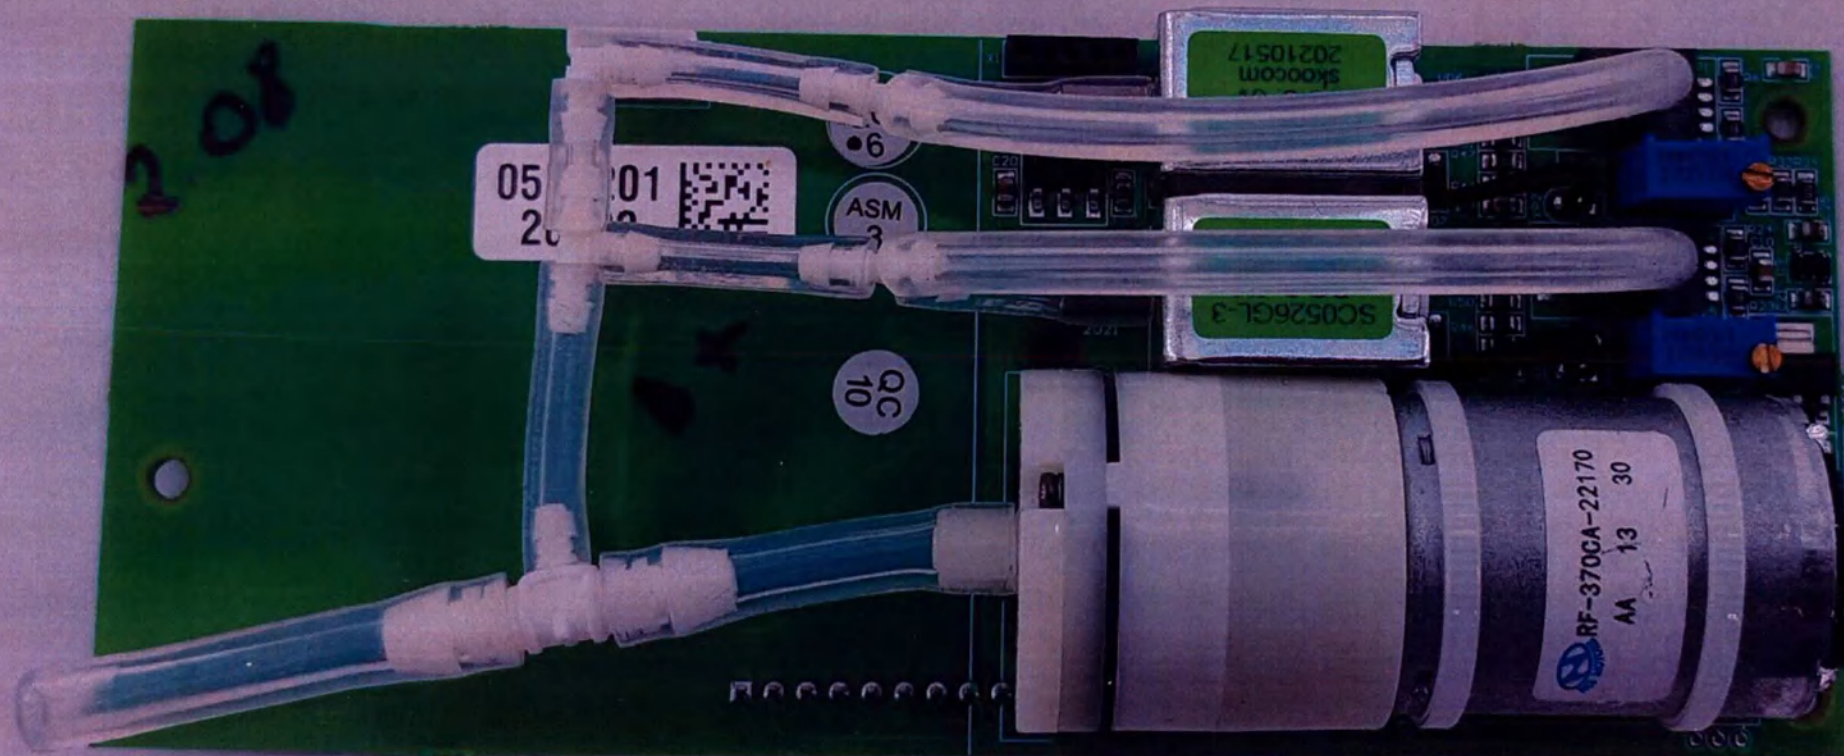

Модуль АД, МТЦ.81.07.501




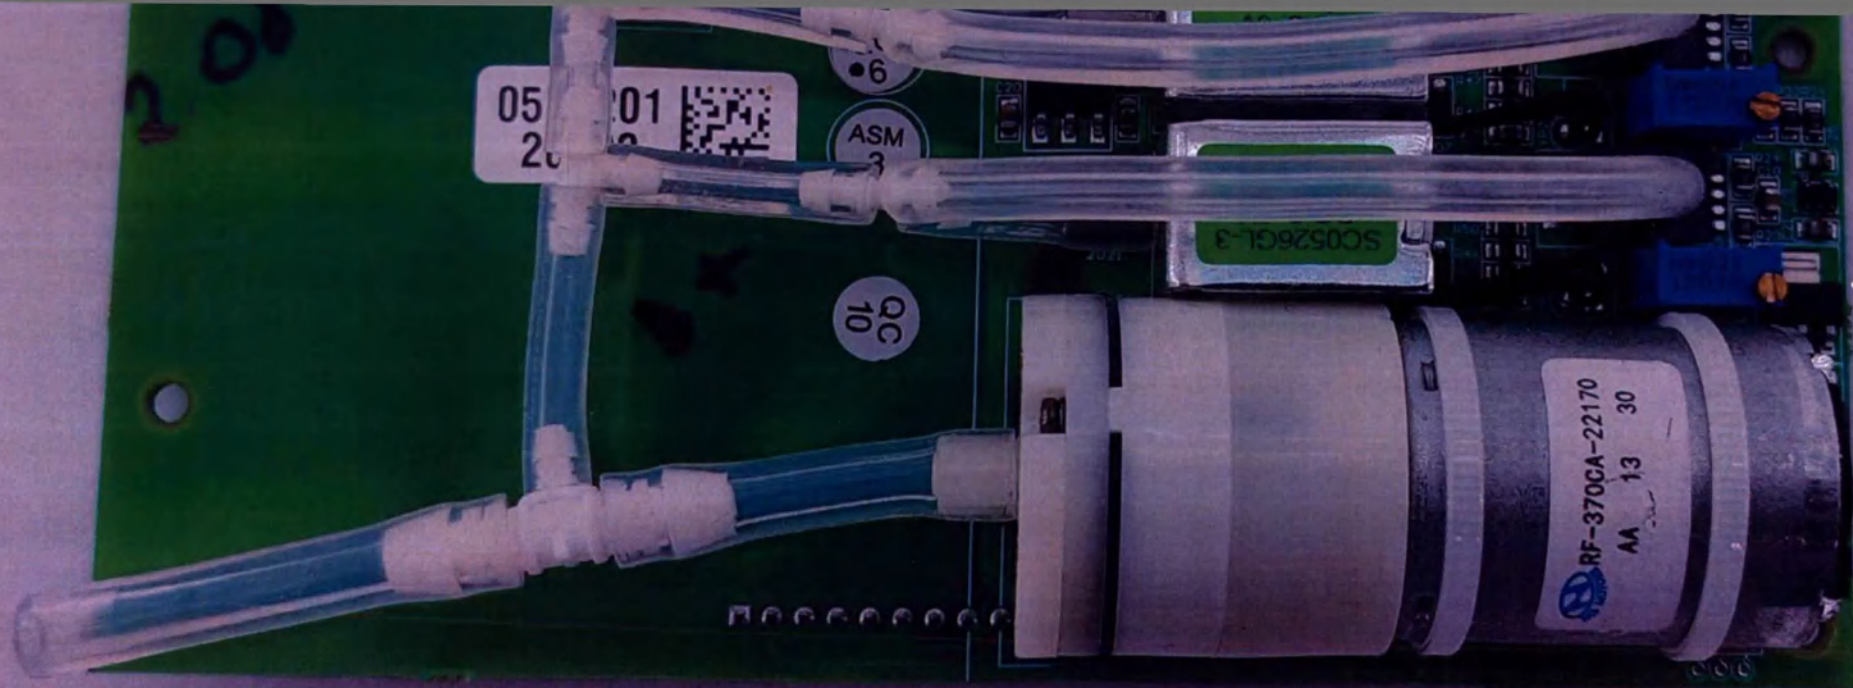


Модуль АД, МТЦ.81.07.501





Модуль АД, МТЦ.81.07.501

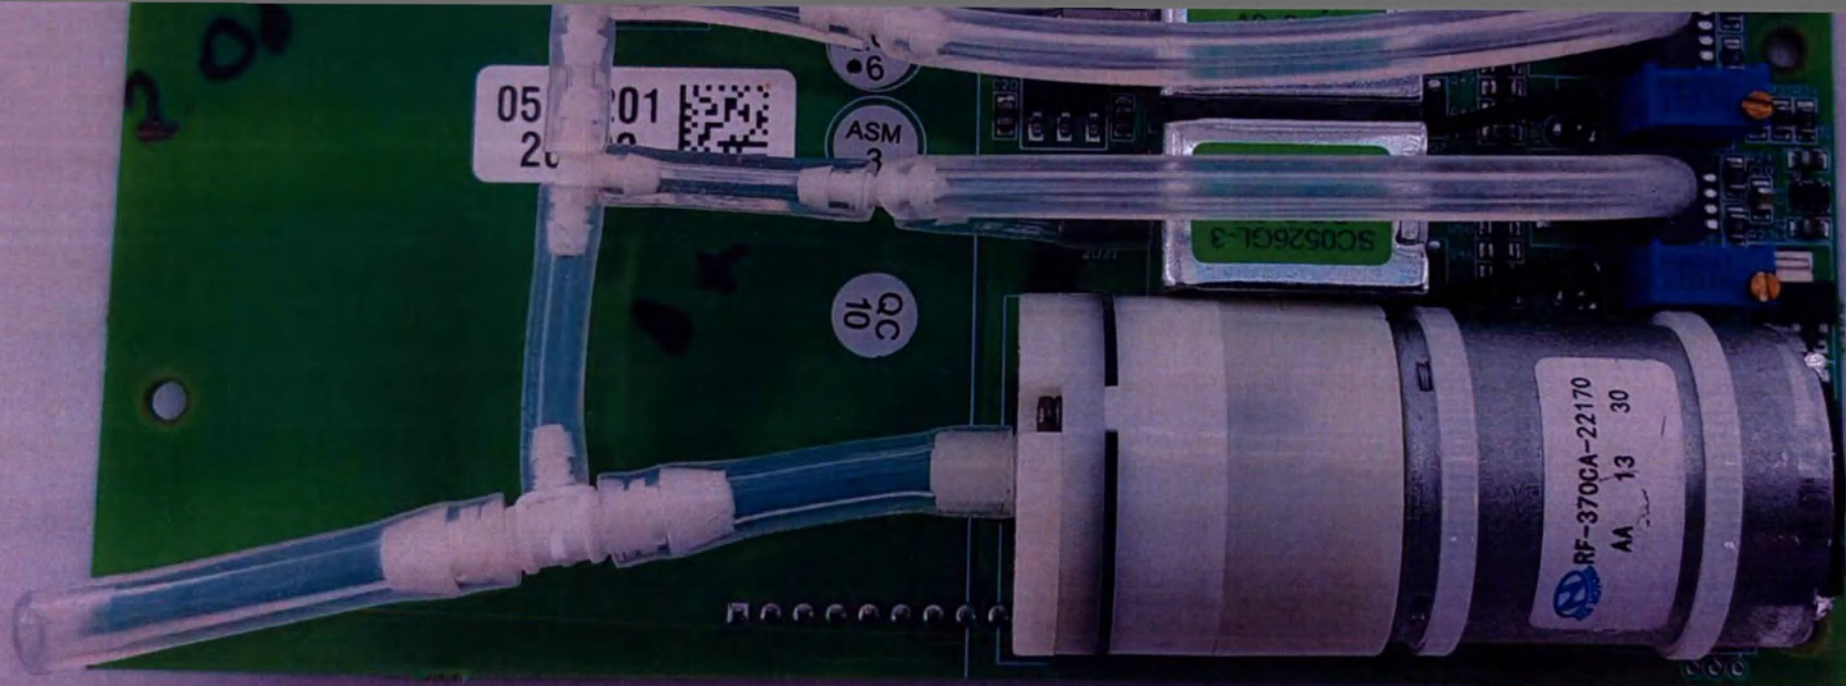

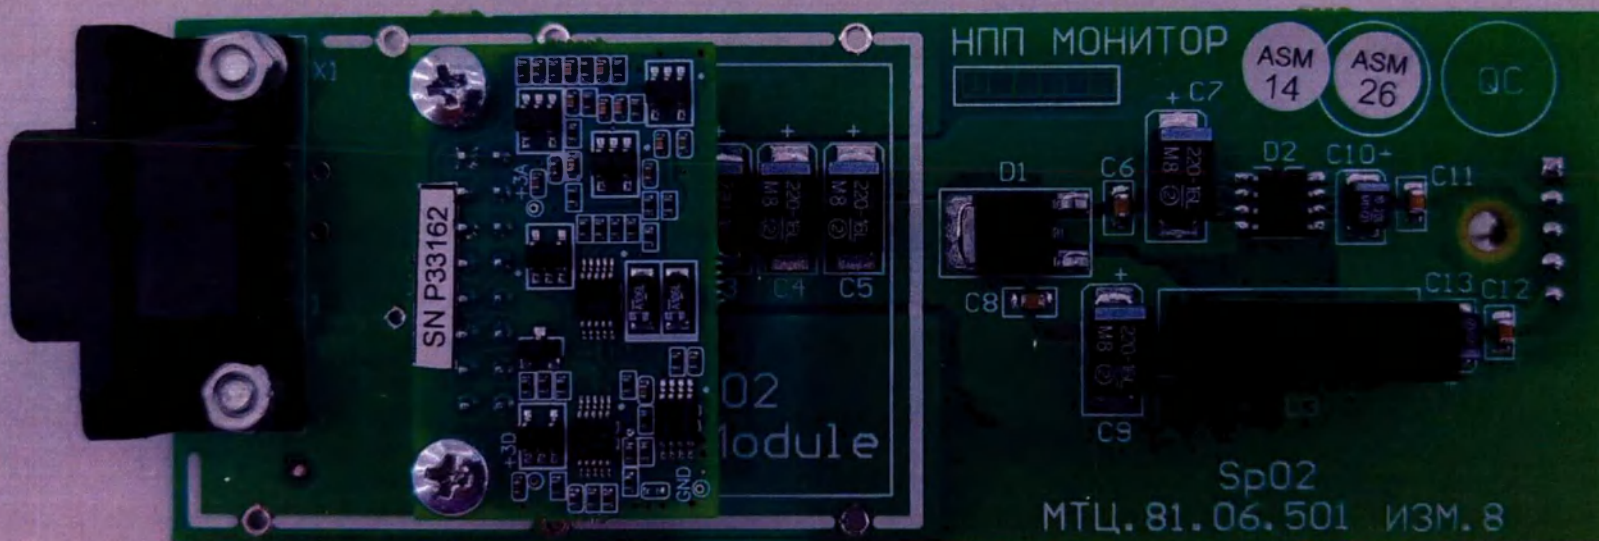


Модуль SpO₂, МТЦ.81.06.501

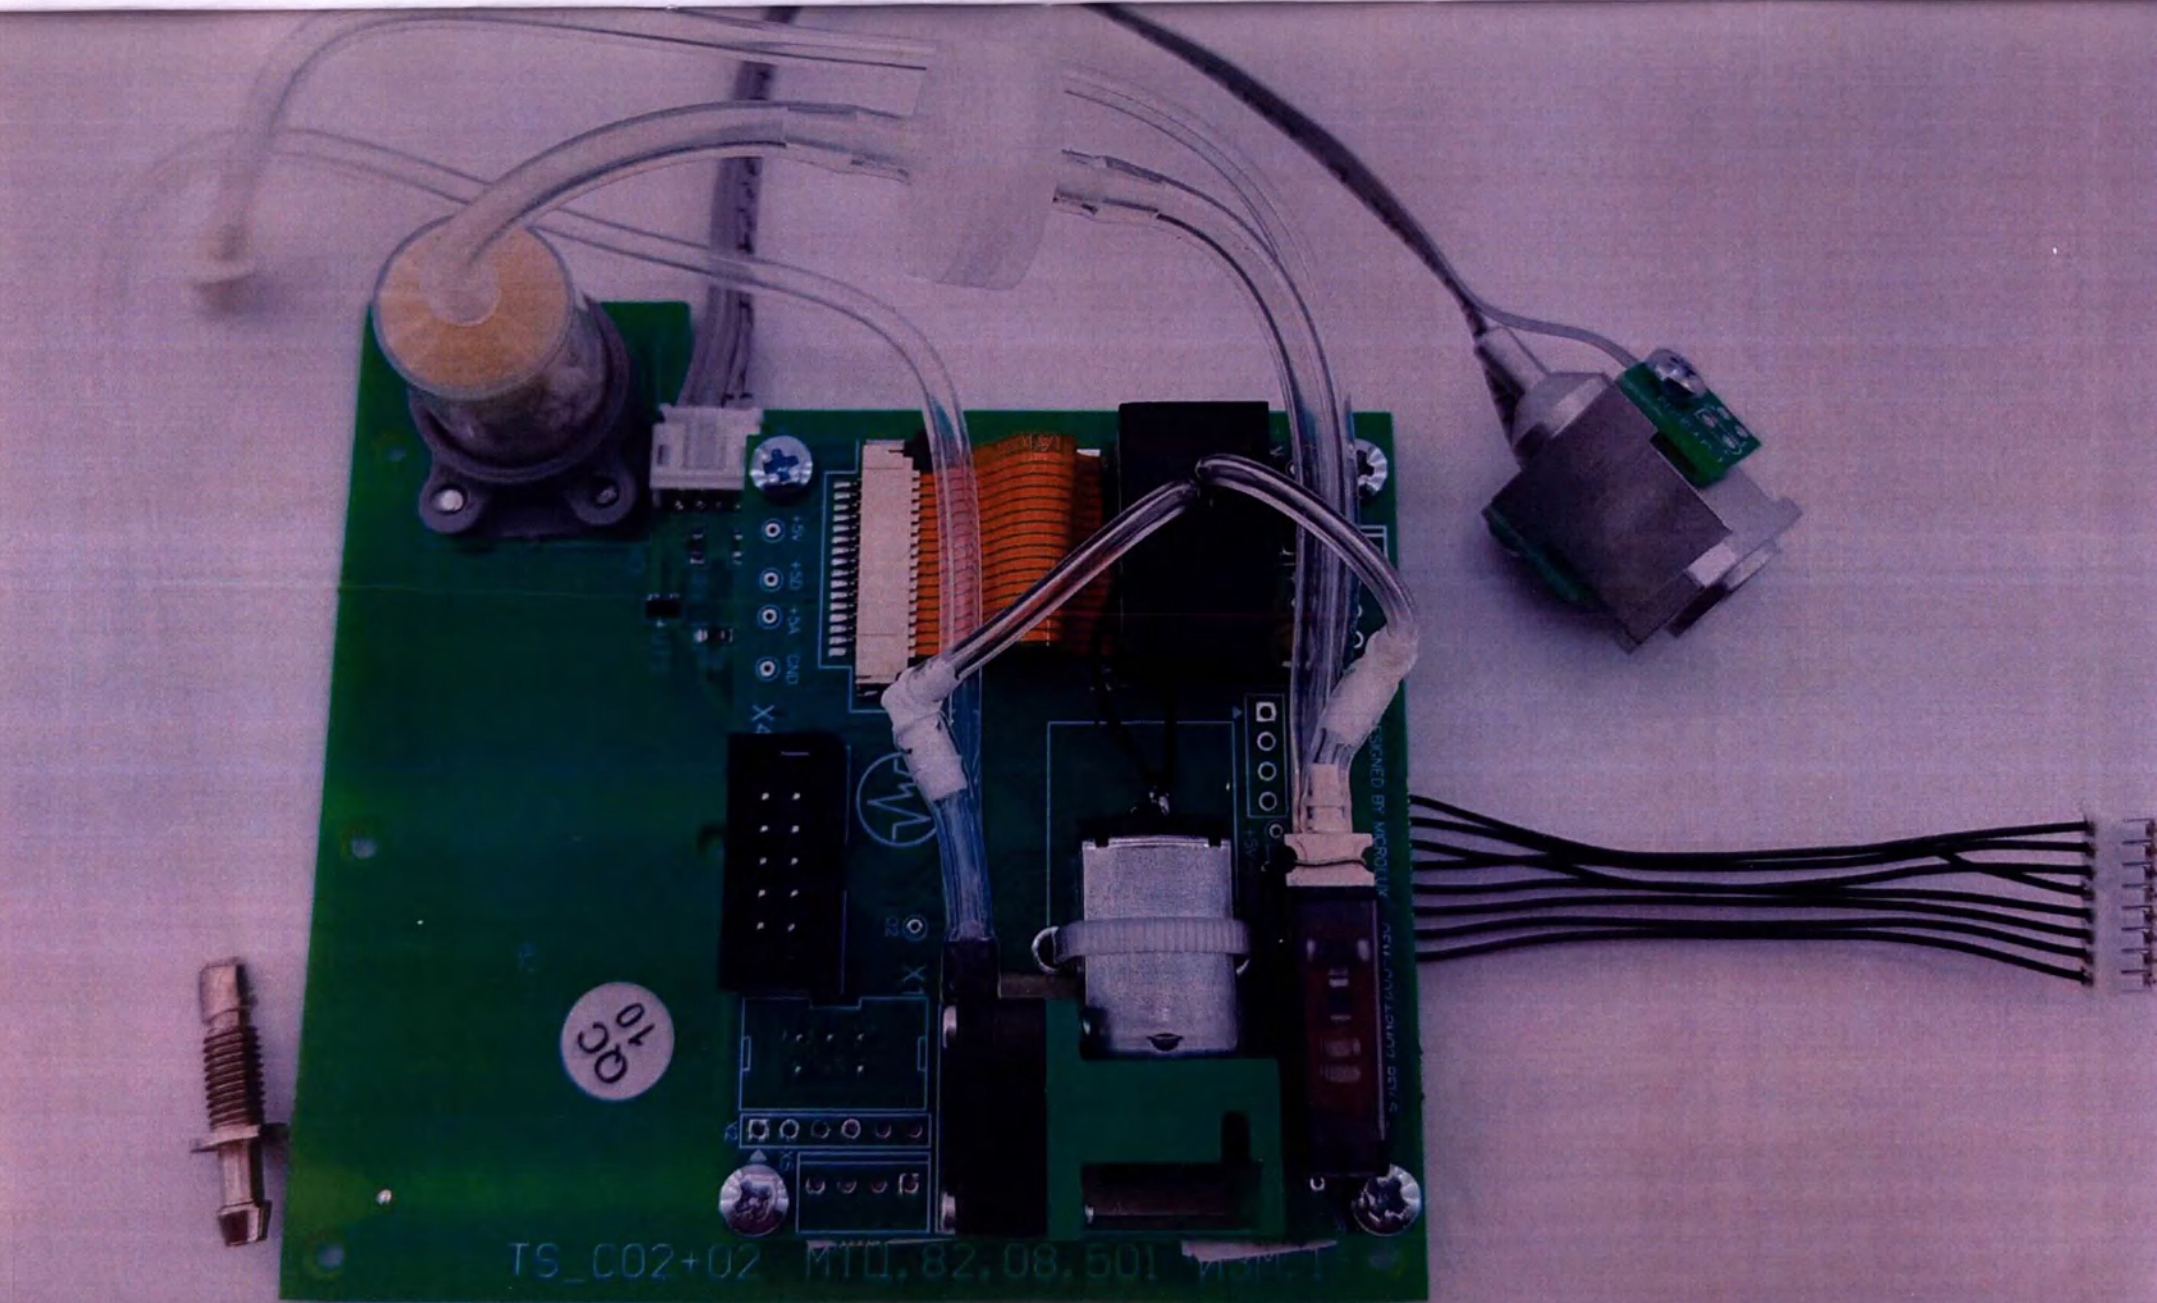


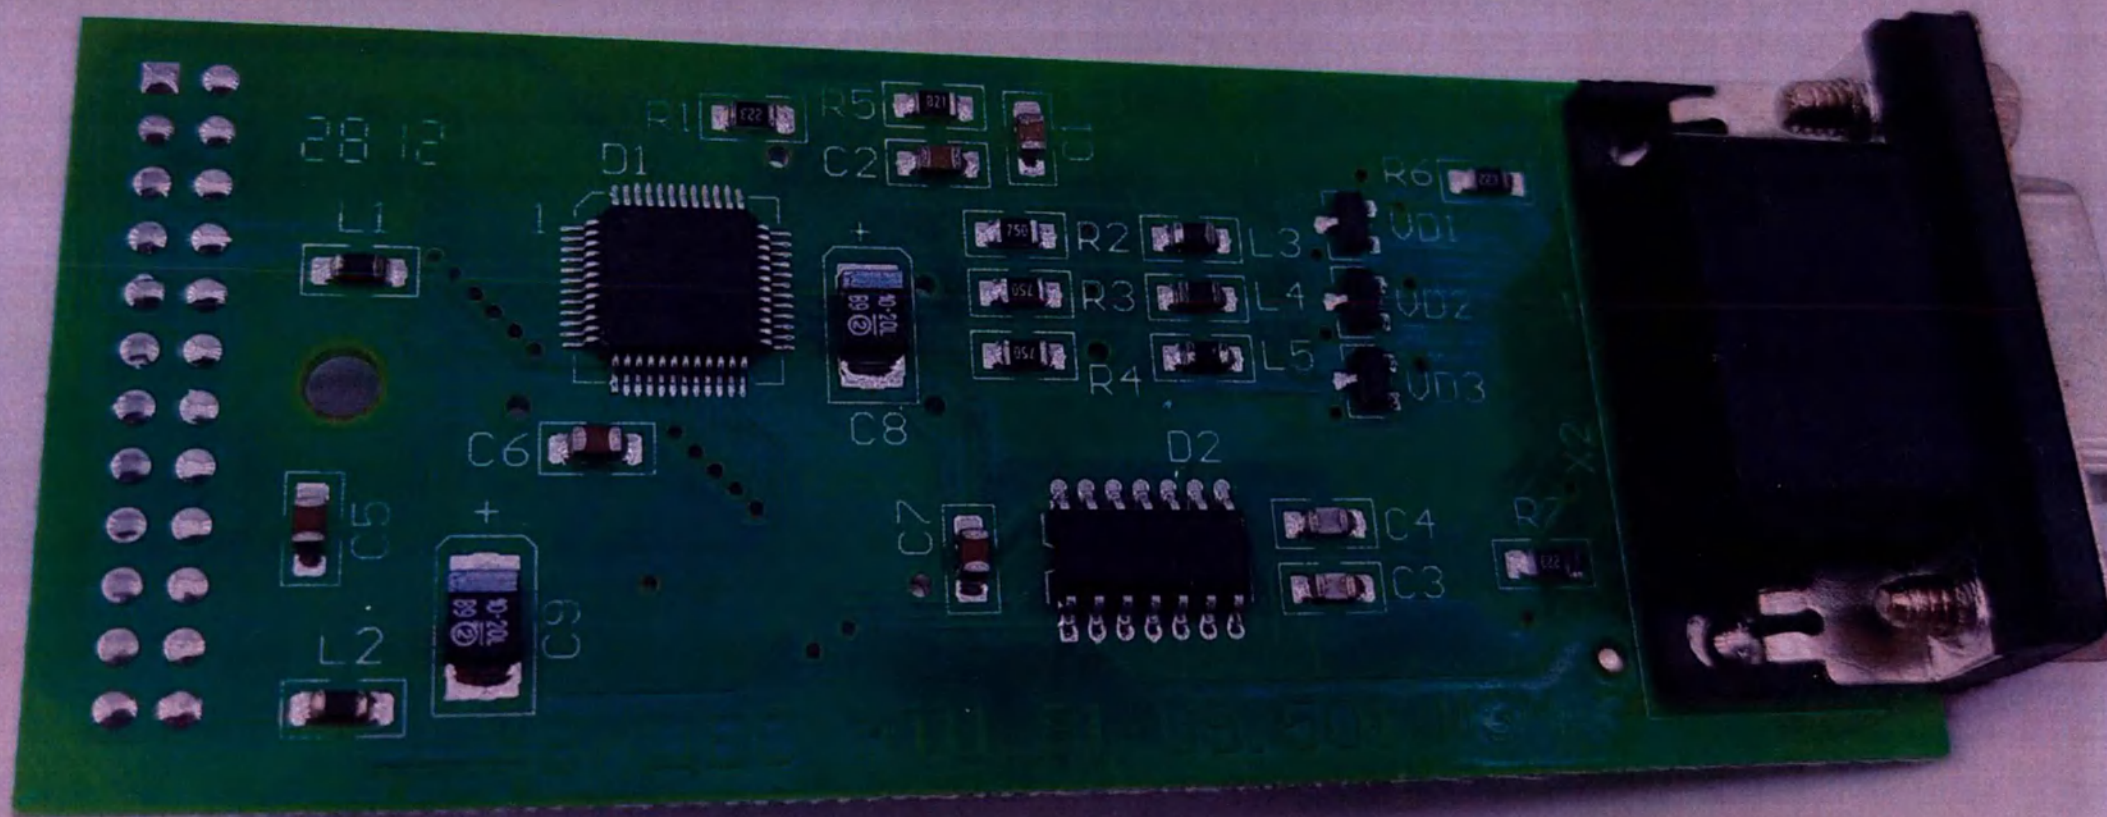

Модуль видео, МТЦ.81.09.501

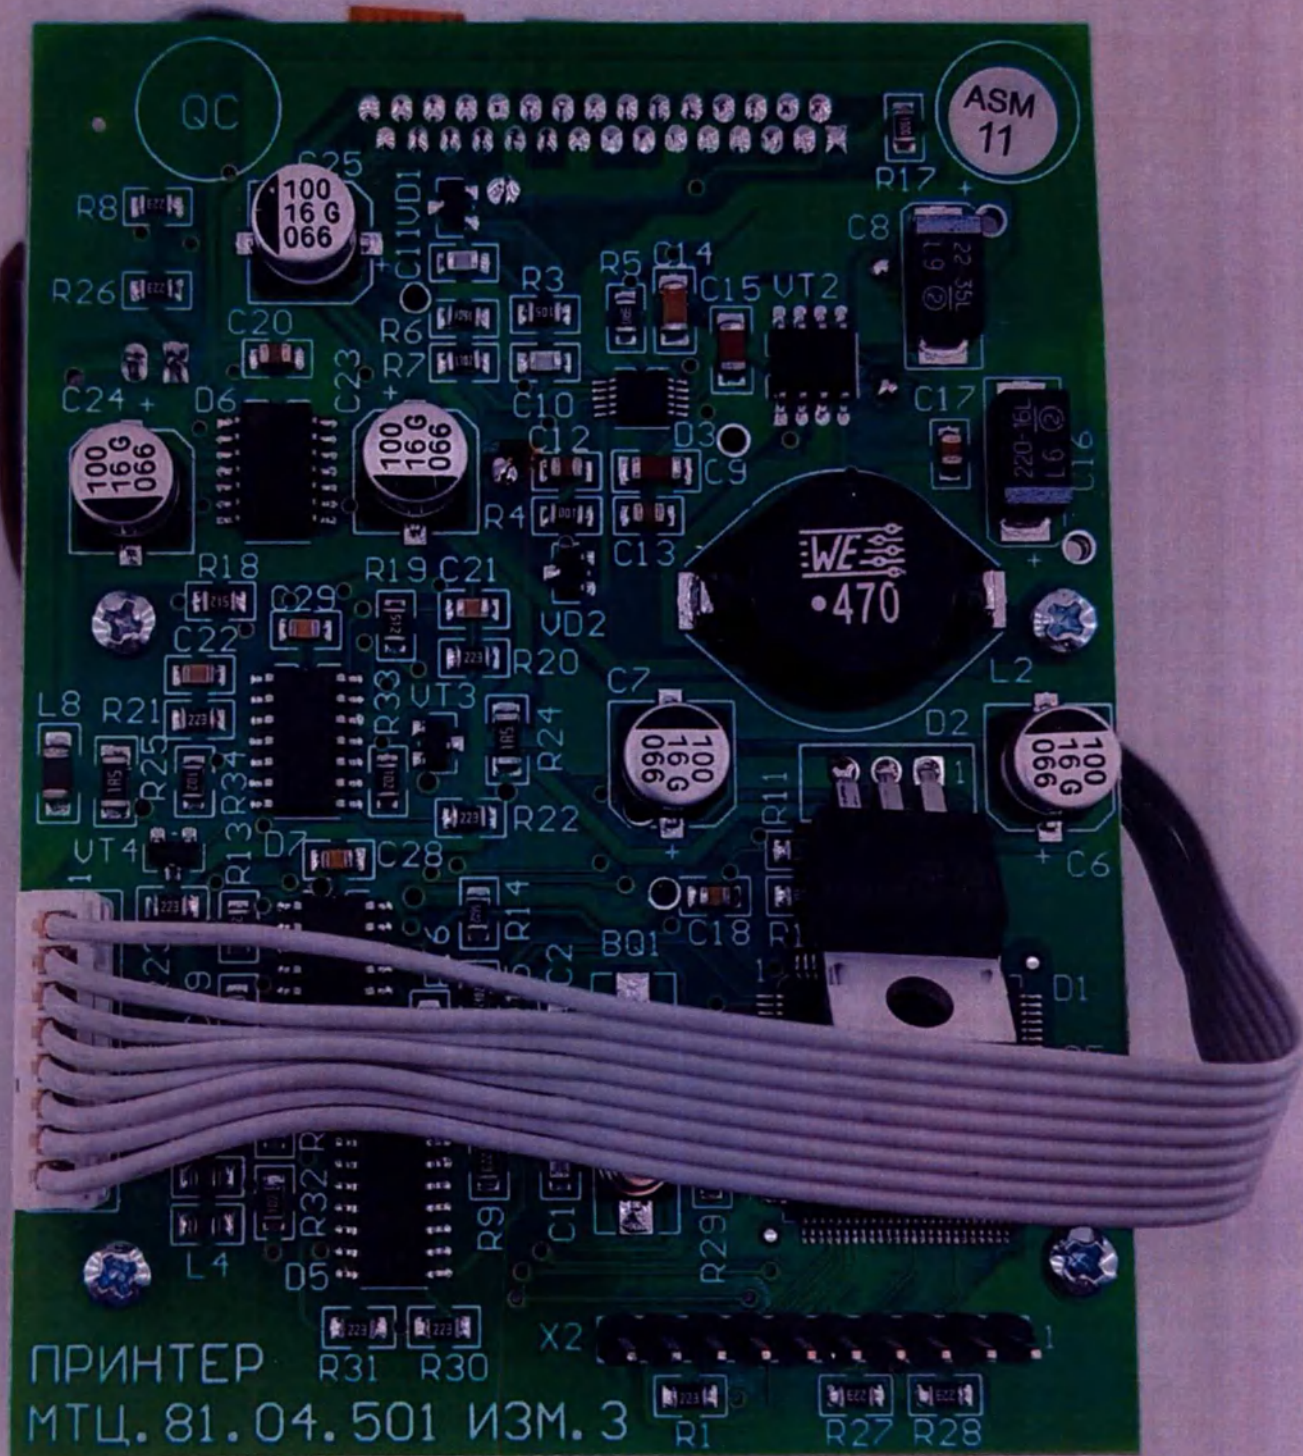


Модуль термопринтера,
МТЦ.81.04.501

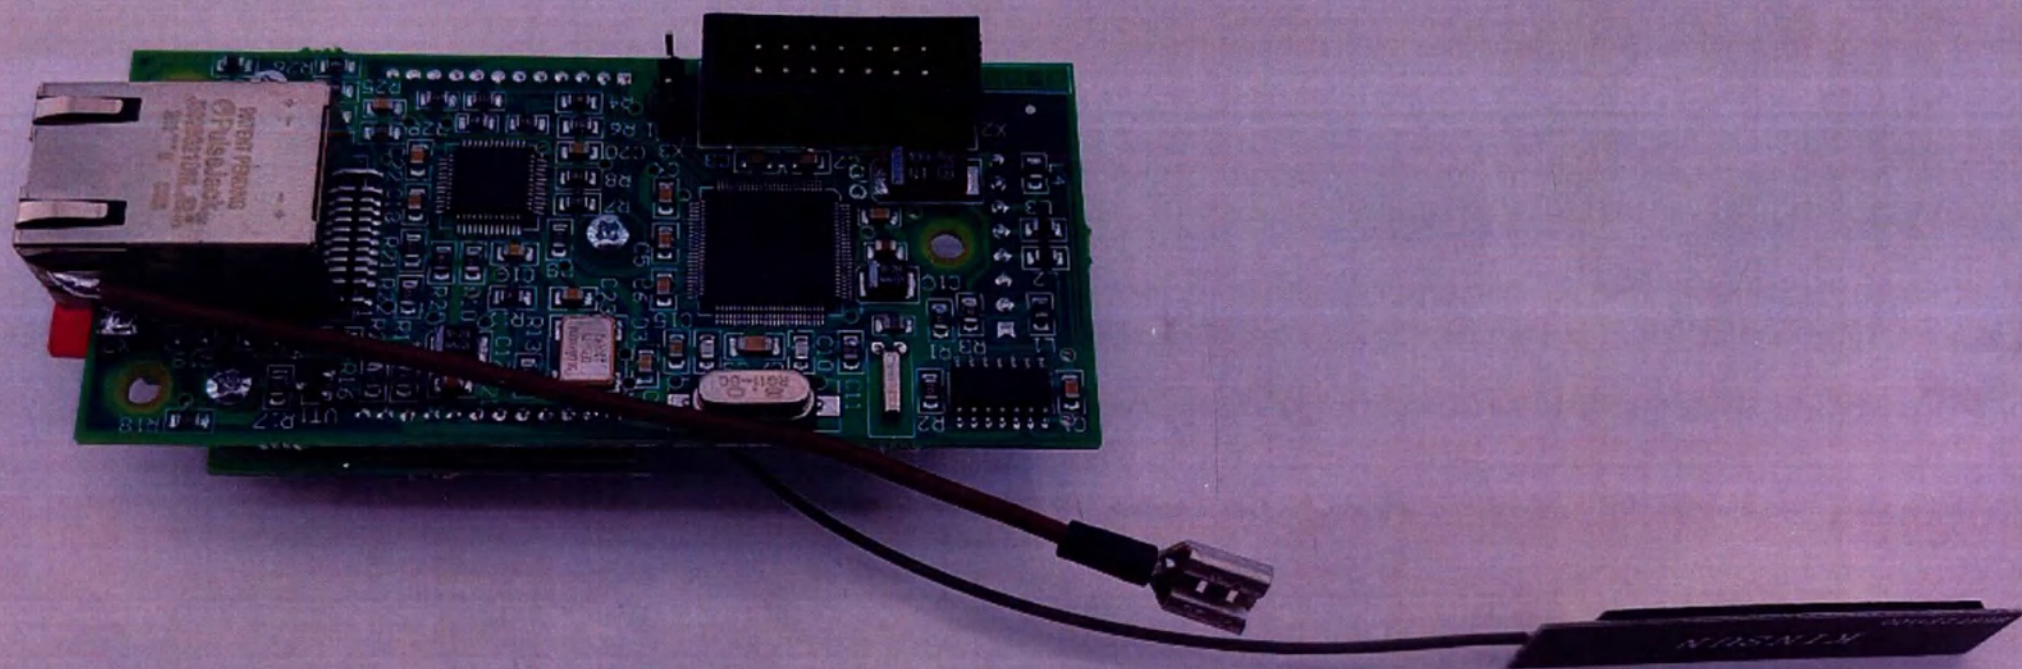


Модуль центральной станции с картой
памяти, МТЦ.81.10.501


Модуль MULTI, МТЦ.82.21.501

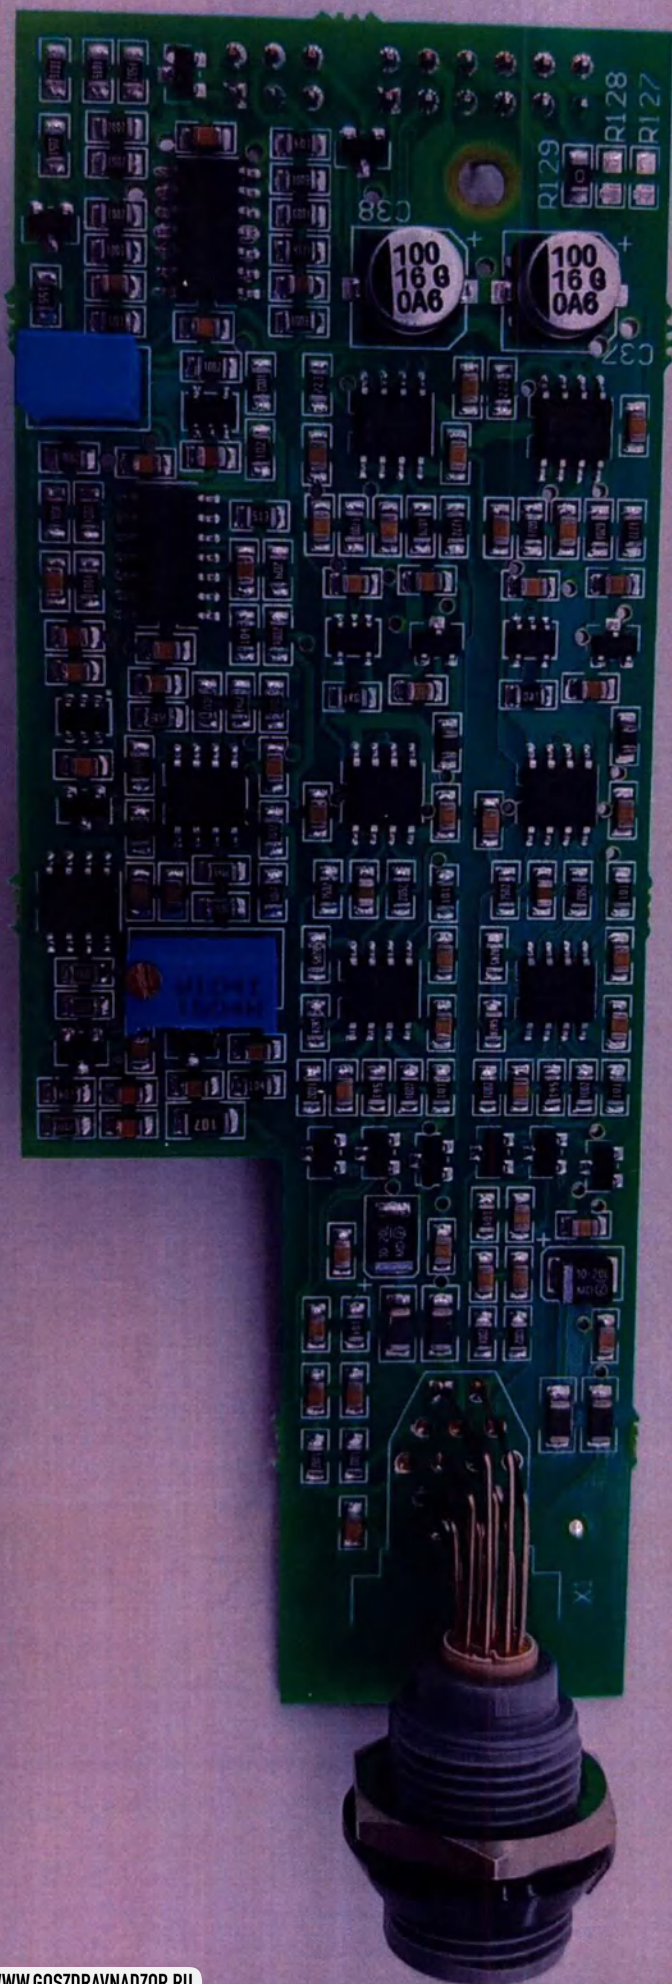


Модуль 1хИД, МТЦ.82.16.501

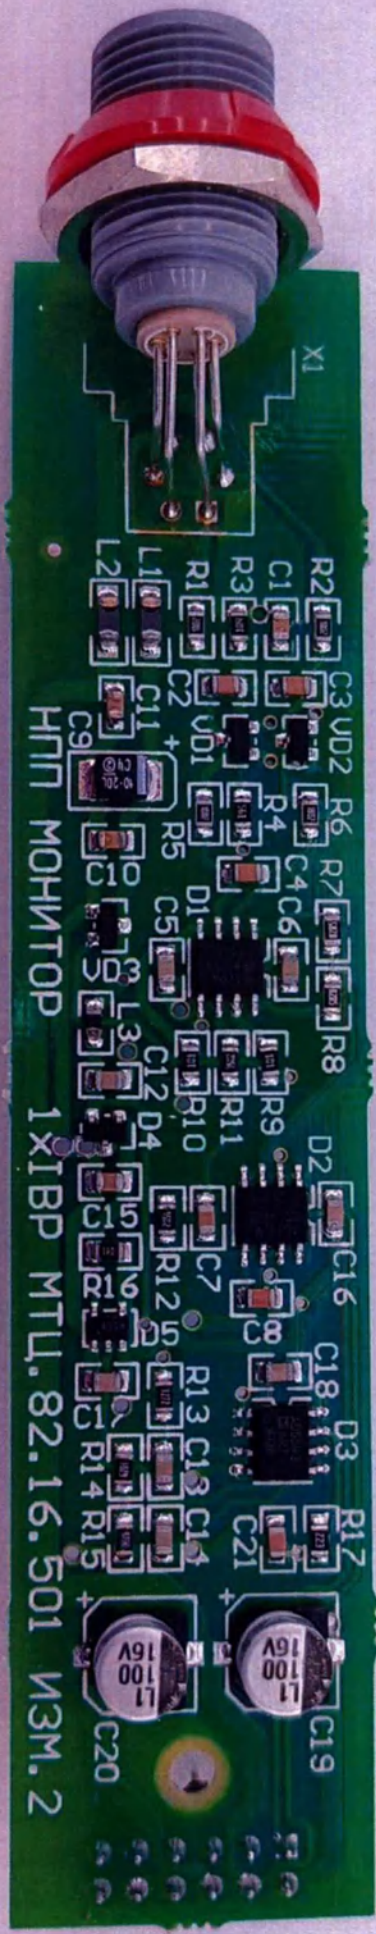

Модуль 2x1M, МТЦ.82.22.501

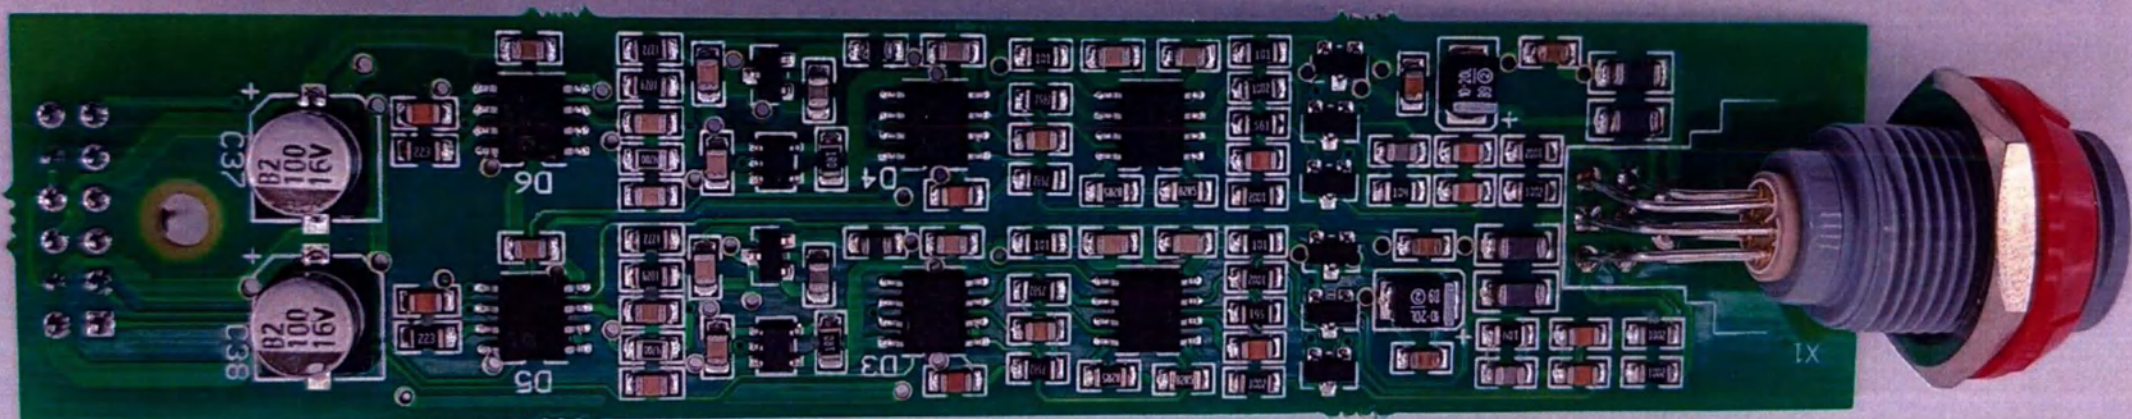

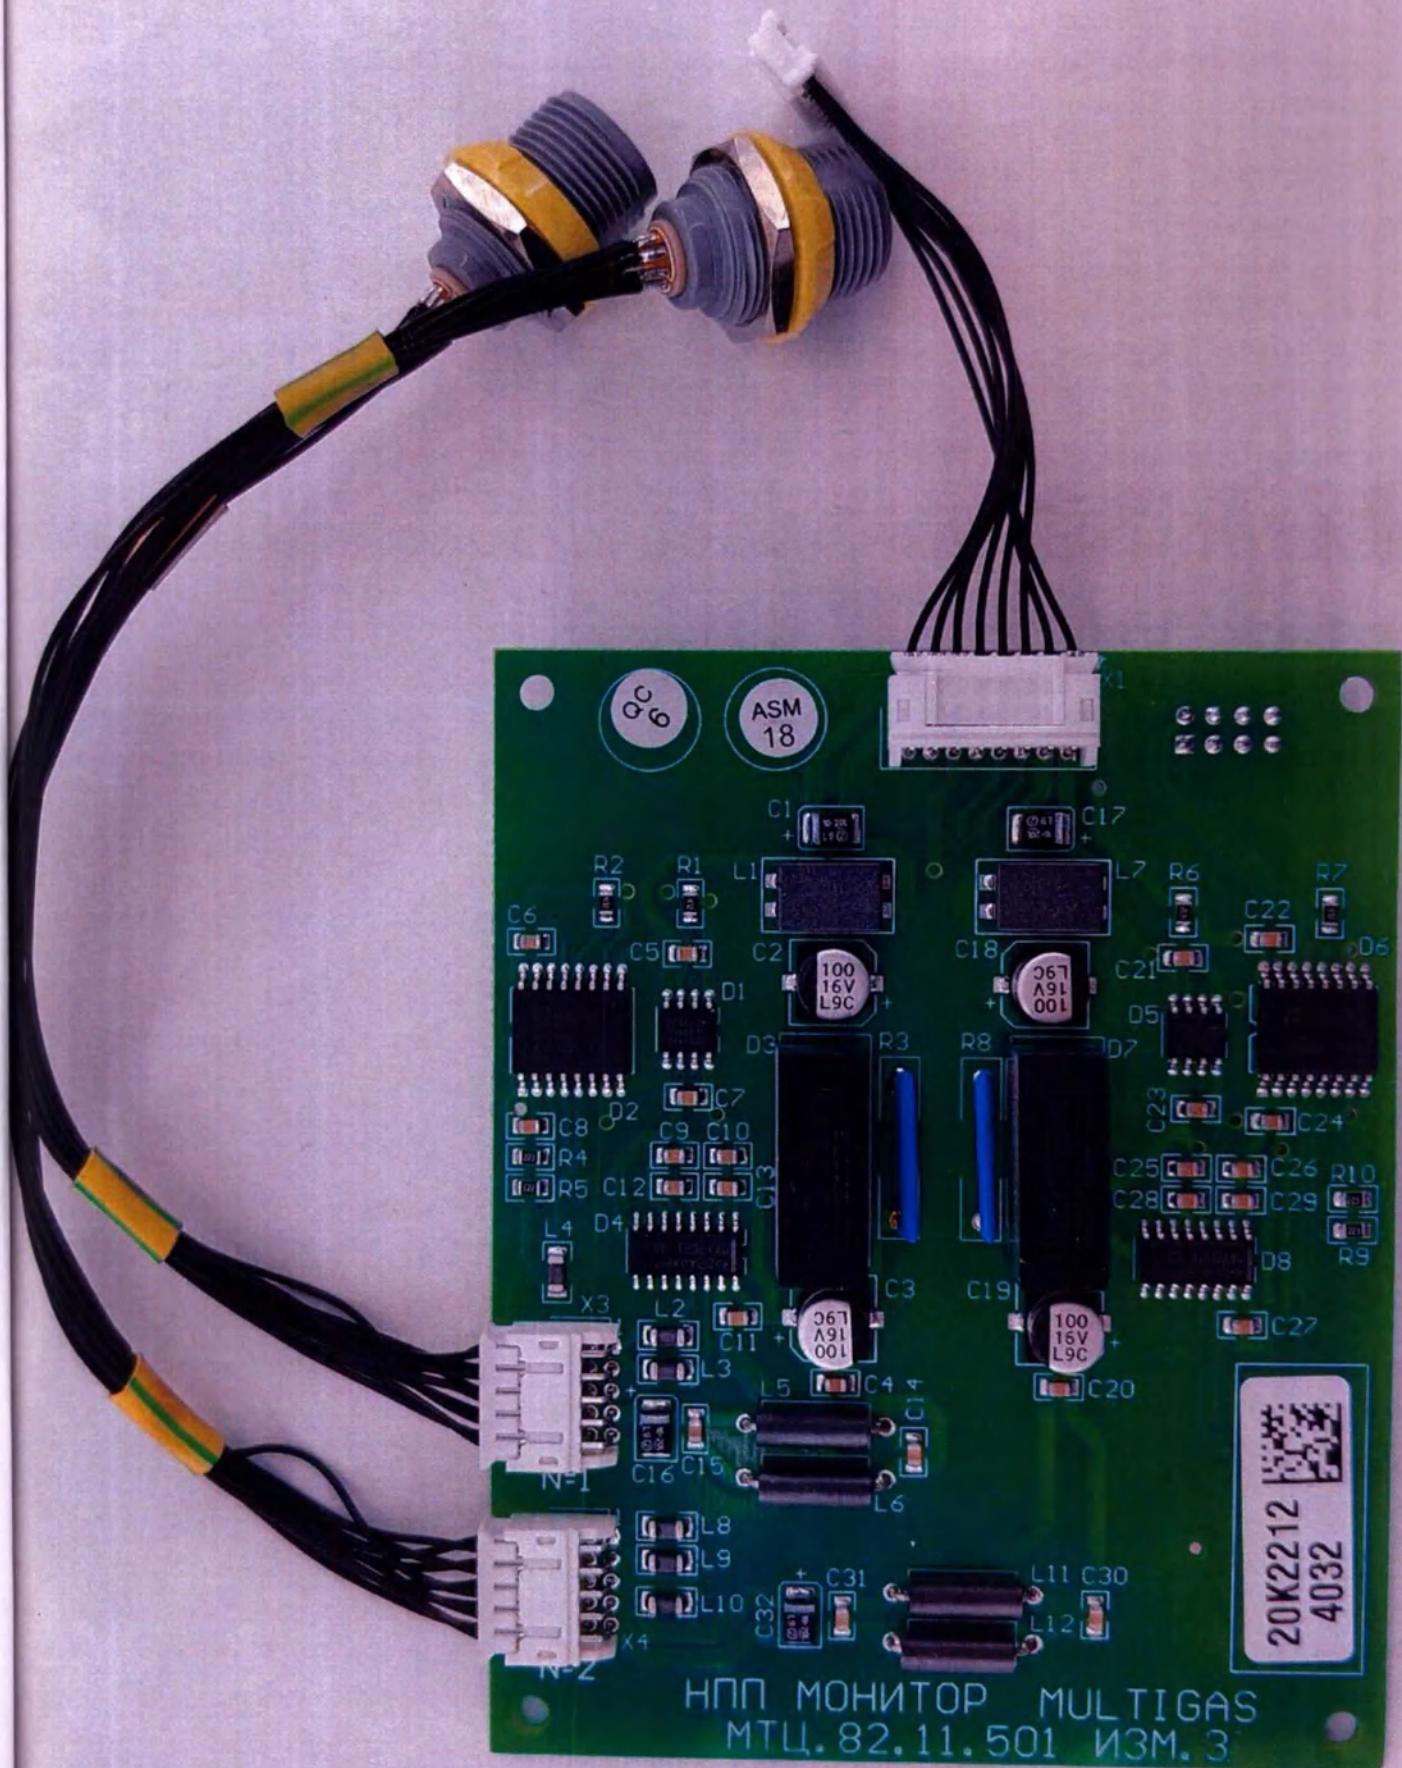


Модуль MGAS, МТЦ.82.11.501

Разветвители ИД, МТЦ.82.22.601



Кабель электродный ЭКГ 3,
МТЦ.82.15.601

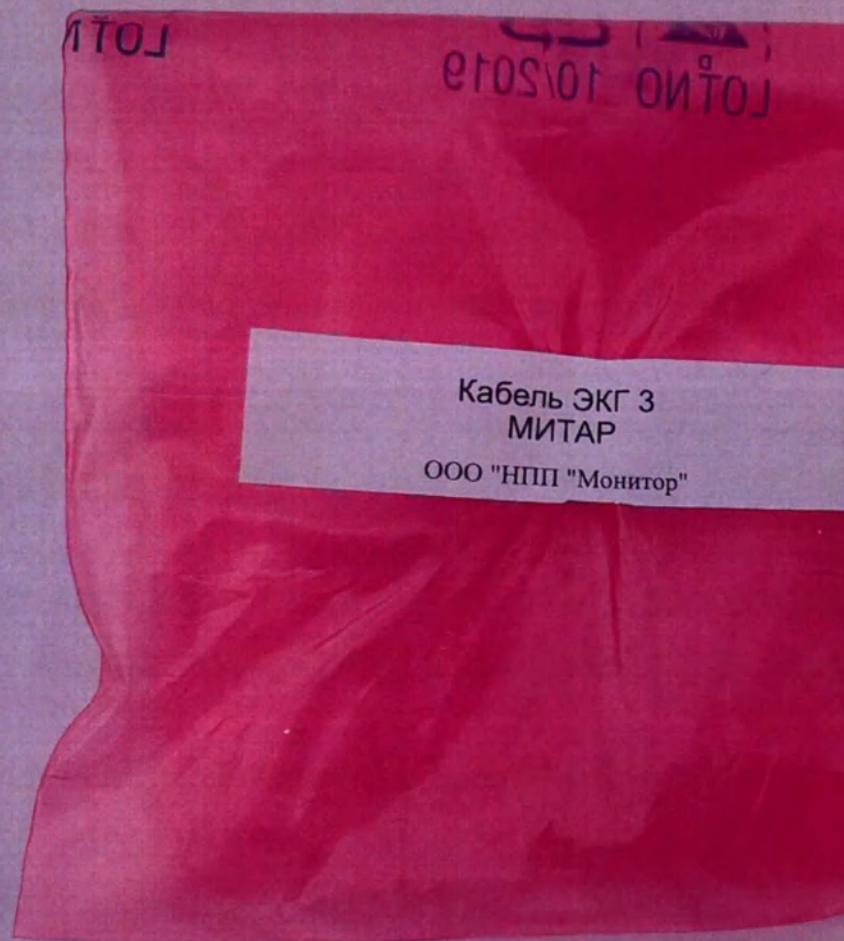

Кабель электродный ЭКГ 5,
МТЦ.82.16.601



Кабель ЭКГ 5
МИТАР
ООО "НПП "Монитор"




Кабель электродный ЭКГ 6,
МТЦ.82.31.601



SX10
LOT NO 06/2019
SX10
LOT NO 06/20

Кабель ЭКГ 6
МИТАР
ООО "НПП "Монитор"

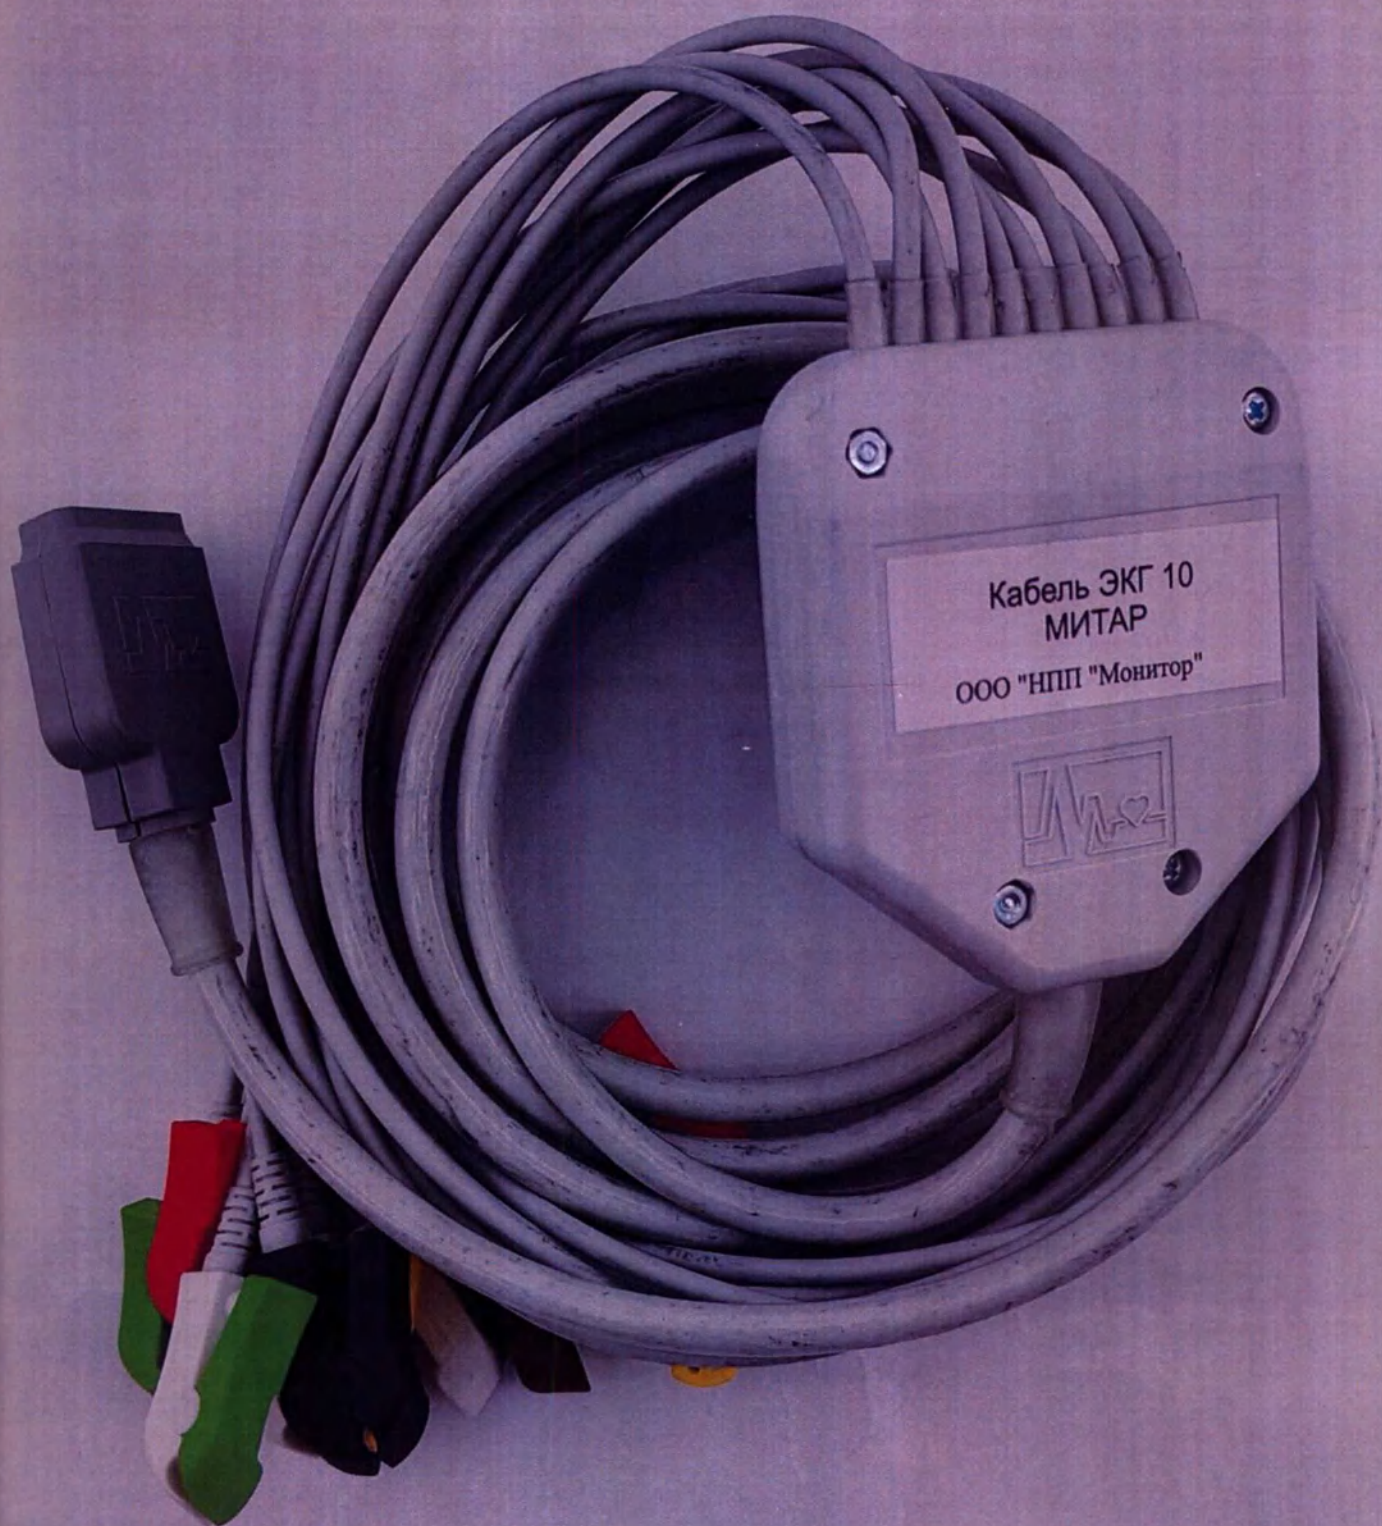

Кабель электродный ЭКГ 10,
МТЦ.82.21.601

EN ECG ELECTRODES
DE EKG-ELEKTRODEN
FR ELECTRODES ECG
IT ELETTRODI PER ECG



SKINTACT®

www.skintact.com

PREMIER

022041120800

30 x REF F-55



UDI



GTRN 19005531000725

LOT 220214-0171

2024-02-14

(01)19005531000725(10)220214-0171(17)240214



Made in Austria

Made in Austria



Leonhard Lang GmbH, Archenweg 56, 6020 Innsbruck, Austria; fax +43 512 392210, medical@LeonhardLang.at



ЭКГ электроды серии Skintact, типов F, FS,
 РУ №ФСЗ 2011/09805 от 25.06.2011 г.



Манжета АД многоразовая


Неонатальная; размер 8-13см; Двухтрубная

Кол-во: 1шт

REF V0121C

Заказ №: VM220112H

MD LOT 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
Ул. Краснокурская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

Изготовитель:
ООО "Петр Телегии"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Манжета АД (неонатальная), V0121C,
РУ №РЗН 2007/00592 от 25.05.2018 г.

Манжета АД многоразовая

Детская; размер 12-19см; Двутрубная

Кол-во: 1шт

REF V0122C

Заказ №: VM220112H

MD **LOT** 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
ул. Краснокурсантская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

 Изготовитель:
ООО "Петр Телегин"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Манжета АД (детская), V0122C,

BPlab®

BLOOD PRESSURE

Манжета АД многоразовая


Детская; размер 17-25см; Двутрубная

Кол-во: 1шт

REF V0123C

Заказ №: VM220112H

MD LOT 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
ул. Краснокурсантская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

Изготовитель:
ООО "Петр Телегин"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Манжета АД (взрослая), V123C,
РУ №РЗН 2007/00592 от 25.05.2018 г.

Манжета АД многоразовая


Взрослая; размер 23-33см; Двутрубная

Кол-во: 1шт

REF V0124C

Заказ №: VM220112H

MD LOT 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
ул. Краснокурская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

Изготовитель:
ООО "Петр Телегин"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Манжета АД (взрослая), V0124C,
РУ №РЗН 2007/00592 от 25.05.2018 г.

® ООО Petr Telegin

Манжета АД многоразовая
Взрослая; размер 31-40см; Двугрубная

Кол-во: 1шт

REF V0125C

Заказ №: VM220112H

MD LOT 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
ул. Краснокурская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

Изготовитель:
ООО "Петр Телегин"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Latex free

Манжета АД (взрослая), V0125C,
РУ №РЗН 2007/00592 от 25.05.2018 г.

Манжета АД многоразовая


Взрослая; размер 38-50см; Двутрубная

Кол-во: 1шт

REF V0126C

Заказ №: VM220112H

MD **LOT** 01-2022



Заказчик:
ООО "НПП "Монитор"
ул. Краснокурская, 104а,
г. Ростов-на-Дону, Россия
+7 863 231 04 01 (02, 03, 11)

Изготовитель:
ООО "Петр Телегин"
Россия, г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, 37Д
+7 831 212 41 41

Манжета АД (взрослая), V0126C,
ПУ №РЗН 2007/00592 от 25.05.2018 г.

www.med-link.com

Speciality for getting and transferring signals

Device name: Non-Invasive Blood Pressure (NIBP) Cuff

Model No: Y000DSN2-1#

REF: OBM-Y0096A

LOT: SX202204280002

SIN: See Cable

Quantity: 1 piece

Compatible: Patient monitor

Shenzhen Med-link Electronics Tech. Co., Ltd.
4th and 5th floor, Building Two, He Community, Daling Street, Longhua District, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
http://www.med-link.com
E-mail: sales@med-link.com
User Feedback: feedback@med-link.com
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (S.I.H.)
Elmstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

CE

2022-04-28

2024-04-27

MD

Model No: Y000DSN2-2#

REF: OBM-Y0097A

LOT: SX202204280004

SIN: See Cable

Quantity: 1 piece

Compatible: Patient monitor

Shenzhen Med-link Electronics Tech. Co., Ltd.
4th and 5th floor, Building Two, He Community, Daling Street, Longhua District, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
http://www.med-link.com
E-mail: sales@med-link.com
User Feedback: feedback@med-link.com
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (S.I.H.)
Elmstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

CE

2022-04-28

2024-04-27

MD

www.med-link.com

Speciality for getting and transferring signals

Наименование: Манжета АД одноразовая неонатальная

Model No: Y000DSN2-3#

REF: OBM-Y0098A

LOT: SX202212220013

SIN: See Cable

Quantity: 1 шт.

Compatible: Patient monitor

Shenzhen Med-link Electronics Tech. Co., Ltd.
4th and 5th floor, Building Two, He Community, Daling Street, Longhua District, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
http://www.med-link.com
E-mail: sales@med-link.com
User Feedback: feedback@med-link.com
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (S.I.H.)
Elmstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

CE

2022-12-22

2024-12-21

MD

www.med-link.com

Speciality for getting and transferring signals

Наименование: Манжета АД одноразовая неонатальная

Model No: Y000DSN2-4#

REF: OBM-Y0099A

LOT: SX202204280005

SIN: See Cable

Quantity: 1 piece

Compatible: Patient monitor

Shenzhen Med-link Electronics Tech. Co., Ltd.
4th and 5th floor, Building Two, He Community, Daling Street, Longhua District, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
http://www.med-link.com
E-mail: sales@med-link.com
User Feedback: feedback@med-link.com
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (S.I.H.)
Elmstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

CE

2022-04-28

2024-04-27

MD

www.med-link.com

Speciality for getting and transferring signals

Наименование: Манжета АД одноразовая неонатальная

Model No: Y000DSN2-5#

REF: OBM-Y0100A

LOT: SX202204280006

SIN: See Cable

Quantity: 1 piece

Compatible: Patient monitor

Shenzhen Med-link Electronics Tech. Co., Ltd.
4th and 5th floor, Building Two, He Community, Daling Street, Longhua District, SHENZHEN, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
http://www.med-link.com
E-mail: sales@med-link.com
User Feedback: feedback@med-link.com
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (S.I.H.)
Elmstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

CE

2022-04-28

2024-04-27

MD

Манжета АД (одноразовая неонатальная), Y000DSN2-1#, Y000DSN2-2#, Y000DSN2-3#, Y000DSN2-4#, Y000DSN2-5#

шланг манжеты АД - 2м
МИТАР

ООО "НПП "Монитор"

шланг манжеты АД
МИТАР

ООО "НПП "Монитор"

Шланги для подключения манжеты АД,
МТЦ.82.18.601



Датчик пульсоксиметрический Nellcor (взрослый), S0010D-L



атчик пульсоксиметрический Nellcor (взрослый)
0010D-S



атчик пульсоксиметрический Nellcor
S0010B-S






Датчик пульсоксиметрический Nellcor (детский), S0010E-L

Датчик пульсоксиметрический Nellcor (детский), S0010C-L



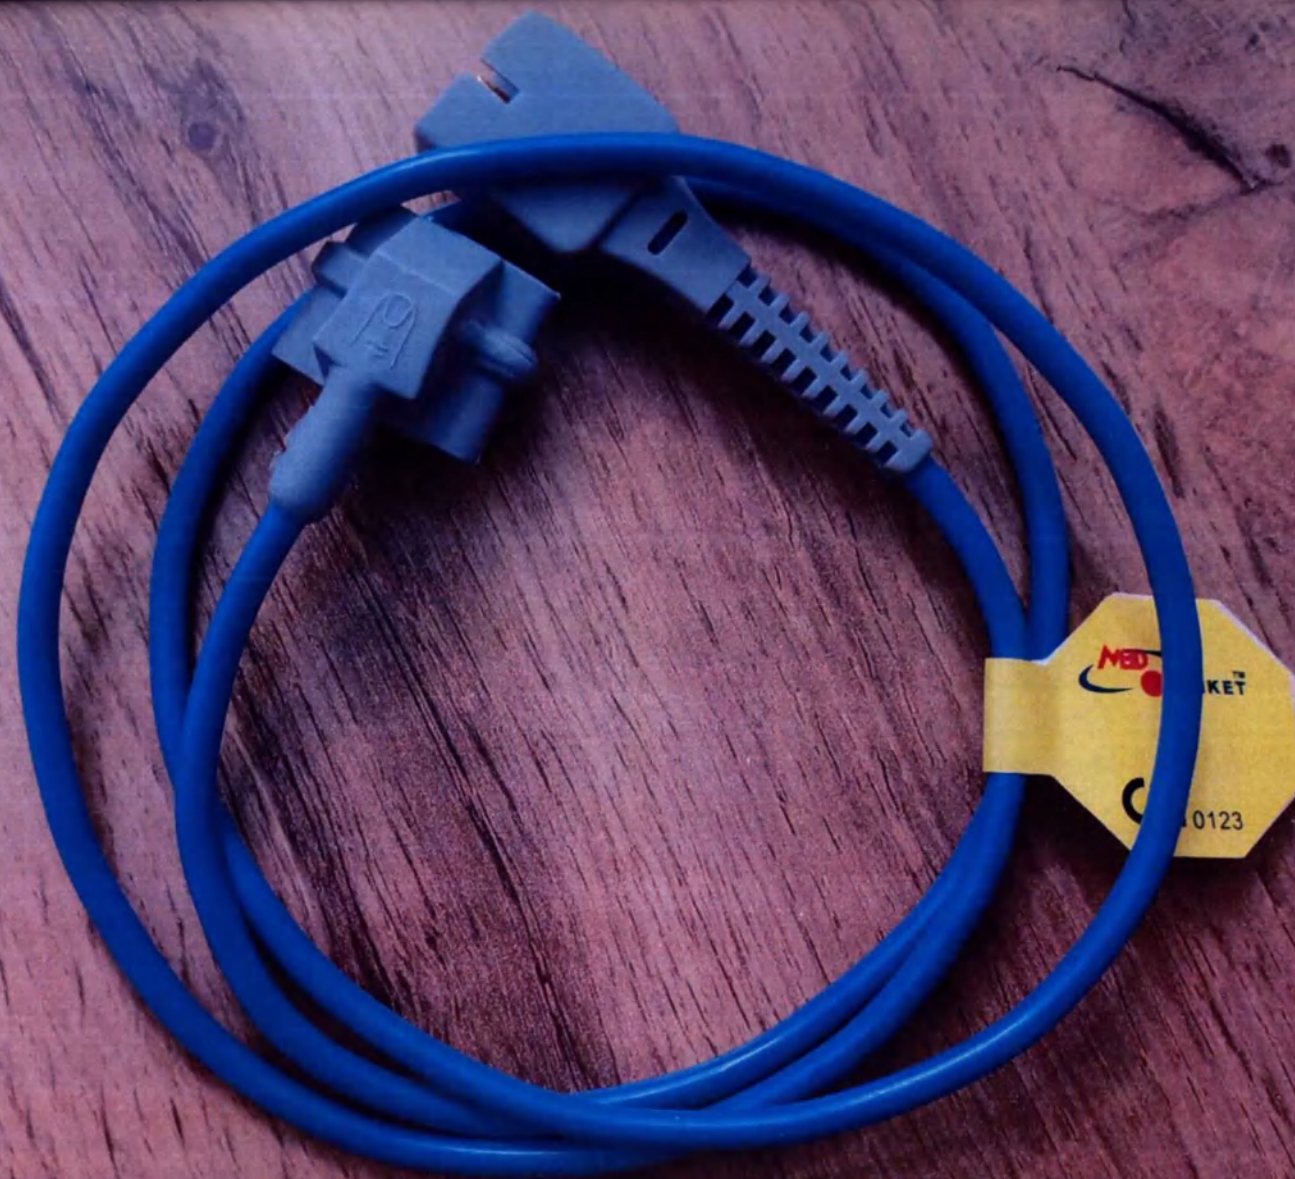

Датчик пульсоксиметрический Nellcor (детский), S0010E-S



Датчик пульсоксиметрический Nellcor
(детский), S0010C-S

Датчик пульсоксиметрический Nellcor (неонатальный), S0010F-L



MedLinket
Model No.: S0010F-L
LOT LA20211104014
REF OBM-S0086A



Датчик пульсоксиметрический Nellcor (неонатальный), S0010F-S

Do not use if pack is damaged
Keine beschädigte Verpackung verwenden

EO
Processed
Arrow Turns Brown in
Ethylene Oxide Gas

MedLinket

Specialize in getting and transferring life signals

Disposable Pulse Oximeter Probe (SpO₂ Sensor)



>10kg



3~20kg



<3kg

Contains: 1 piece

- Compatible:
- ☐ BCI oximeters
 - ☐ CSI oximeters
 - ☐ Datascope patient monitor
 - ☐ Datex patient monitor
 - ☐ Ohmeda oximeters
 - ☐ Dolphin oximeters
 - ☐ Nonin oximeters
 - ☒ Nellcor oximeters
 - ☐ Nihon Kohden patient monitor
 - ☐ Novamatrix patient monitor
 - ☐ Palco oximeters
 - ☐ _____

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4th and 5th Floor, Building Two, Hualian Industrial Zone, Xinshi
Community, Dalang Street, Longhua District, 518109 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
<http://www.med-linket.com>
E-mail: sales@med-linket.com

Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
LABEL NO.: BZ0117E REV: G.2



Non-Sterile



Caution



Waste electrical
and electronic
equipment must
be disposed of in
accordance with
the local
applicable
regulations, not
with domestic
waste



Single patient use



Refer to instruction
manual/booklet

CE 0123
CE-mark

80%
0%
Humidity limitation

40°C
-10°C
Temperature Limit

RxOnly

Caution: Federal (USA)
law restricts this device to
sale by or on order of a
physician



Type BF Applied Part

IPX2

Protected against
vertically falling water
drops when enclosure
tilted up to 15°

Model NO.: S0010M-L
REF OBM-S0088A

220506 250505
LOT JA20220506037

Одноразовый датчик пульсоксиметрический
(неонатальный/взрослый), S0010M-L

Кабель-удлиннитель SPO2, S0010NE-L







Датчик температуры серии YSI 400 (взрослый), W0001 B



MedLinket

Model No.: W0001C

LOT LA20211014019

REF OBM-W0078C

Датчик температуры серии YSI 400 (детский), W0001 C



Датчик температуры серии YSI 400 (детский), W0001 D



MedLinket

Speciality for getting
and transferring signals

Device name: **Temperature Probes**

Model No.: **W0001E**

PN



OBM-W0078E

LOT

LA20221226014

Quantity: **1 Piece**

Description: **Paediatric , Disposable ,
Skin-surface ,2.252K,0.8M**

Compatible: **YSI-4499**

UDI



(01) 0 6944414 05013 5 (17) 251225 (10) LA20221226014



(01) 0 6944414 05013 5

(17) 251225

(10) LA20221226014



Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4th and 5th Floor, Building Two, Hualian Industrial Zone, Xinshi
Community, Dalang Street, Longhua District, 518109 Shenzhen,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

<http://www.med-linket.com>

E-mail: sales@med-linket.com

User Feedback: feedback@med-linket.com

Made in China

EC REP



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

UK Responsible Person: Lotus Global Co Ltd

Address: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,

England, United Kingdom Tel: 0044-20-70961611

CE 0123



IPX1

Rx Only



2022-12-26



2025-12-25

MD

Do not use if the pack is damaged

Initial Red
Turns Orange


EO

Датчик температуры серии YSI 400 (детский), W0001E



Удлинительный кабель для одноразового датчика температуры, W0001G

Одноразовая линия для капнографии, СА20-007

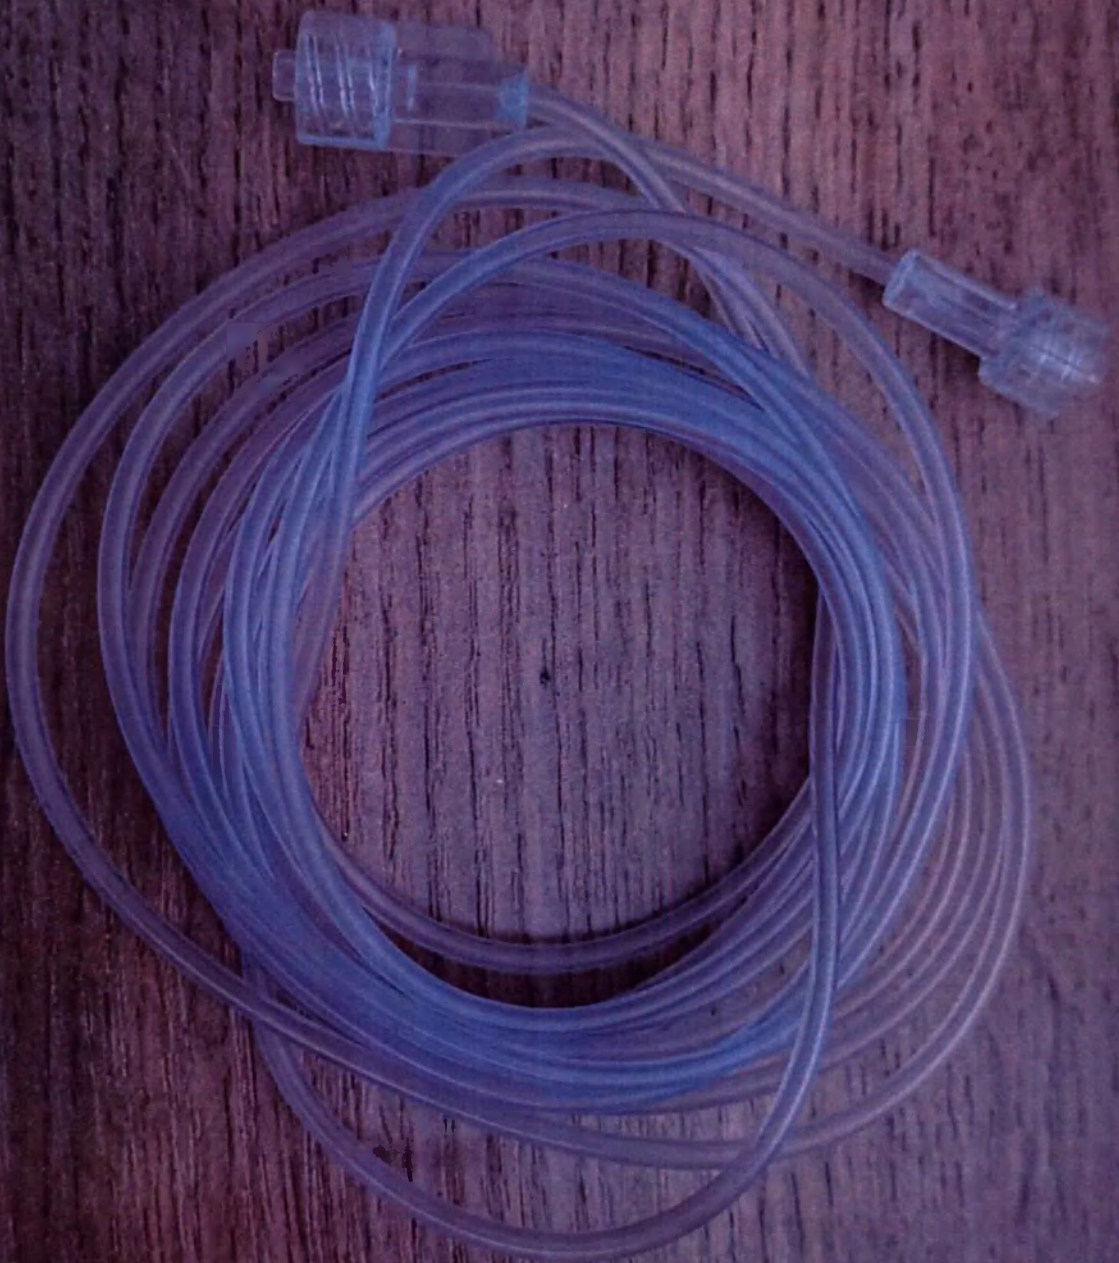

Nasal CO2 Sampling Cannula, Adult

60cm length, Single patient use, Disposable

The sampling cannula is made of medical grade PVC material. The cannula, nares connector and standard size Luer-Lock connectors.

Environment of use: Hospital and sub-acute settings

Patient population: Non intubated patients who are breathing spontaneously.

Introduce for use:

- Remove the sampling line from its outer wrapper and place it carefully on the patient's nose.
- Connect the sampling line to the monitor CO2 adapter.
- Do not use the sampling cannula for venous, arterial or enteral access.

Specifications

Nasal Cannula tube ID 1.2mm, OD 2.4mm

Cautions: Do not use if packet is damaged

Warning: Do not attempt to clean, disinfect, or sterilize the device as it could lead to contamination of the device and may cause infection to patient and staff.

LOT : 20220608

Mfg date: Jun 08th, 2022; Exp. date: Jun 07th, 2023

Mark: this product is not manufactured with natural latex materials

Одноразовая линия для капнографии орально-назальная (взрослая), SA20-001



Одноразовая линия для калнографии орально-назальная
(детская/ неонатальная), СА20-002

Кабель для подключения датчика ИД
к монитору, МТЦ.81.20.601

10
♻️
04
10/2019

SX10

Кабель для подключения
датчика ИД к монитору

SX-
LOT

Combitrans Halteplatte 2-fach

Combitrans Attachment Plate Double

- DE: Platte für die vertikale Befestigung von bis zu Combitrans-Transformator.
- DE: Halteplatte zur Fixierung von Eitringstransformator.
- FR: Plaque support pour caissons à usage unique Combitrans.
- SE: Platt; för fästing av upp till Combitrans-avgångstransformatorer.
- IT: Piatto di sostegno verticale per trasformatore monouso Combitrans.
- PT: Placa para fixação vertical para Combitrans com transformador descartável.
- CZ: Rampe pro upevnění jednorázových převodníků.
- SK: Nosná platňa na vertikálnu oporu jednorázového Combitrans prevodníka.
- ES: Placa soporte para la fijación a placas de soporte.
- PL: Płyta do pionowego zamocowania 2 przebiegowych Combitrans.

REF 5215600
LOT 21H20844
2021-08-20
2024-08-19



0134527478118380732408101111102041021102044

P.1. Platte für die vertikale Befestigung von bis zu Combitrans-Transformator.

Combitrans Halteplatte 2-fach

Hersteller: B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

Produktions-Nr.: 5215600

Lot-Nr.: 21H20844

Expiry Date: 2024-08-19

Version: 11_2019 NL V02

www.bbraun.com

B. Braun Medical AG, 34119 Bielefeld, Germany

B BRAUN
B. Braun Medical AG
D-34119 Bielefeld
Germany

CE 0123

Version 11_2019 NL V02



Пластина для крепления преобразователей КОМБИТРАНС (Combitrans attachment plate),

000 ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 20.07.2017 г., 5215600, Вид 150490

[illegible]

Катетер термодиллюционный
"Кородин" (с аксессуарами), 45041422




Мультигазовый датчик в боковом потоке
(с аксессуарами). AneSure-M

Мультигазовый датчик в прямом потоке
(с аксессуарами), AneSure-S




Датчик капнографа в прямом потоке
(с аксесуарам), CM10-002

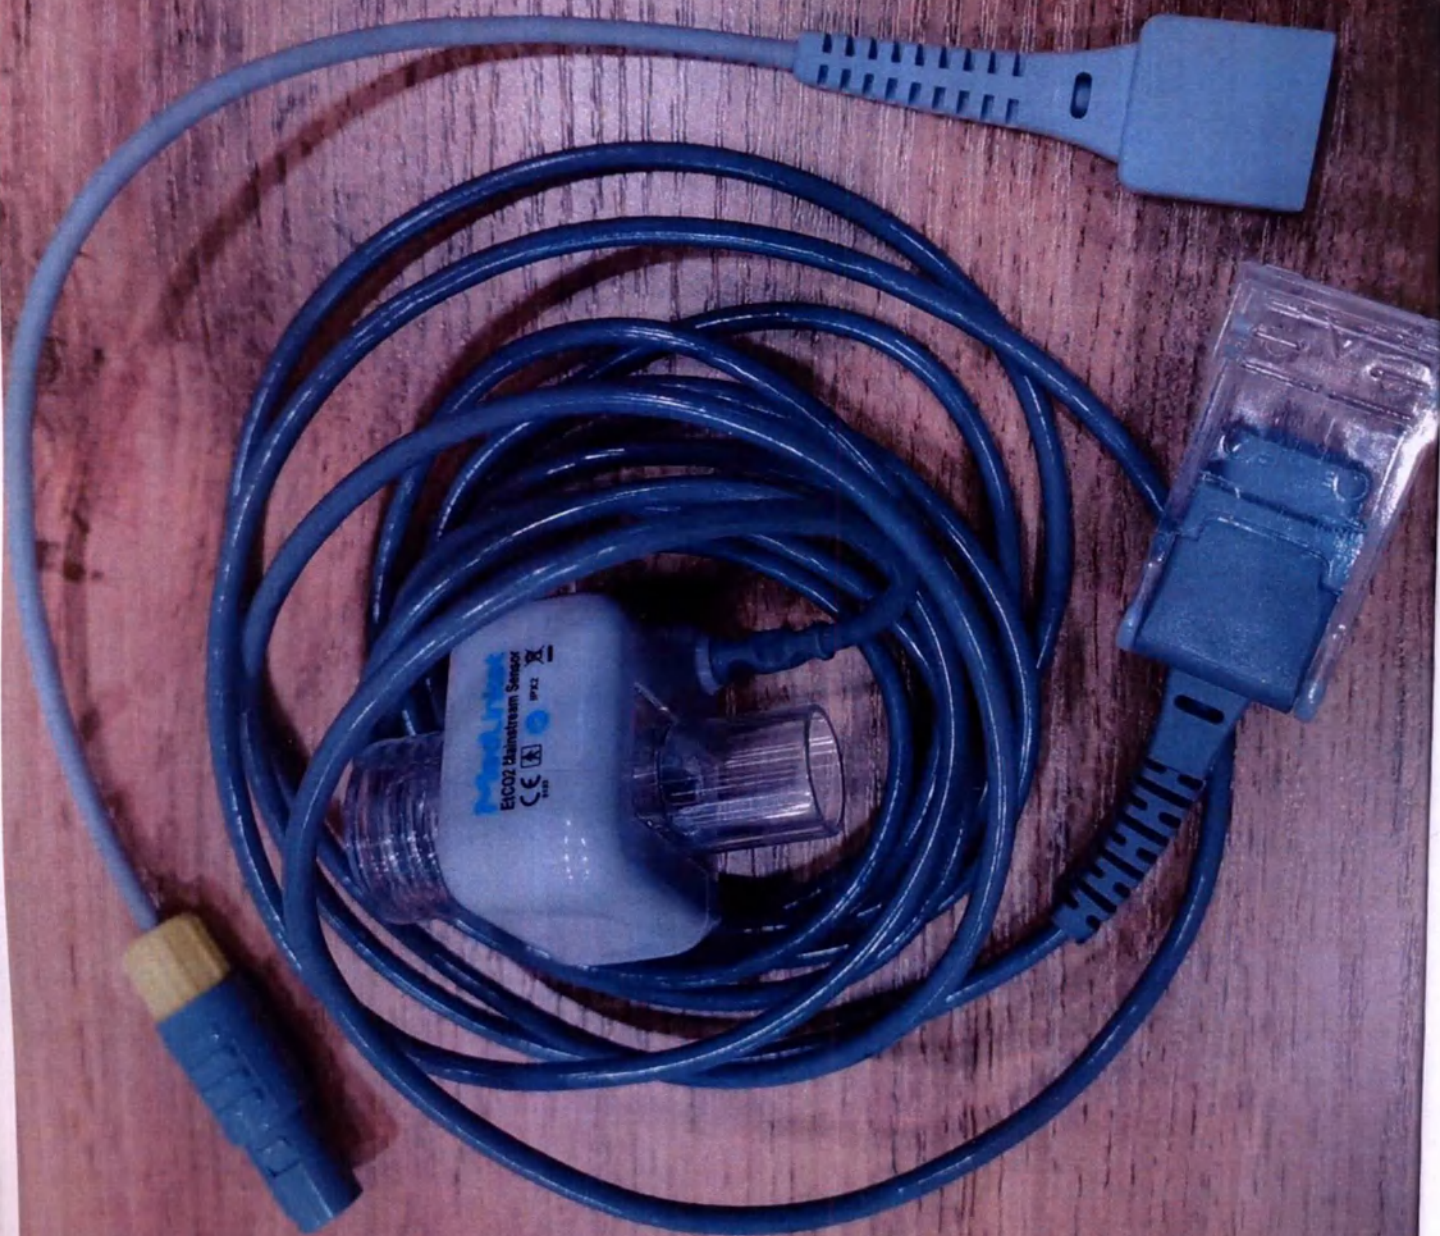



Датчик капнографа в боковом потоке (с аксессуарами), CM20-002

ТУ 401000-001-24149103-2011

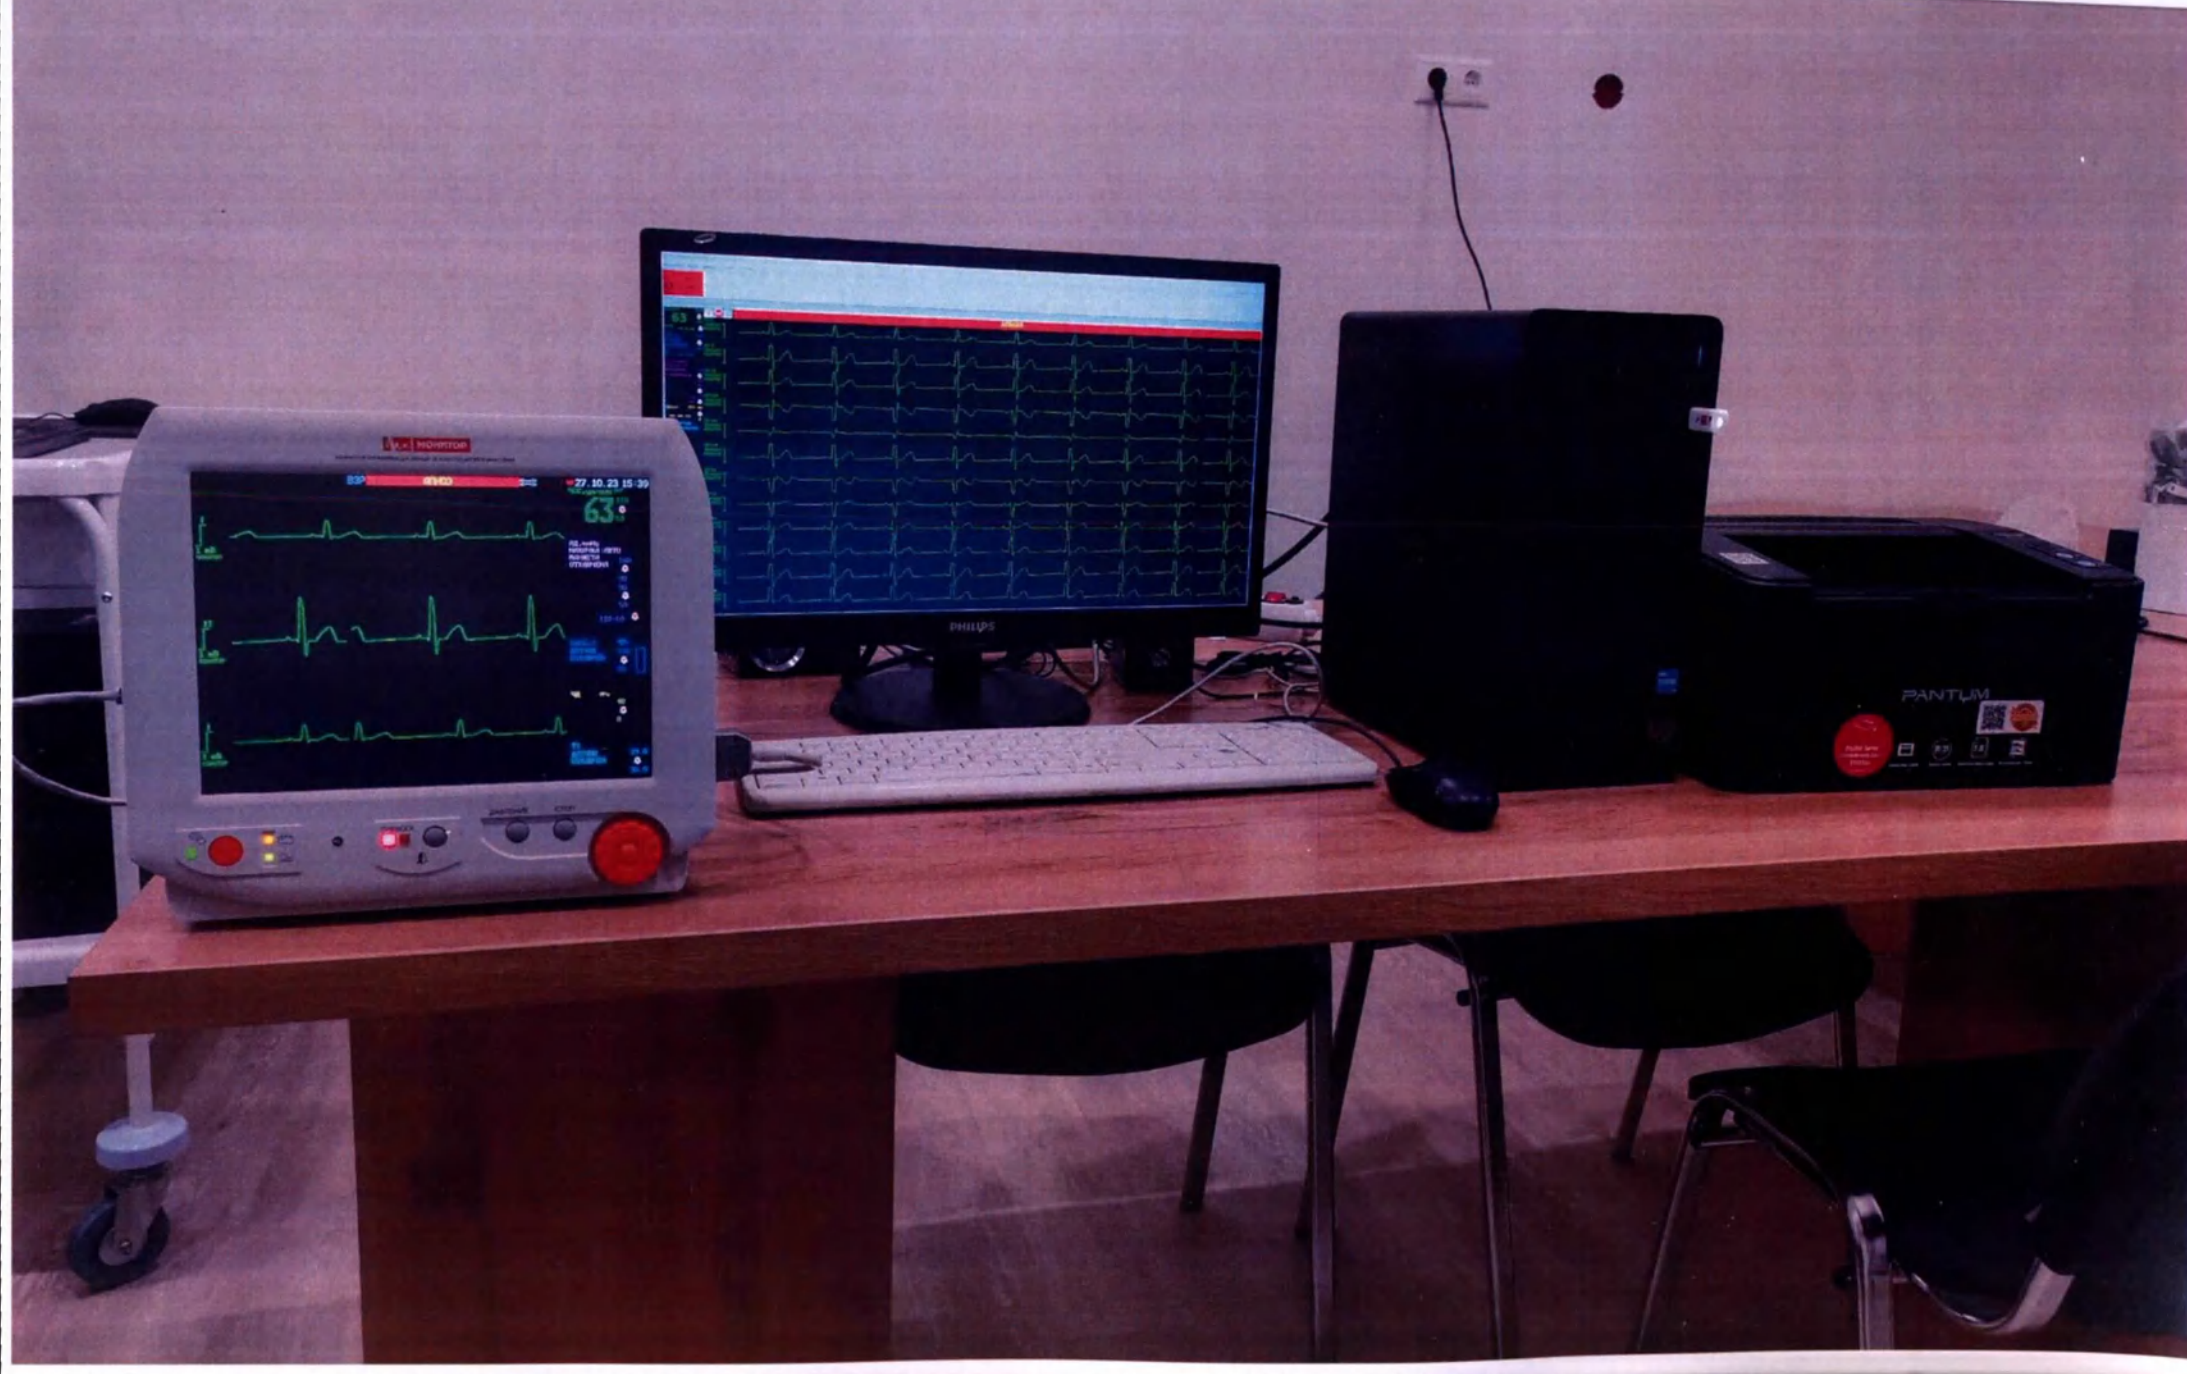



Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии
"ЛР-Регистрон" 57мм в рулоне 23 м

P/N:OEM-S1388A

Датчик дыхания термисторный
МИТАР

ООО "НПП "Монитор"



Термисторный датчик дыхания,
МТЦ.82.27.601

Кабель сетевой 220 В SCZ-1



Кабель сетевой 220В SCZ-1

ХРІАНЕТ-Технікум Східного, Китай

Вставка плавкая
МИТАР
ООО "НПП "Монитор"



Вставка плавкая ВП1-1, 1А, 250 В,
АГО.481.303 ТУ

Кронштейн для крепления монитора к стене, А 277 СБ





Кабель COM-порт
МИТАР
ООО "НПП "Монитор"



Кабель COM-порт для подключения монитора
к компьютеру, МТЦ.82.25.601



Набор принадлежностей для мониторинга глубины наркоза

В данном документе прошито 62 листов а

Генеральный директор Ю.Б. Попов

