



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»


Шалин О. В.

Макеты маркировки медицинского изделия
Набор реагентов ГД5-НР для проведения клинического анализа крови
человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5
по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023


2024

1 Макеты этикеток первичной упаковки

1) Изотонический реагент ГД5-ИР

LOT	CONT	IVD		
	20 литров			
	Набор реагентов ГД5-ИР для проведения клинического анализа крови человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023			
		РУ		
	ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ИР			
	REF			Не замораживать
	ООО «Эйлитон» Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru; http://www.unimed.ru. Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д.9а, корп.1			
	Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!			

2) Лизирующий дифференцирующий реагент ГД5-ЛР-Д


	IVD	
	Набор реагентов ГД5-ИР для проведения клинического анализа крови человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023	
	РУ	
	ЛИЗИРУЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ЛР-Д	
	REF	
	CONT	
	1 литр	
		Не замораживать
ООО «Эйлитон» Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru; http://www.unimed.ru. Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д.9а, корп.1		
LOT		
		
Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!		

3) Лизирующий трансформирующий реагент ГД5-ЛР-Т



Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ


**ЛИЗИРУЮЩИЙ
ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ГД5-ЛР-Т**



0,2 литра

Не замораживать

ООО «Эйлитон»
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29,
тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.
Место производства:
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1




Для ознакомления с инструкцией
по применению изделия и паспортом
перейдите на сайт www.unimed.ru или
отсканируйте QR-код!

4) Детергентный очищающий реагент ГД5-ДОР



Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ

**ДЕТЕРГЕНТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ГД5-ДОР**



1 литр

Не замораживать

ООО «Эйлитон»
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4,
стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.
Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1




Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и
паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!

2 Макет этикетки потребительской (транспортной) упаковки

**Набор реагентов ГД5-НР для проведения клинического анализа крови человека
на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023, РУ**






 Не замораживать
 


Наименование реагента	Количество, шт.
Изотонический реагент ГД5-ИР	
Лизирующий дифференцирующий реагент ГД5-ЛР-Д	
Лизирующий трансформирующий реагент ГД5-ЛР-Т	
Детергентный очищающий реагент ГД5-ДОР	



 ООО «Эйлитон»
 Россия, 141983,
 Московская обл., г. Дубна,
 ул. Программистов, д.4,
 стр.2, пом.29,
 тел. +7(495)734-91-31,
 e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.

Место производства: Россия,
 141983, Московская обл.,
 г. Дубна, проспект Науки,
 д.9а, корп.1




Масса нетто ____ кг.
 Масса брутто ____ кг.

3 Прочая маркировка.

1) Наклейка RFID-метка.



Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 4

1/11/2018 лист

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»

Шалин О.В. Шалин О.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Эйлитон»



Шалин О. В.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов ГД5-НР для проведения клинического анализа крови
человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5**

по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023

2024

Наименование медицинского изделия:

Набор реагентов ГД5-НР для проведения клинического анализа крови человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023

Разработчик:

ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29

Производитель:

ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29

Место производства:



ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д. 9А, к. 1





LOT 0020722	CONT 20 литров	IVD		
 22.07.2022	Набор реагентов ГД5-ИР для проведения клинического анализа крови человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023 ру			
 22.07.2025	ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ИР			
	REF ГД5-ИР-502	Не замораживать.		
ООО «Элитон» Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29 тел. +7(495)-734-91-31, e-mail: office@elited.ru; http://www.elited.ru Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна проспект Научк. д.9а, корп.1				
0001	Для ознакомления с инструкцией по применению изделия в паспорте перейдите на сайт www.elited.ru или отсканируйте QR-код!			



Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ

ЛИЗИРУЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ЛР-Д

REF ГД5-ЛР-Д-502



CONT
1 литр



2°C 35°C

Не
замораживать

ООО «Эйлитон»
Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4,
стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>;
Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1



0010522




23.05.2025





23.05.2022


0001

Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и
паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!

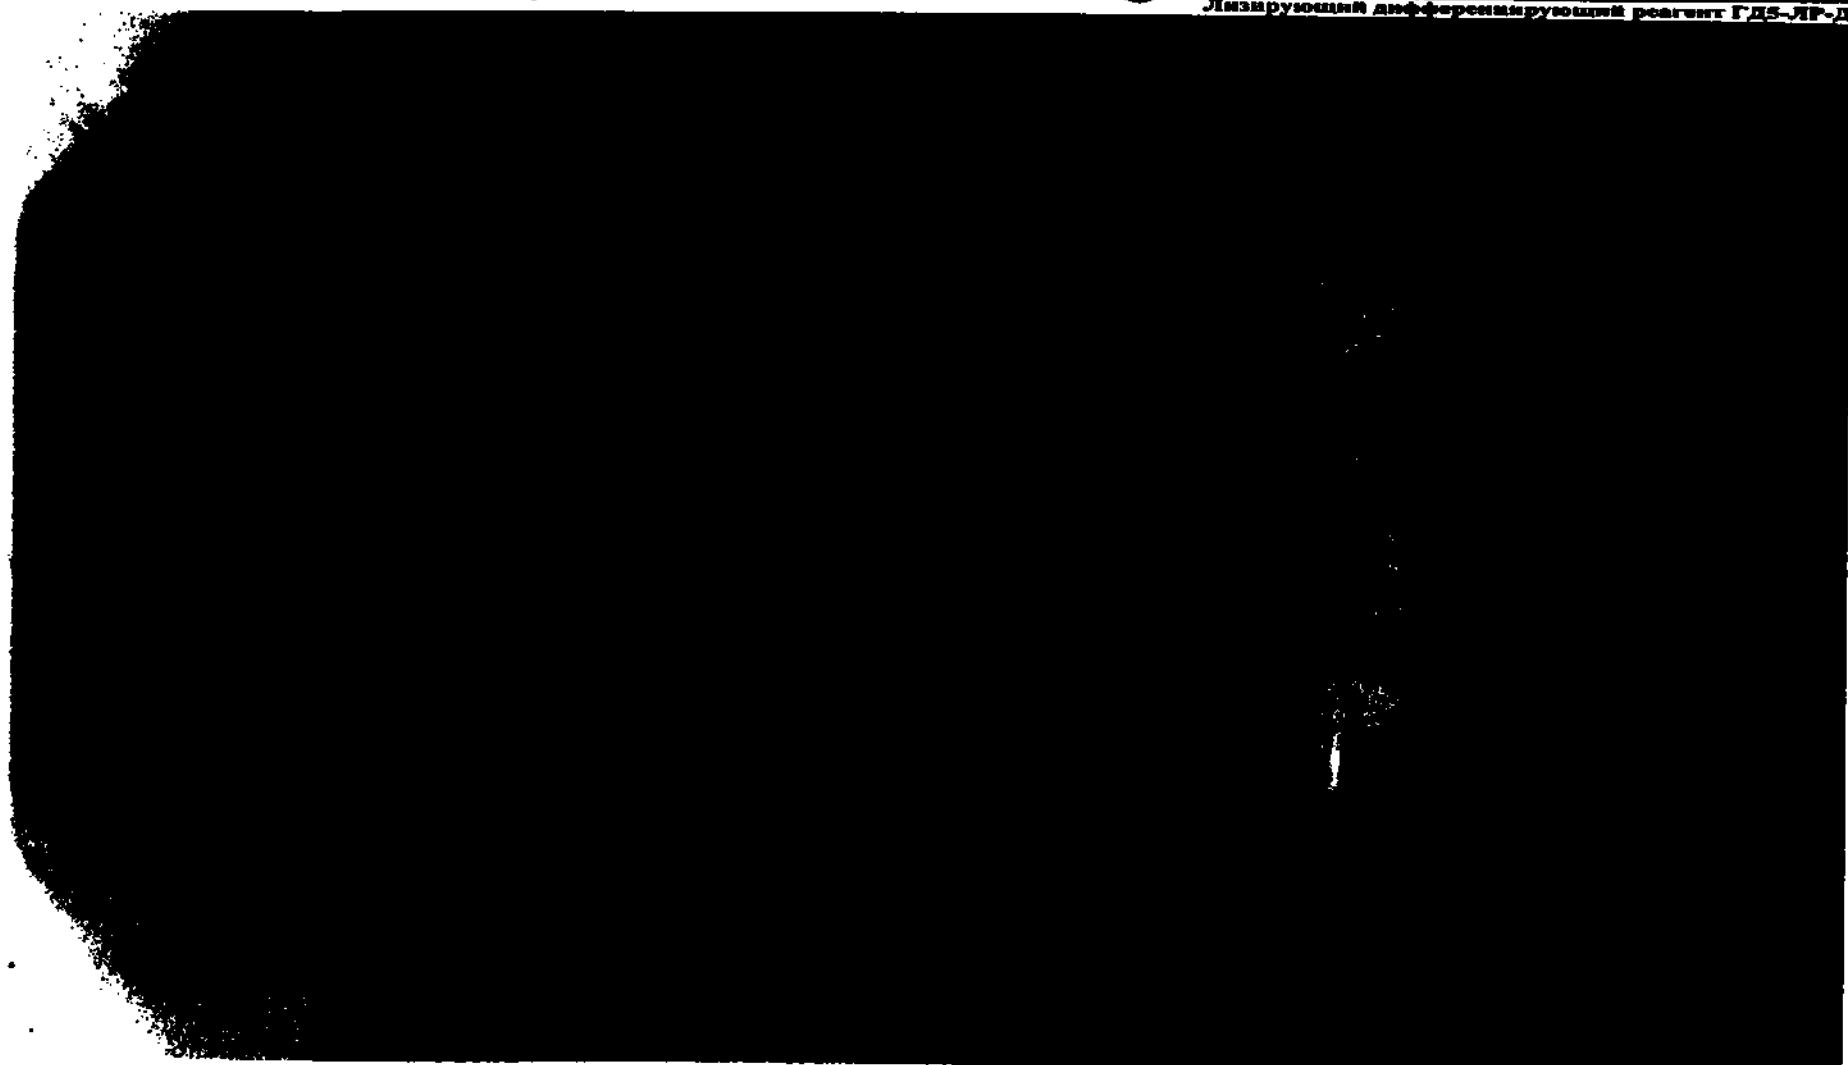

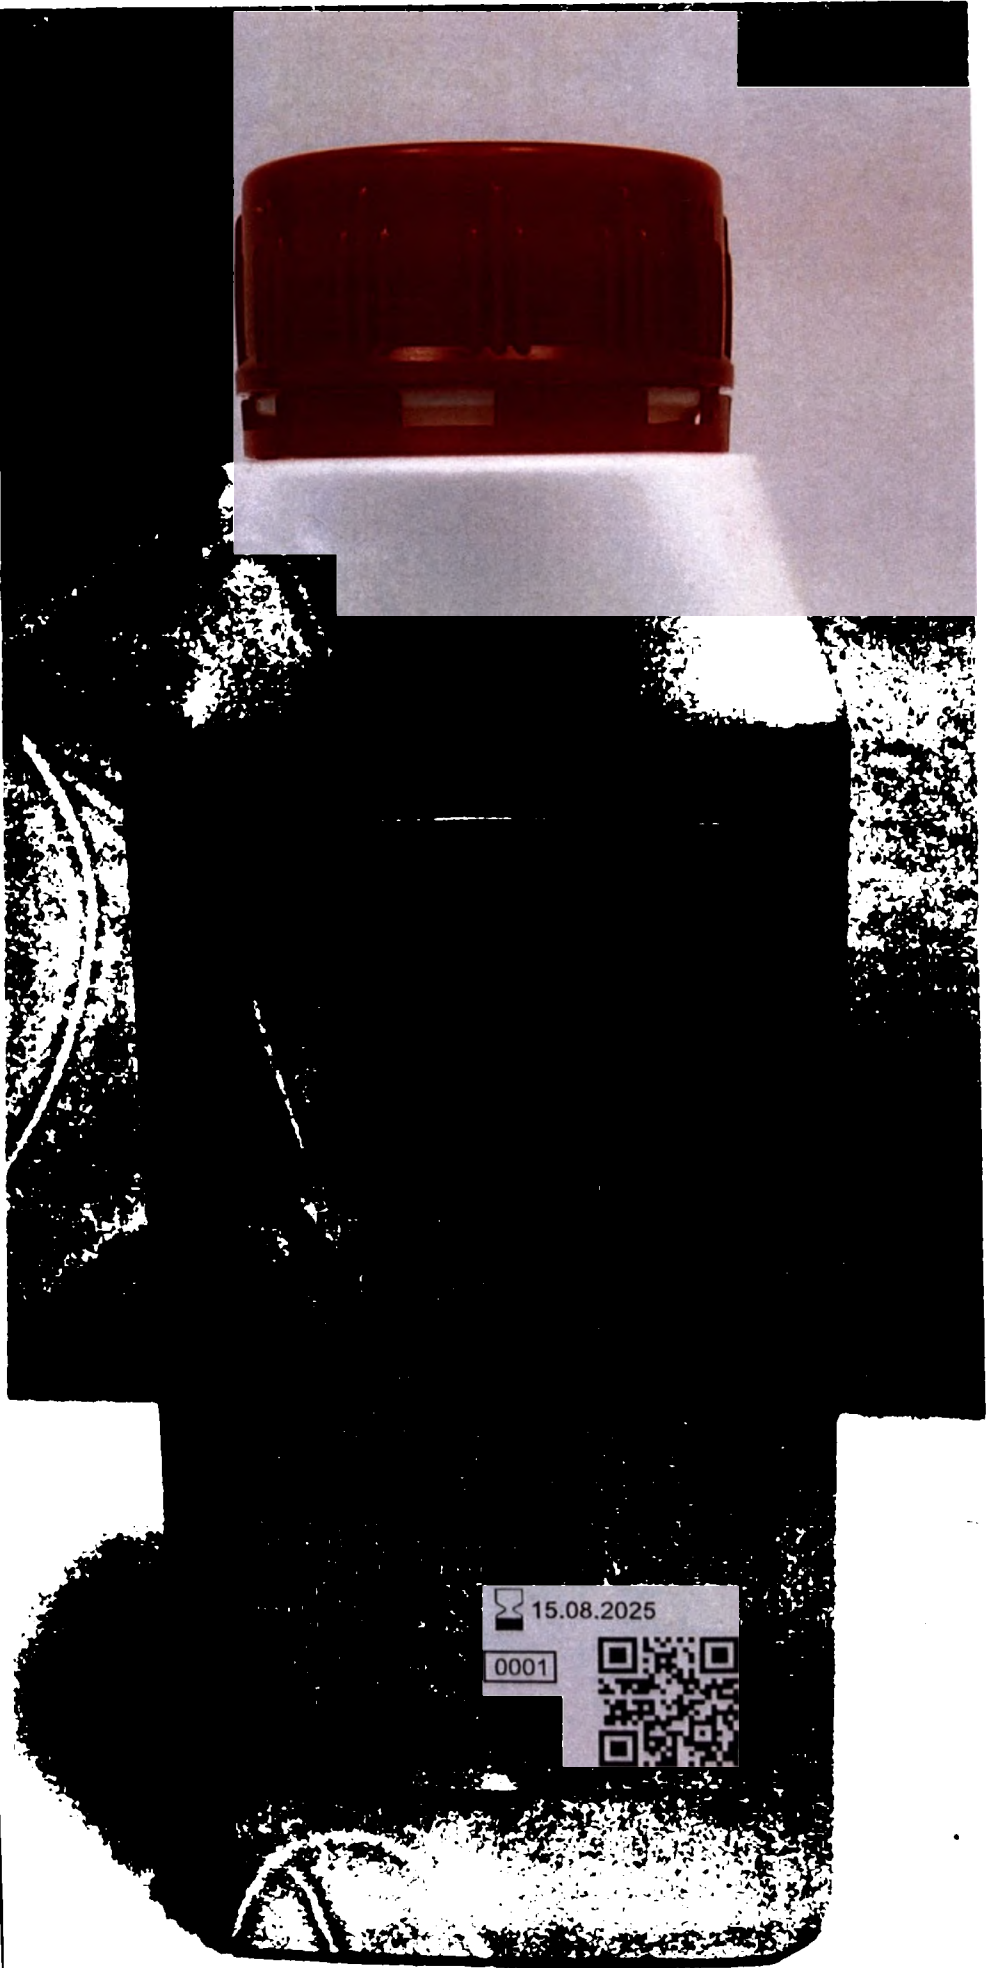

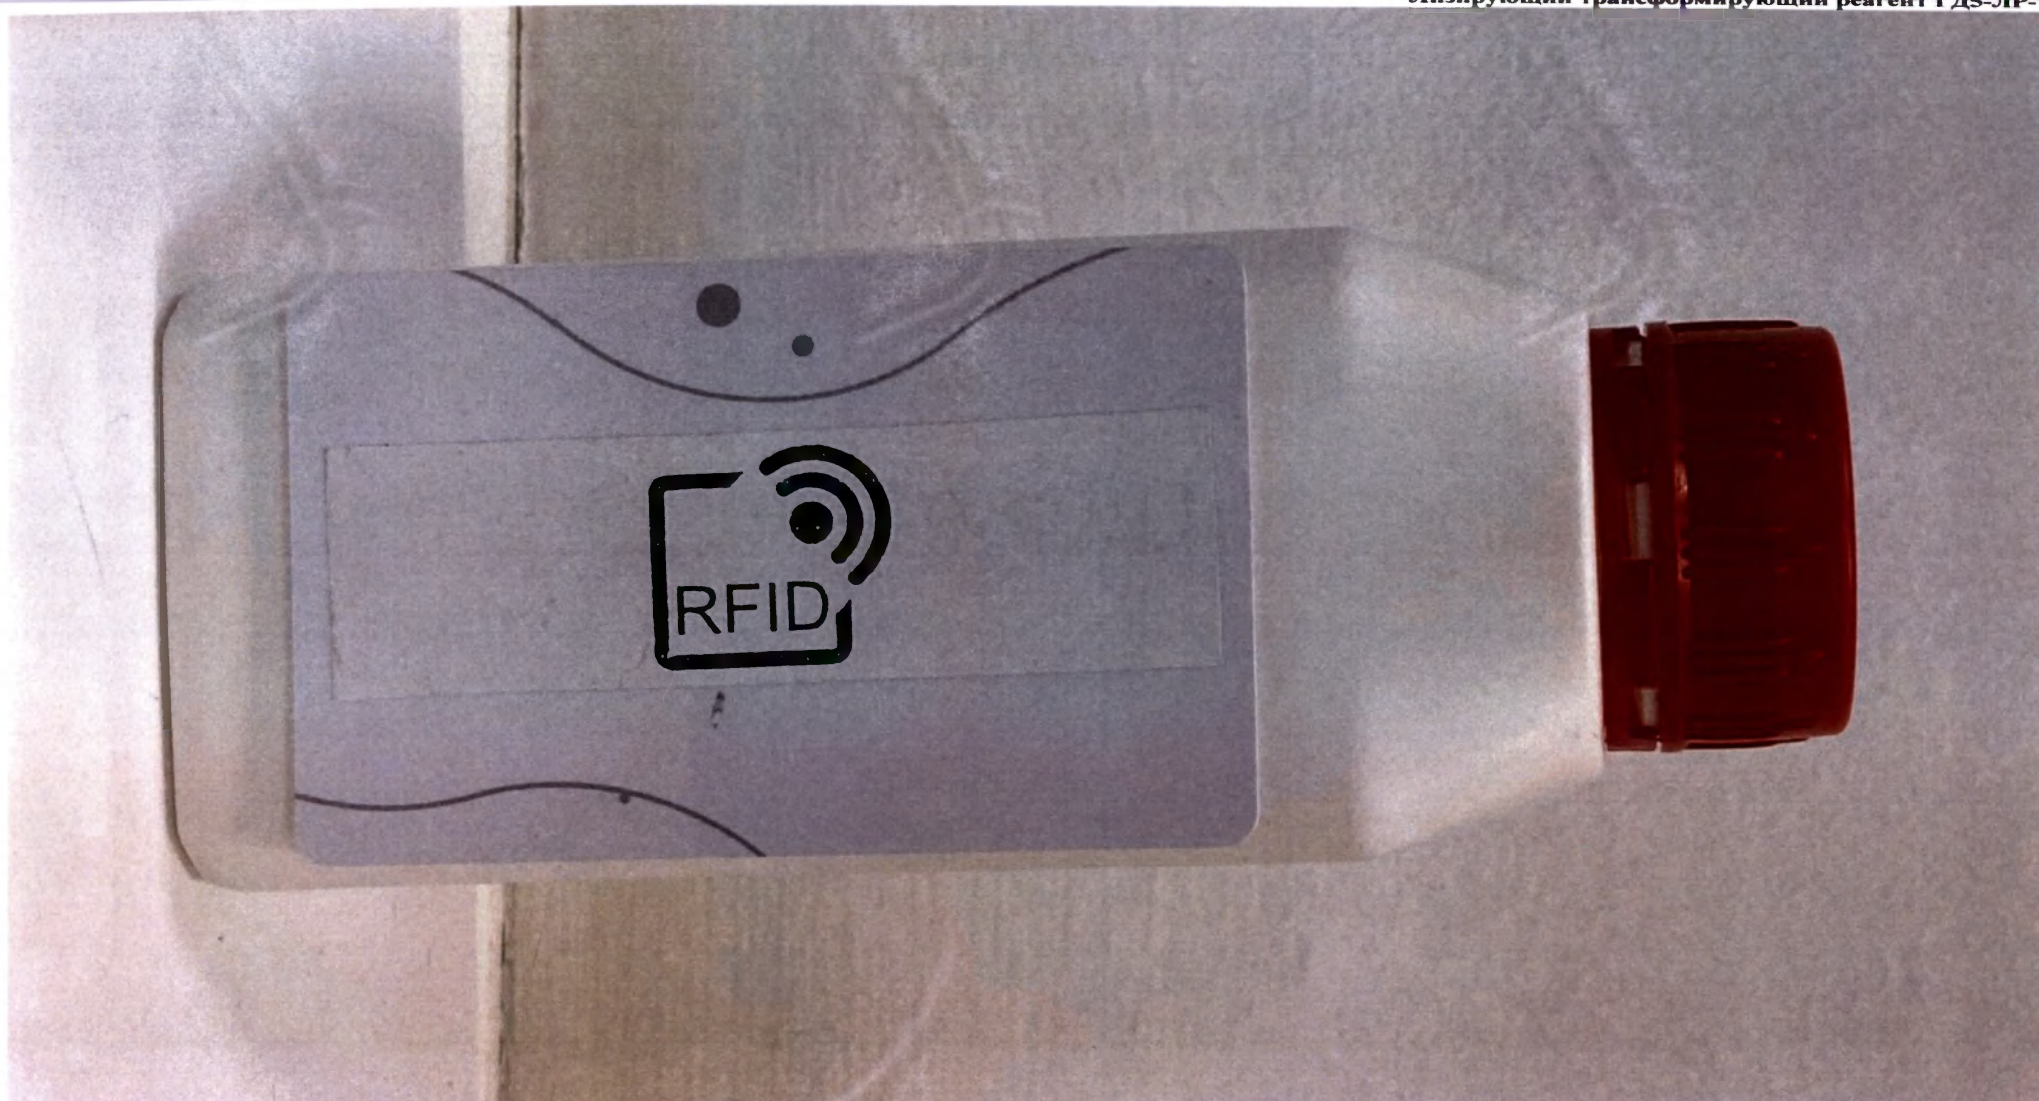

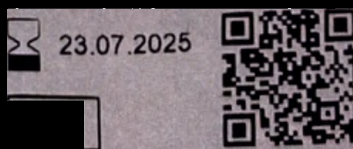



Набор реагентов ГДС-НР для проведения клинического анализа крови человека на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по ТУ 21.20.23-063-59879815-2023, РУ



Наименование реагента	Количество, шт.
Истинный реагент ГДС-НР	1
Позитивный дифференцирующий реагент ГДС-НР-Д	1
Позитивный трансформирующий реагент ГДС-НР-Т	1
Детектный оптический реагент ГДС-НОР	1




ООО «Зилитон»
 Россия, 141983,
 Московская обл., г. Дубна,
 ул. Прогрессовая, д.4,
 этаж 2, пом. 20
 тел. +7(495)734-81-31,
 e-mail: info@zilint.ru,
 http://www.zilint.ru

Место производства: Россия,
 141983, Московская обл.,
 г. Дубна, промзона Нара,
 д.16, корпус 1

LOT 0010522 23.05.2025

Масса нетто 23,5 кг. Масса брутто 23,9 кг.

LOT**CONT****IVD**

20 литров




Набор реагентов ГД5-ИР для проведения
клинического анализа крови человека
на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023



РУ



ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ИР

**REF**

Не замораживать



ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4, стр.2, пом.29,
тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru; http://www.unimed.ru.

Место производства:

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, проспект Науки, д.9а, корп.1



Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и
паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!





Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ

ЛИЗИРУЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ЛР-Д

REF



CONT
1 литр



35°C
2°C


Не
замораживать

ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4,
стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.

Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1

LOT



Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и
паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!



Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ


ЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ЛР-Т

REF



CONT

0,2 литра



Не
замораживать


ООО «Эйлитон»

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4, стр. 2, пом. 29,
тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.

Место производства:

Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1

LOT



Для ознакомления с инструкцией
по применению изделия и паспортом
перейдите на сайт www.unimed.ru или
отсканируйте QR-код!




Набор реагентов ГД5-НР для проведения
клинического анализа крови человека на
гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023
РУ

ДЕТЕРГЕНТНЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ РЕАГЕНТ ГД5-ДОР



1 литр




Не
замораживать

ООО «Эйлитон»


Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна, ул. Программистов, д.4,
стр.2, пом.29, тел. +7(495)734-91-31, e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.

Место производства: Россия, 141983, Московская обл., г. Дубна,
проспект Науки, д.9а, корп.1



Для ознакомления с инструкцией по применению изделия и
паспортом перейдите на сайт www.unimed.ru или отсканируйте QR-код!

**Набор реагентов ГД5-НР для проведения клинического анализа крови человека
на гематологических анализаторах ГЕМАДИФФ® 5 по
ТУ 21.20.23-063-59879815-2023, РУ**



Не
замораживать



Наименование реагента	Количество, шт.
Изотонический реагент ГД5-ИР	
Лизирующий дифференцирующий реагент ГД5-ЛР-Д	
Лизирующий трансформирующий реагент ГД5-ЛР-Т	
Детергентный очищающий реагент ГД5-ДОР	



ООО «Эйлитон»
Россия, 141983,
Московская обл., г. Дубна,
ул. Программистов, д.4,
стр.2, пом.29,
тел. +7(495)734-91-31,
e-mail: office@unimed.ru;
<http://www.unimed.ru>.

Место производства: Россия,
141983, Московская обл.,
г. Дубна, проспект Науки,
д.9а, корп.1



Масса нетто ____ кг.

Масса брутто ____ кг.

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 16

шестнадцать лист

Генеральный директор

ООО «Эйлитон»

Шалин С.В. Шалин С.В.

