

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

П.А. Свистаков

«14» июня 2024 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Колонка хроматографическая для анализатора автоматического «Лидлаб Енисей G 01»
для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50–546-65614693-2024»



Колонка хроматографическая Лидлаб Енисей G 01

Колонка хроматографическая
для анализатора автоматического
«Лидлаб Енисей G 01» для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-546-65614693-2024

HbA1c

Место производства

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Состав:

Колонка хроматографическая – 1 шт.

Фильтр – 2 шт.


RFID-карта – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Аналитический паспорт – 1 шт.

HbA1c

massura



	XX.XX.XXXX	SN	XXXXXXXXXXXX
	XX.XX.XXXX	REF	XXXXXXXXXXXX

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Колонка хроматографическая Лидлаб Енисей G 01

  Фильтр(2 шт)		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
	LOT	XXXXXXXXXX
	SN	XXXXXXXXXXXXXX

  Колонка хроматографическая		XX.XX.XXXX
		XX.XX.XXXX
	LOT	XXXXXXXXXX
	SN	XXXXXXXXXXXXXX





лидкор

КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ
для анализатора автоматического
«Лидлаб Енисей G 01»
для диагностики in vitro
по ТУ 32.50.50-546-65614693-2024

 Россия, 620102, Свердловская
область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская,
стр. 23, офис 204

Телефон: 8 800 500 71 28


leadcore.ru



RFID-карта



лидлаб

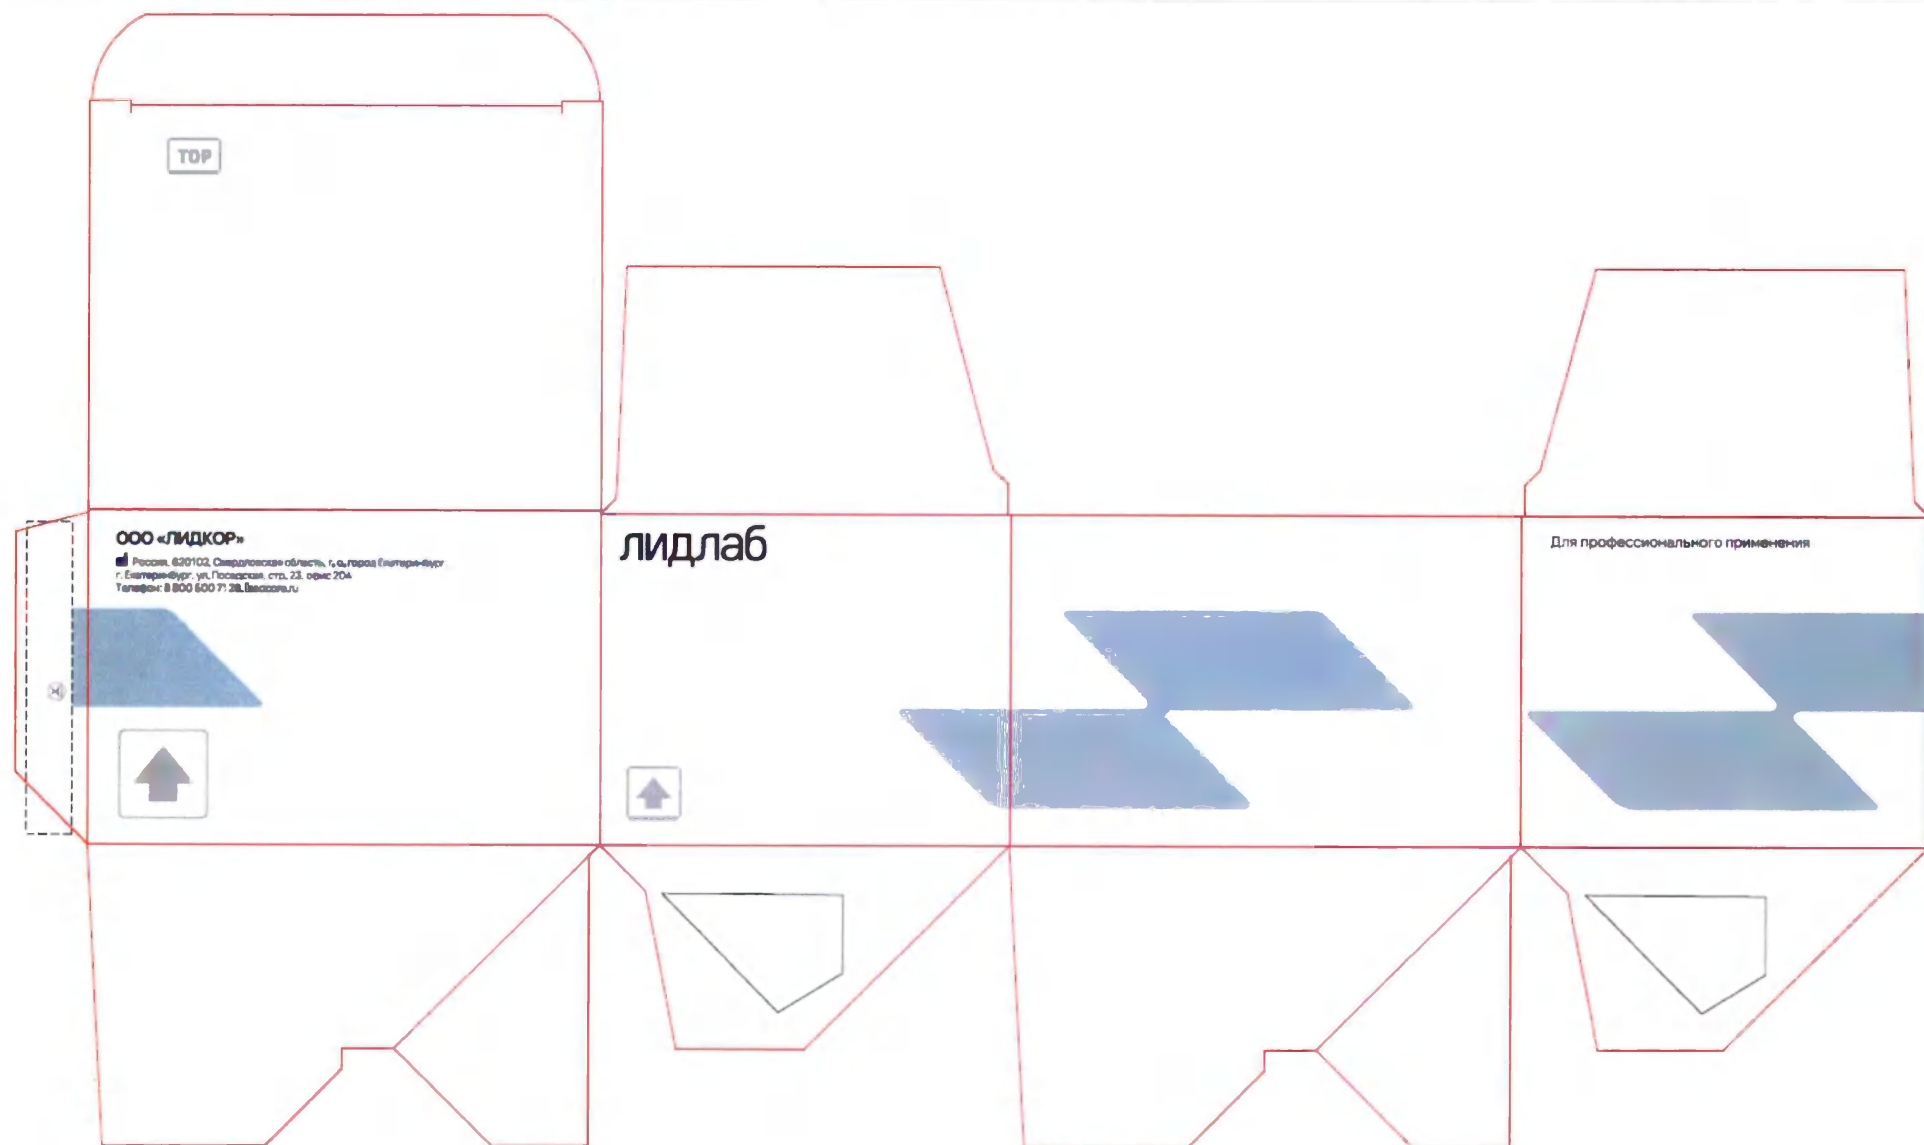

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 5 л.

14.06.2024



Директор
ООО «ЛИДКОР»

П.А. Свистаков/

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Г.А. Свистаков

«18» июня 2024 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

«Колонка хроматографическая для анализатора автоматического «Лидлаб Енисей G 01» для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50–546-65614693-2024»

Общий вид медицинского изделия в полном составе

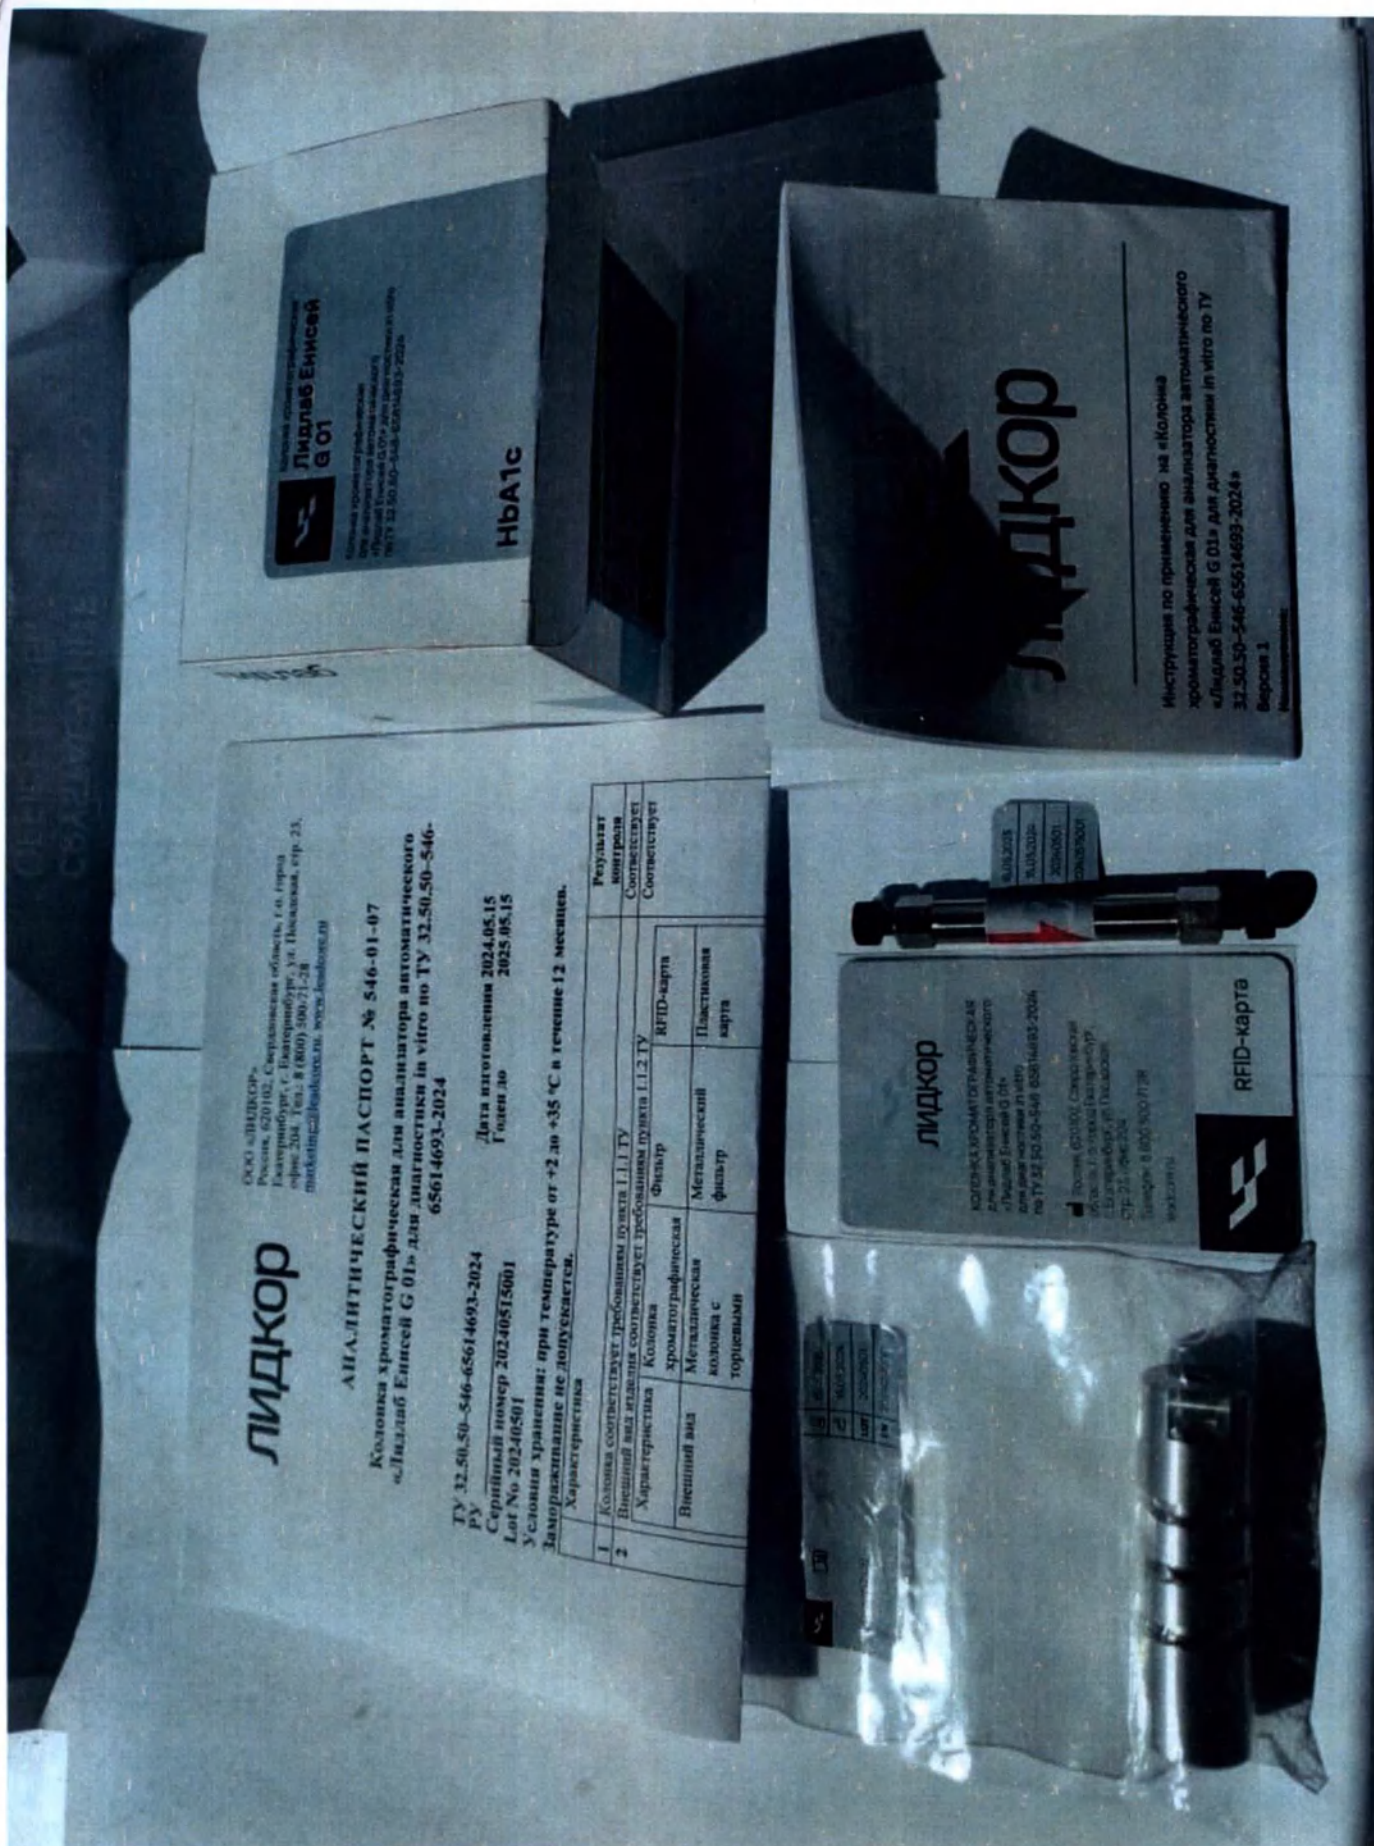

ЛИДКОР

ООО «ЛИДКОР»,
Россия, 620102, Свердловская область, г.п. Гора,
Горноуральск, с. Восточный 2-й, ул. Пискарева, стр. 23,
офис 204. Тел.: 8 (800) 500-01-28
mailto:info@lidkor.ru, www.lidkor.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 546-01-07

Колонка хроматографическая для анализатора автоматического
«Лидкор Енисей G 01» для диагностики in vitro по ТУ 32.50.50-546-
65614693-2024

ТУ 32.50.50-546-65614693-2024

Серийный номер 20240515001

Lot № 20240501

Условия хранения: при температуре от +2 до +35 °С в течение 12 месяцев.
Замораживание не допускается.

Дата изготовления 2024.05.15


Годен до 2025.05.15

Характеристика

№	Характеристика	Колонка	Внешний вид	Хроматографическая колонка с торцевыми	Фильм	Металлический фильтр	RFID-карта	Пластиковая карта	Результат контроля
1	Колонка соответствует требованиям пункта 1.1.1 ТУ								Соответствует
2	Внешний вид изделия соответствует требованиям пункта 1.1.2 ТУ								Соответствует



Потребительская (транспортная) упаковка

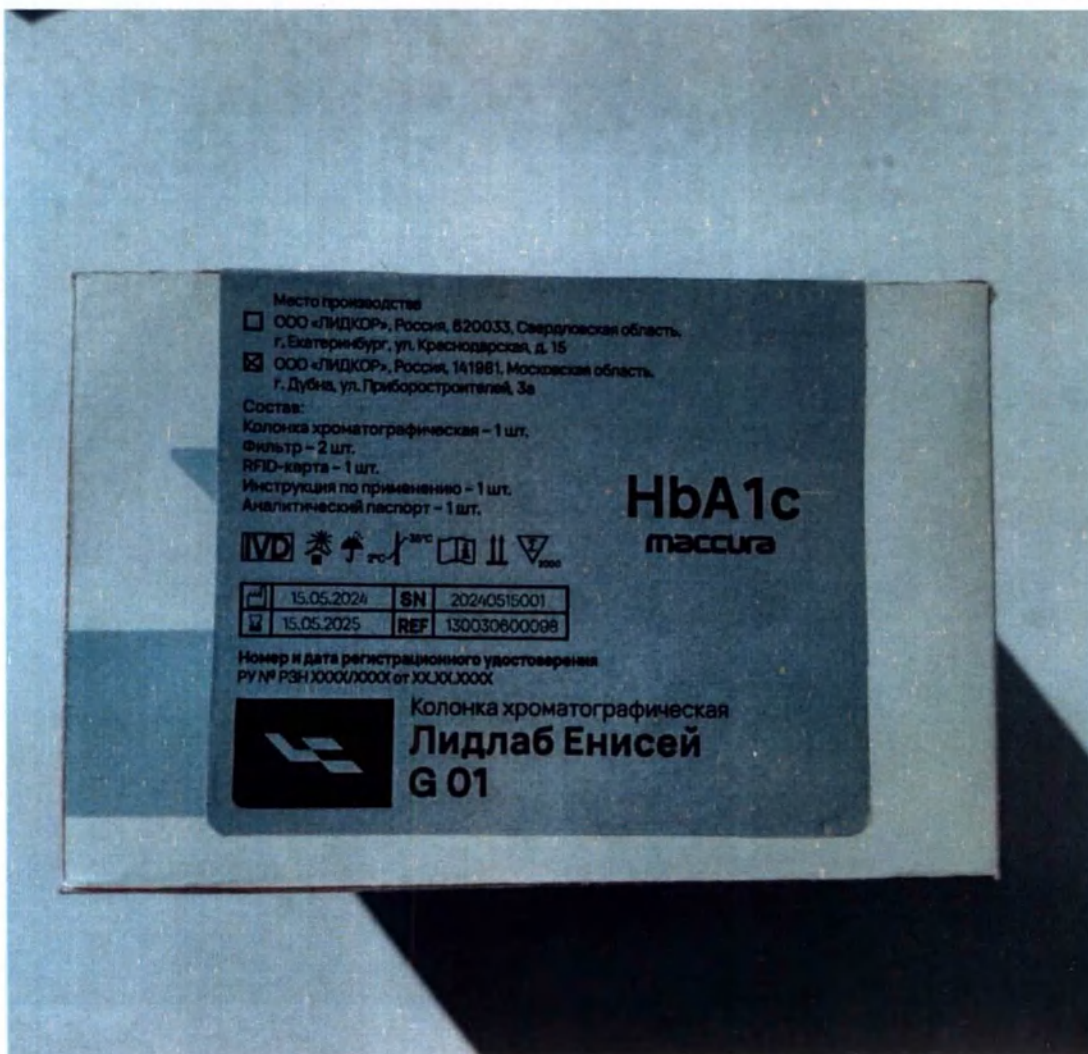

ООО «ЛИДКОР»


■ Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru





лидлаб



Для профессионального применения

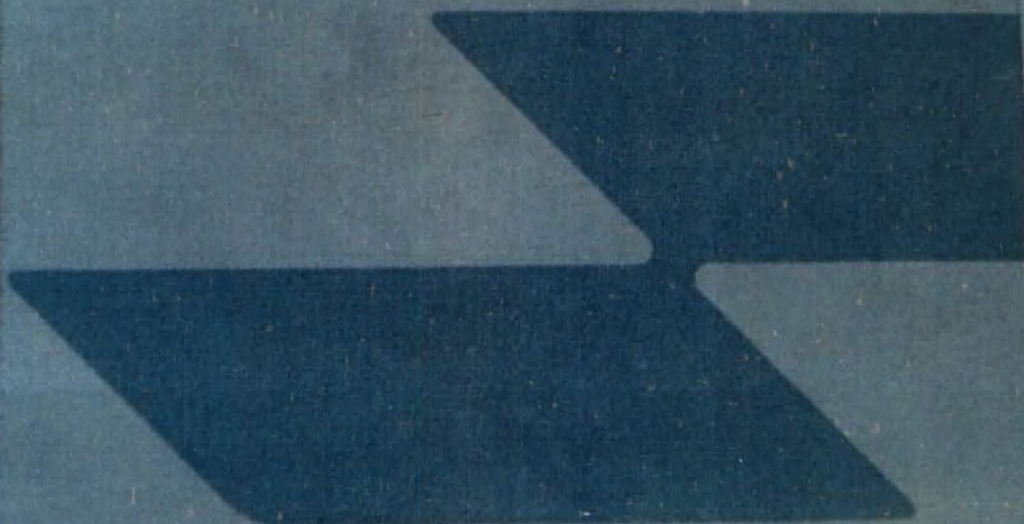

Колонка хроматографическая

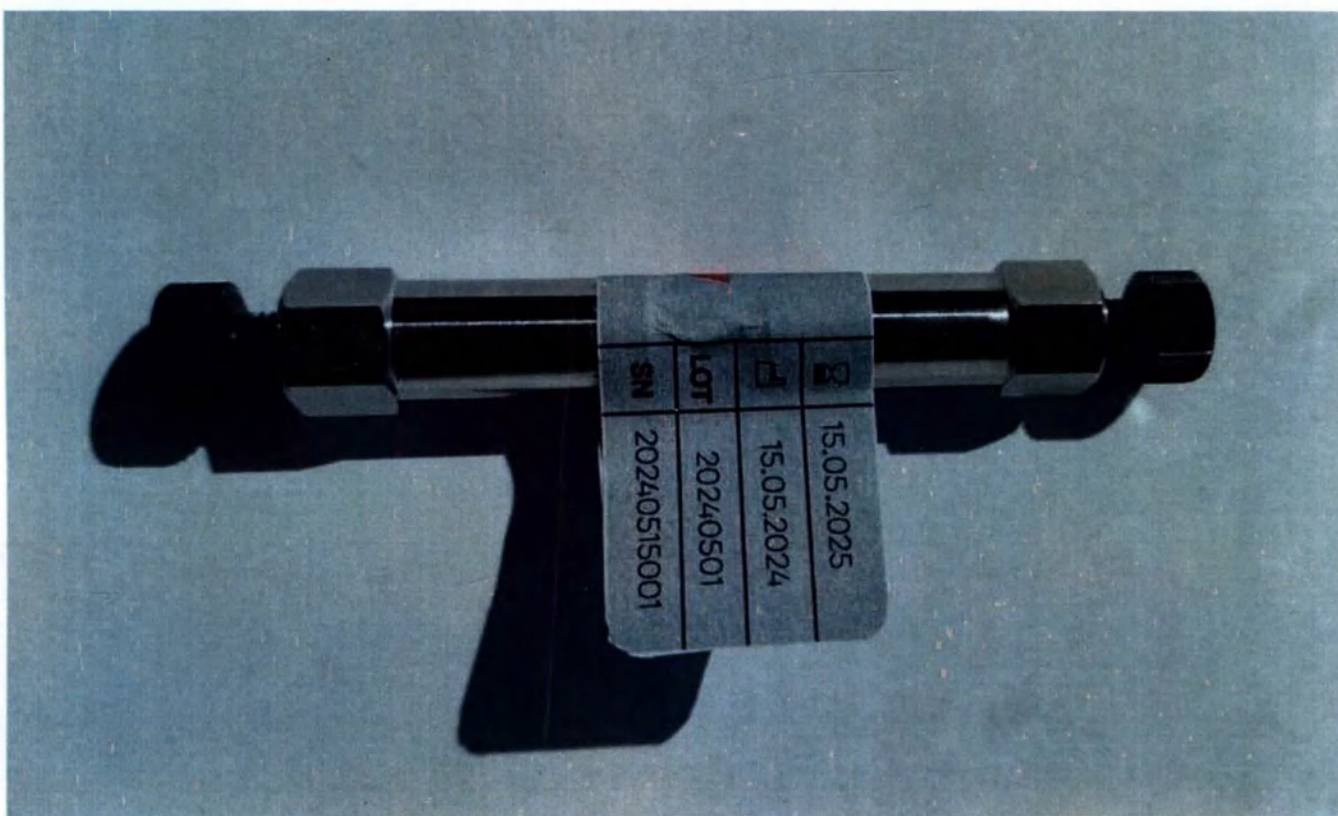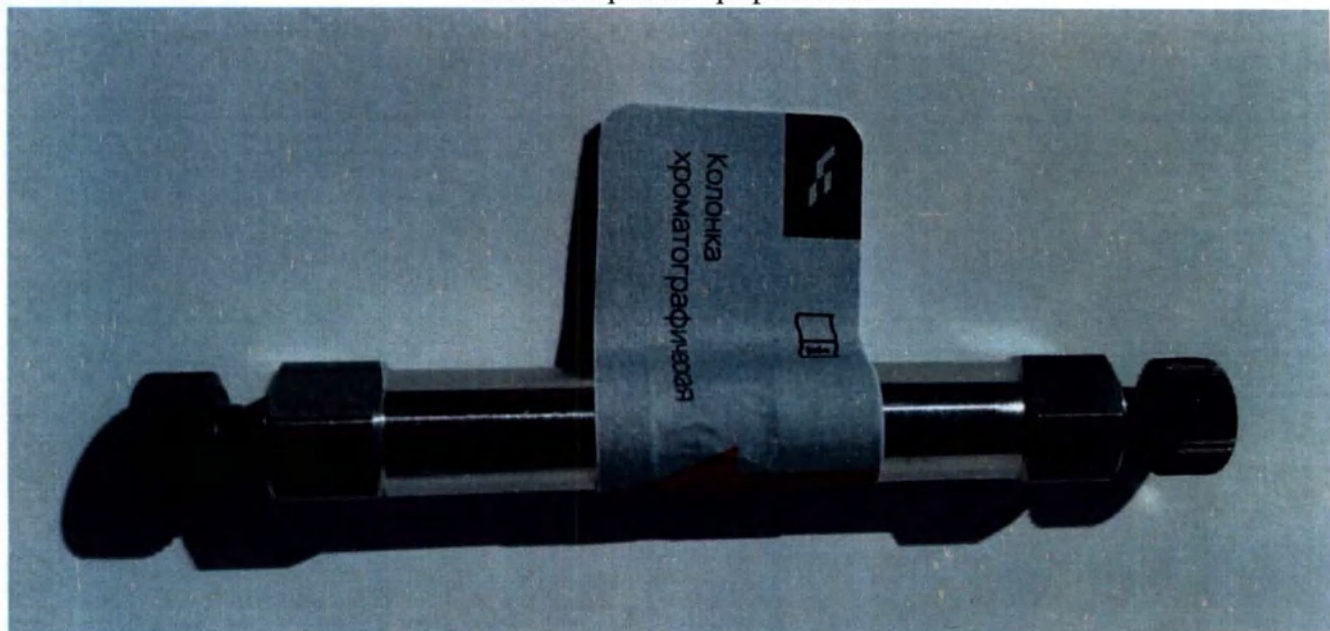

Фильтр



RFID-карта



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 л.

18.06.2024

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/П.А. Свистаков/

