ООО «Сирона Денталь Системс»
115035, Москва, Овчинниковская
набережная, д. 18/1, стр. 2,
БЦ «Овчинниковский»
Тел.: +7 (495) 725-10-87
E-mail: CIS-Info@dentsplysirona.com

Dentsply Sirona

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»

«Дентсплай Сирона» Dentsply Sirona LLC

К.Г. Левин
"15" октября 2024 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ № 1/23 ОТ 22.06.2023
ДИРЕКТОР ПО РЕГИСТРАЦИИ, СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano; модель Axano Pure.

производства SIRONA Dental Systems GmbH
(СИРОНА Дентал Системс ГмбХ), Германия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

I. Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Состав:			**6**
1.	Стоматологическое кресло, с элементами для подключения.		7
2.	Педальный переключатель		
	2.1	вариант исполнения Smart Control	8
	2.2	вариант исполнения Classic	9
3.	Моторизованный подголовник.		10
4.	Подушка для подголовника.		11
5.	Подлокотники (правый и/или левый).		12
6.	Подушка корректирующая на сиденье кресла пациента.		13
7.	Разъём для сторонних устройств.		14
8.	Плита установочная		
	8.1	вариант исполнения стандартная	15
	8.2	вариант исполнения демонстрационная	16
9.	Блок врача с элементами для подключения.		17
10.	Нескользящий силиконовый мат		
	вариант исполнения для блока врача		18
	вариант исполнения для блока ассистента		19
	вариант исполнения для лотка		20
11.	Универсальный пистолет (пустер) Sprayvit (Sprayvit M) со шлангом, варианты исполнения: (левосторонний и/или правосторонний		21
12.	Ультразвуковой наконечник (скейлер) SiroSonic TL со шлангом.		23
13.	Моторы со шлангами		
	вариант исполнения BL E		25
	вариант исполнения BL ISO F		27
	вариант исполнения BL Implant E		29
14.	Шланг для турбин.		31
15.	Быстросъемное соединение quick coupling R (LED) для турбин.		32
16.	Внутриротовая камера SiroCam AF+, с элементами для подключения.		33
17.	Боковая подставка для внутриротовой камеры.		34
18.	Компоненты встроенного ApexLocator. в составе: электрод, зажим для губ, зажим файла, кабель		35
19.	Наконечник эндодонтический угловой T1 Line Endo 6 L		36
	Наконечник эндодонтический угловой Endo 6:1		37
20.	Изолирующая силиконовая оболочка для эндодонтии с ApexLocator.		38
21.	Перистатический насос для подачи физиологического раствора NaCl.		39
22.	Набор шлангов для перистальтического насоса (упаковка 5 штук).		40
23.	Съемный хомут для бутылки с физиологическим раствором NaCl.		41
24.	Наконечник механический угловой CA 20:1 L MICRO-SERIES.		42
25.	Силиконовая подставка для стерильных инструментов.		43
26.	Рентгеновский негатоскоп для панорамных снимков.		44
27.	Магнитный держатель для смарт-устройства или негатоскопа для панорамных рентгеновских снимков.		45
28.	Лоток с элементами крепления.		46
29.	Держатель стакана.		47
30.	Блок ассистента с элементами для подключения.		48
31.	Наконечник отсасывателя аэрозольного тумана.		49
32.	Канюля отсасывателя аэрозольного тумана.		50
33.	Шланг отсасывателя аэрозольного тумана.		51
34.	Наконечник слюноотсоса.		52
35.	Шланг слюноотсоса.		53
36.	Хирургическая канюля.		54
37.	Фильтр отсасывающих шлангов.		55

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

38.	Боковая подставка для полимеризационной лампы (светильника).		56
39.	Водяной блок с элементами для подключения.		57
40.	Плевательница.		58
41.	Сливная трубка стакана для полоскания рта (наполнитель стакана).		59
42.	Переходник отсасывающих шлангов для плевательницы.		60
43.	Соединительный шланг водяного блока.		61
44.	Вставной блок для очистки отсасывающих шлангов.		62
45.	Вставной блок для автоматического промывания Autopurge/санации.		63
46.	Санационные переходники:		
	для турбины		64
	для мотора BL		65
	для мотора ISO		66
	для SiroSonic TL		67
47.	Средство для дезинфекции водопроводящих трубок Dentosept S или Dentosept Clean.		68
48.	Рабочий светильник с элементами крепления		
	вариант исполнения LEDview Plus		69
	вариант исполнения LEDview Plus с набором крепежных элементов на потолок (в составе: опорная стойка для потолков, крепежный адаптер для опорной стойки, кронштейн для светильника).		70
49.	Зеркало рабочего светильника.		71
50.	Держатель камеры рабочего светильника.		72
51.	Монитор пациента 22" DC.		73
52.	Комплект кабелей для HDMI подключения системы SIVISION.		74
53.	Консоли и опоры: Опора для крепления консоли рабочего светильника или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus или консоли рабочего светильника и монитора или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus и монитора; Консоль для крепления рабочего светильника; Консоль для крепления лотка или лотка и монитора.		76
54.	Стоматологические рабочие кресла		
	вариант исполнения Hugo		77
	вариант исполнения Theo		78
	вариант исполнения Carl		79
	вариант исполнения Paul		80
55.	Программное обеспечение Sidexis 4 на электронном носителе.		81
56.	Лицензионный код для активации Sidexis 4.		82
57.	Элементы для инсталляции установки стоматологической.		83
58.	Эксплуатационная документация, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе и/или на бумажном носителе, в составе:		
	58.1. инструкция по эксплуатации Treatment center, модель Axano.		84
	58.2. инструкция по эксплуатации Hugo, Theo		85
	58.3. инструкция по эксплуатации Carl, Paul		86
	58.4. инструкция по эксплуатации LEDview Plus		87
	58.5. инструкция по эксплуатации SIVISION digital		88
	58.6. инструкция по эксплуатации SiroSonic/L/TL		89
	58.7. инструкция по эксплуатации Endo 6:1 и TI Line Endo 6 L		90
	58.8. инструкция по эксплуатации CA 20:1 L MICRO-SERIES		92
II. Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure Состав:			**93**
1.	Стоматологическое кресло, с элементами для подключения.		94
2.	Педальный переключатель		
	2.1	вариант исполнения Smart Control	95
	2.2	вариант исполнения Classic	96

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3.	Моторизованный подголовник.		97
	Подголовник с двойным шарниром.		98
4.	Подушка для подголовника.		99
5.	Подлокотники (правый и/или левый).		100
6.	Подушка корректирующая на сиденье кресла пациента.		101
7.	Разъём для сторонних устройств.		102
8.	Плита установочная		
	8.1	вариант исполнения стандартная	103
	8.2	вариант исполнения демонстрационная	104
9.	Блок врача с элементами для подключения.		105
10.	Нескользящий силиконовый мат		
	вариант исполнения для блока врача		106
	вариант исполнения для блока ассистента		107
	вариант исполнения для лотка		108
11.	Универсальный пистолет (пустер) Sprayvit (Sprayvit M) со шлангом, варианты исполнения: (левосторонний и/или правосторонний		109
12.	Ультразвуковой наконечник (скейлер) SiroSonic TL со шлангом.		111
13.	Моторы со шлангами		
	вариант исполнения BL E		113
	вариант исполнения BL ISO F		115
	вариант исполнения BL Implant E		117
14.	Шланг для турбин.		119
15.	Быстросъемное соединение quick coupling R (LED) для турбин.		120
16.	Внутриротовая камера SiroCam AF, с элементами для подключения.		121
	Внутриротовая камера SiroCam AF+, с элементами для подключения.		122
17.	Компоненты встроенного ApexLocator. в составе: электрод, зажим для губ, зажим файла, кабель		123
18.	Наконечник эндодонтический угловой TI Line Endo 6 L		124
	Наконечник эндодонтический угловой Endo 6:1		125
19.	Изолирующая силиконовая оболочка для эндодонтии с ApexLocator.		126
20.	Перистатический насос для подачи физиологического раствора NaCl.		127
21.	Набор шлангов для перистальтического насоса (упаковка 5 штук).		128
22.	Съемный хомут для бутылки с физиологическим раствором NaCl.		129
23.	Наконечник механический угловой CA 20:1 L MICRO-SERIES.		130
24.	Силиконовая подставка для стерильных инструментов.		131
25.	Рентгеновский негатоскоп для панорамных снимков.		132
26.	Магнитный держатель для смарт-устройства или негатоскопа для панорамных рентгеновских снимков.		133
27.	Лоток с элементами крепления.		134
28.	Держатель стакана.		135
29.	Блок ассистента с элементами для подключения.		136
30.	Наконечник отсасывателя аэрозольного тумана.		137
31.	Канюля отсасывателя аэрозольного тумана.		138
32.	Шланг отсасывателя аэрозольного тумана.		139
33.	Наконечник слюноотсоса.		140
34.	Шланг слюноотсоса.		141
35.	Хирургическая канюля.		142
36.	Фильтр отсасывающих шлангов.		143
37.	Боковая подставка для полимеризационной лампы (светильника).		144
38.	Водяной блок с элементами для подключения.		145
39.	Плевательница.		146
40.	Сливная трубка стакана для полоскания рта (наполнитель стакана).		147
41.	Переходник отсасывающих шлангов для плевательницы.		148
42.	Соединительный шланг водяного блока.		149

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

43.	Вставной блок для очистки отсасывающих шлангов.	150
44.	Вставной блок для автоматического промывания Autopurge/санации.	151
45.	Санационные переходники:	
	для турбины	152
	для мотора BL	153
	для мотора ISO	154
	для SiroSonic TL	155
46.	Средство для дезинфекции водопроводящих трубок Dentosept Clean.	156
47.	Рабочий светильник с элементами крепления	
	вариант исполнения LEDview Plus	157
	вариант исполнения LEDview Plus с набором крепежных элементов на потолок (в составе: опорная стойка для потолков, крепежный адаптер для опорной стойки, кронштейн для светильника).	158
48.	Зеркало рабочего светильника.	159
49.	Держатель камеры рабочего светильника.	160
50.	Монитор пациента 22" DC.	161
51.	Комплект кабелей для HDMI подключения системы SIVISION.	162
52.	Консоли и опоры: Опора для крепления консоли рабочего светильника или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus или консоли рабочего светильника и монитора или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus и монитора; Консоль для крепления рабочего светильника; Консоль для крепления лотка или лотка и монитора.	164
53.	Стоматологические рабочие кресла	
	вариант исполнения Hugo	165
	вариант исполнения Theo	166
	вариант исполнения Carl	167
	вариант исполнения Paul	168
54.	Программное обеспечение Sidexis 4 на электронном носителе.	169
55.	Лицензионный код для активации Sidexis 4.	170
56.	Элементы для инсталляции установки стоматологической.	171
57.	Эксплуатационная документация, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе и/или на бумажном носителе, в составе:	
	57.1. инструкция по эксплуатации Treatment center, модель Axano Pure.	172
	57.2. инструкция по эксплуатации Hugo, Theo	173
	57.3. инструкция по эксплуатации Carl, Paul	174
	57.4. инструкция по эксплуатации LEDview Plus	175
	57.5. инструкция по эксплуатации SIVISION digital	176
	57.6. инструкция по эксплуатации SiroSonic/L/TL	177
	57.7. инструкция по эксплуатации Endo 6:1 и TI Line Endo 6 L	178
	57.8. инструкция по эксплуатации CA 20:1 L MICRO-SERIES	180
	Макеты маркировки на русском языке	181

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

I. Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Стоматологическое кресло, с элементами я подключения.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Педальный переключатель,
вариант исполнения: Smart Control



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Classic

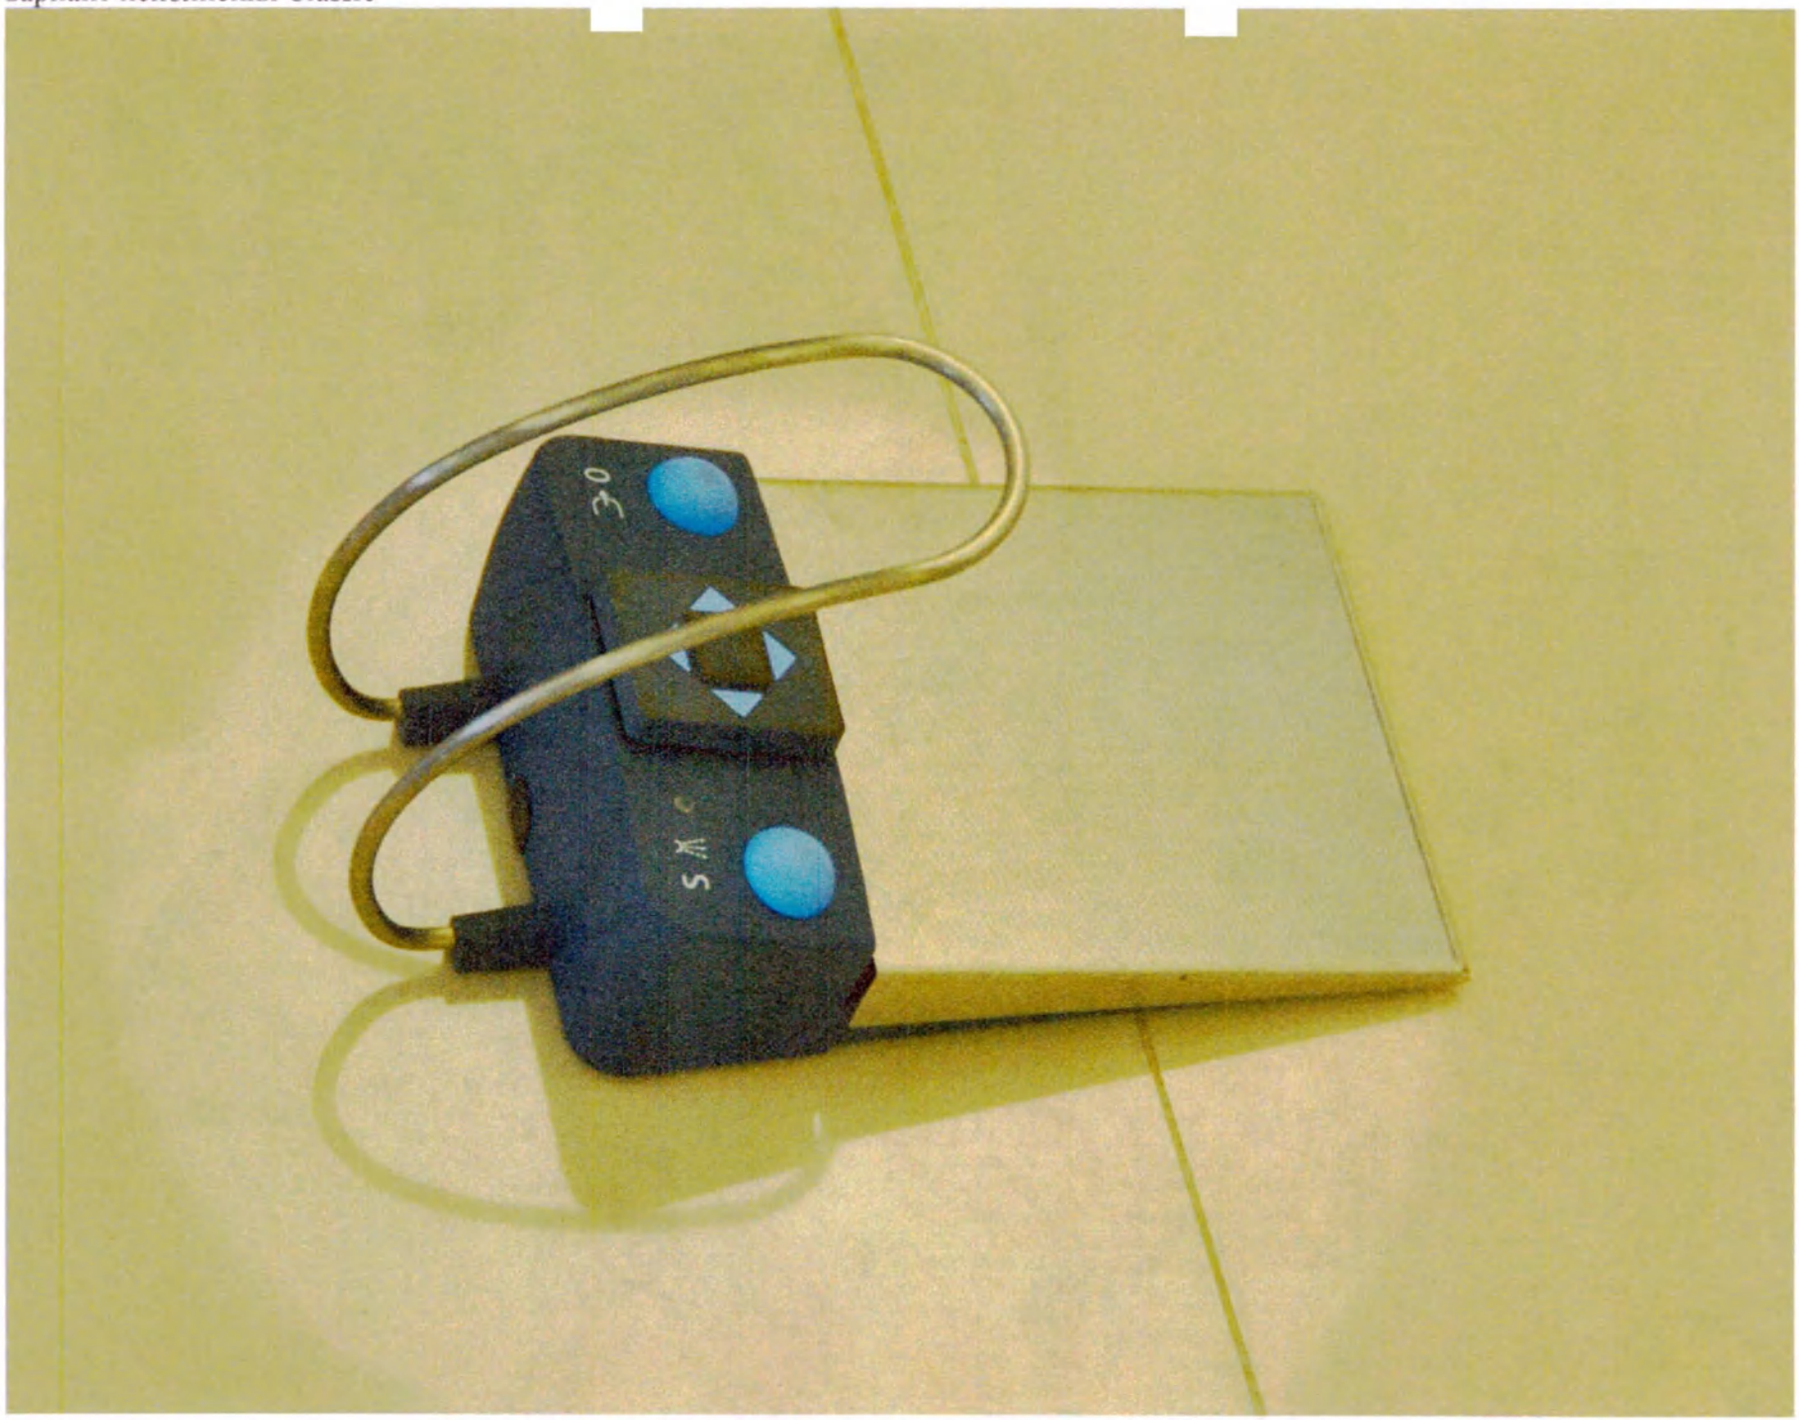

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Моторизованный подголовник.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Подушка для подголовника.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Подлокотники (правый и/или левый).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Подушка корректирующая на сиденье кресла пациента.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Разъём для сторонних устройств.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Плита установочная, вариант исполнения [redacted]ндартная



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения демонстрационная

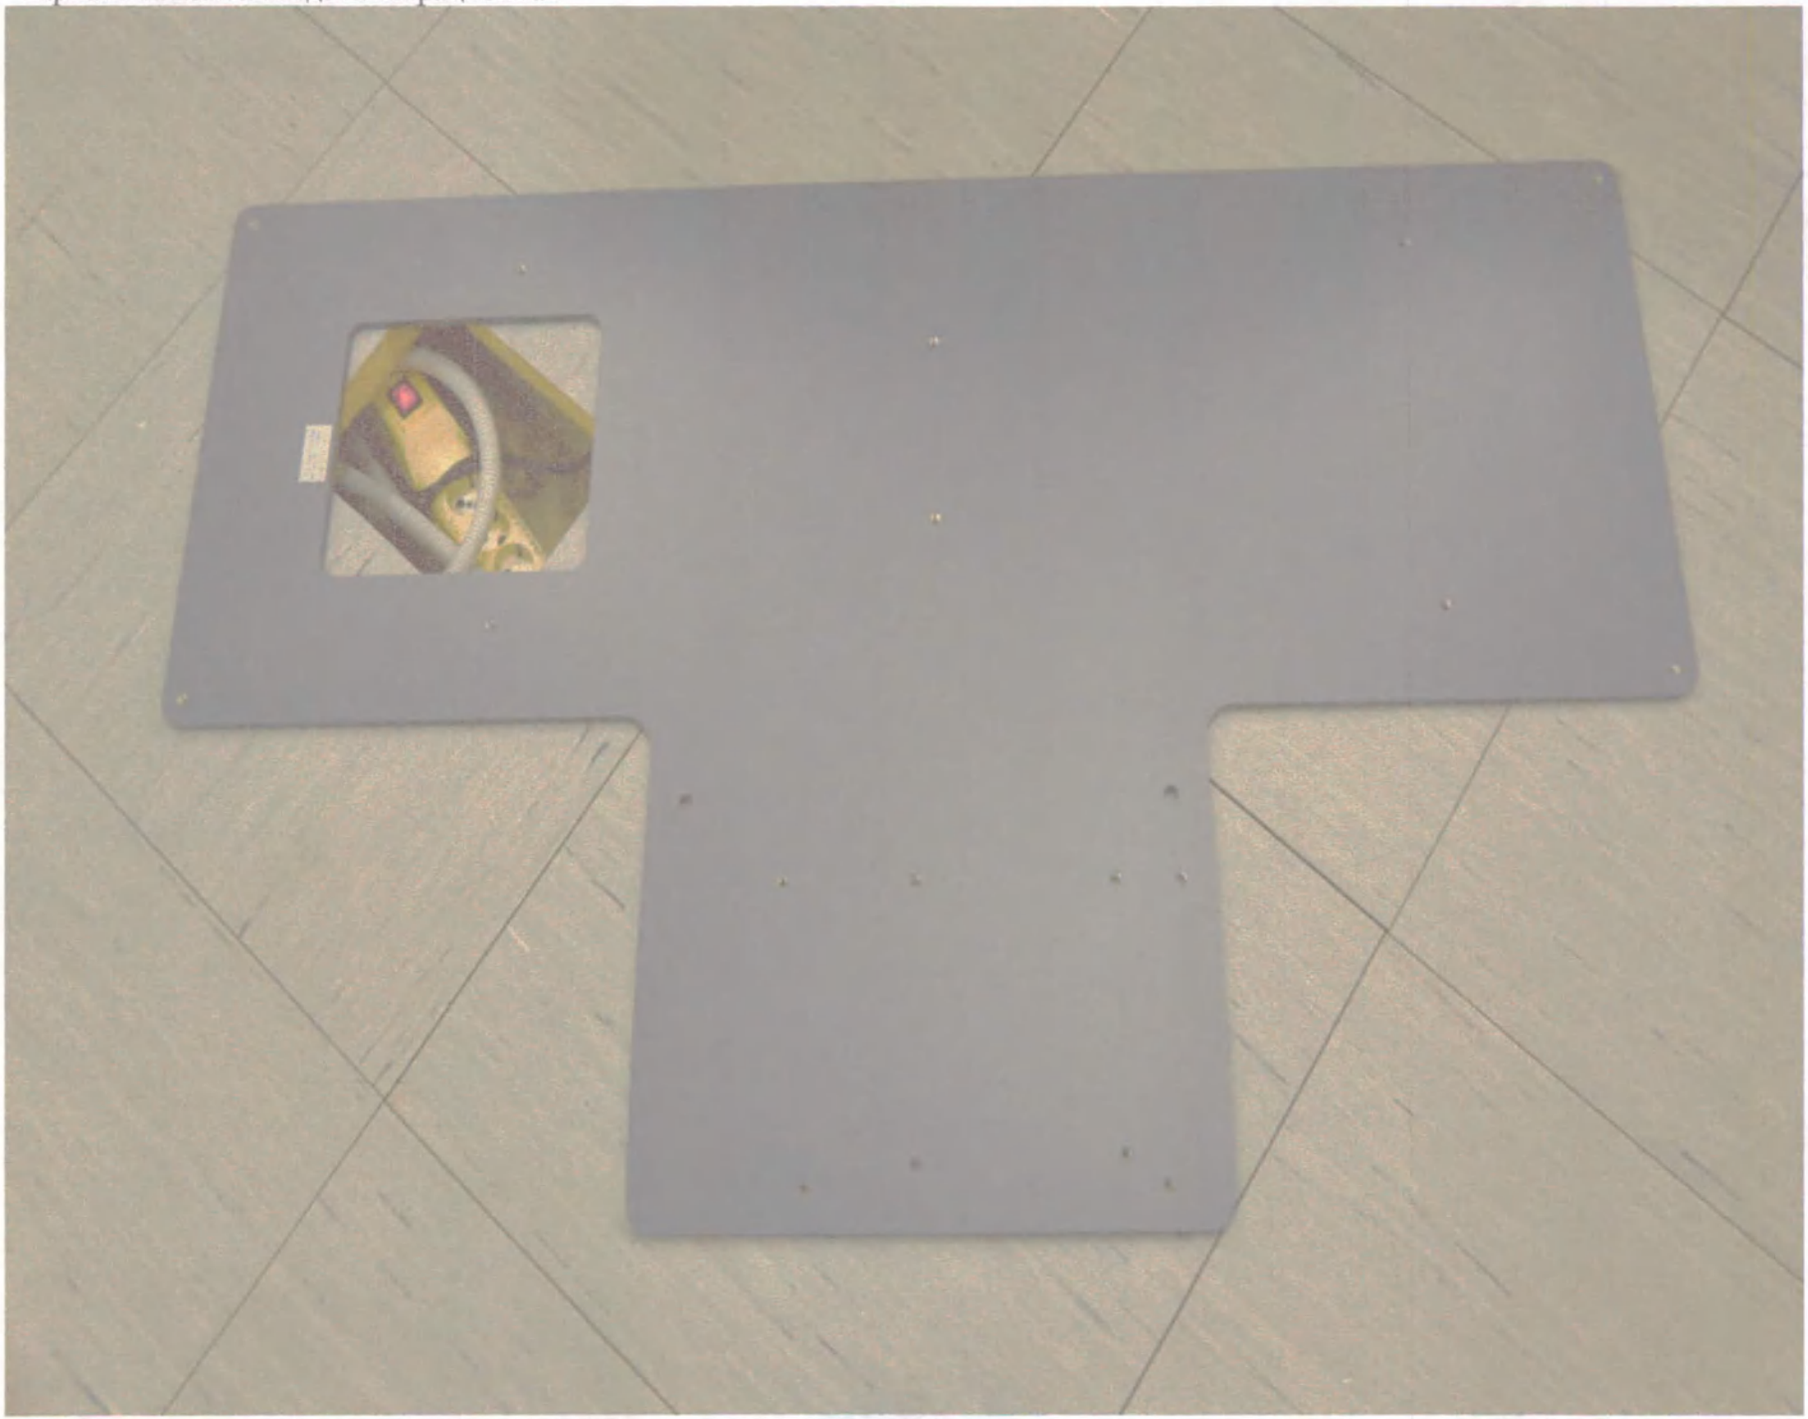


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Блок врача с элементами для подключения.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Нескользящий силиконовый мат, вариант исполнения для блока врача

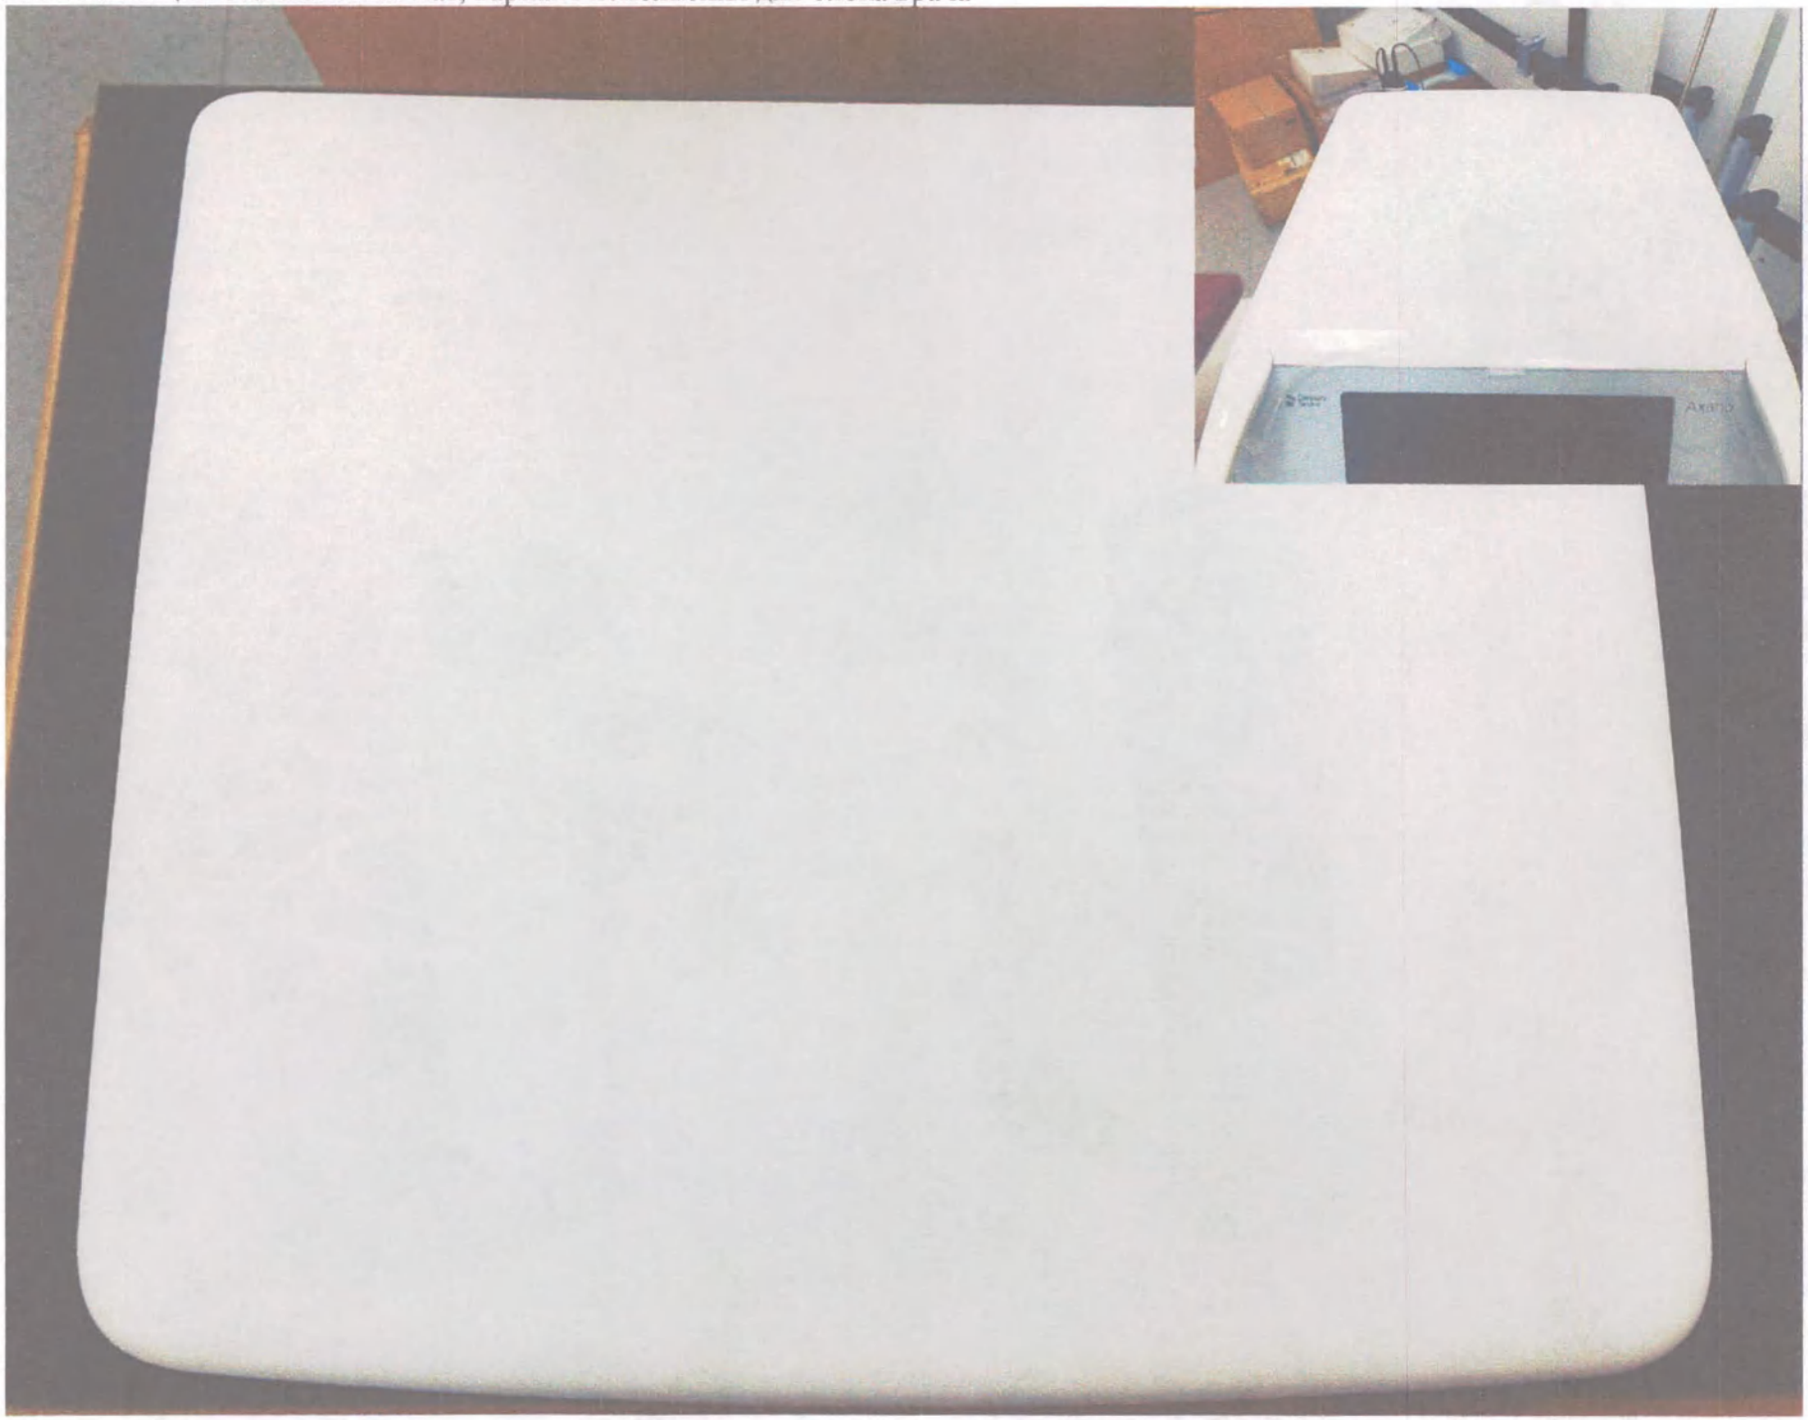

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения для блока ассистента

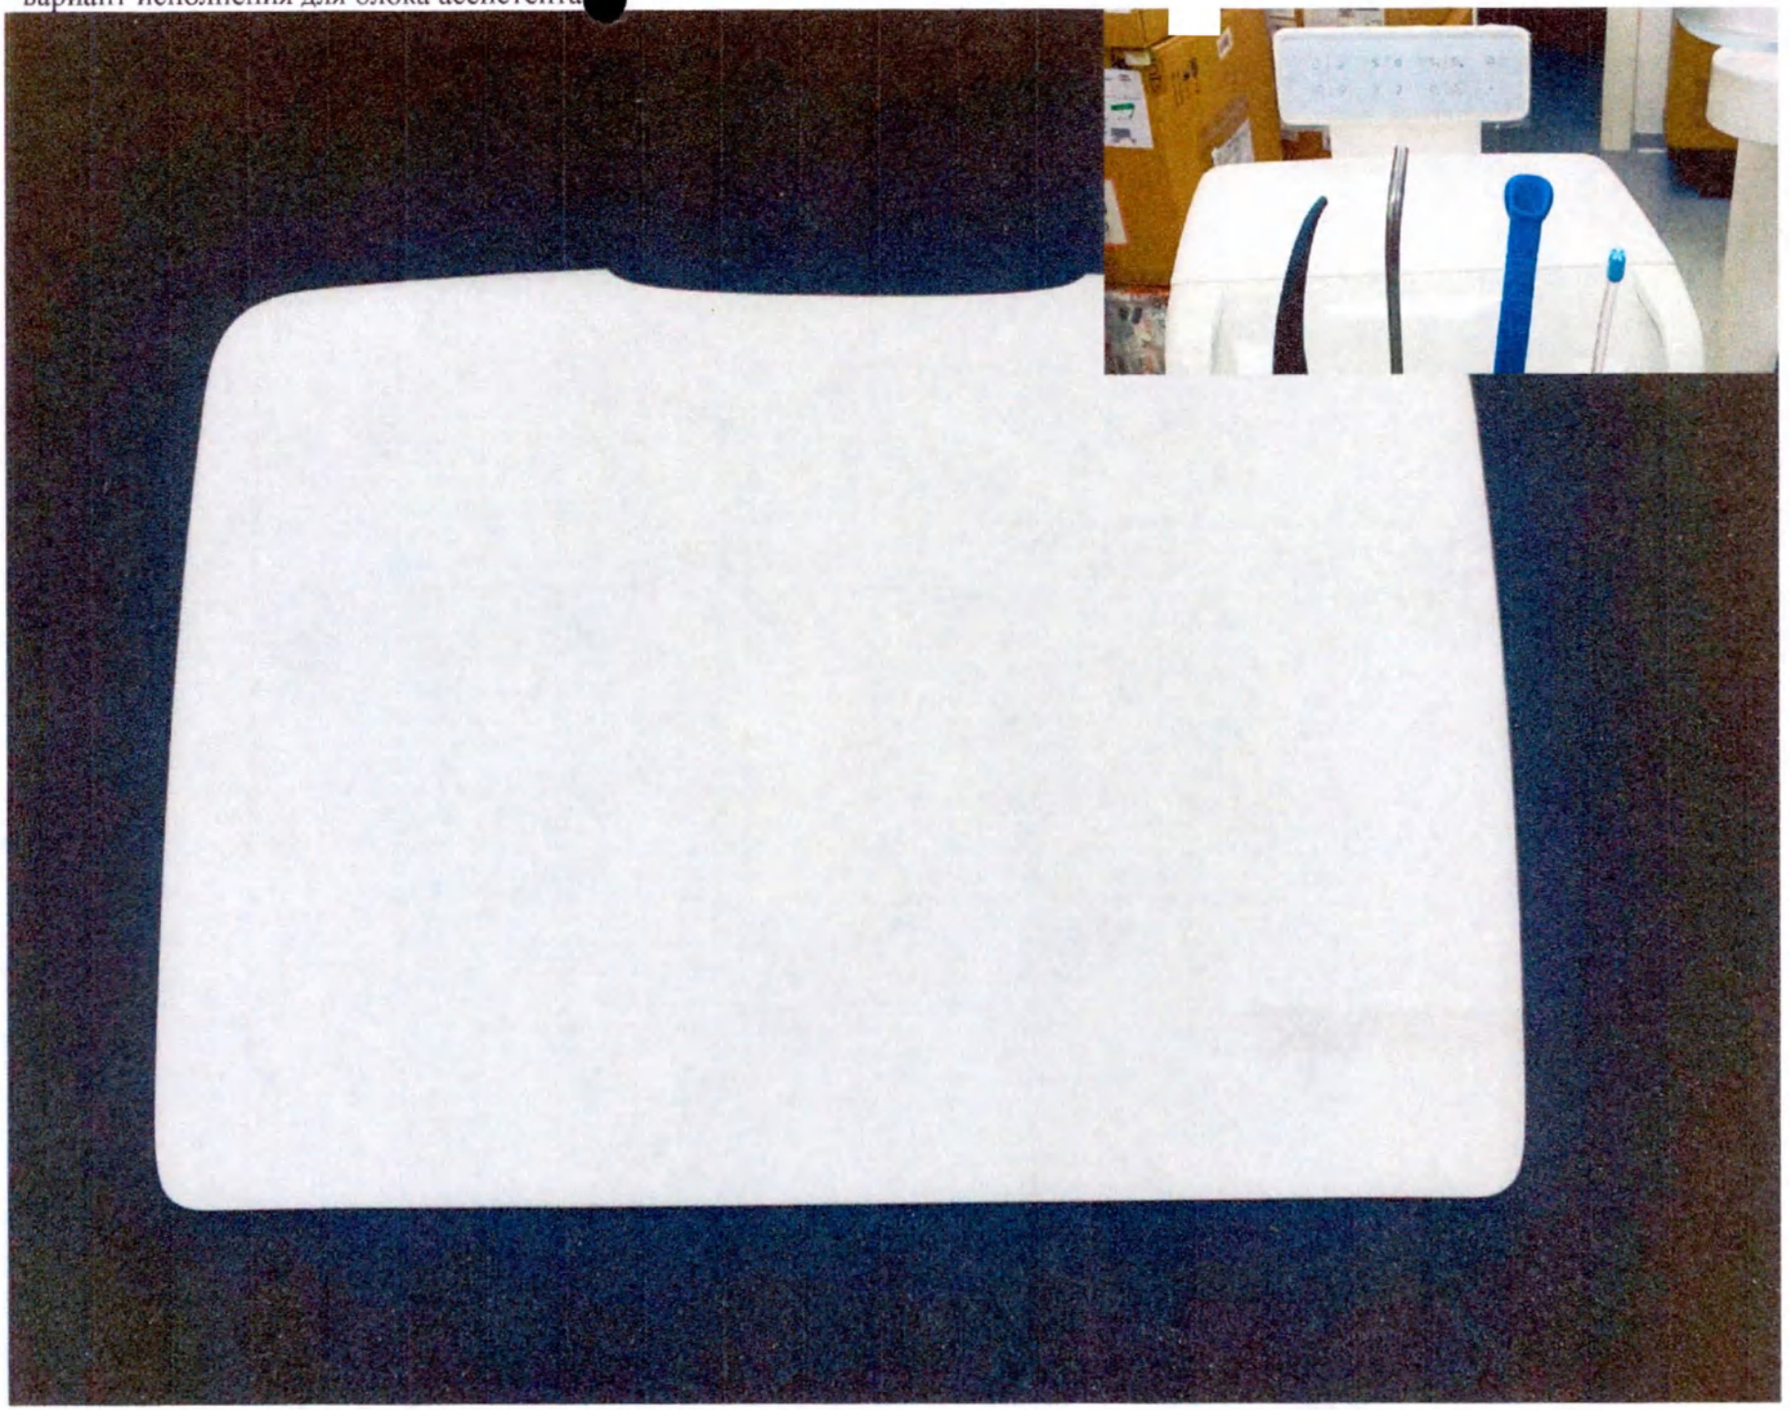

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения для лотка



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. Универсальный пистолет (пустер) Sprayvi [illegible]rayvit M) со шлангом, варианты исполне[illegible]: (левосторонний и/или правосторонний).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


12. Ультразвуковой наконечник (скейлер) SiroSonic TL со шлангом.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. Моторы со шлангами,
вариант исполнения BL E

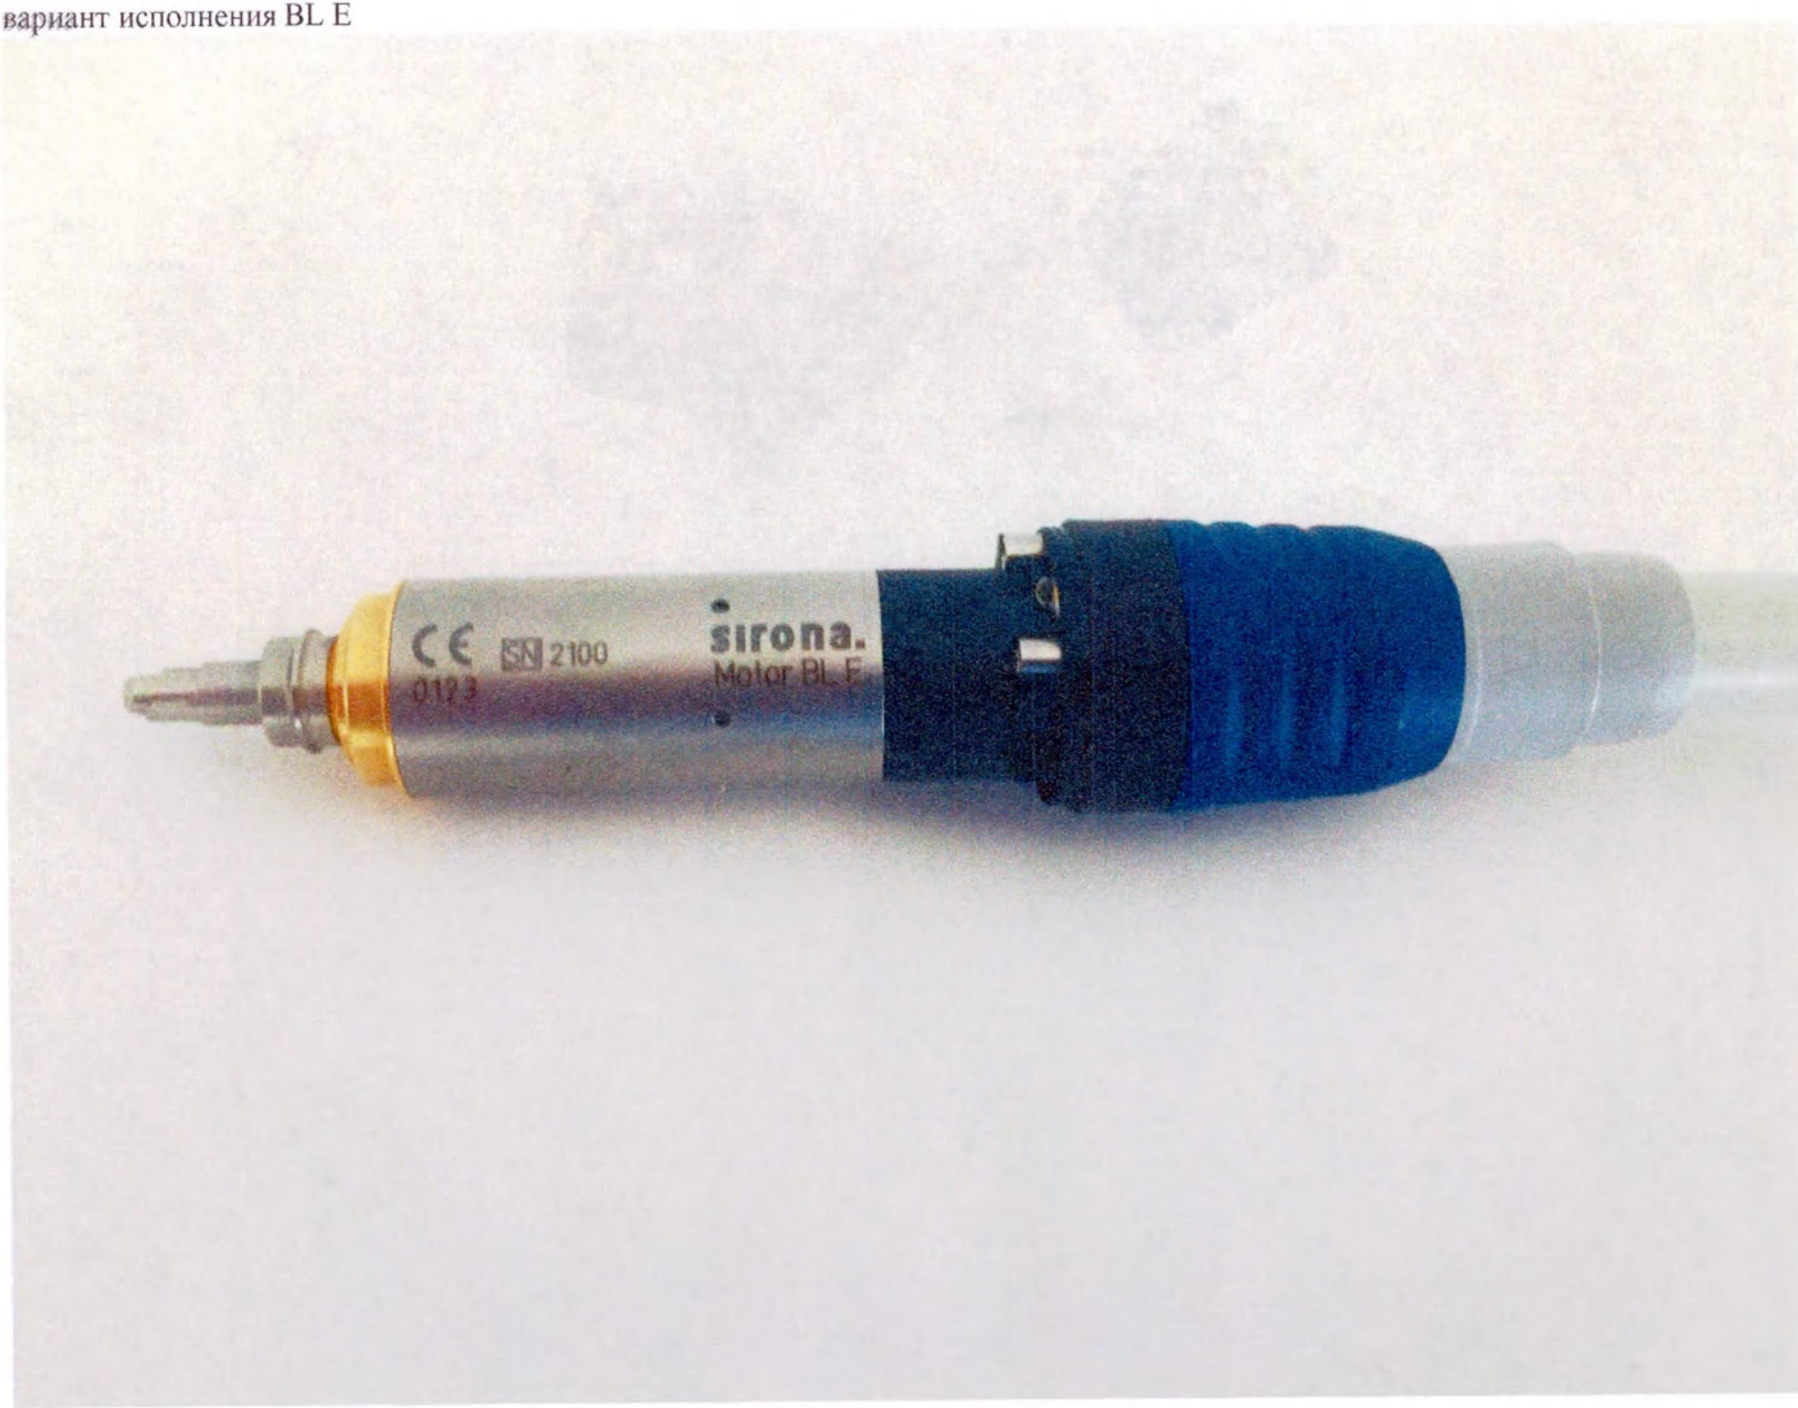


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

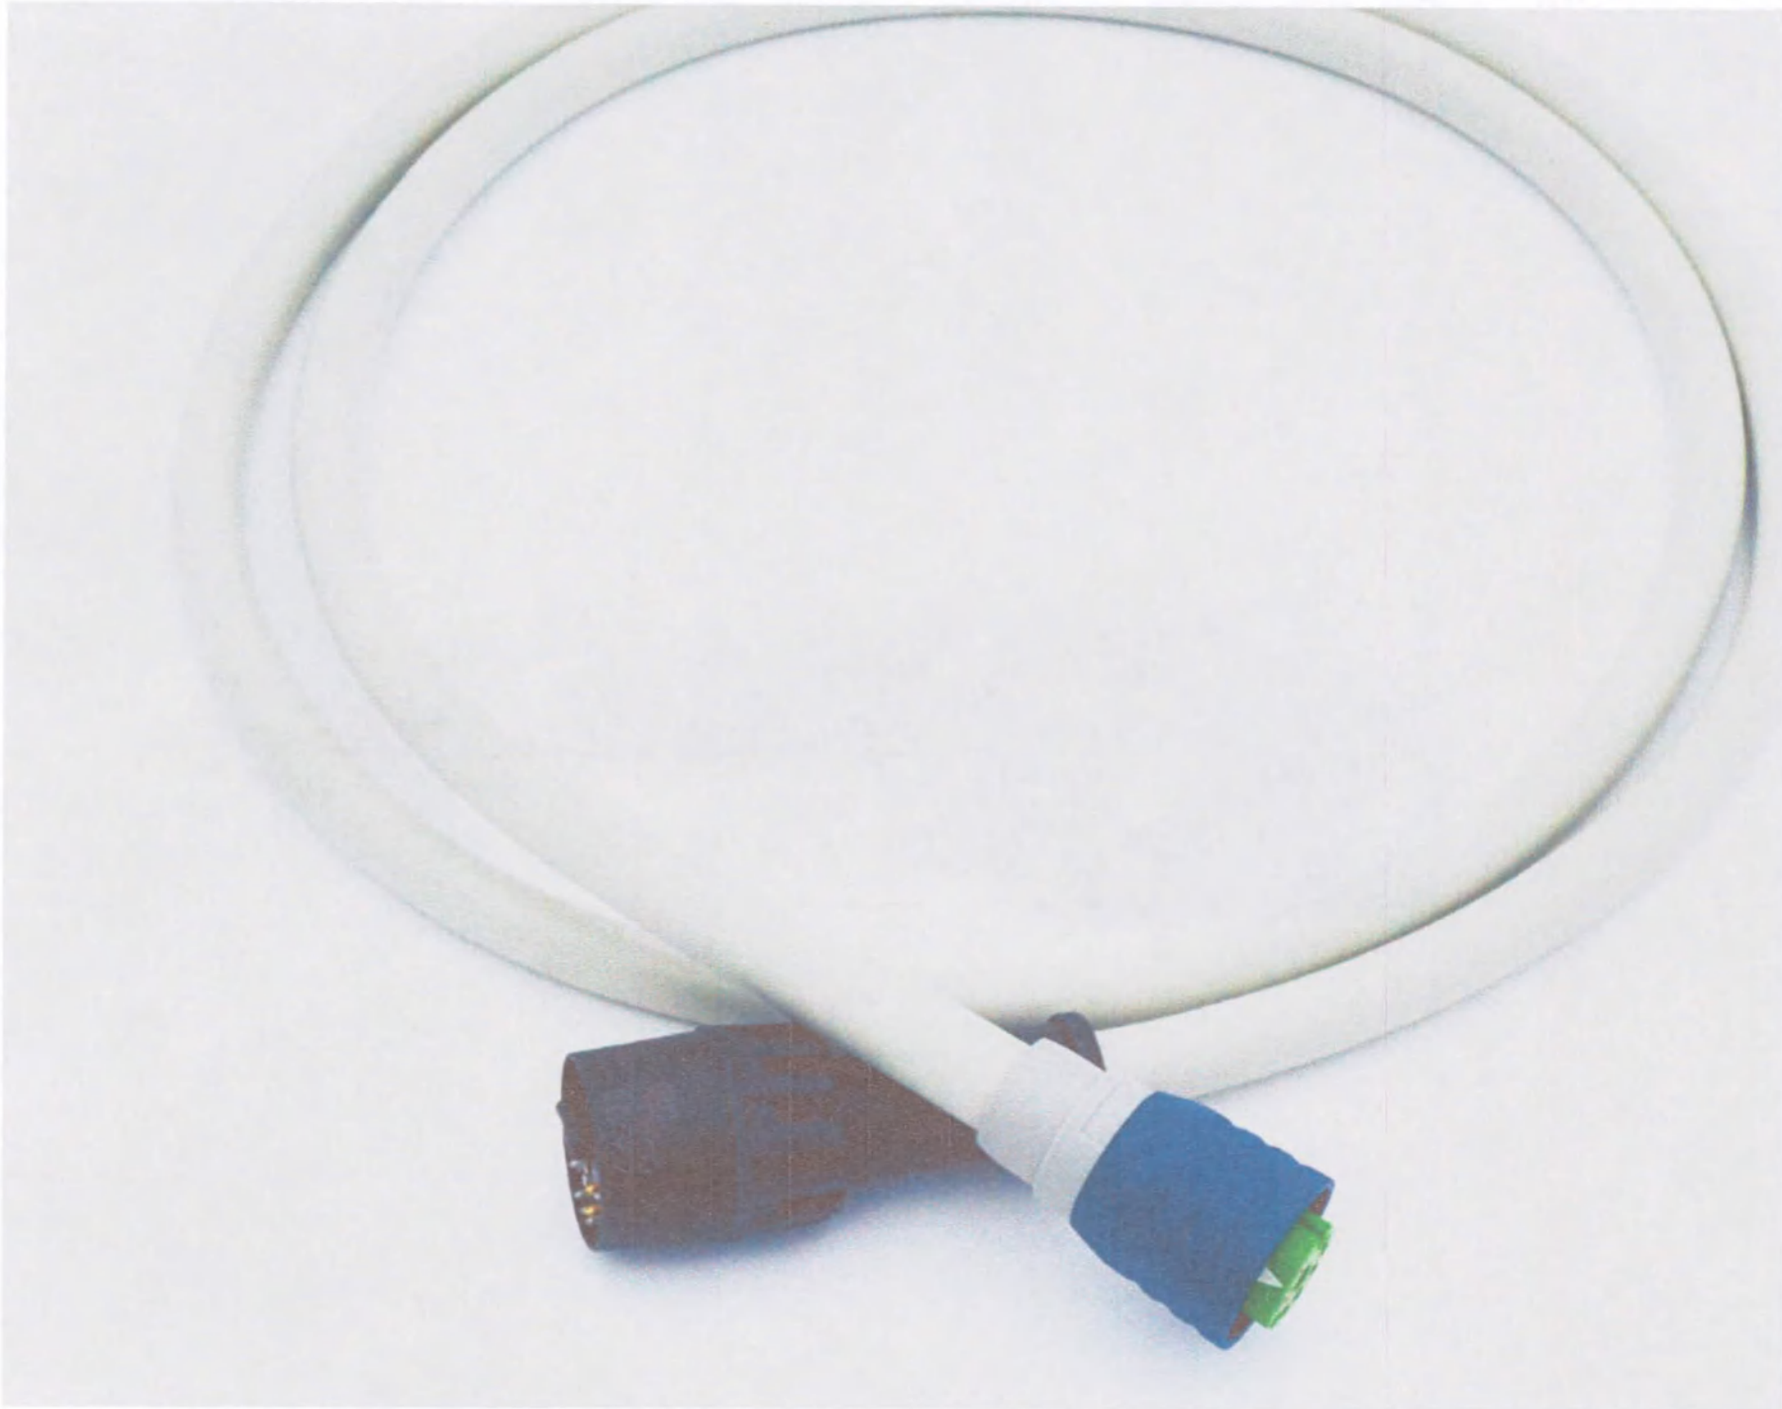

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения BL ISO F



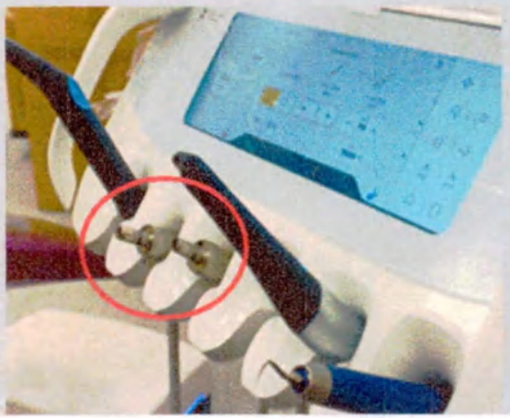

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения BL Implant E



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. Шланг для турбин.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15. Быстросъемное соединение quick coupling R (LED) для турбин.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

16. Внутриротовая камера SiroCam AF+, с э[illegible]ентами для подключения.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17. Боковая подставка для внутриротовой камеры.

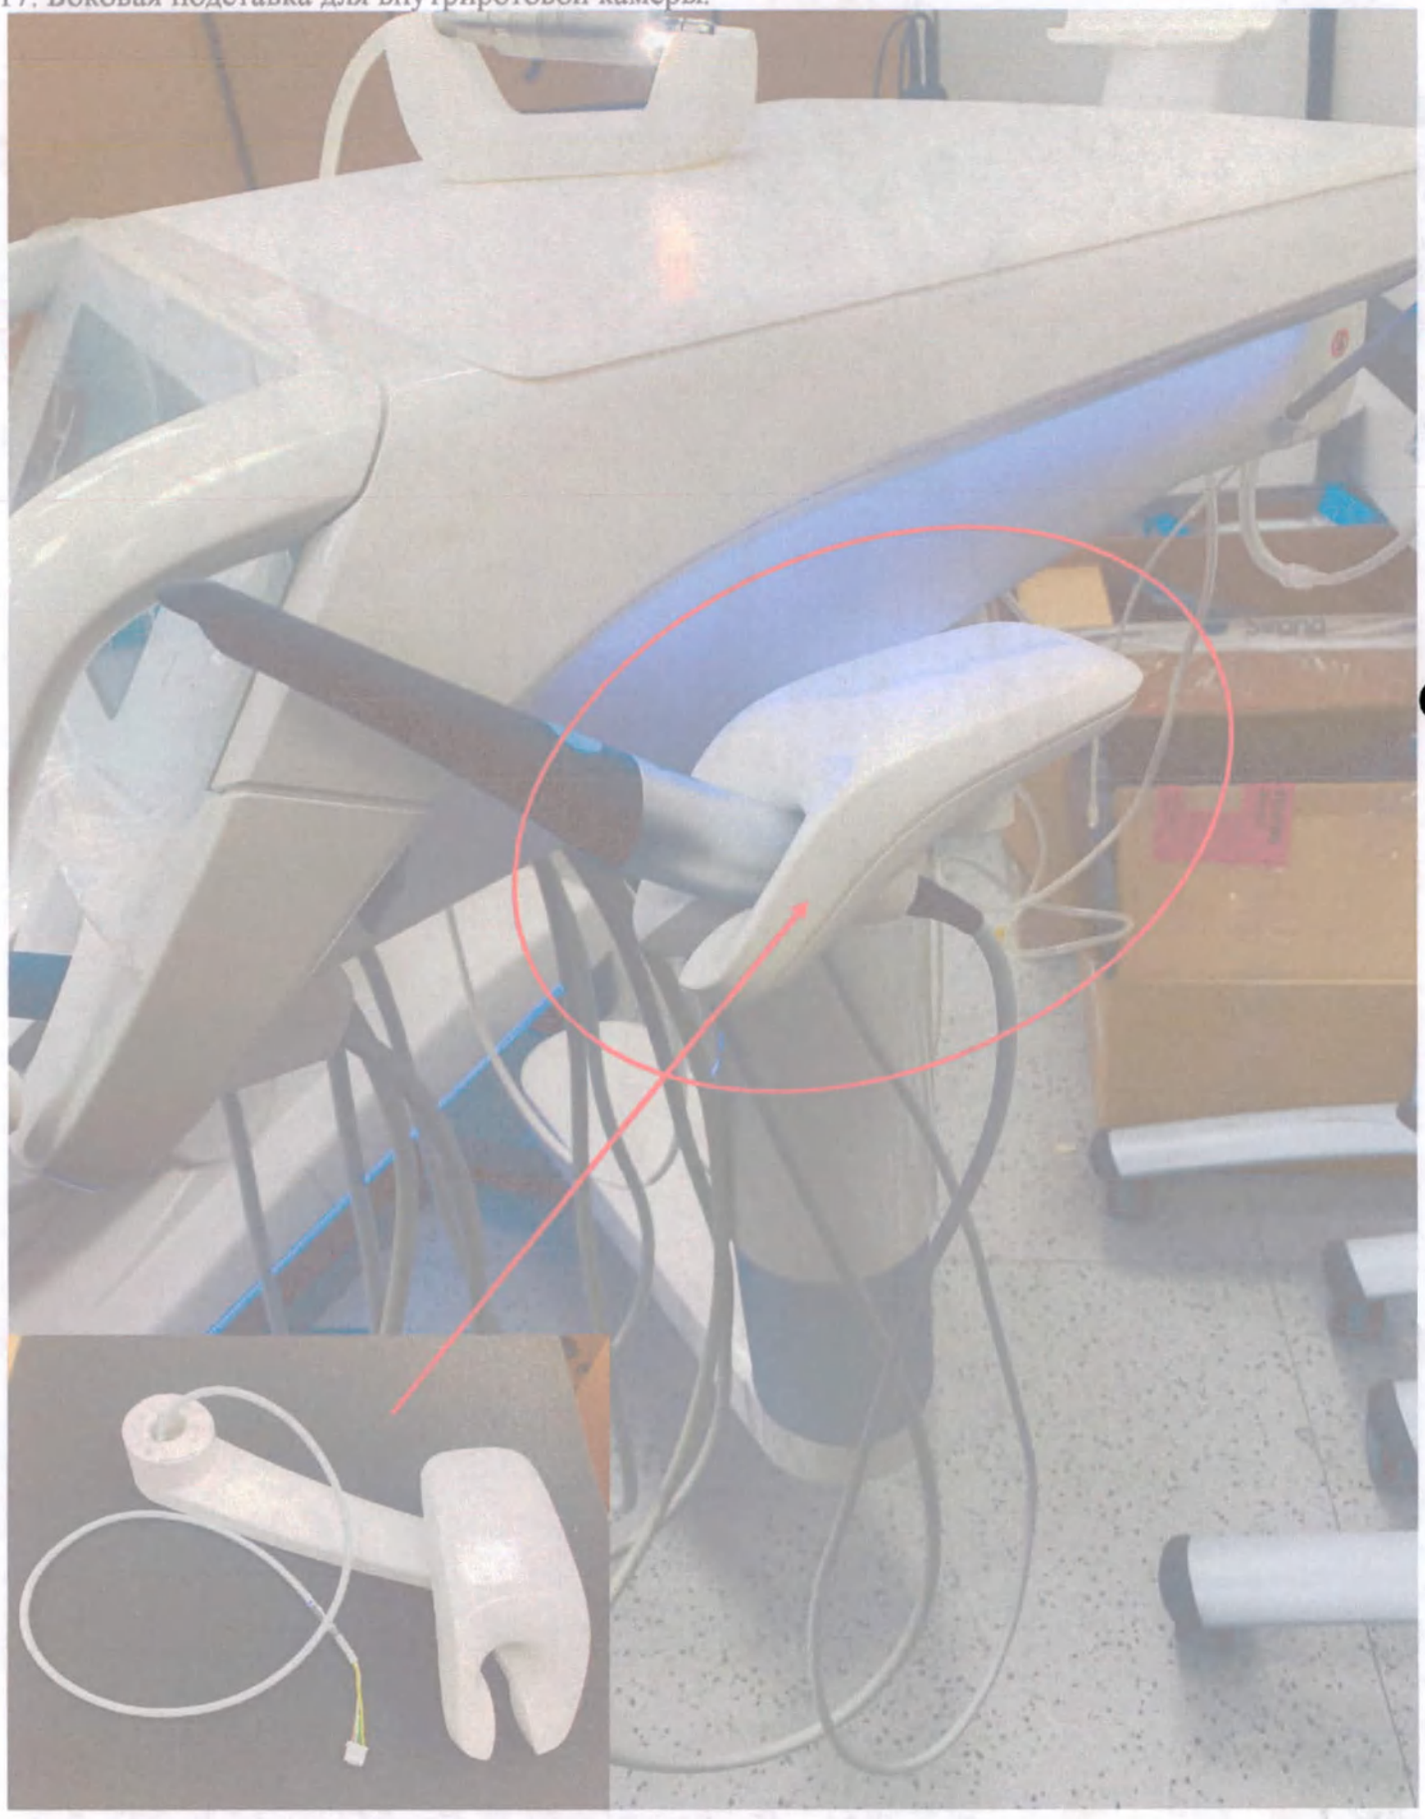

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

18. Компоненты встроенного ApexLocator, в составе: электрод (A), зажим для губ (B), зажим файла (C), кабель (D)

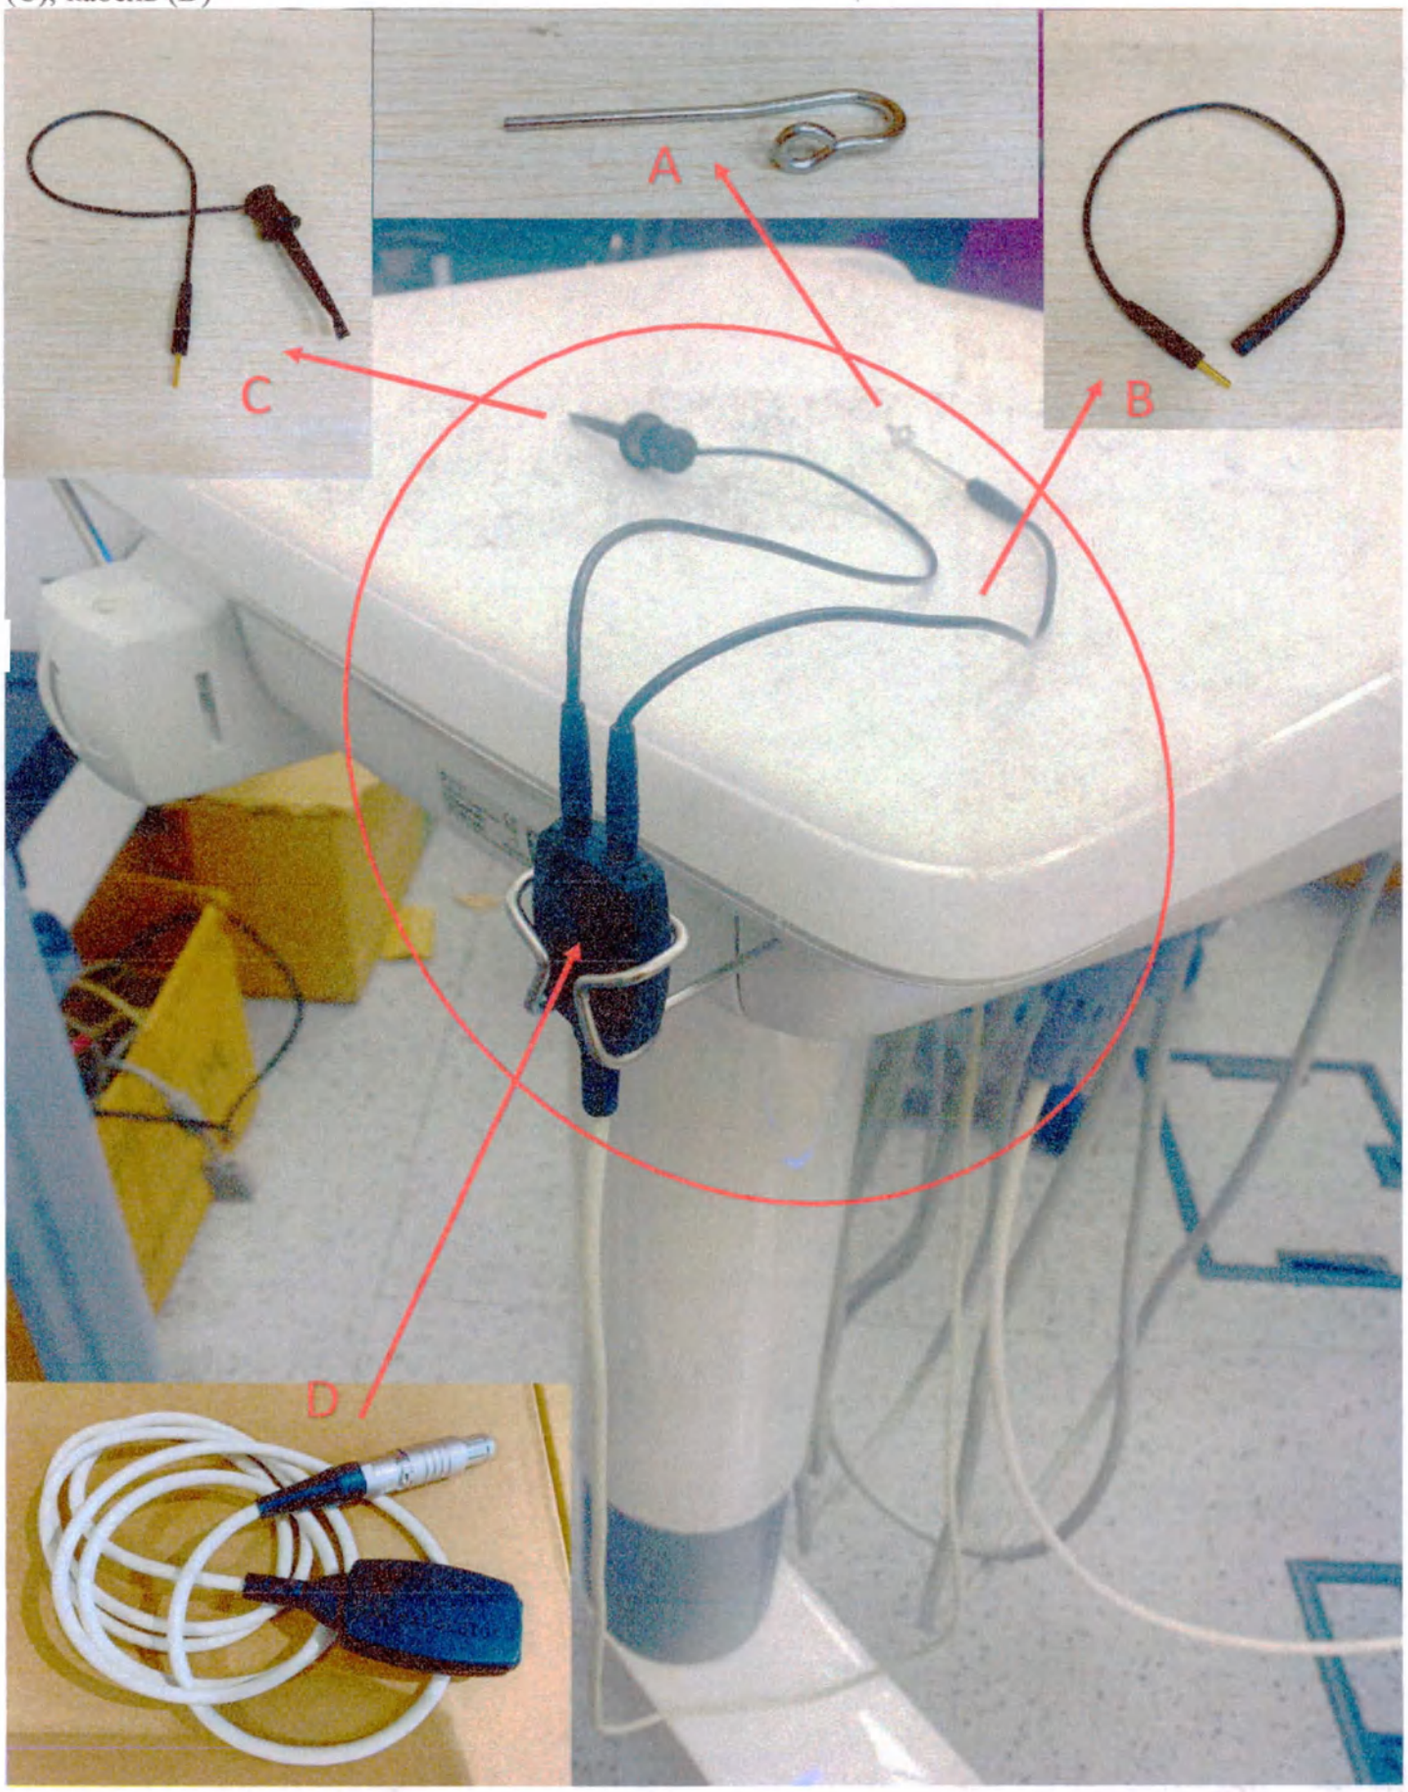

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

19. Наконечник эндодонтический угловой T1 Line Endo 6 L



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наконечник эндодонтический угловой Endo 6:1



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

20. Изолирующая силиконовая оболочка для эндодонтии с ApexLocator.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

21. Перистатический насос для подачи физиологического раствора NaCl.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

22. Набор шлангов для перистальтического насоса (упаковка 5 штук).

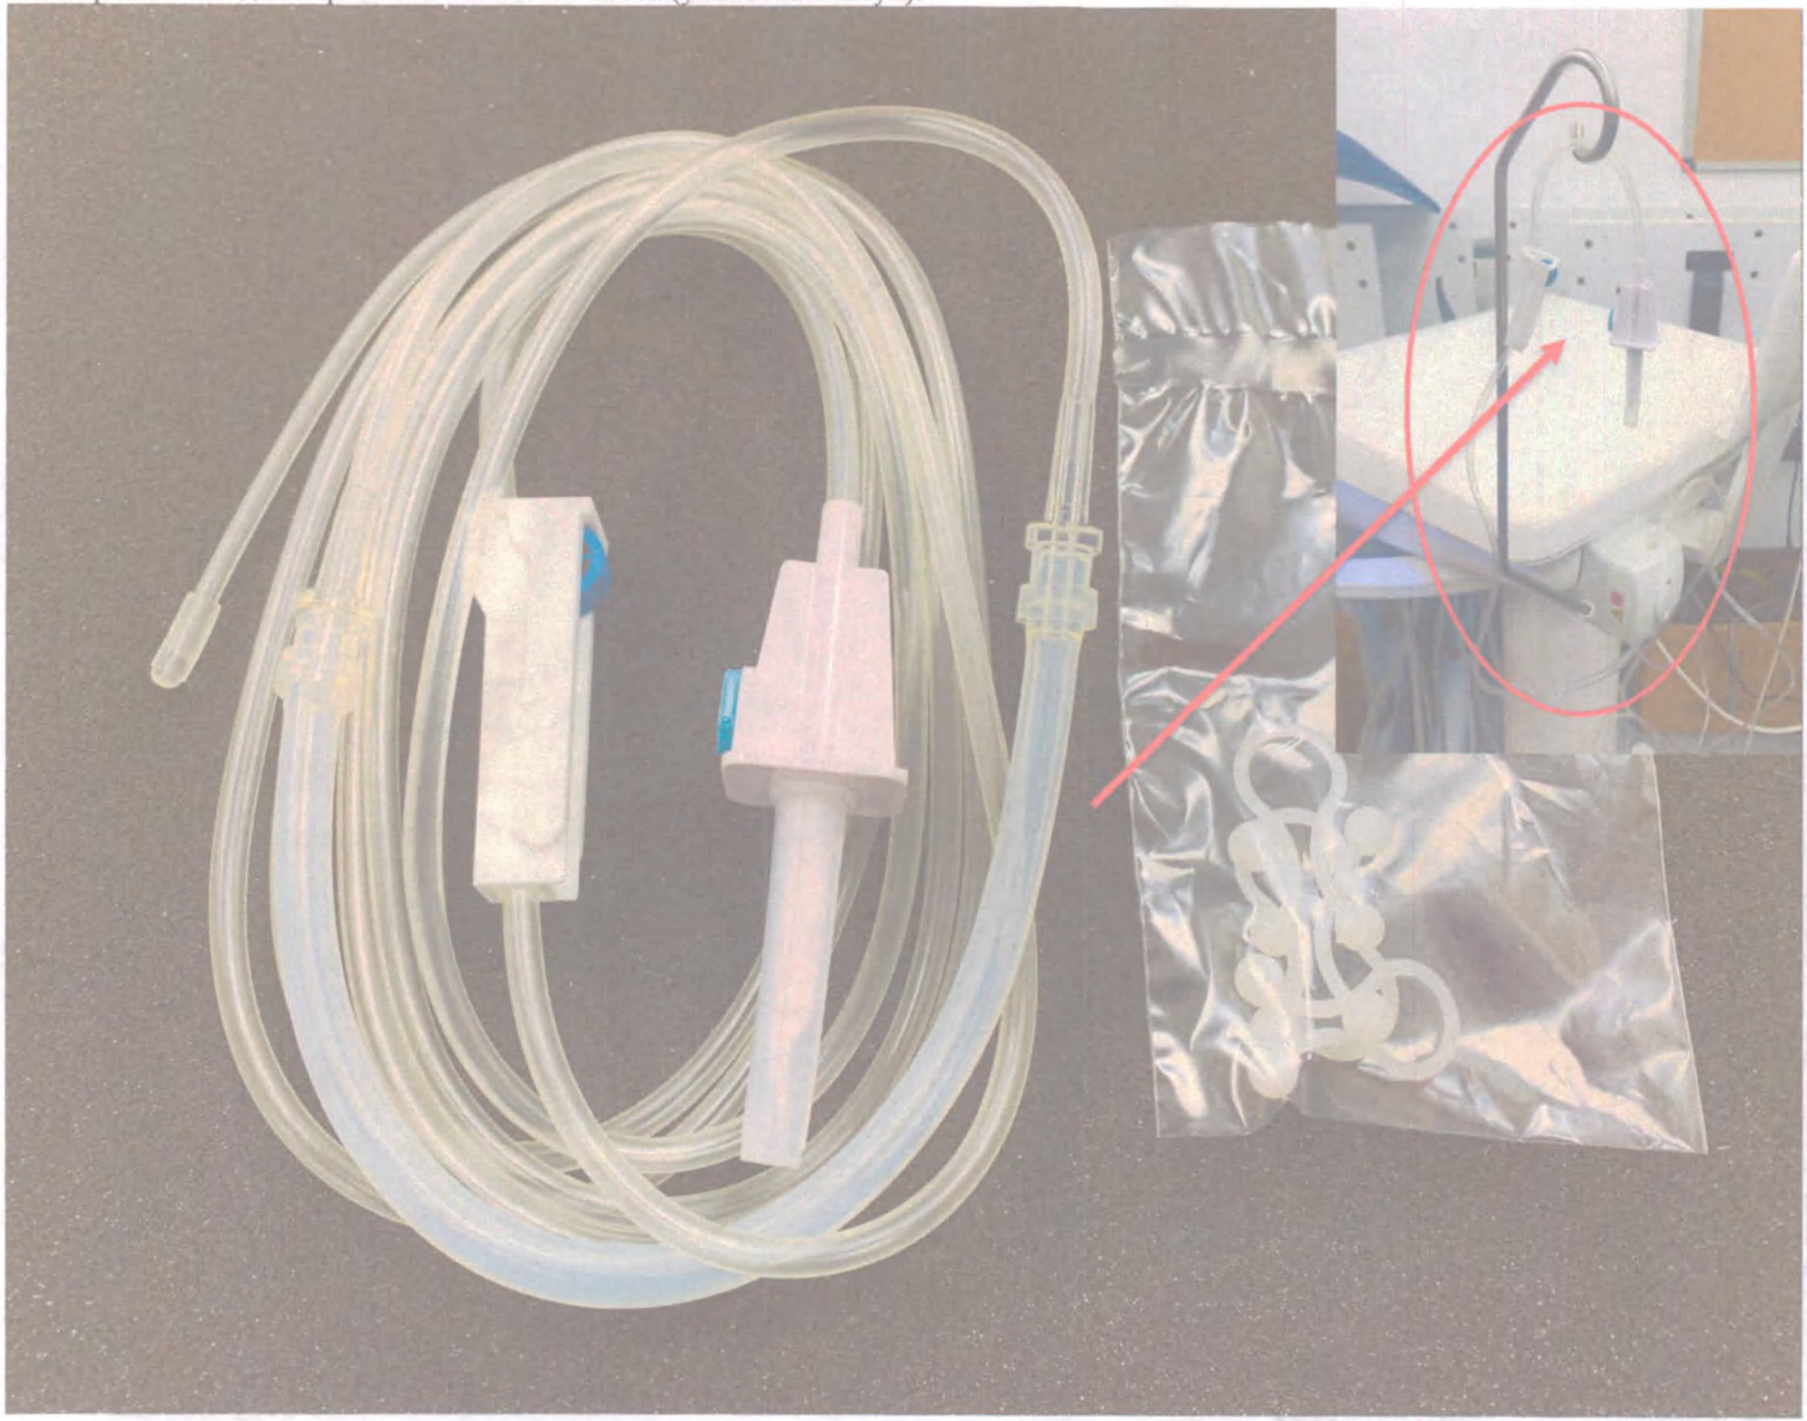

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

23. Съемный хомут для бутылки с физиологи[redacted]ким раствором NaCl.

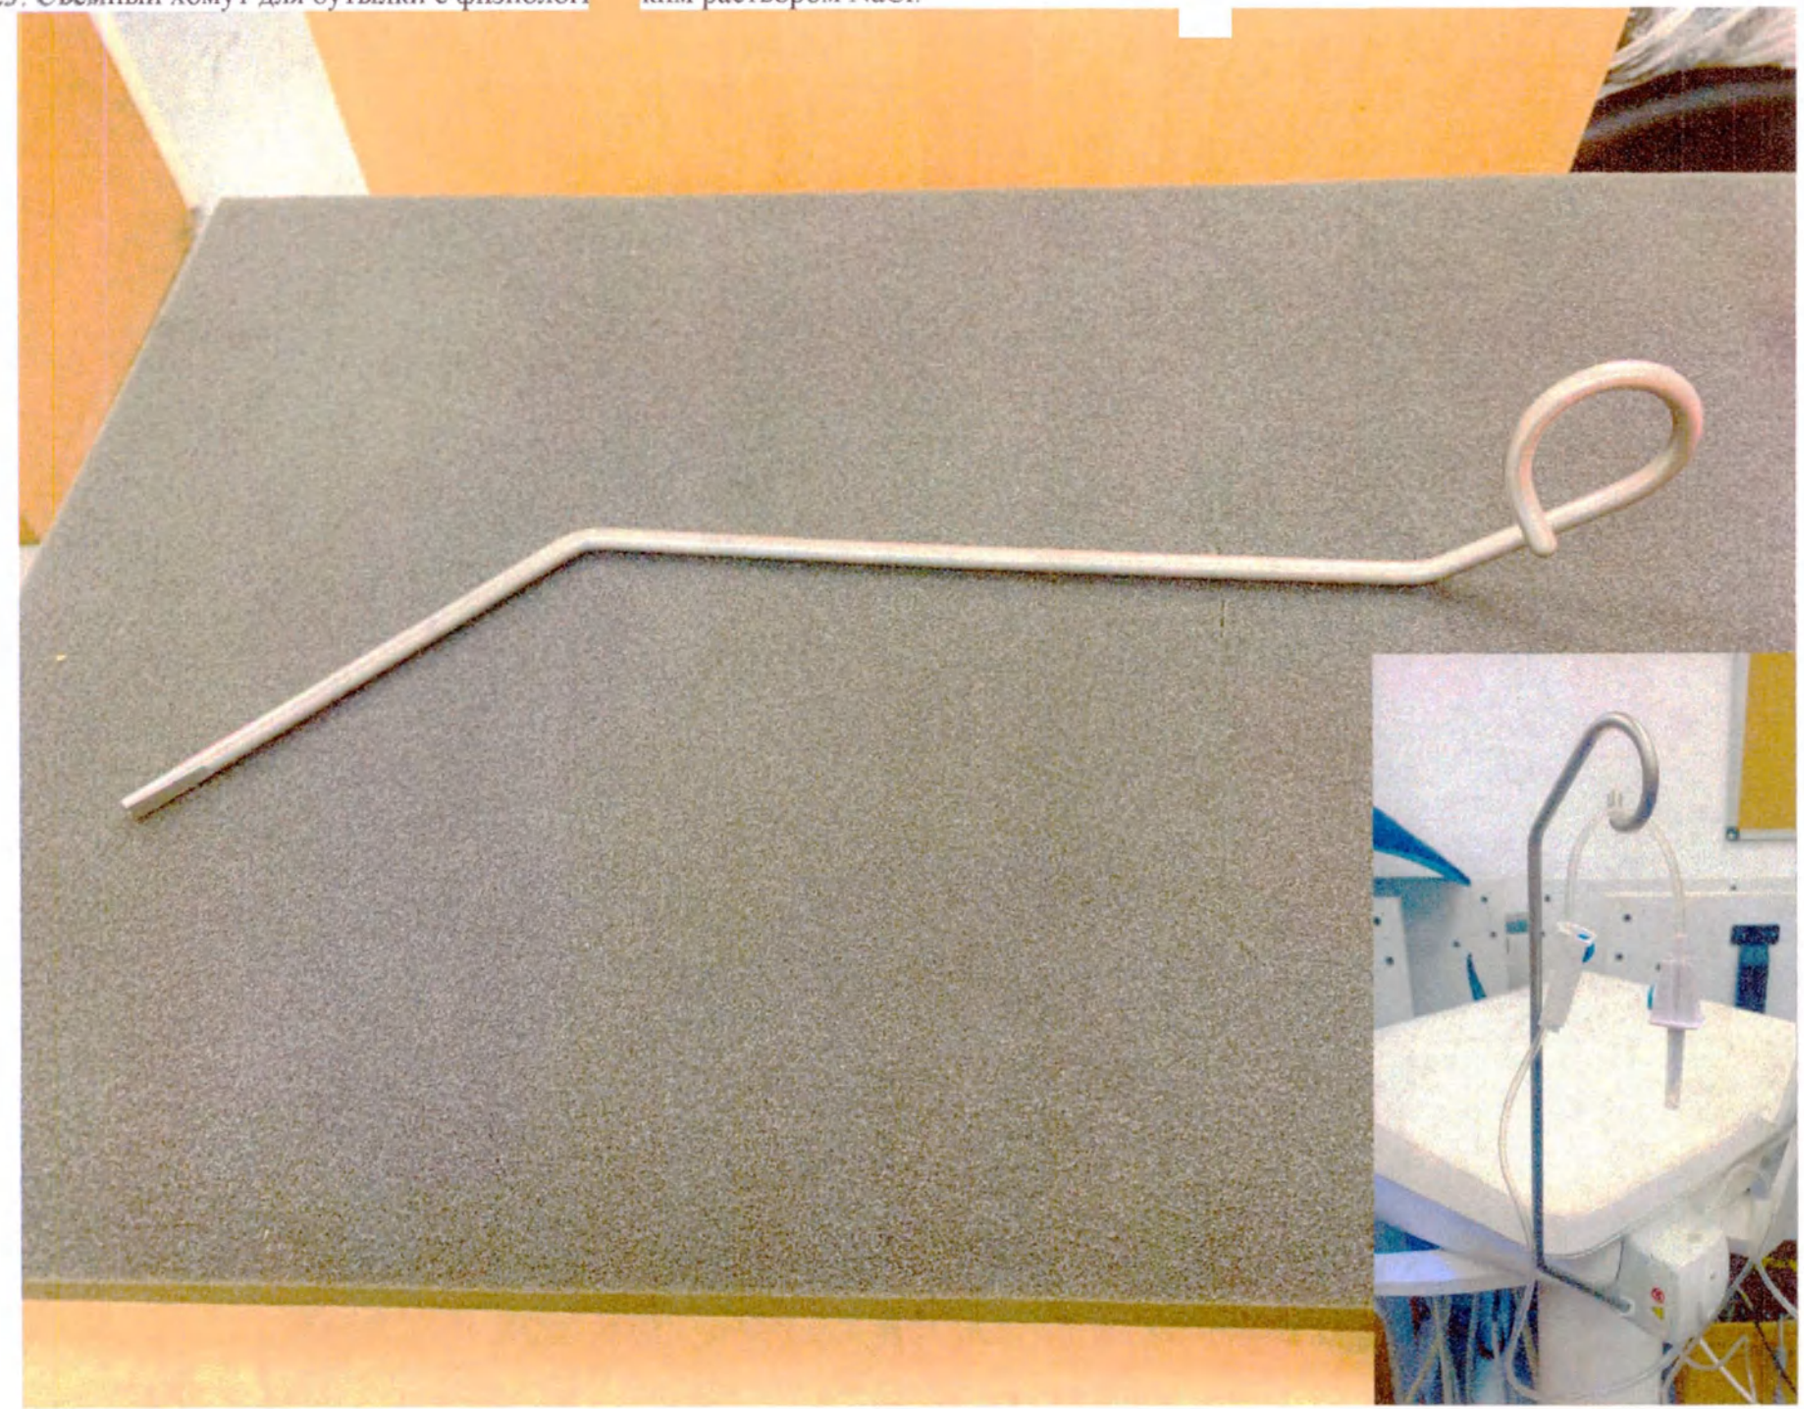

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


24. Наконечник механический угловой CA 20:1 L MICRO-SERIES.





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

25. Силиконовая подставка для стерильных и рументов.

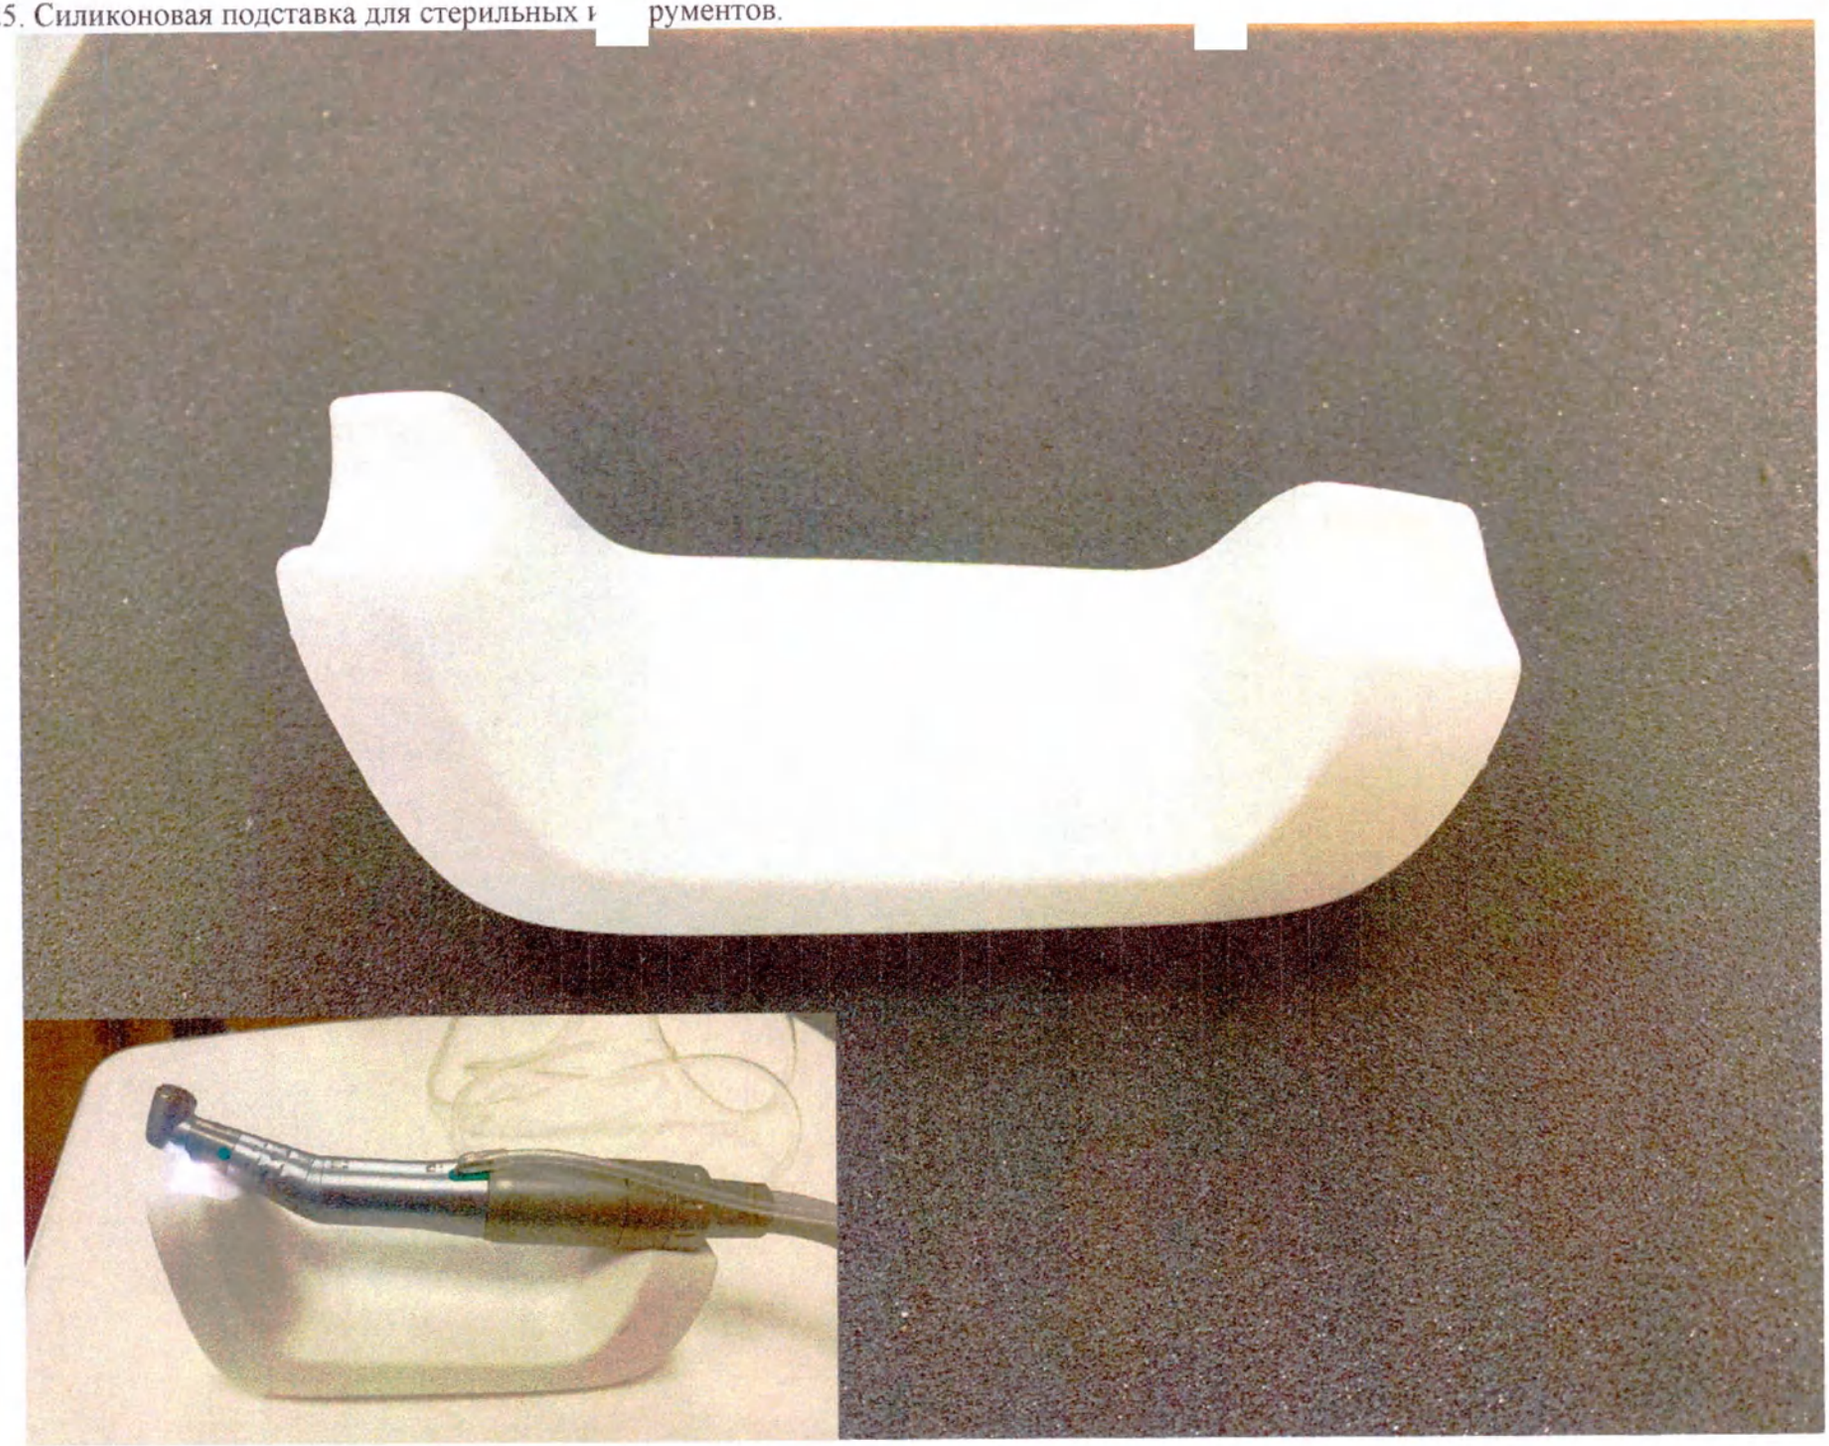


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

26. Рентгеновский негатоскоп для панорамных снимков.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

27. Магнитный держатель для смарт-устройства или негатоскопа для панорамных рентгеновских снимков.

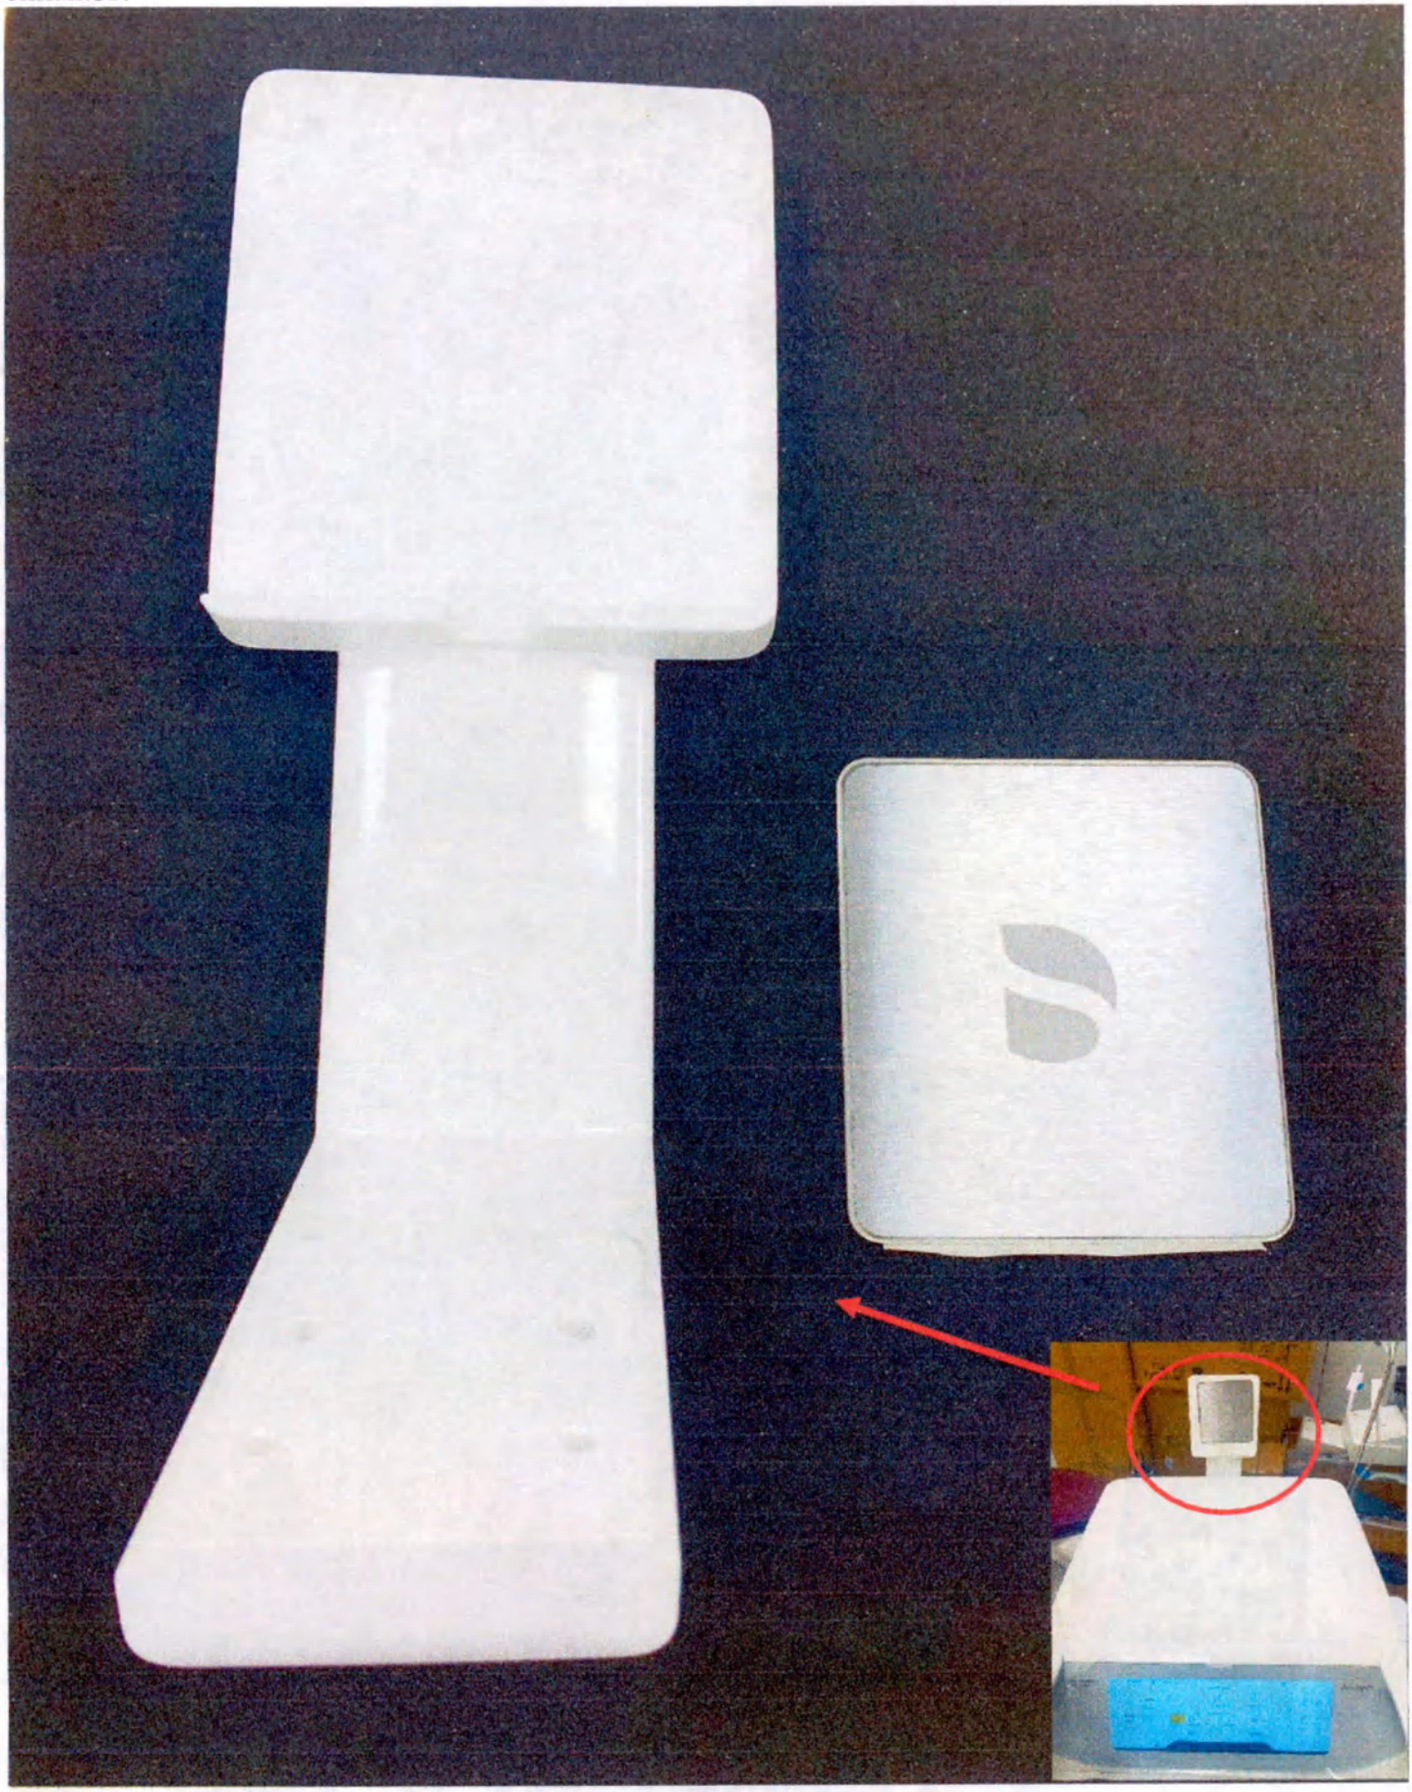


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

28. Лоток с элементами крепления.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

29. Держатель стакана.

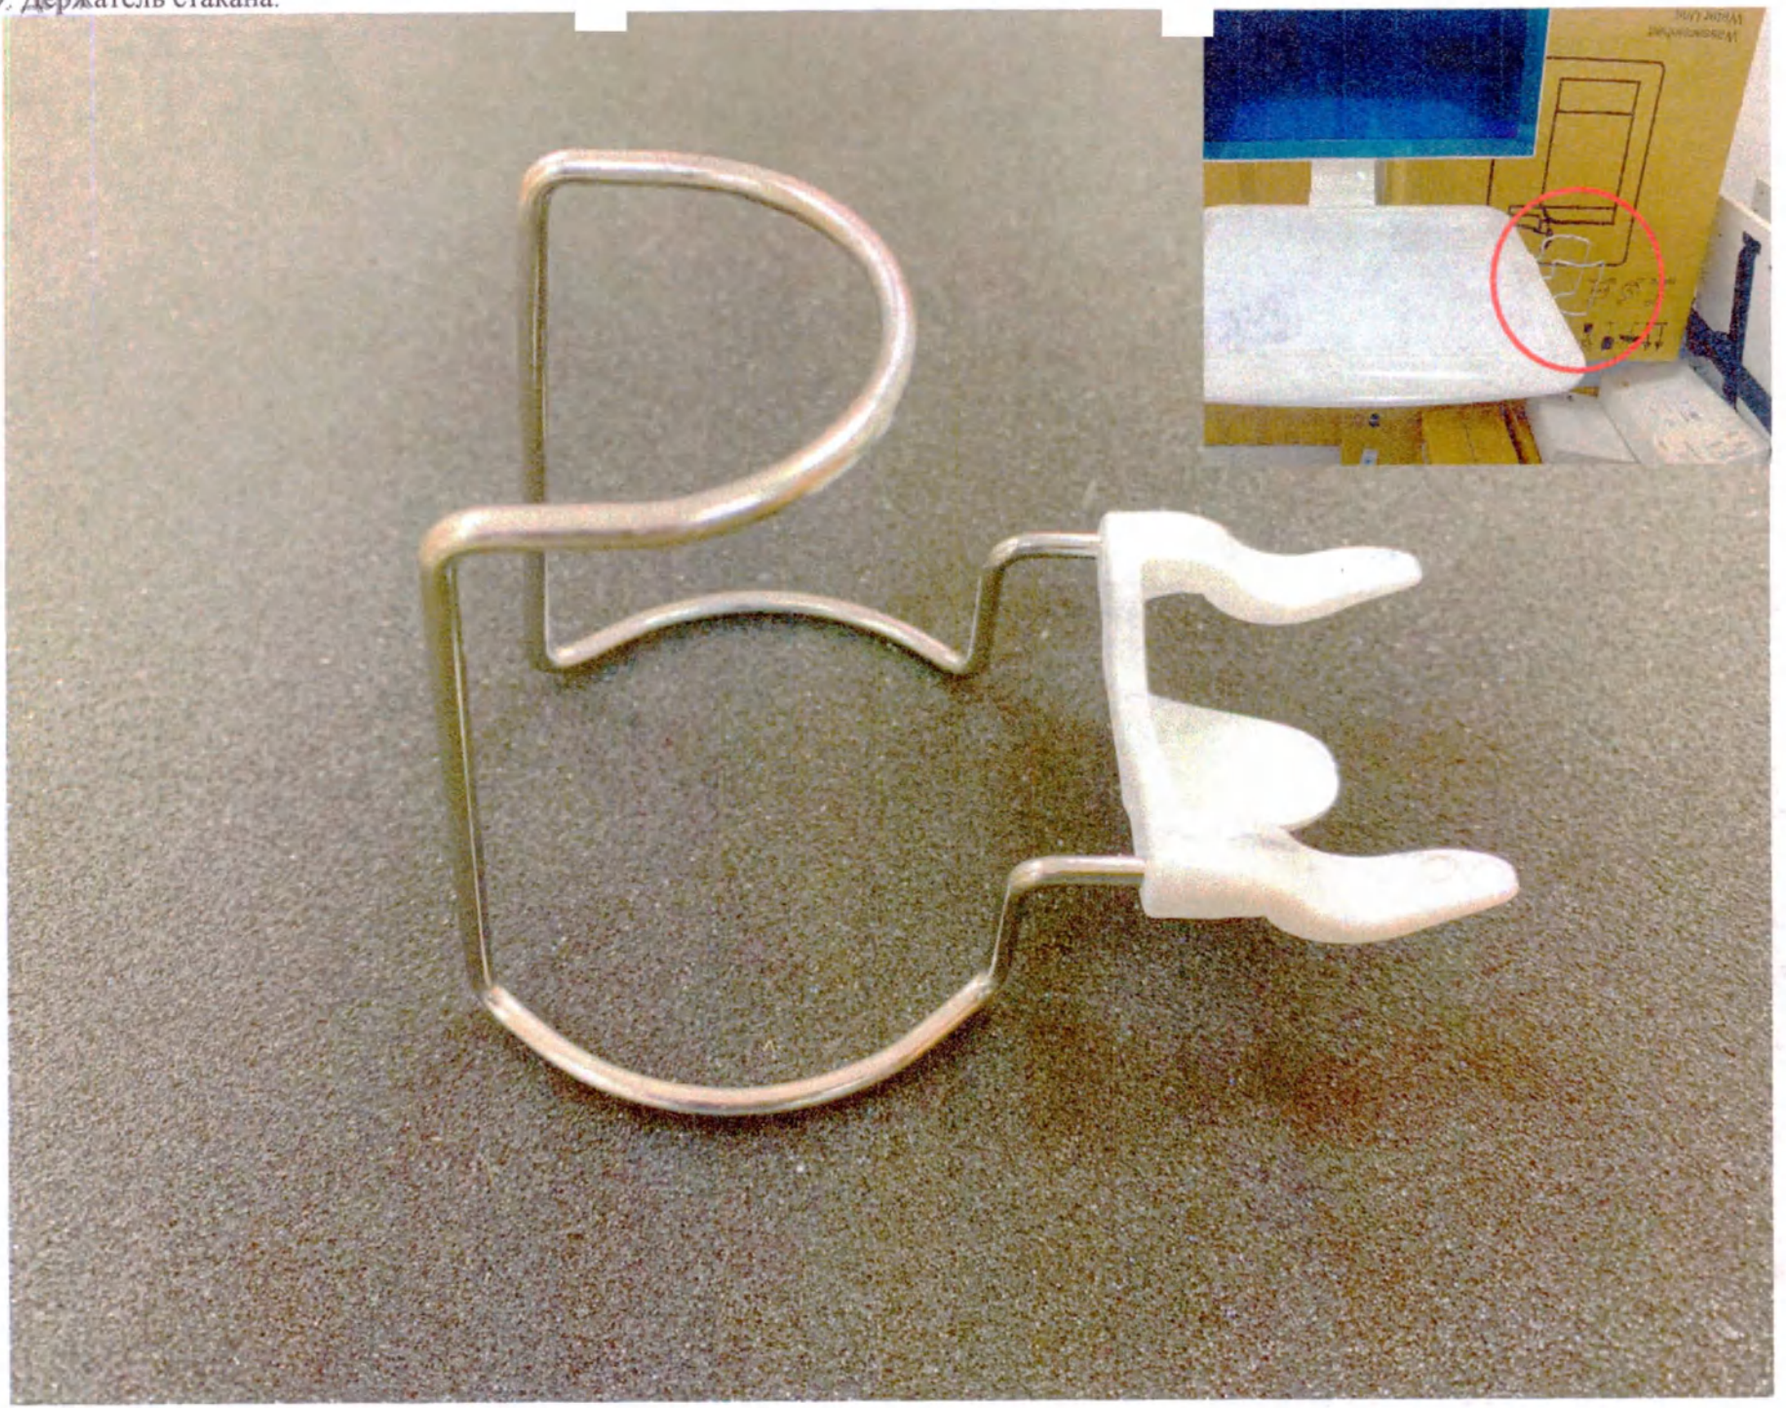

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

30. Блок ассистента с элементами для подключения.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

31. Наконечник отсасывателя аэрозольного тумана.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

32. Канюля отсасывателя аэрозольного тумана.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

33. Шланг отсасывателя аэрозольного тумана

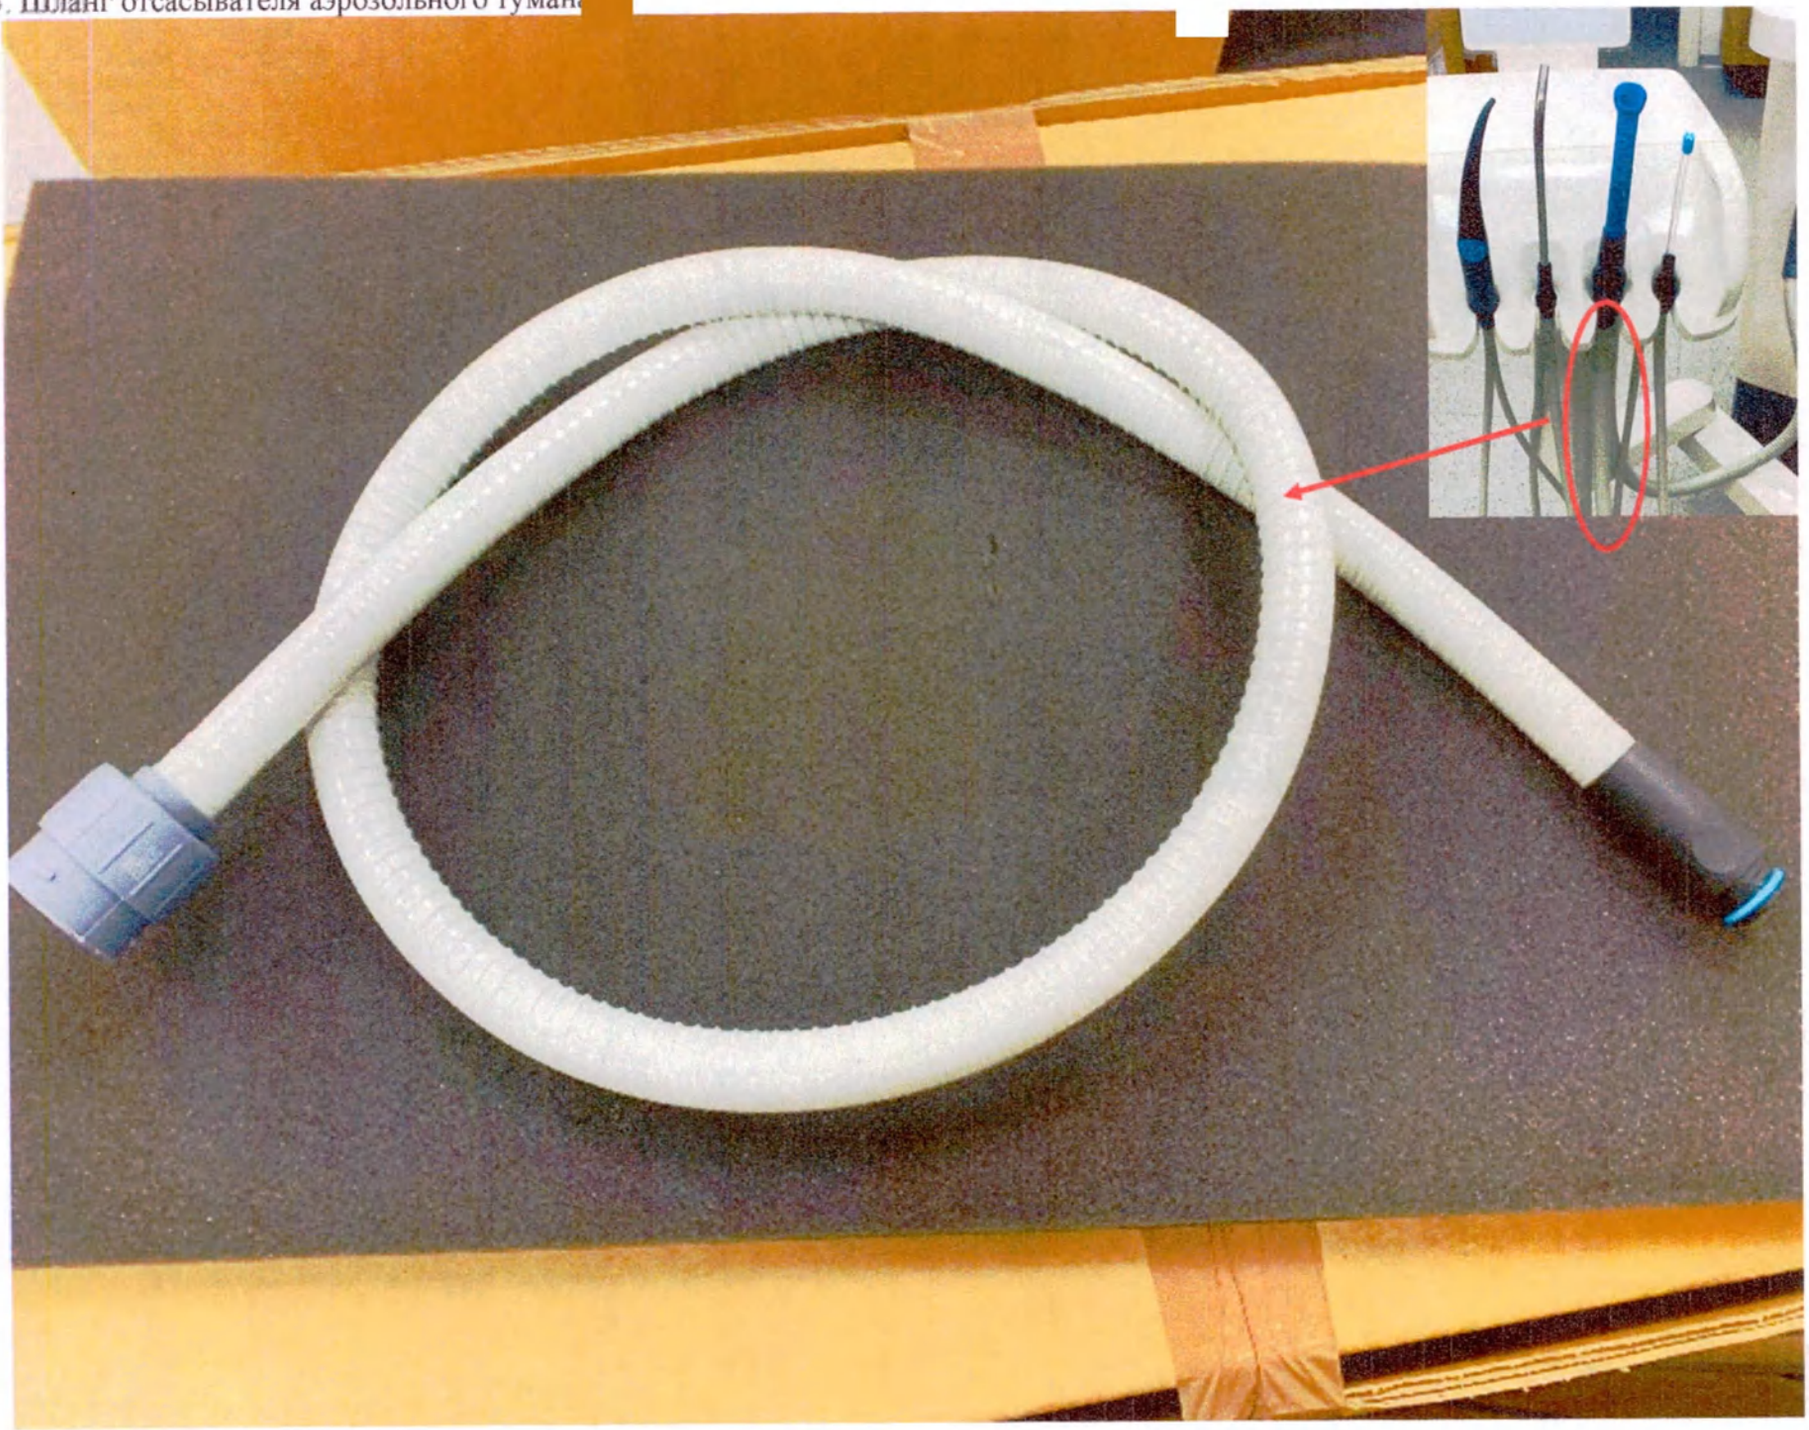


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Наконечник слюноотсоса.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

35. Шланг слюноотсоса.

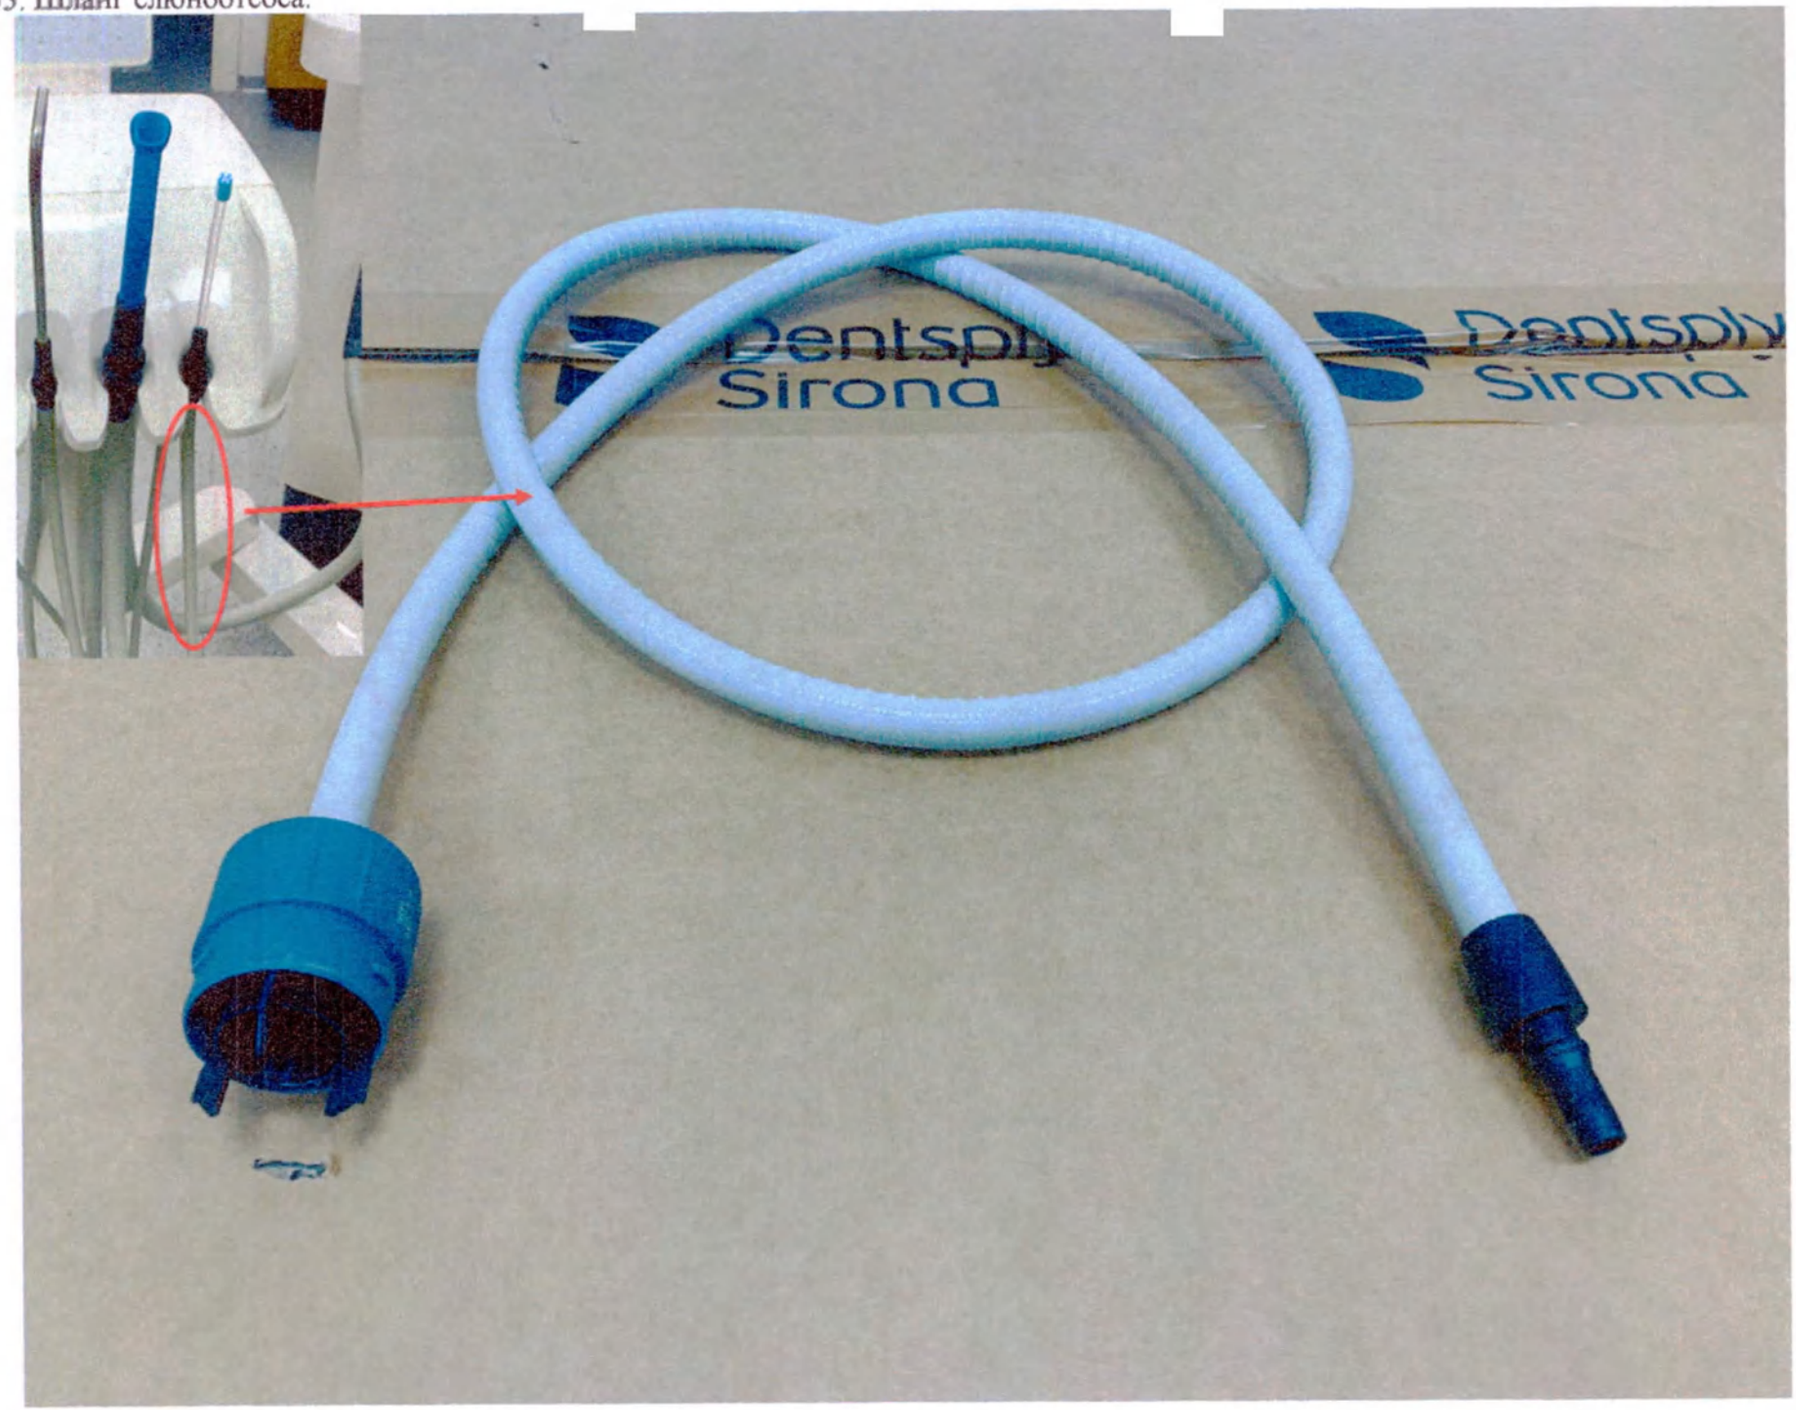

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

36. Хирургическая канюля.

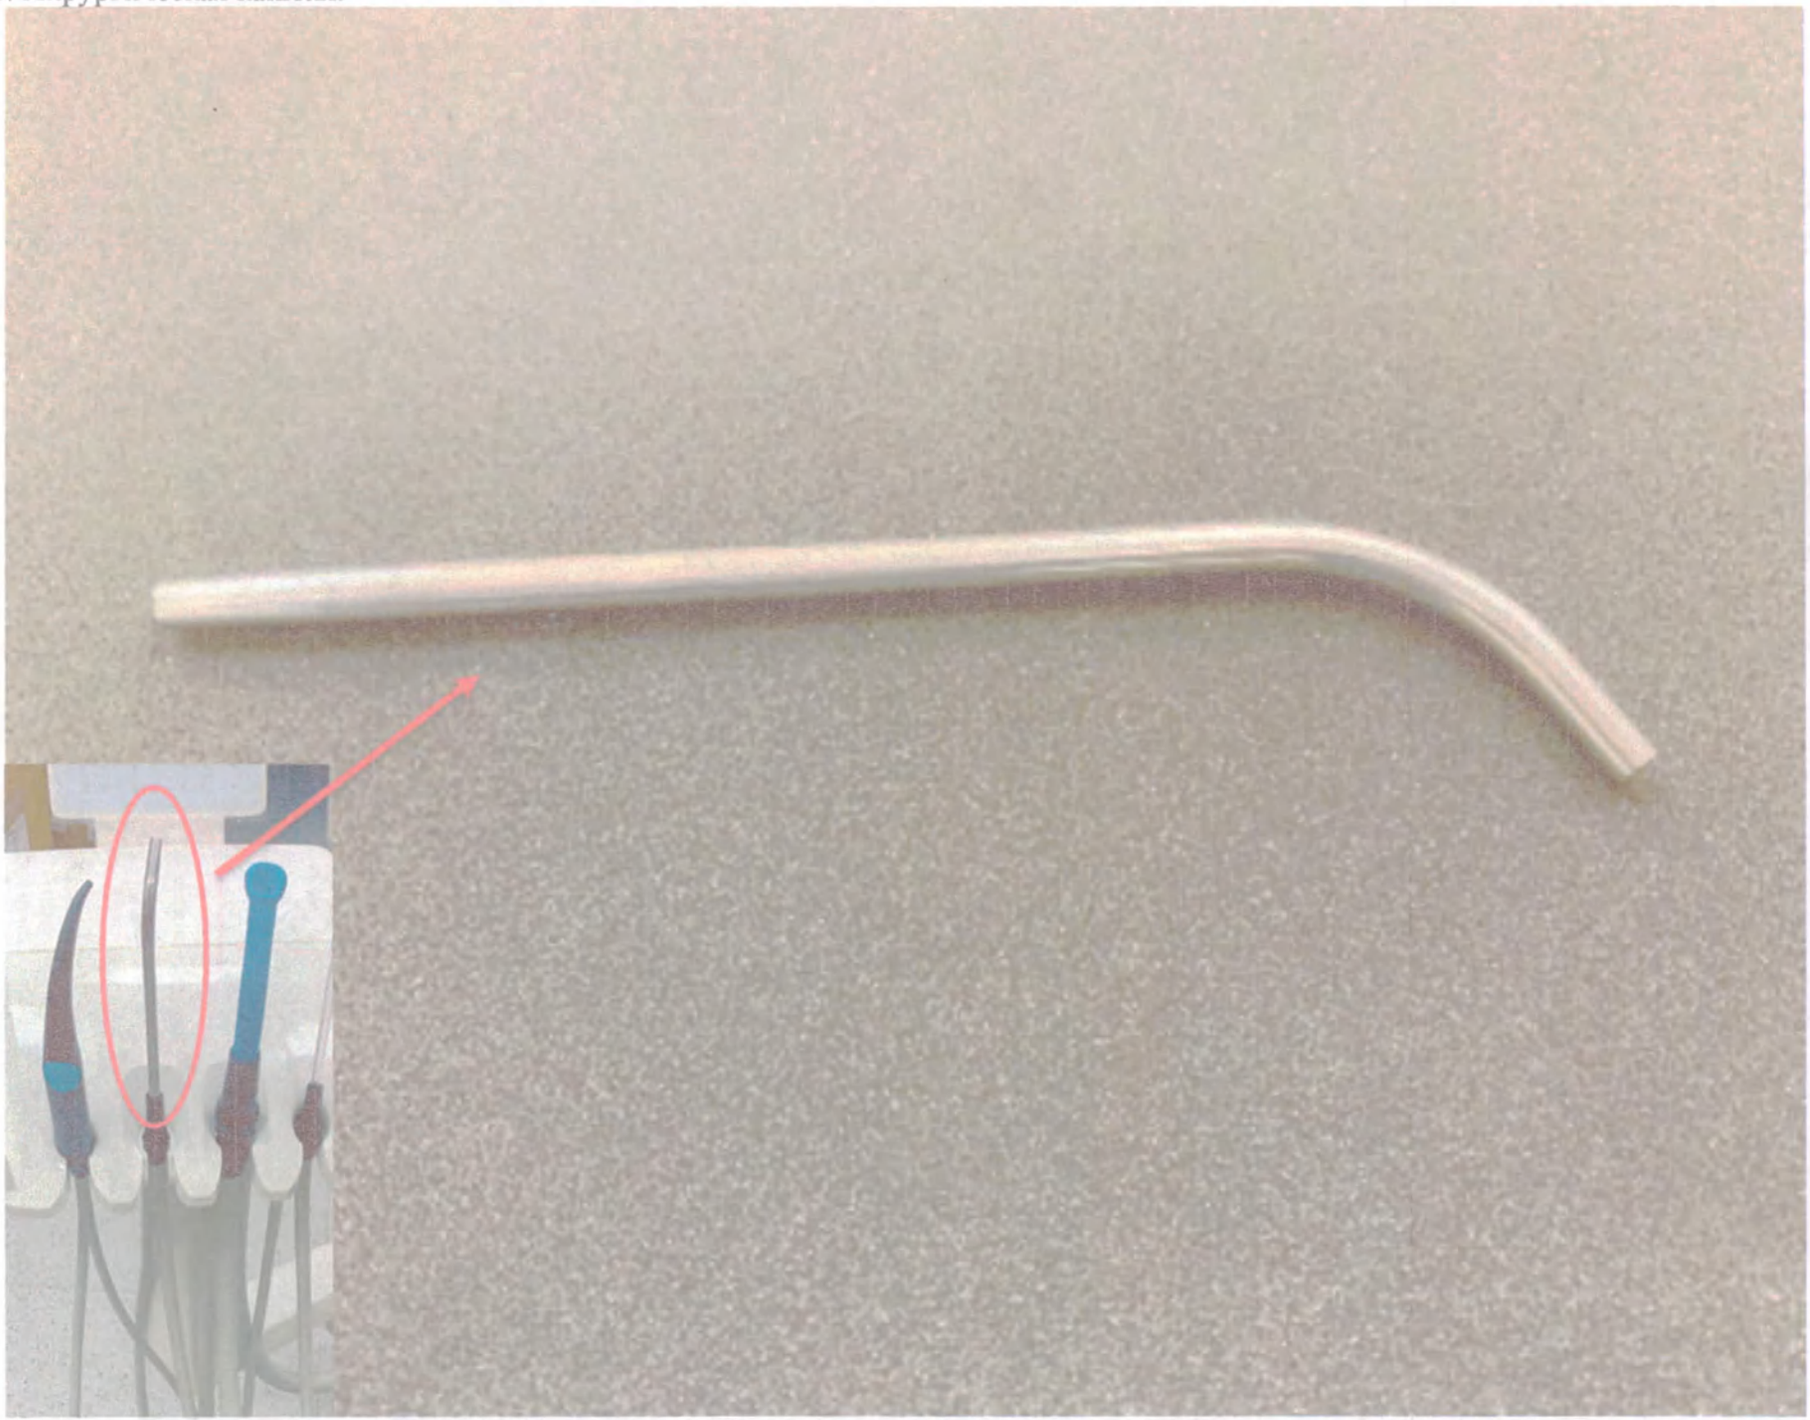


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

37. Фильтр отсасывающих шлангов.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

38. Боковая подставка для полимеризационной лампы (светильника).

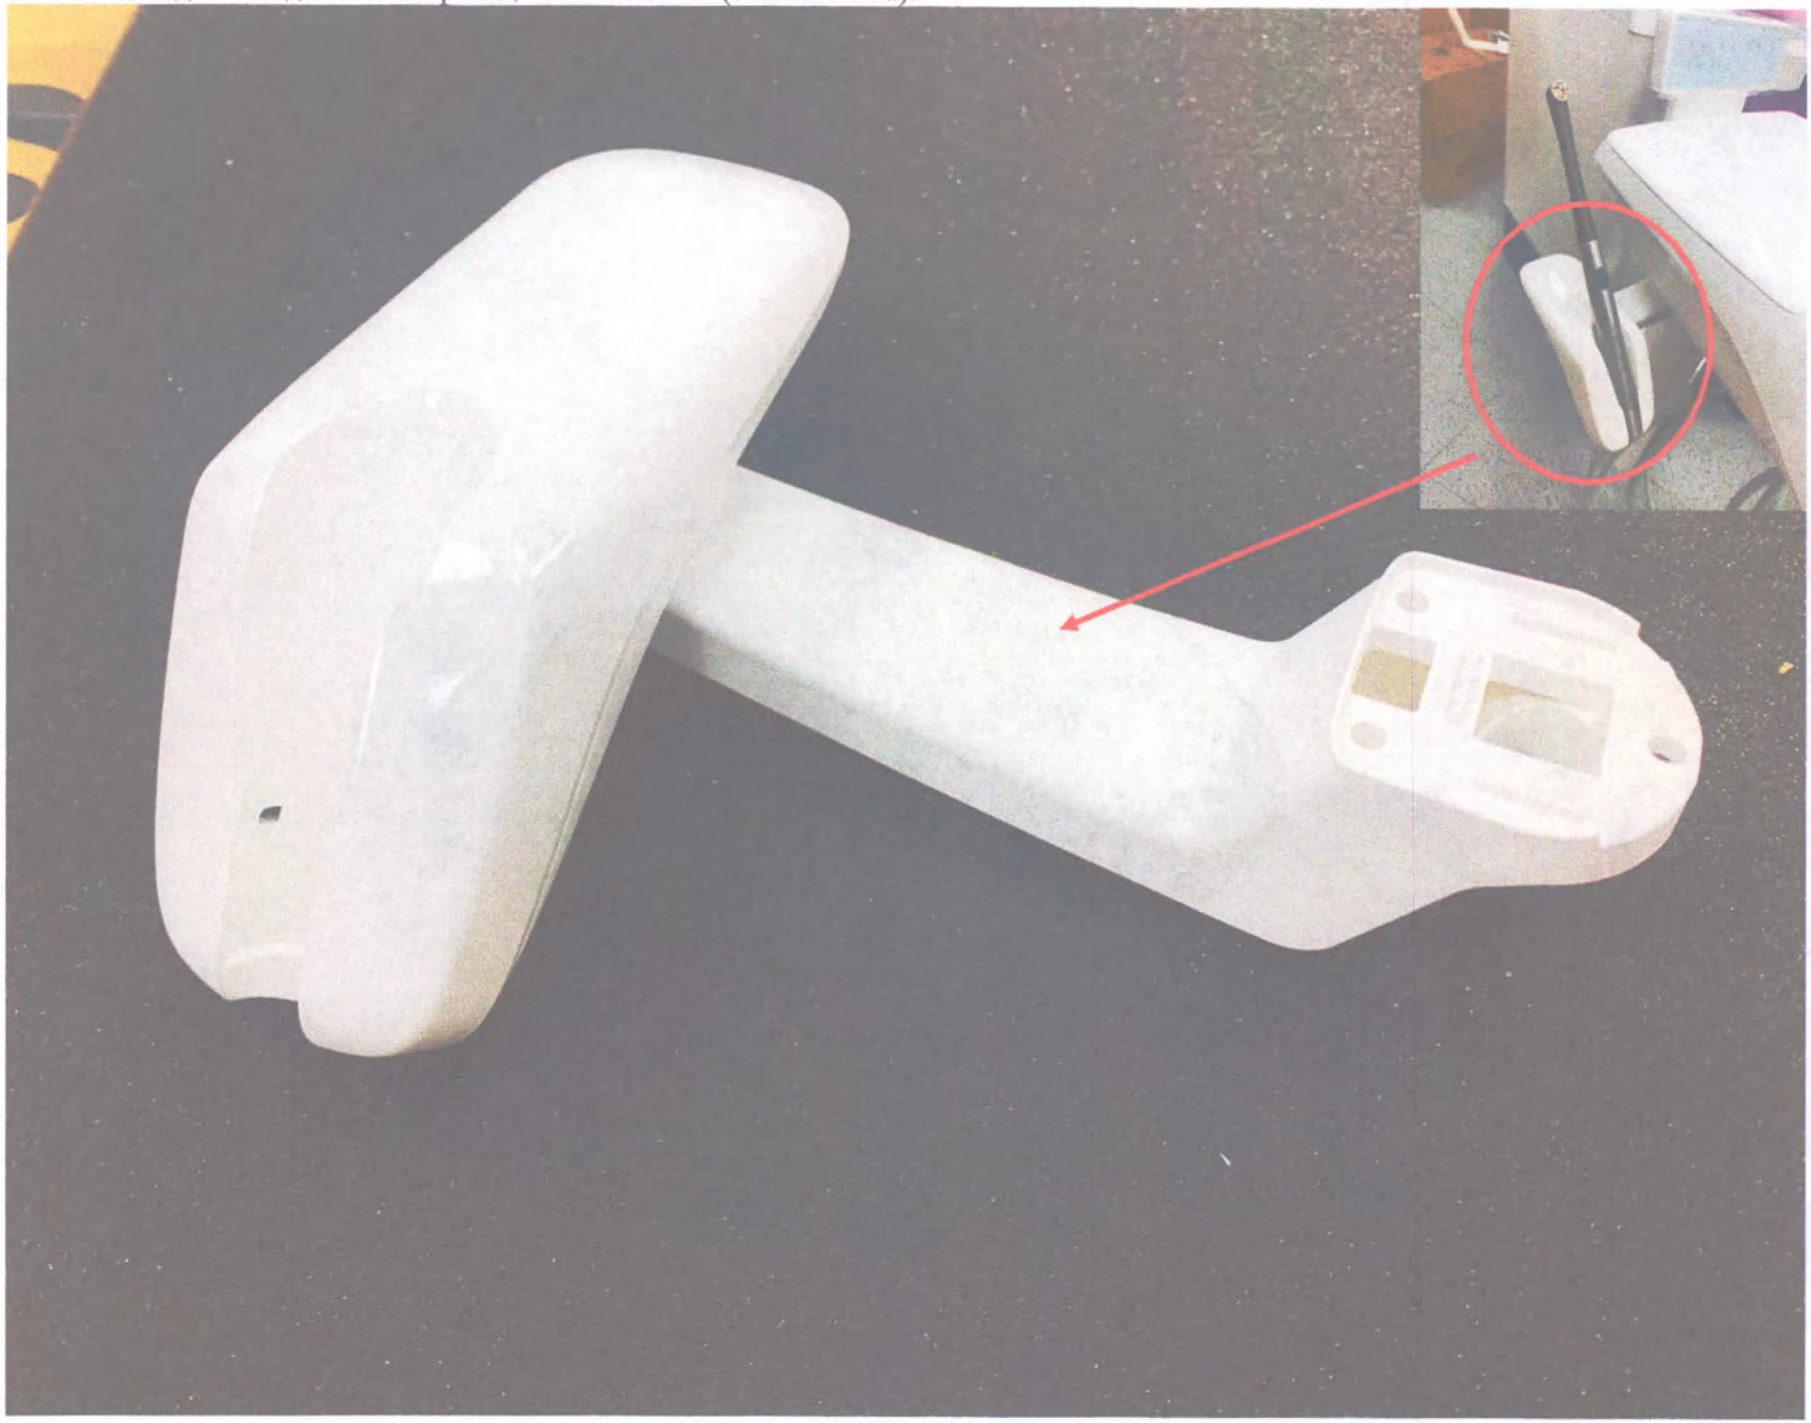


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

39. Водяной блок с элементами для подключения.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


40. Плевательница.

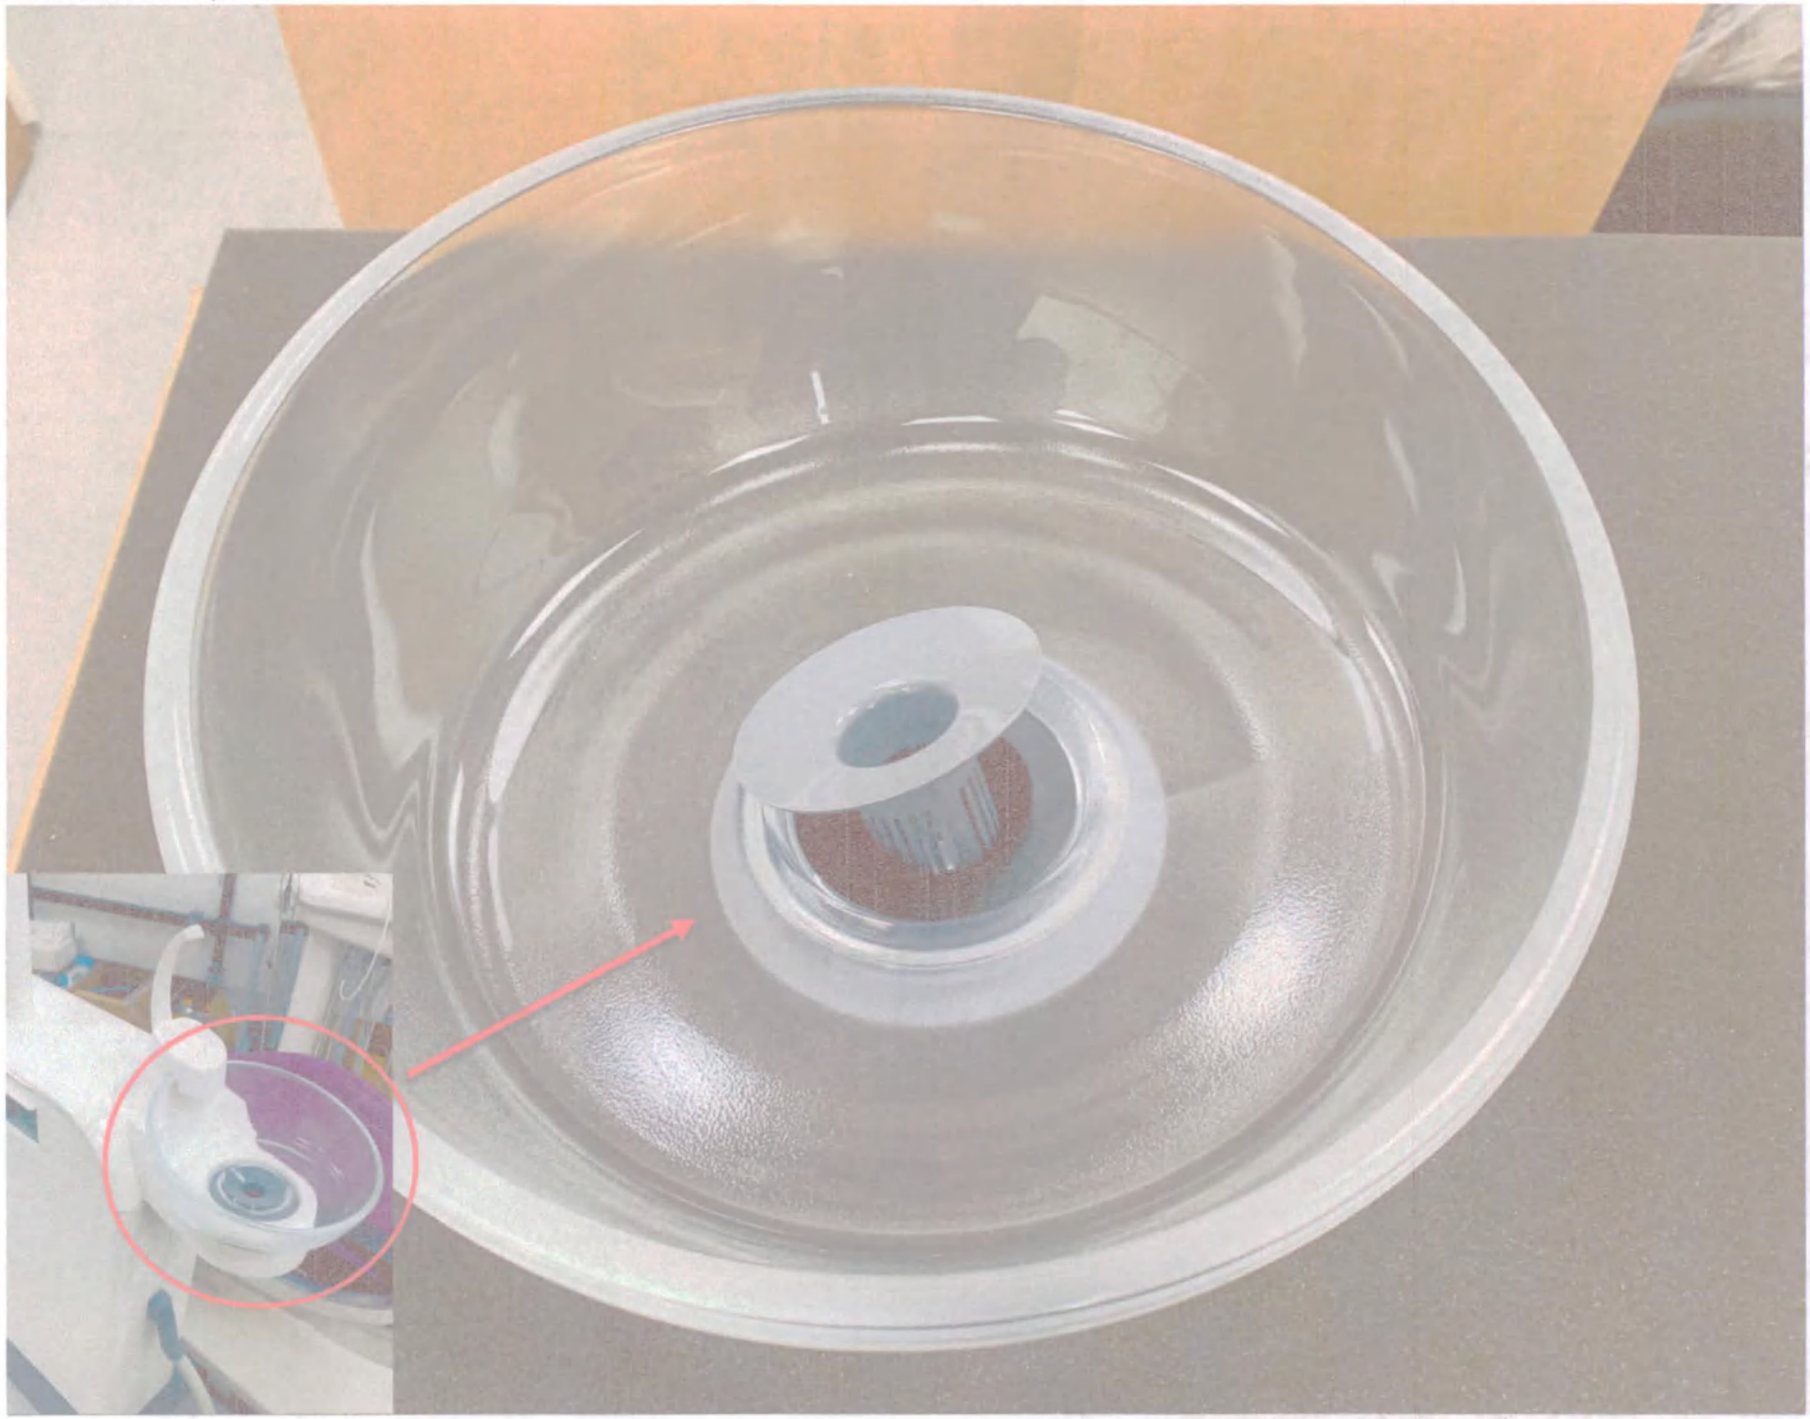


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

41. Сливная трубка стакана для полоскания рта (наполнитель стакана).

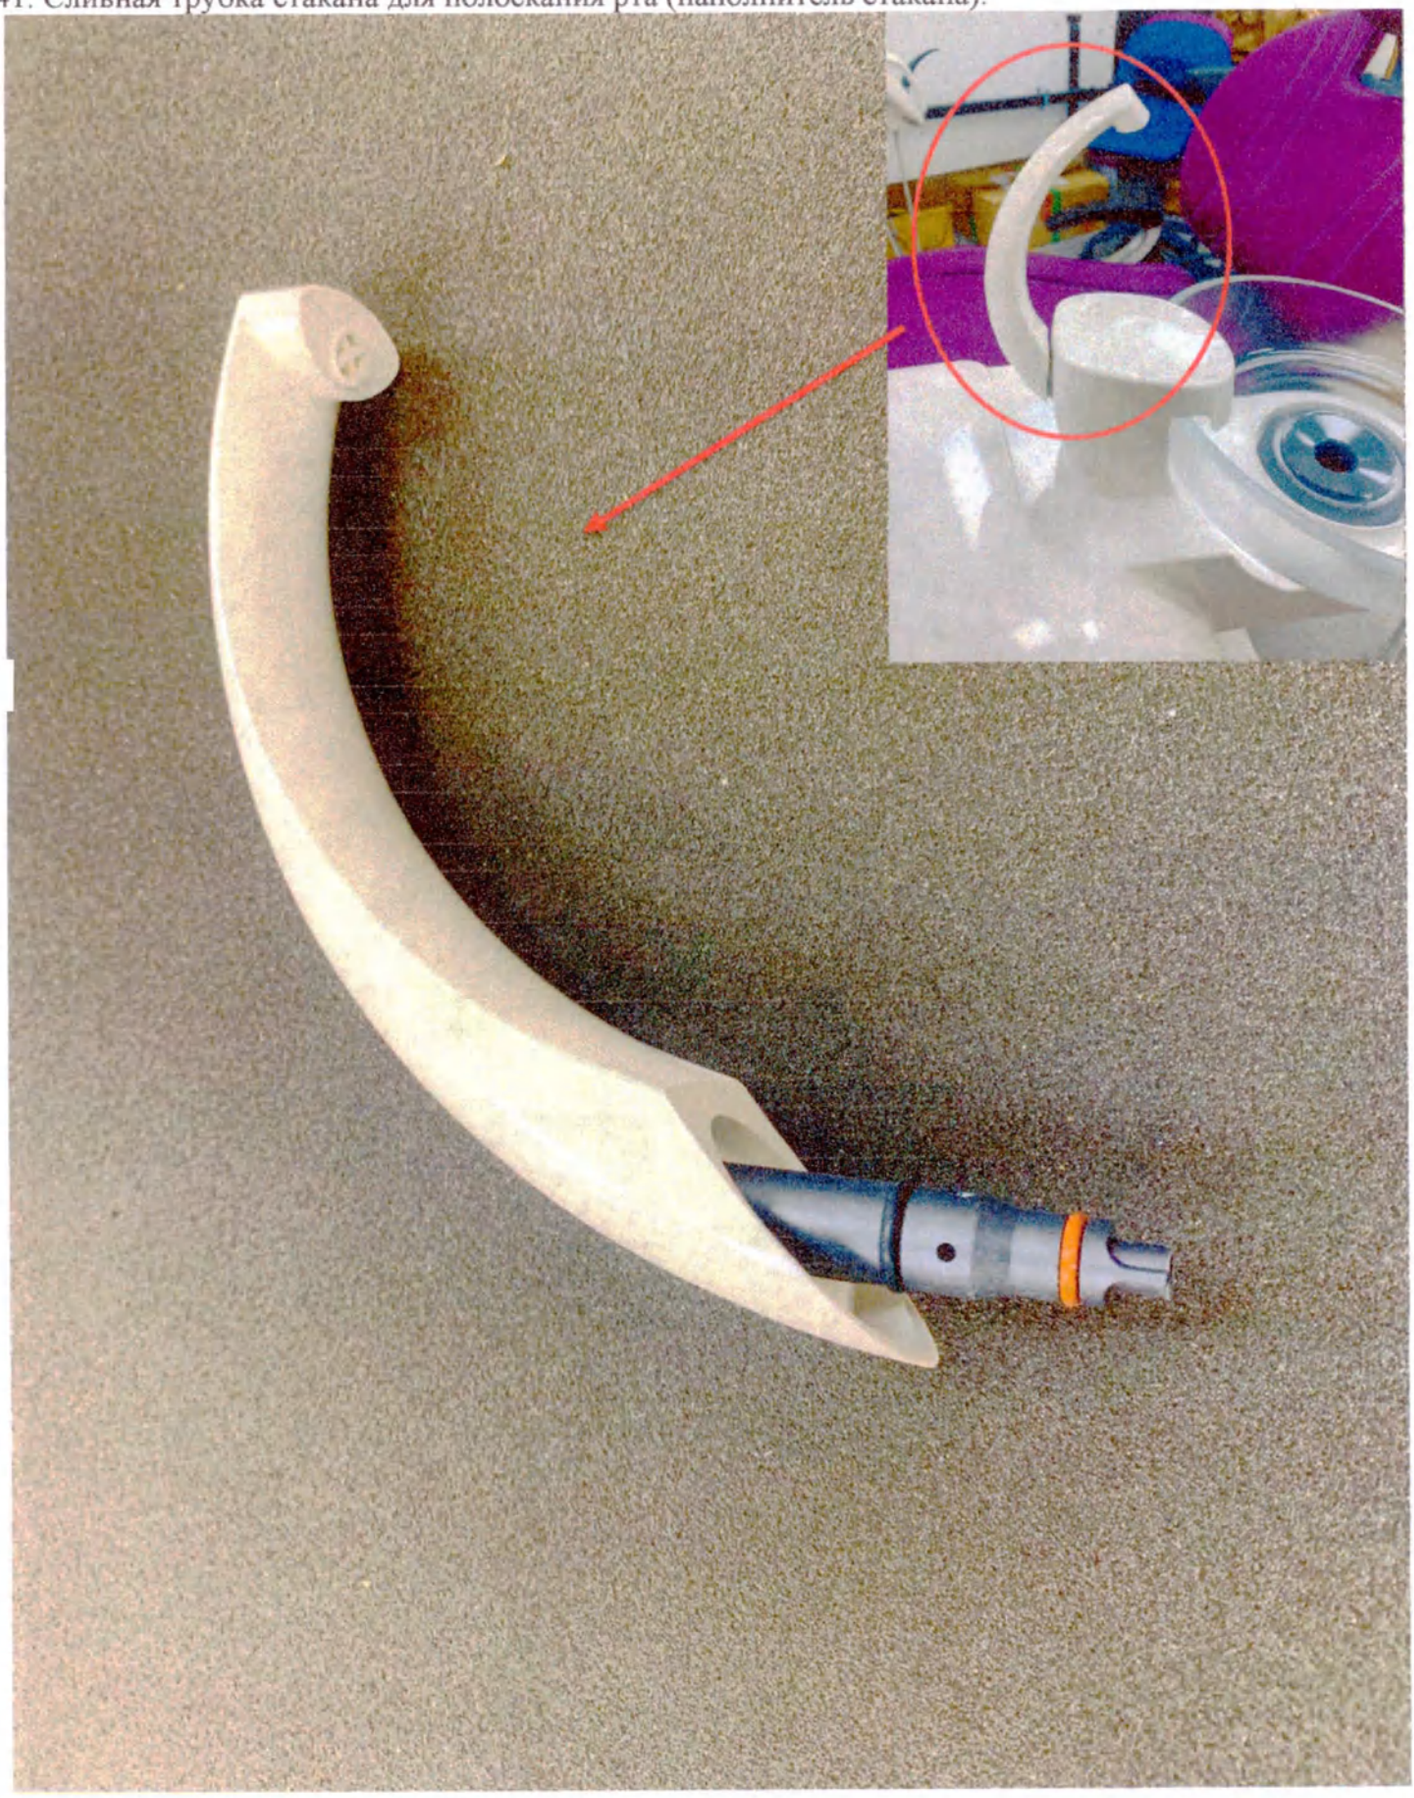


42. Переходник отсасывающих шлангов для плевательницы.

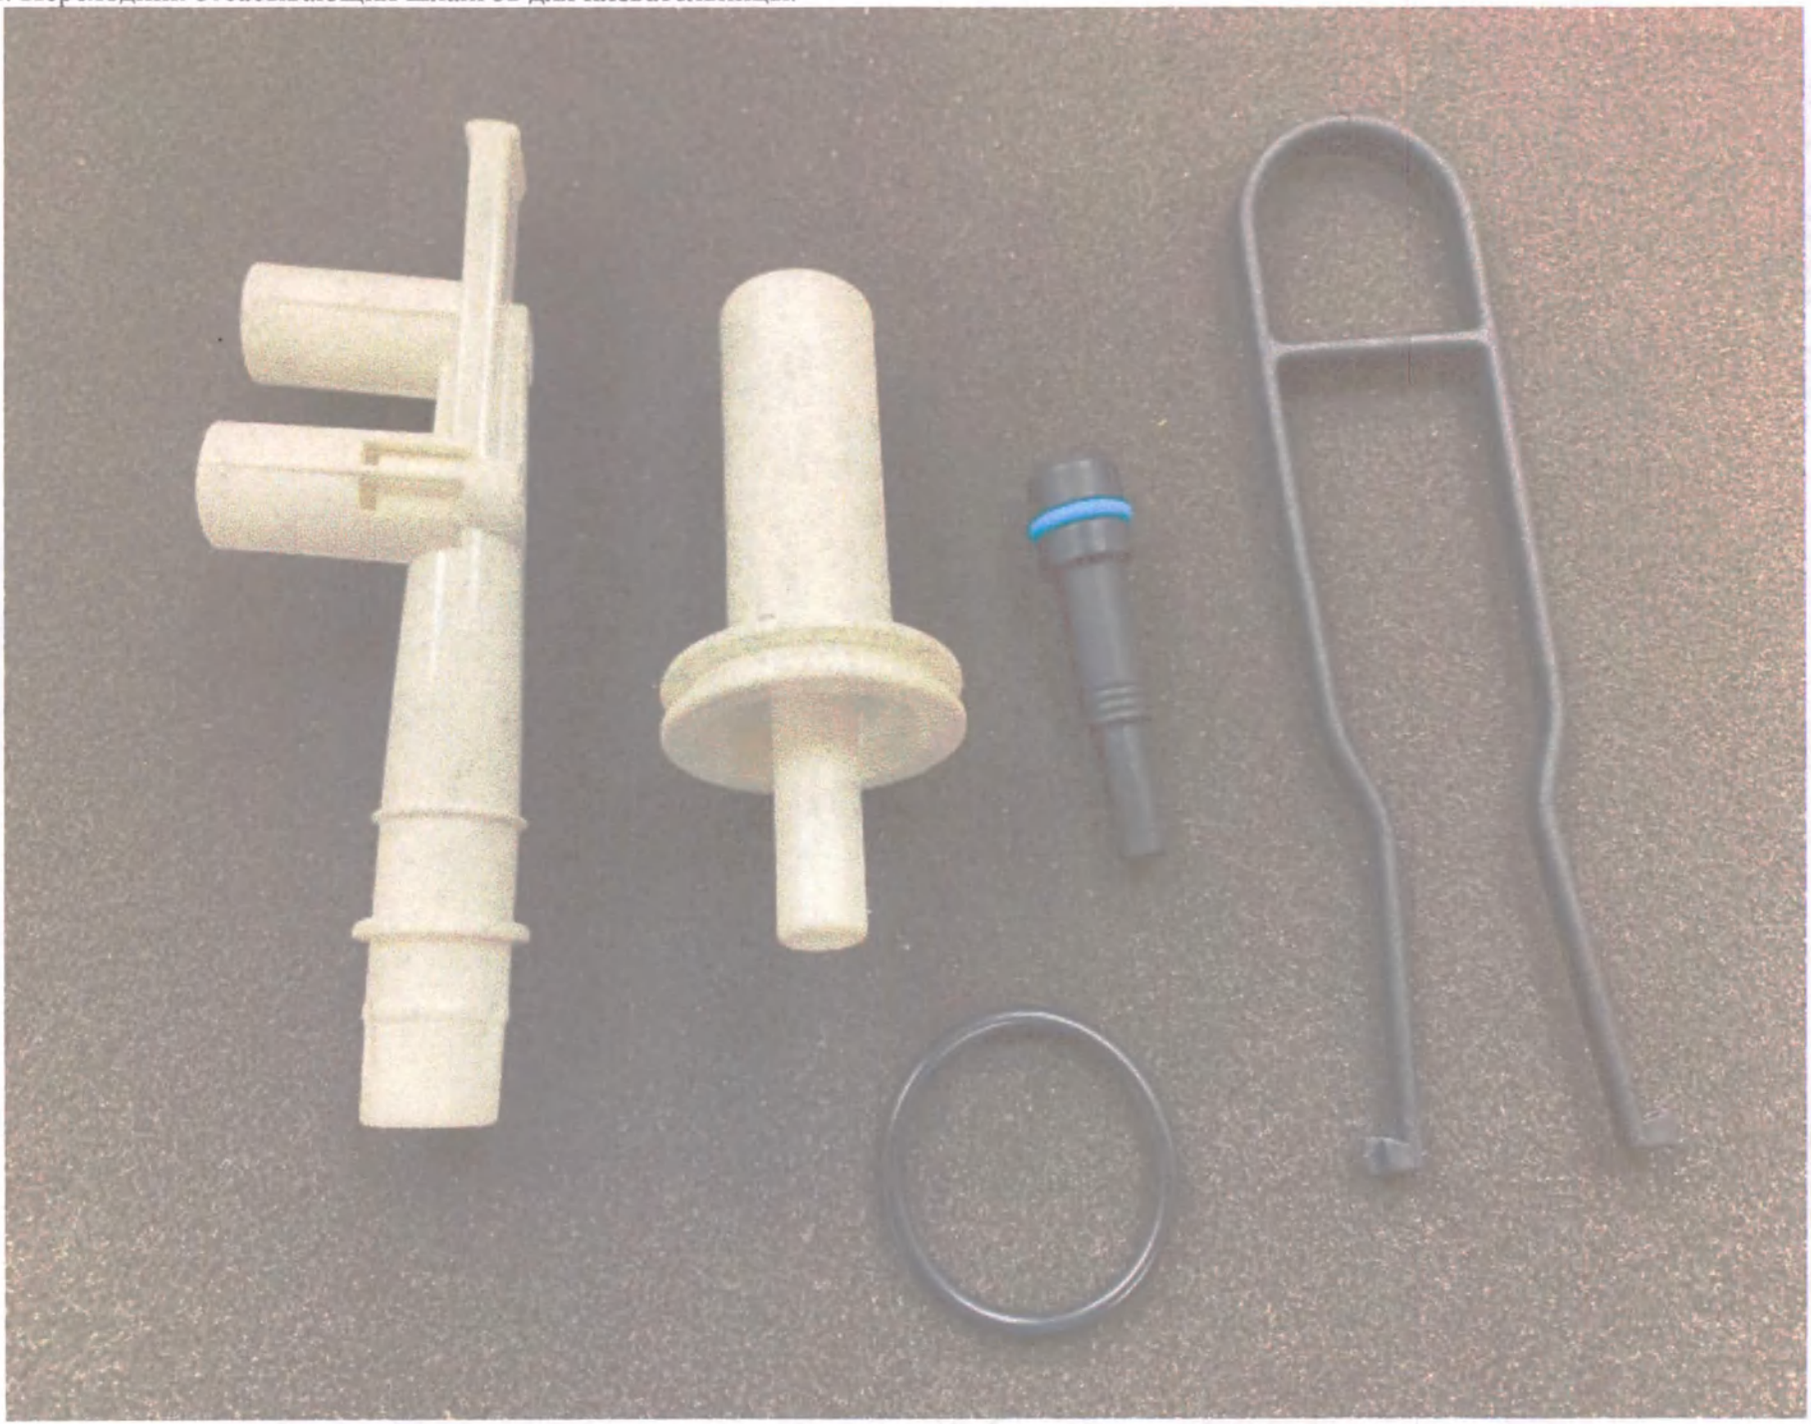


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

43. Соединительный шланг водяного блока.

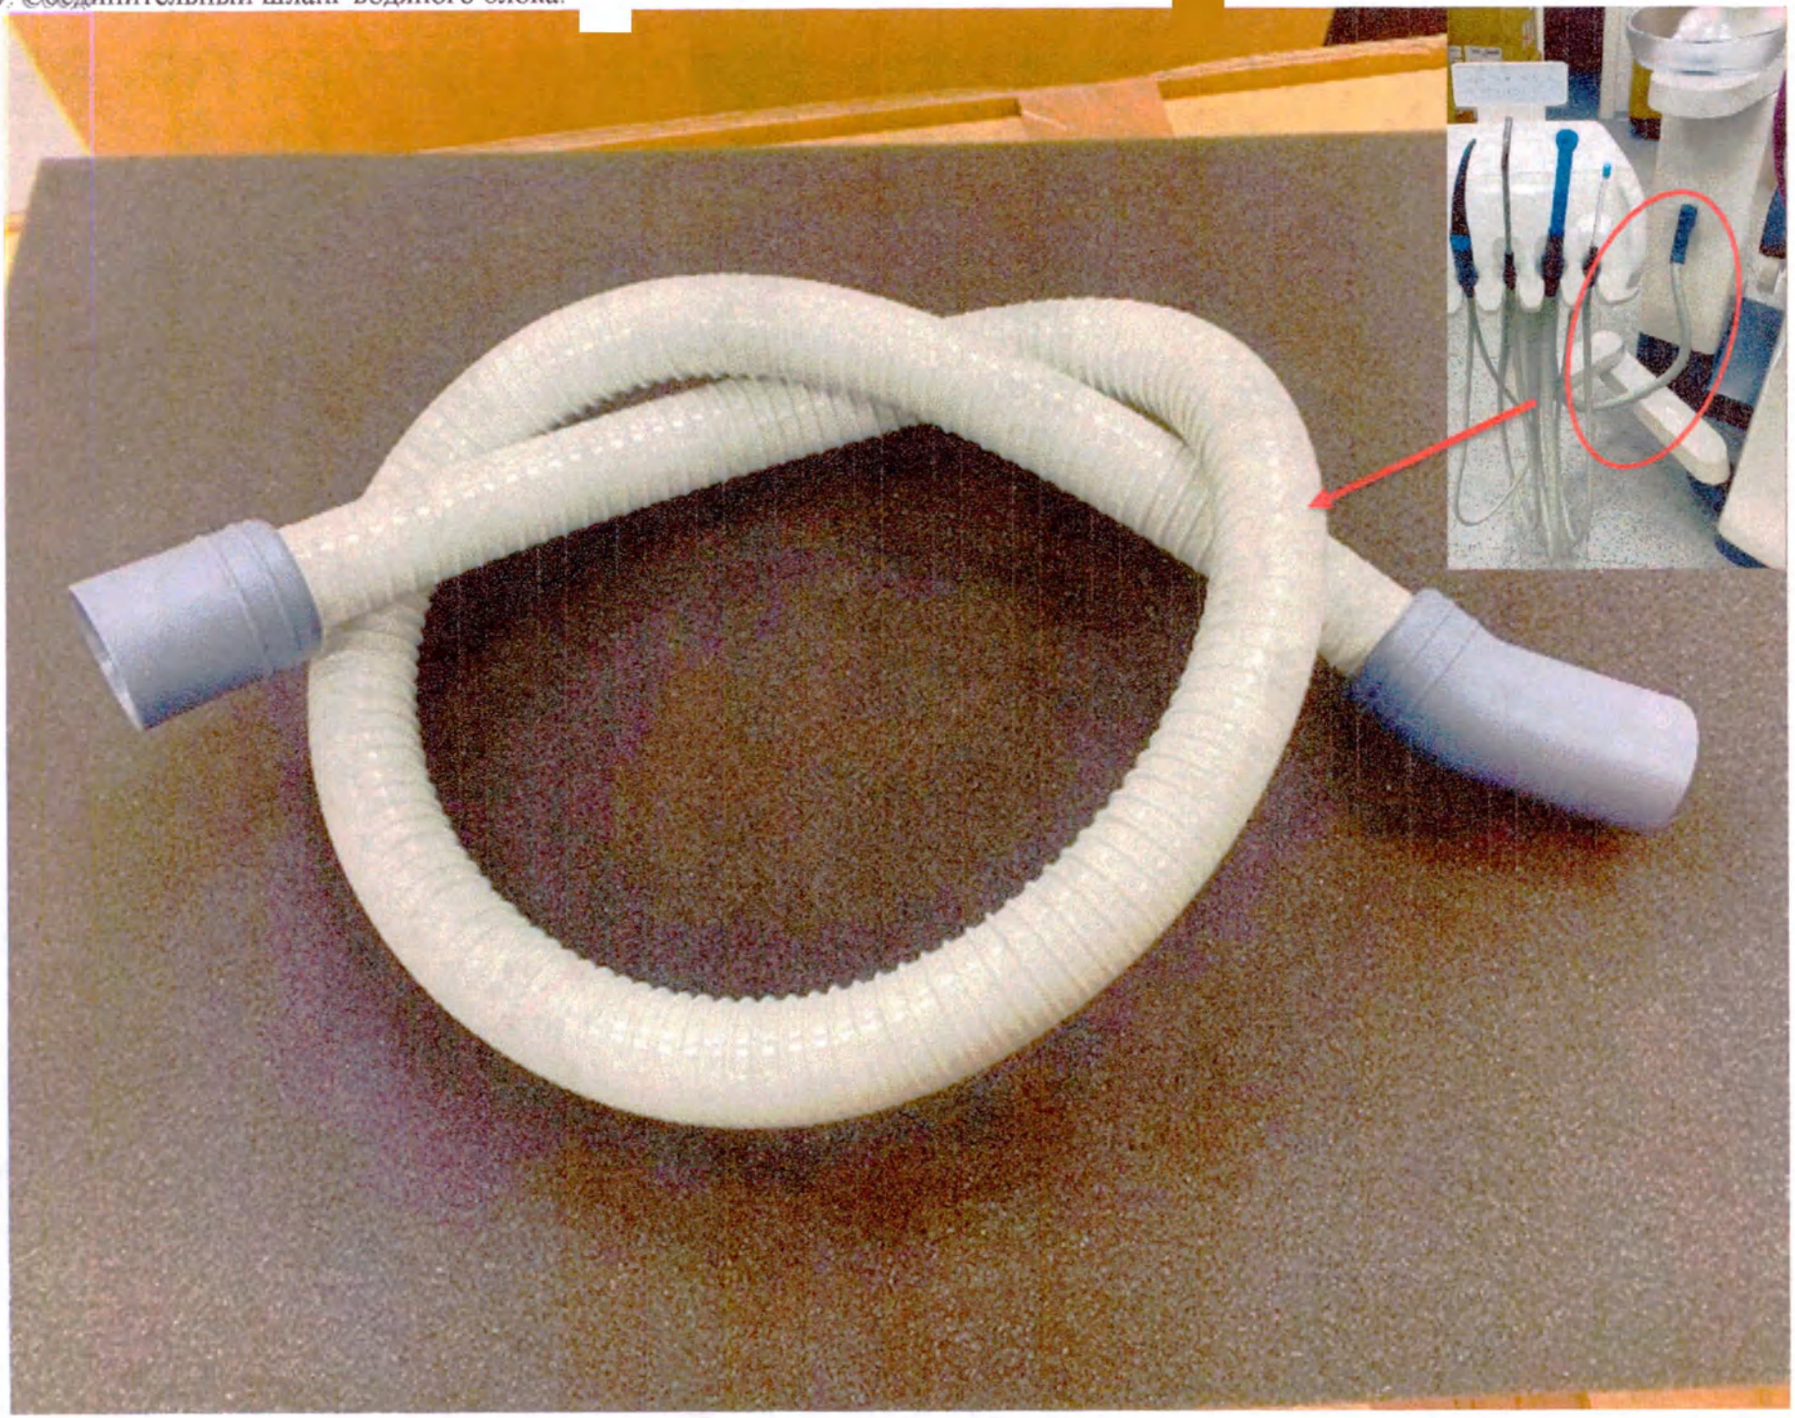

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

44. Вставной блок для очистки отсасывающих шлангов.

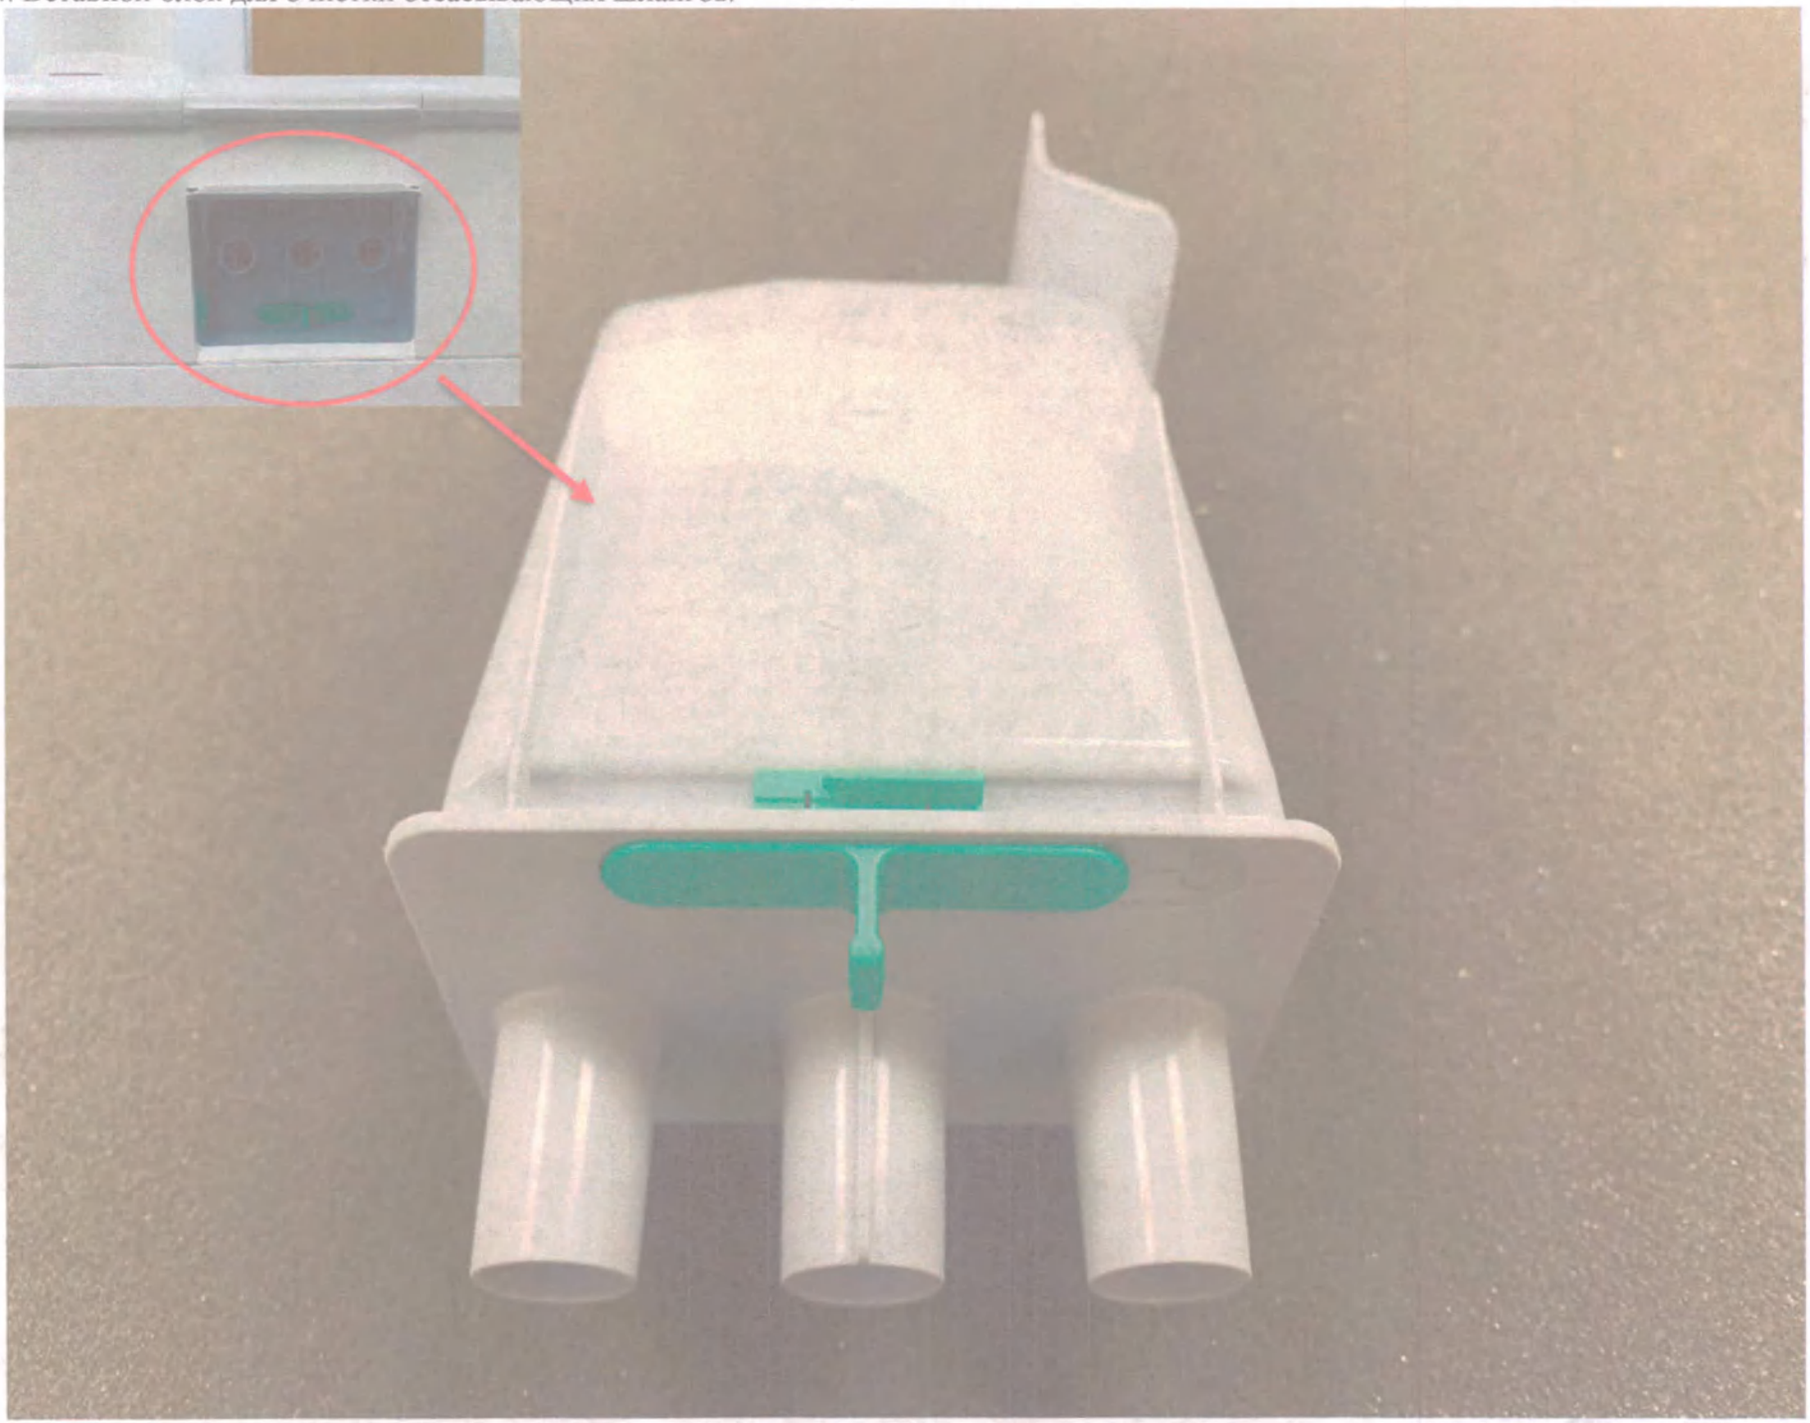


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

45. Вставной блок для автоматического про ания Autopurge/санации.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

46. Санационные переходники:
для турбины

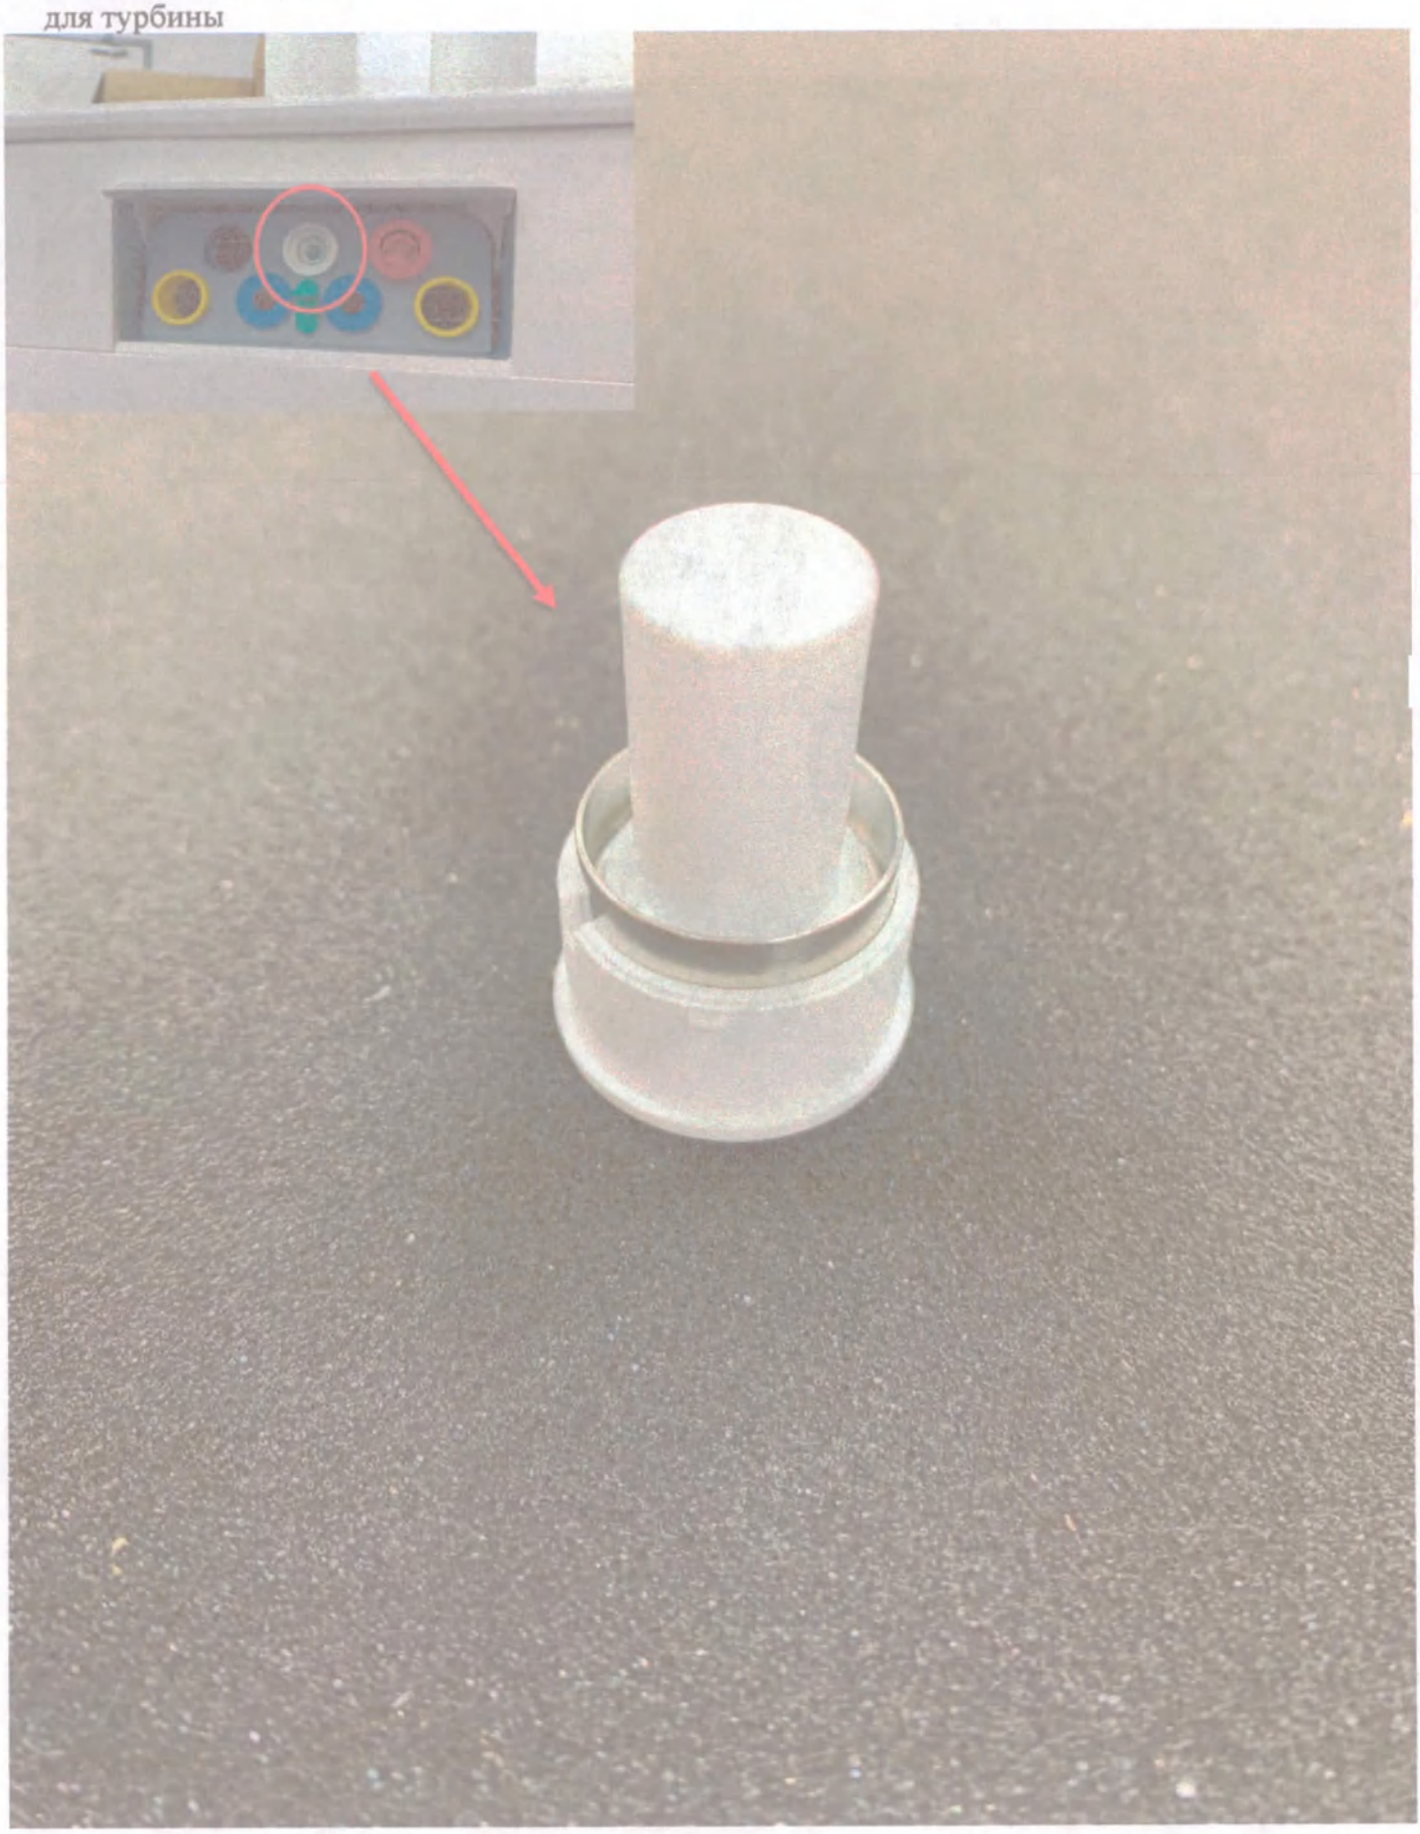


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для мотора BL

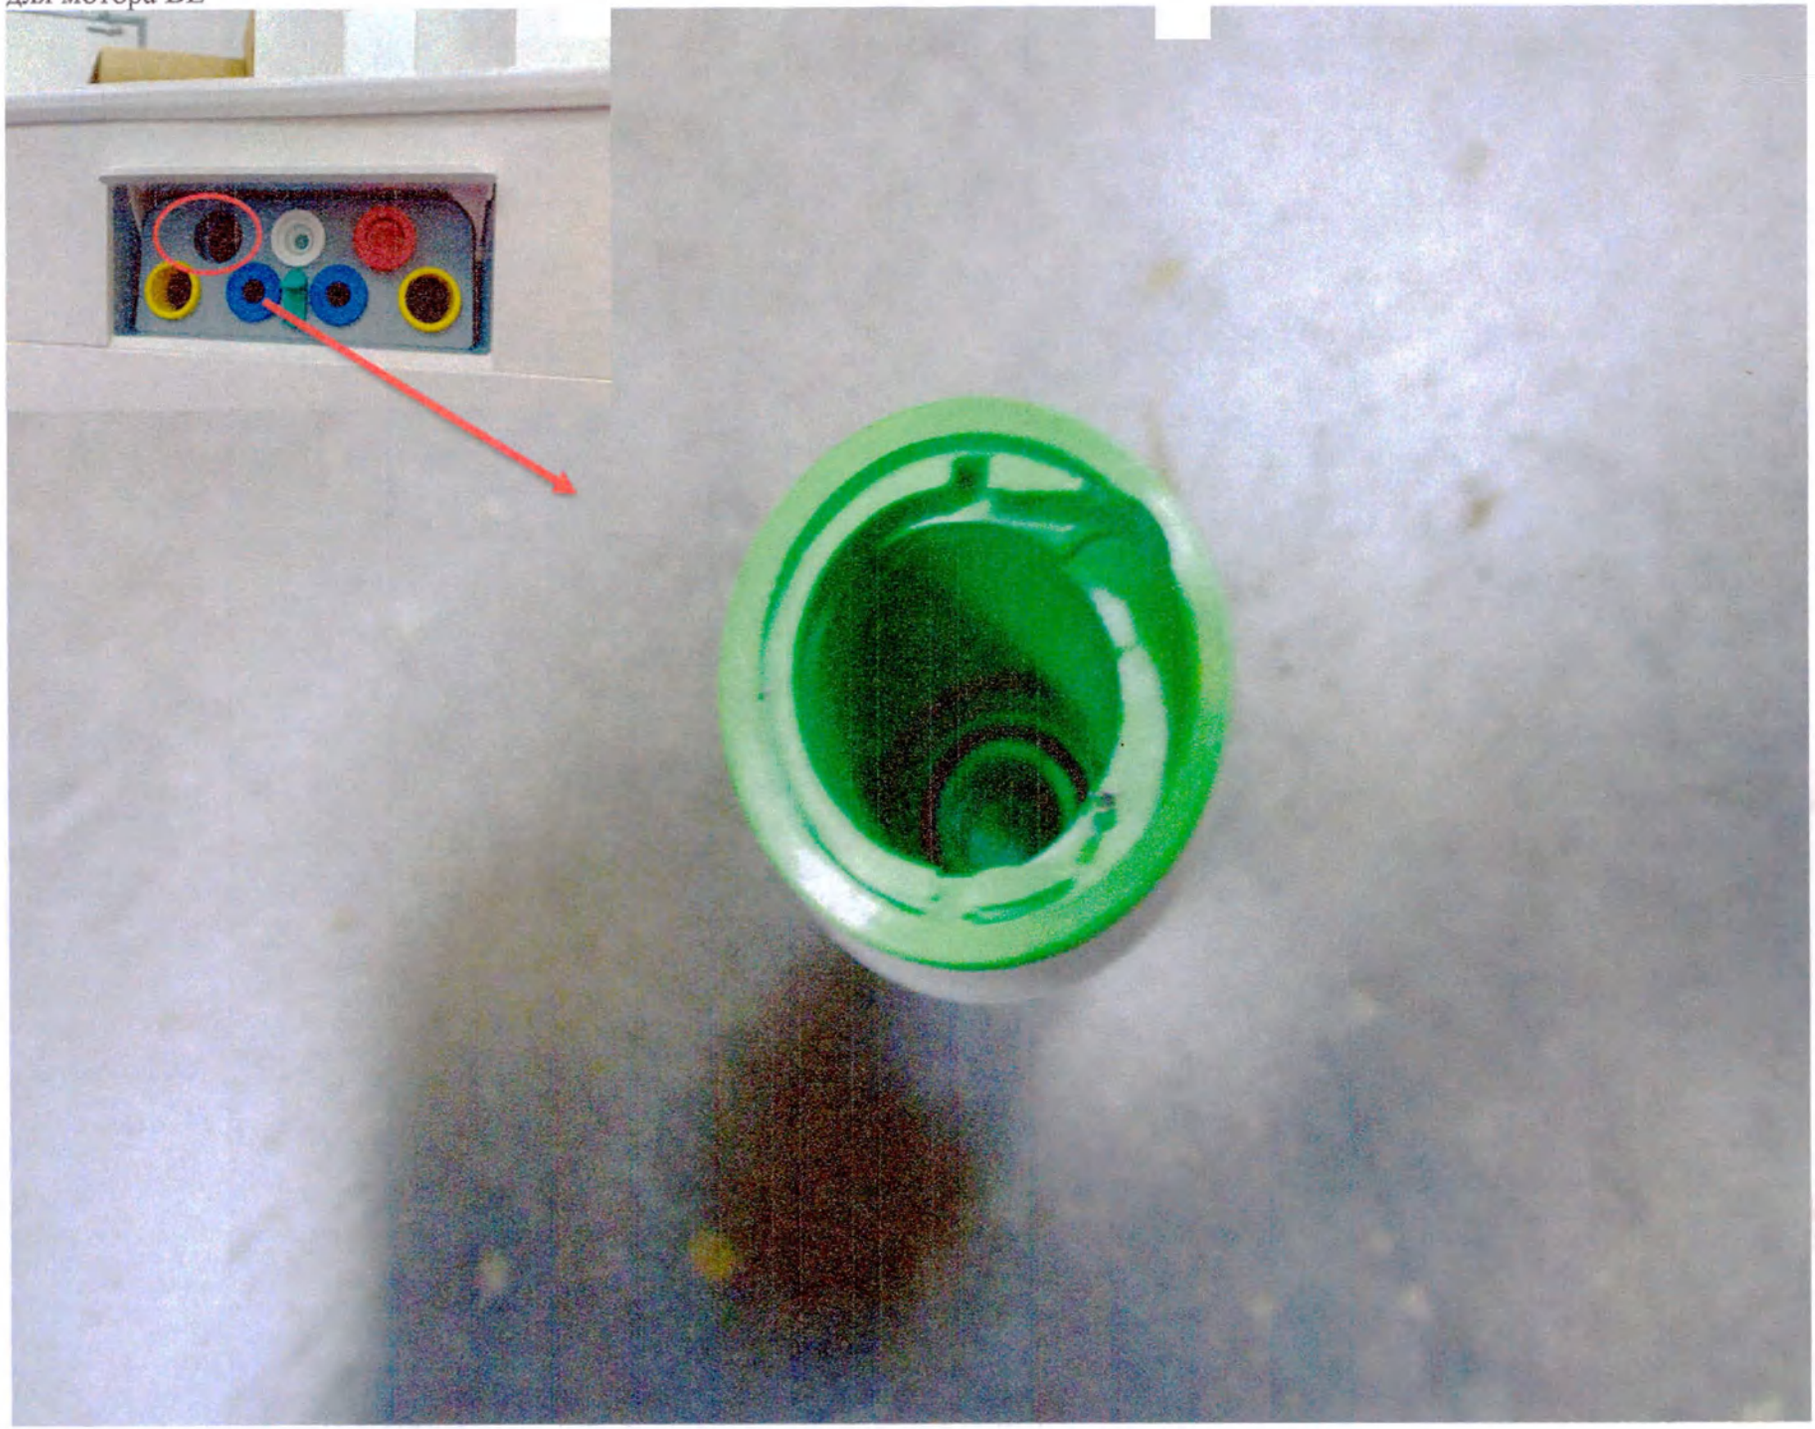


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для мотора ISO

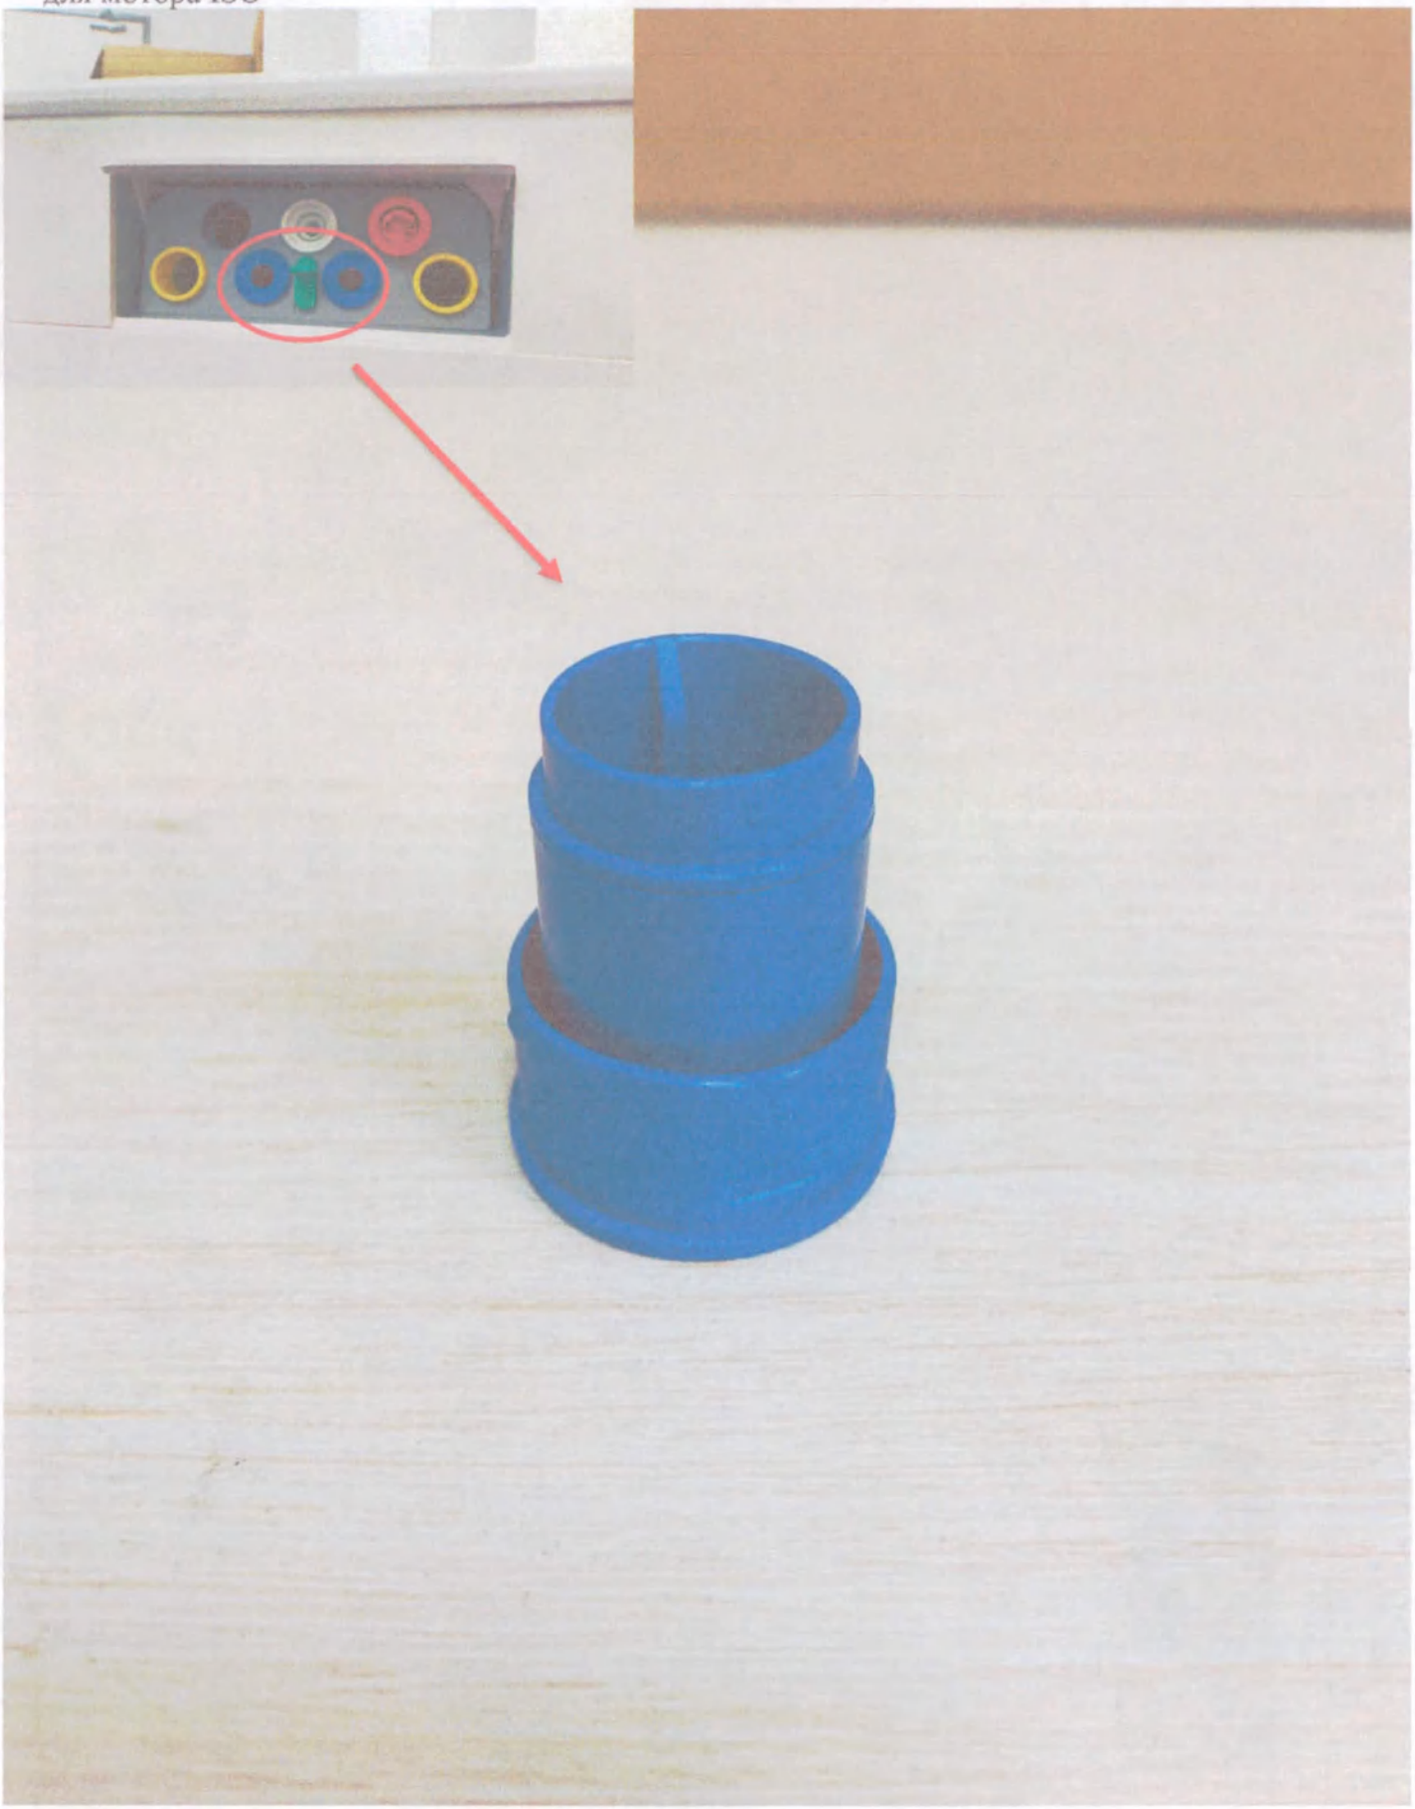

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для SiroSonic TL

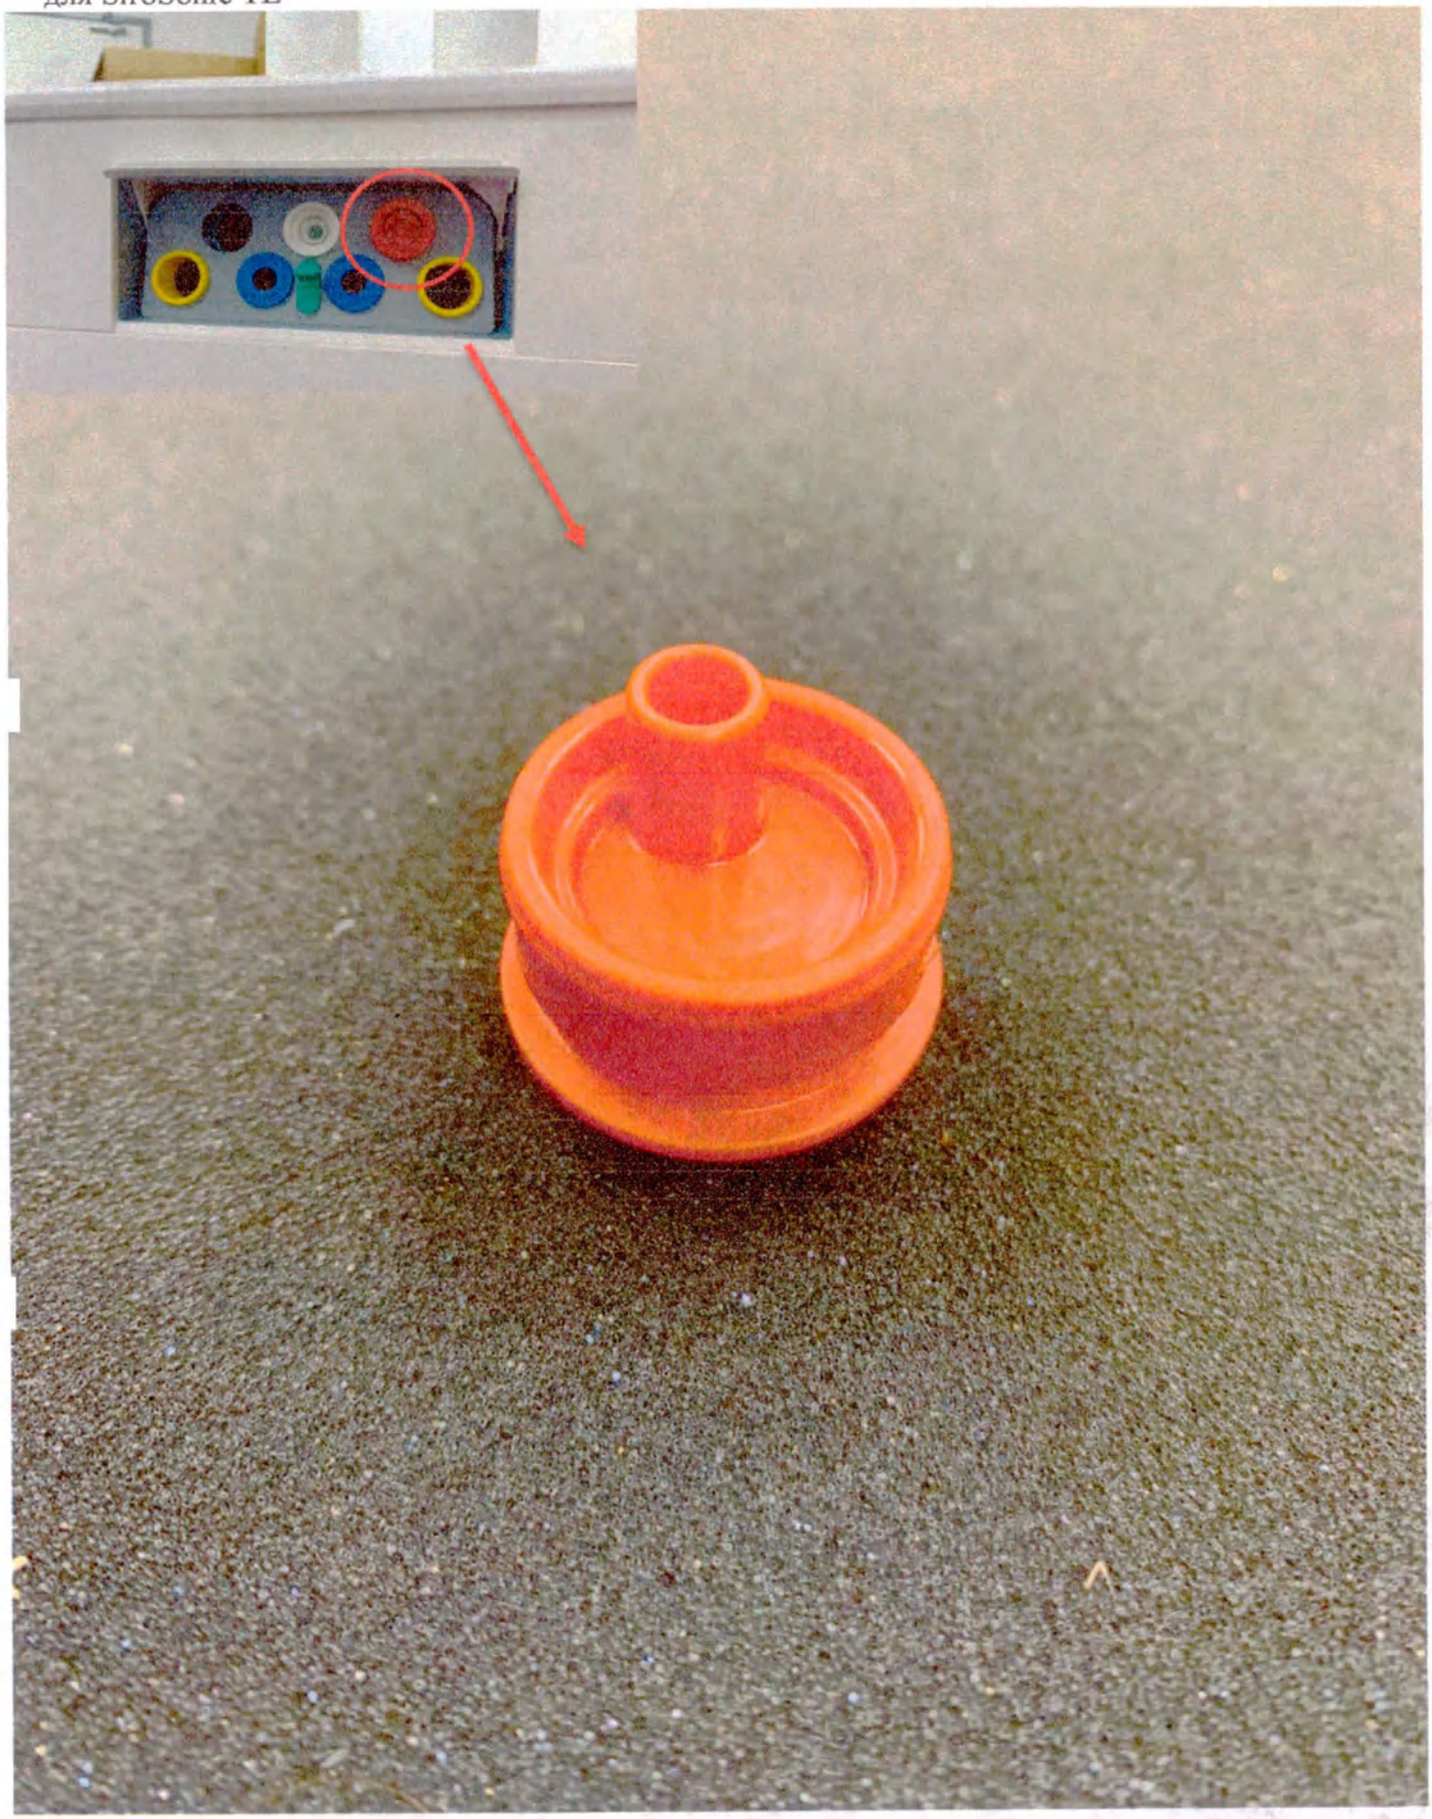

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


47. Средство для дезинфекции водопроводящих трубок Dentosept S или Dentosept Clean.





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

48. Рабочий светильник с элементами крепле , вариант исполнения LEDview Plus

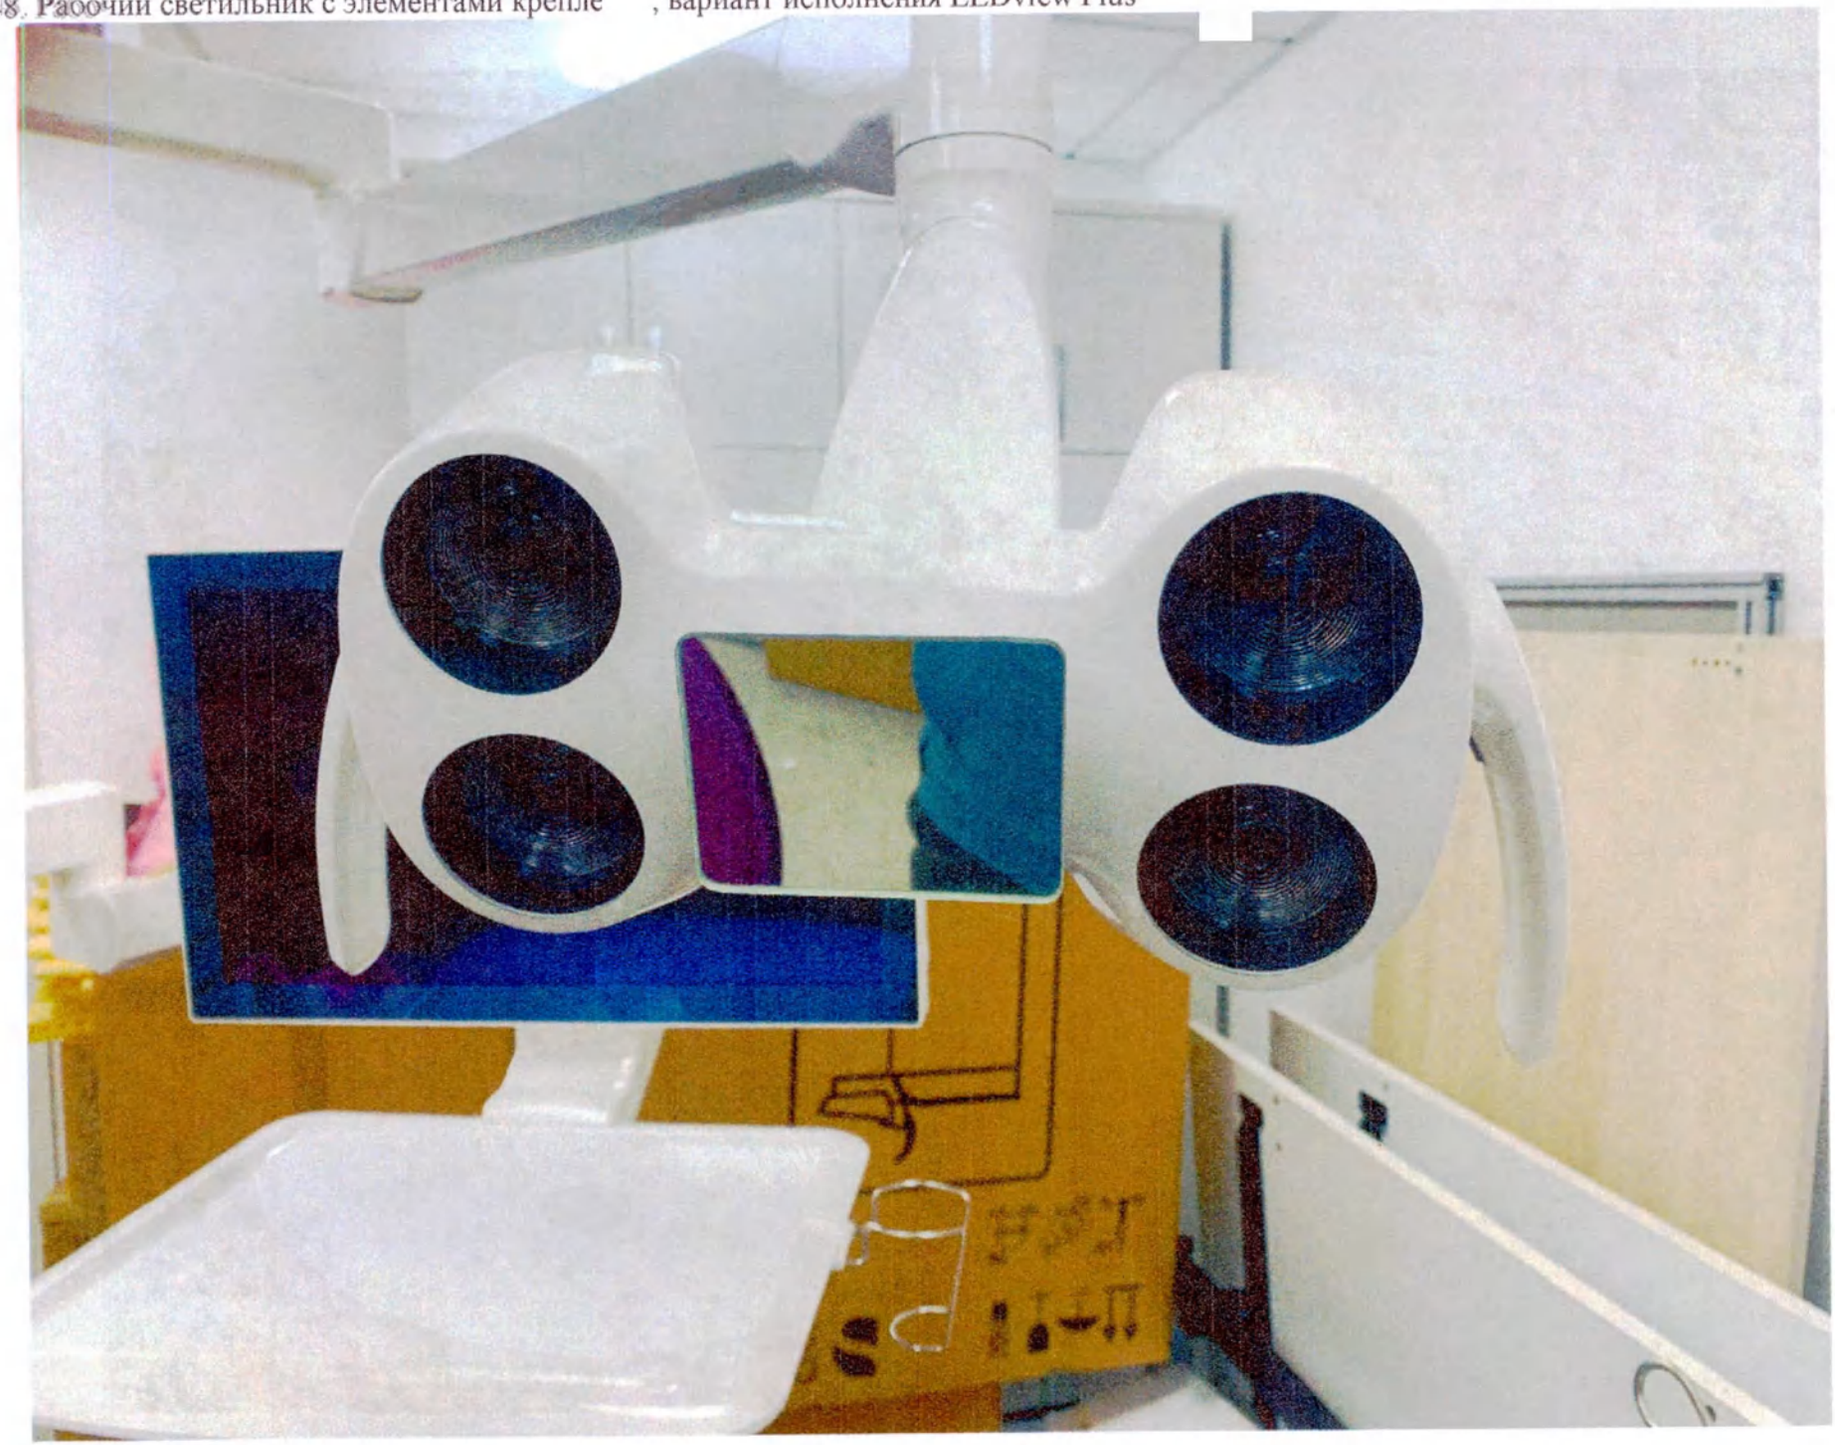



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения LEDview Plus с набором крепежных элементов на потолок (в составе: опорная стойка для потолков, крепежный адаптер для опорной стойки, кронштейн для светильника).






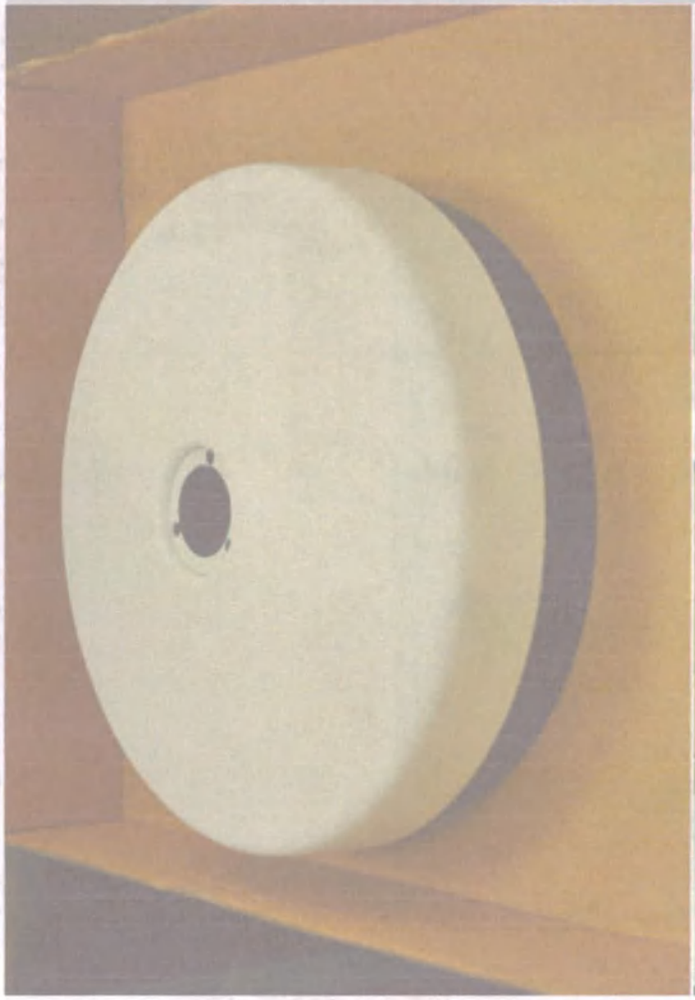

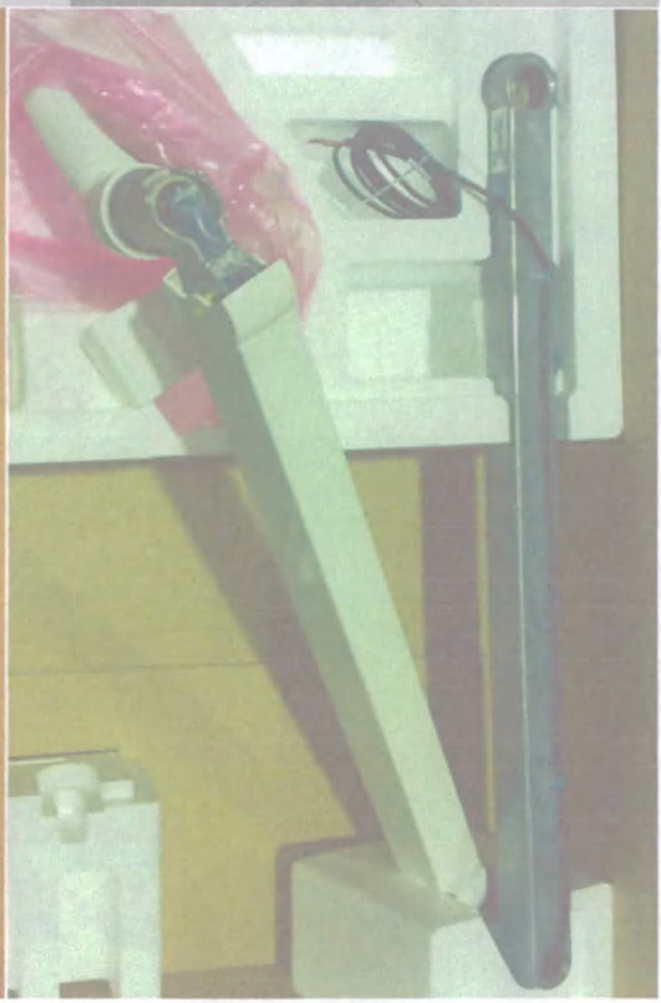

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

49. Зеркало рабочего светильника.

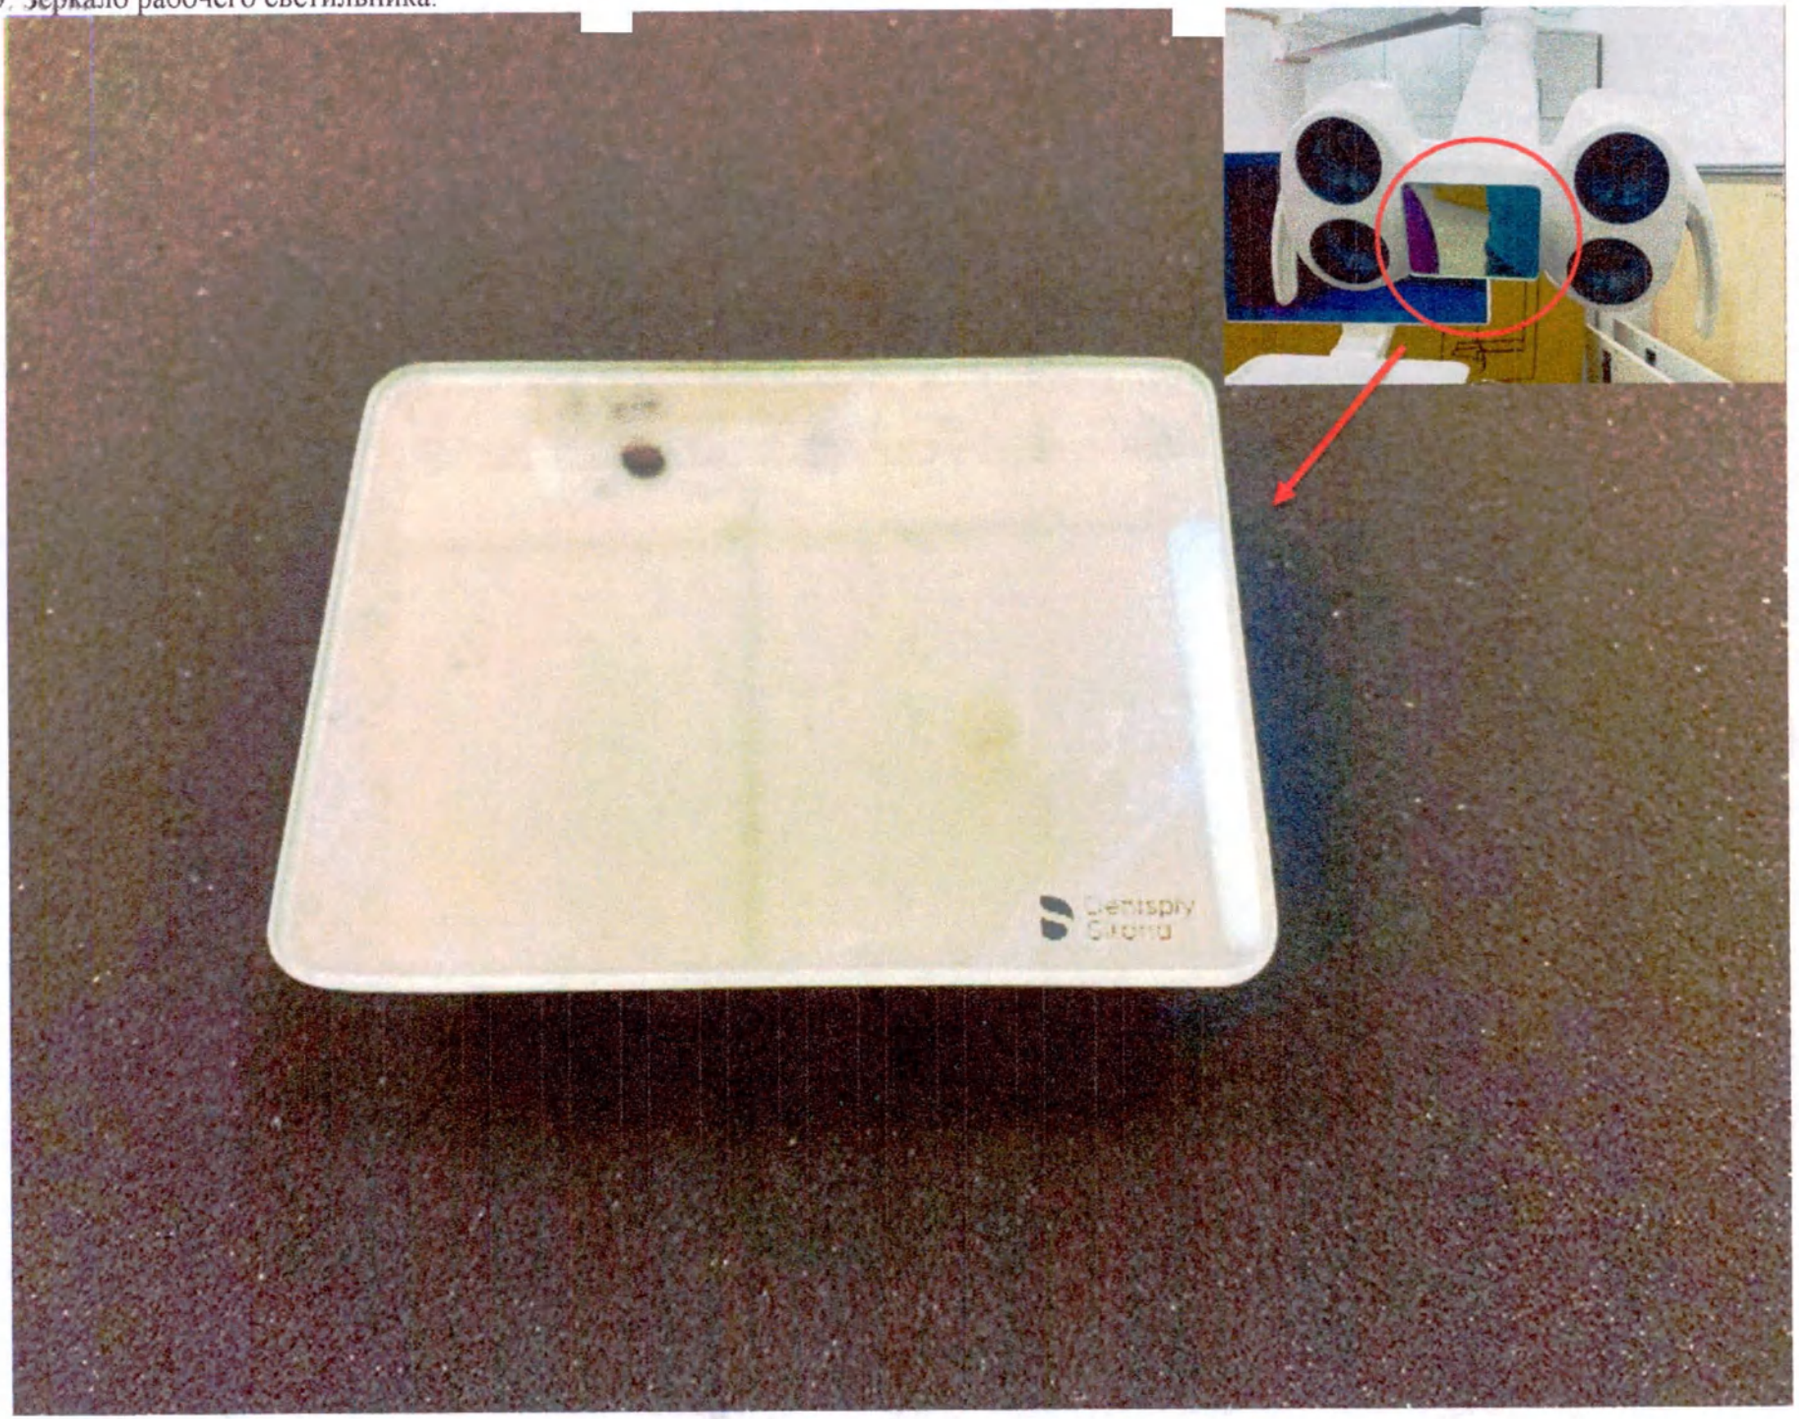

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

50. Держатель камеры рабочего светильника.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

51. Монитор пациента 22" DC.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

52. Комплект кабелей для HDMI подключения системы SIVISION.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

53. Консоли и опоры: Опора (A) для крепления консоли рабочего светильника или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus или консоли рабочего светильника и монитора или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus и монитора; Консоль для крепления рабочего светильника (B); Консоль для крепления лотка или лотка и монитора (C).

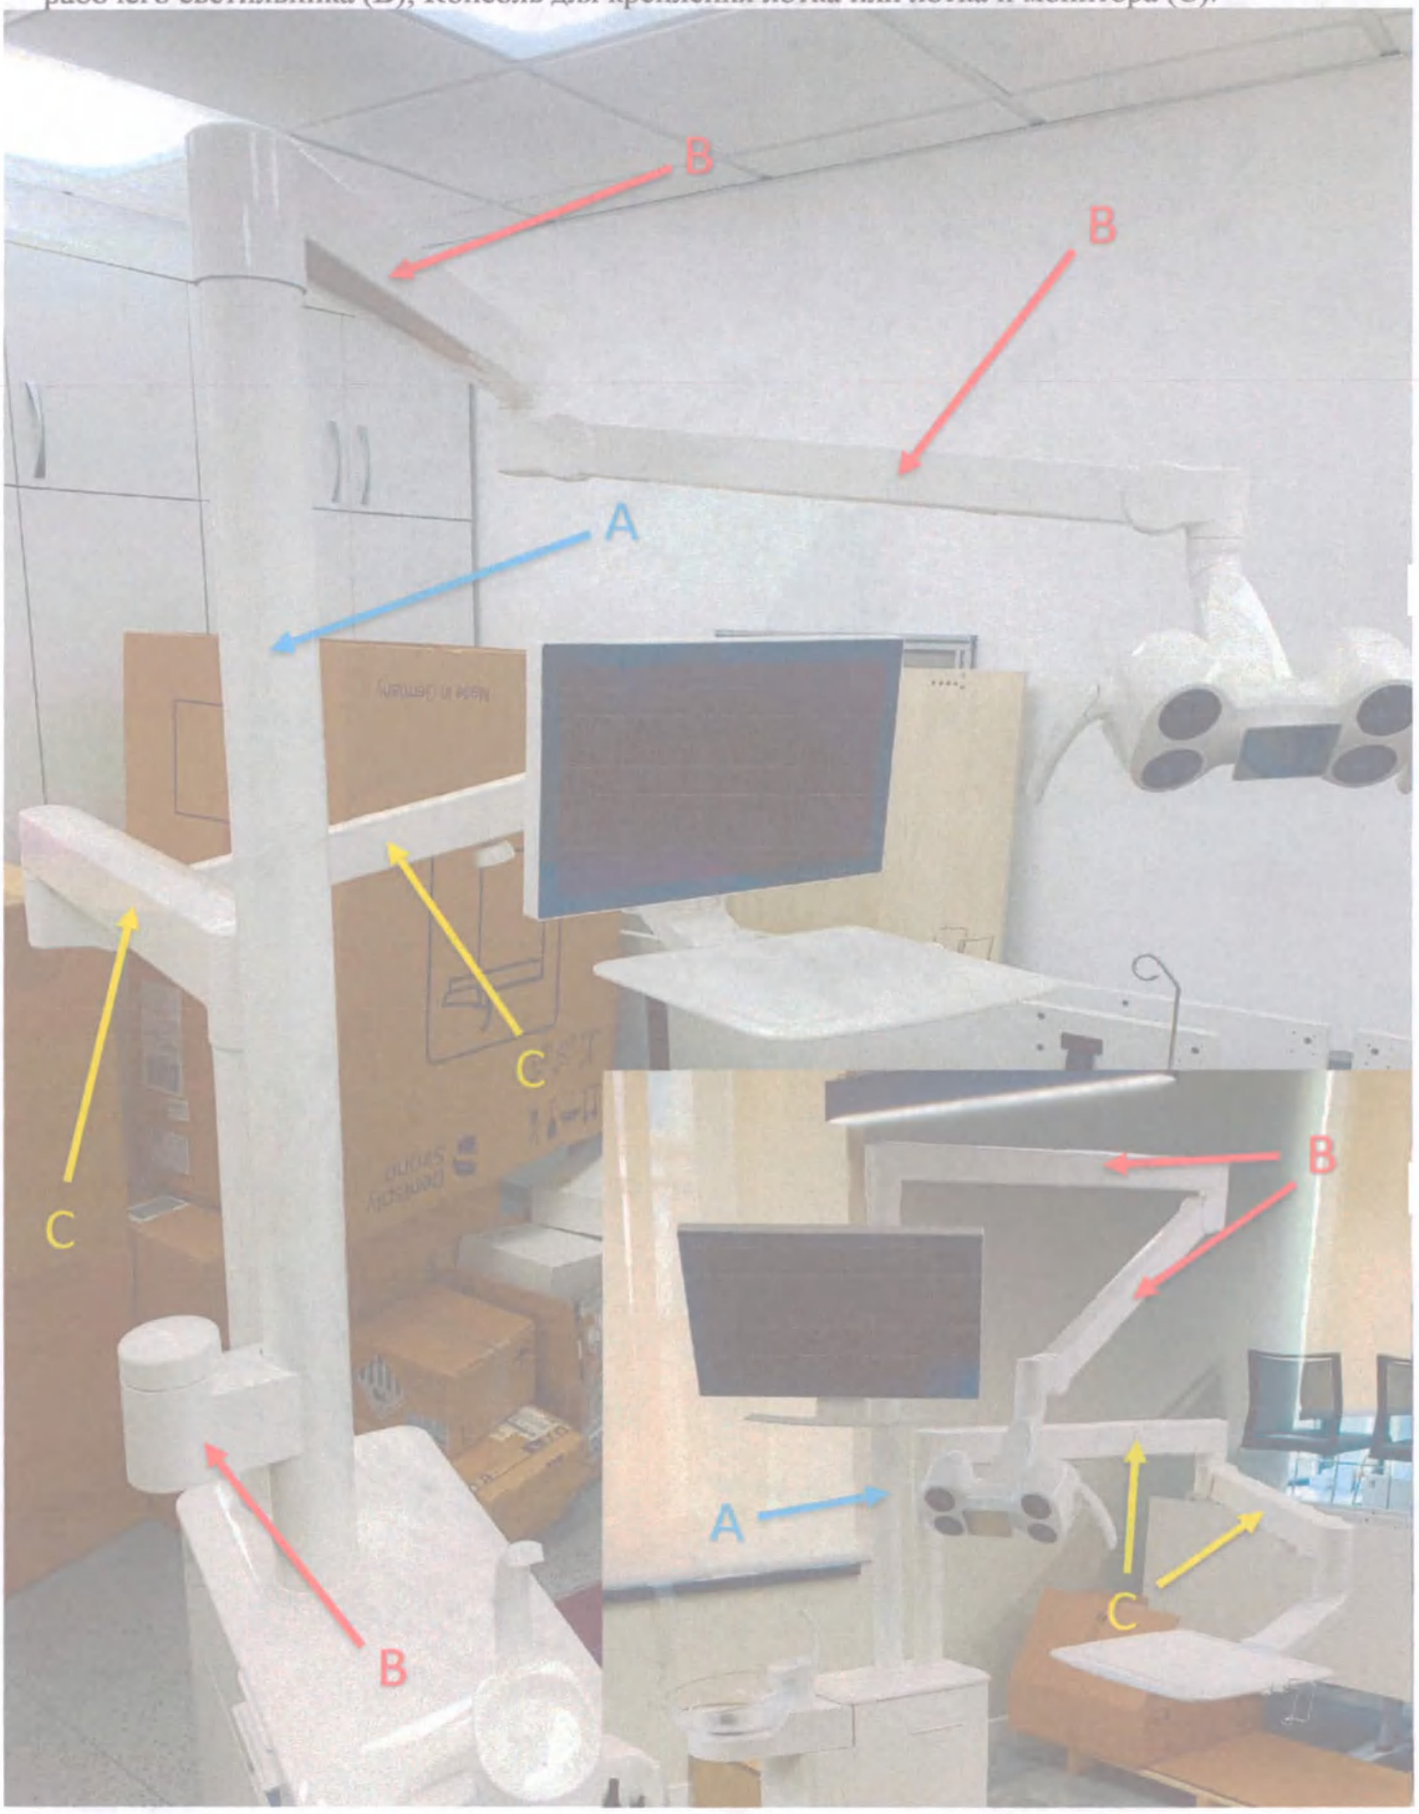

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

54. Стоматологические рабочие кресла
вариант исполнения Hugo



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Theo



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Carl




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Paul




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


55. Программное обеспечение Sidexis 4 на электронном носителе.

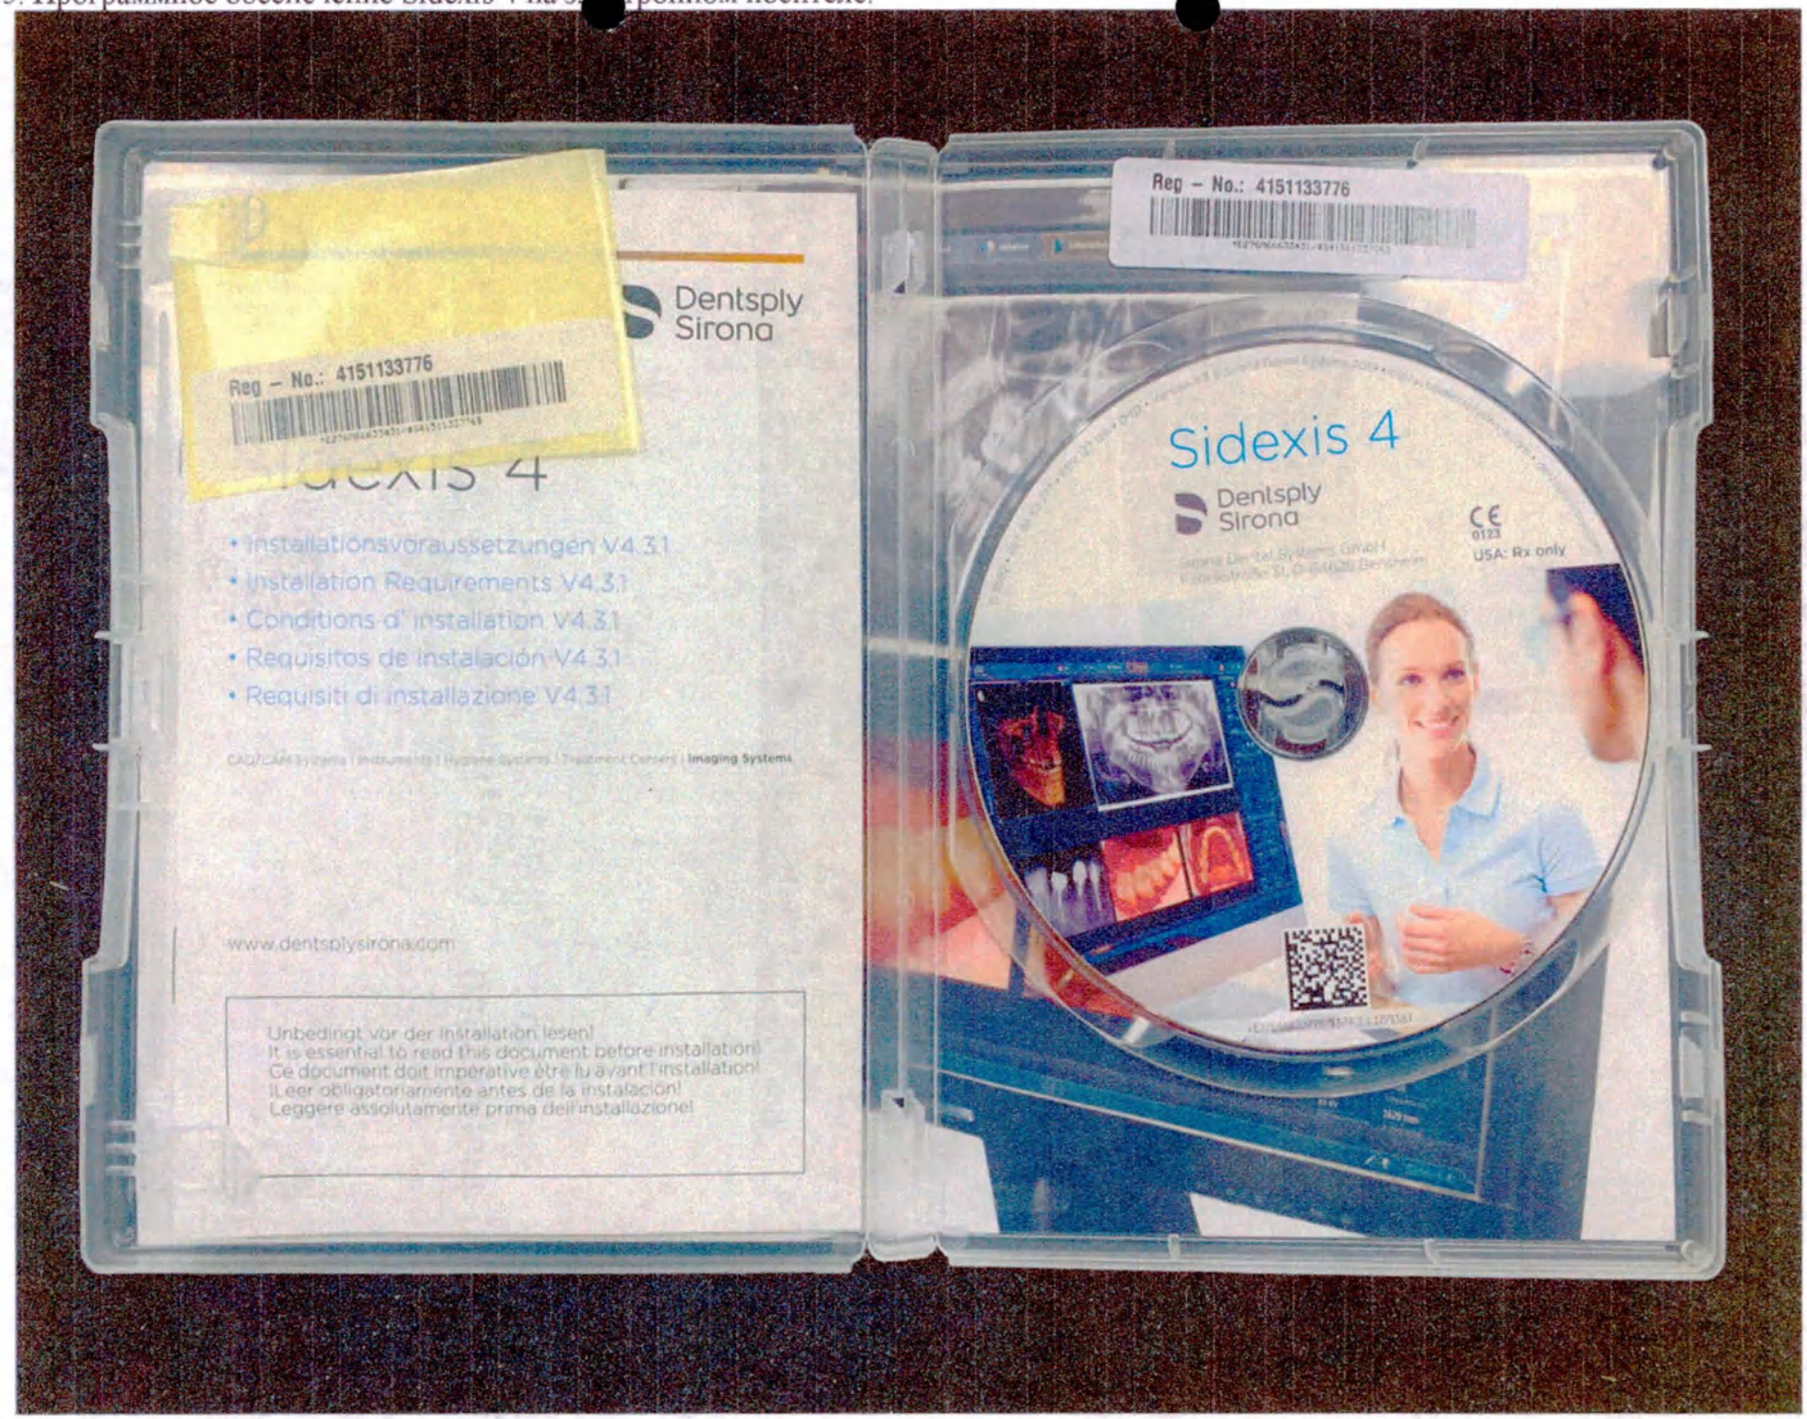

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

56. Лицензионный код для активации Sidexis 4.

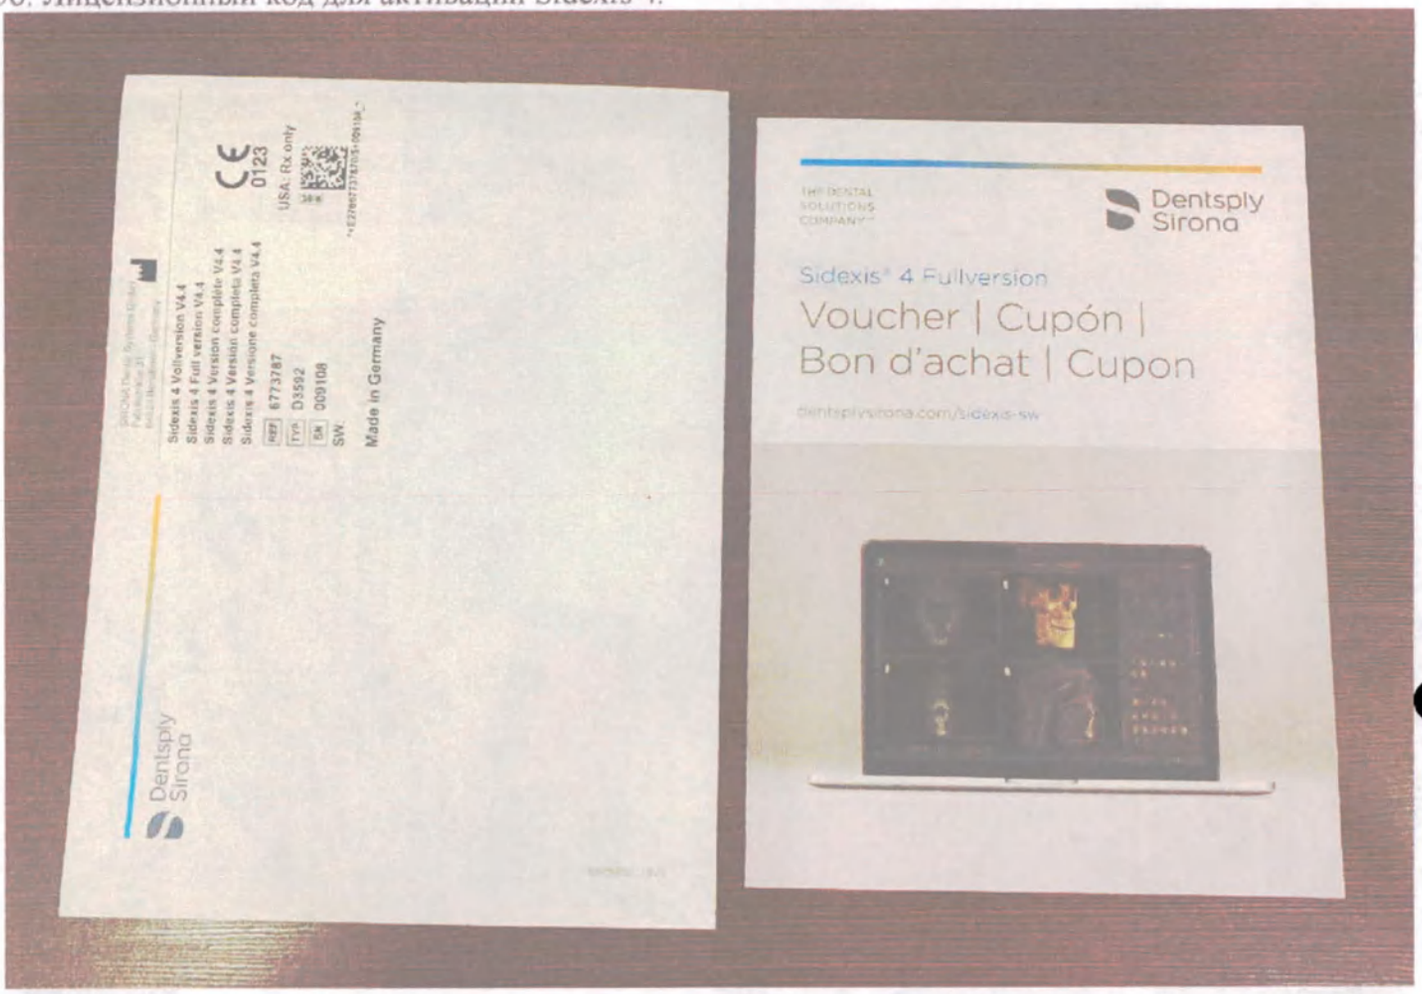

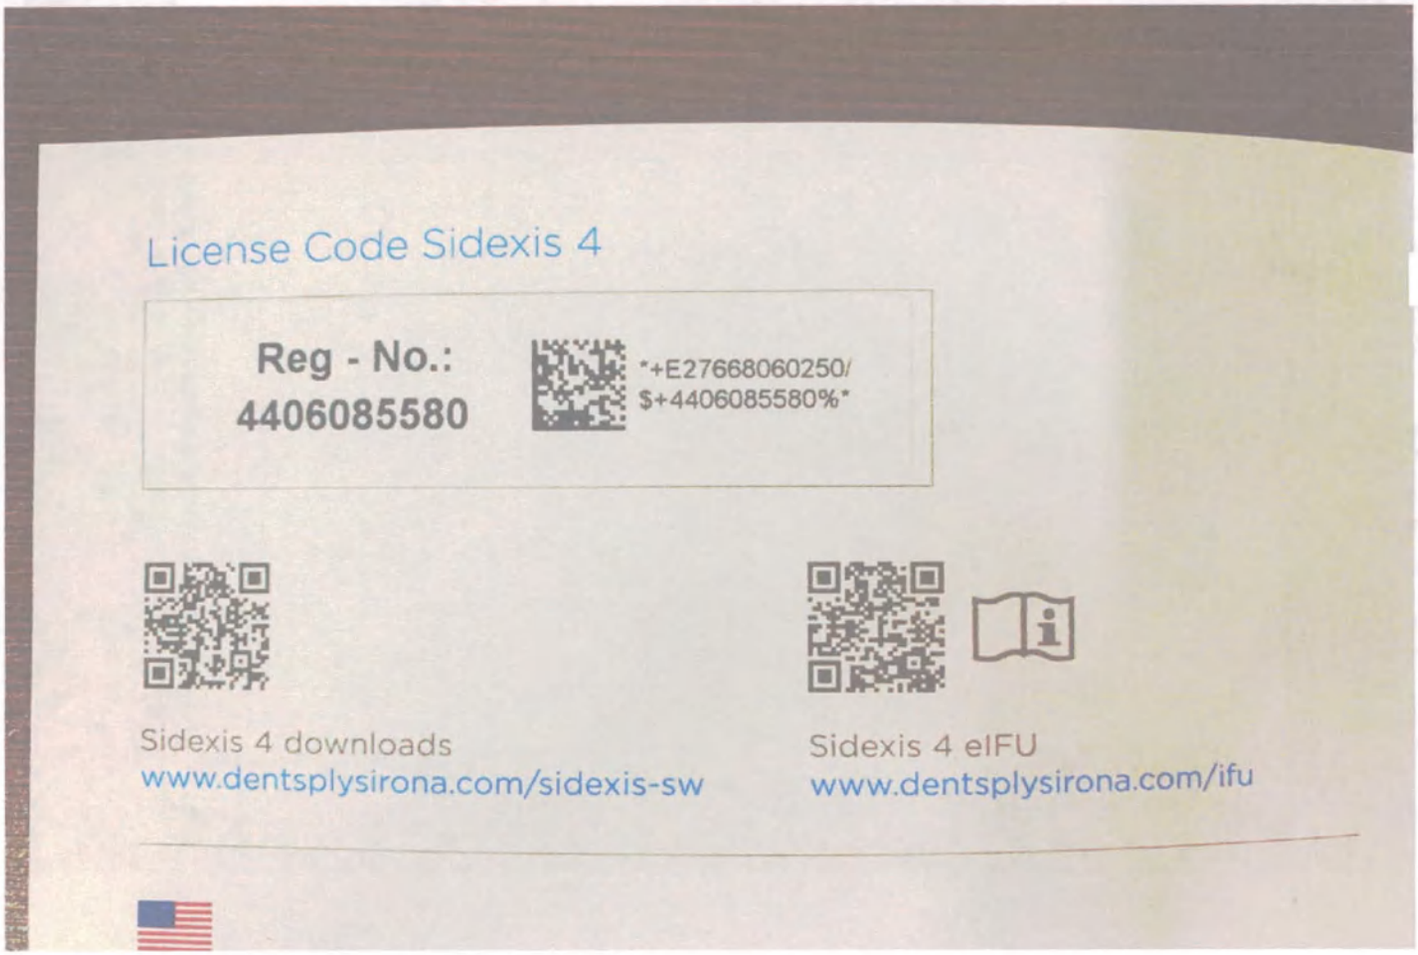

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

57. Элементы для инсталляции установки стоматологической.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

58. Эксплуатационная документация, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе и/или на бумажном носителе, в составе:

58.1. инструкция по эксплуатации Treatment center, модель Axano

Действует с: 02.2022


Dentsply Sirona

Treatment Center

Axano

Инструкция по эксплуатации

Русский

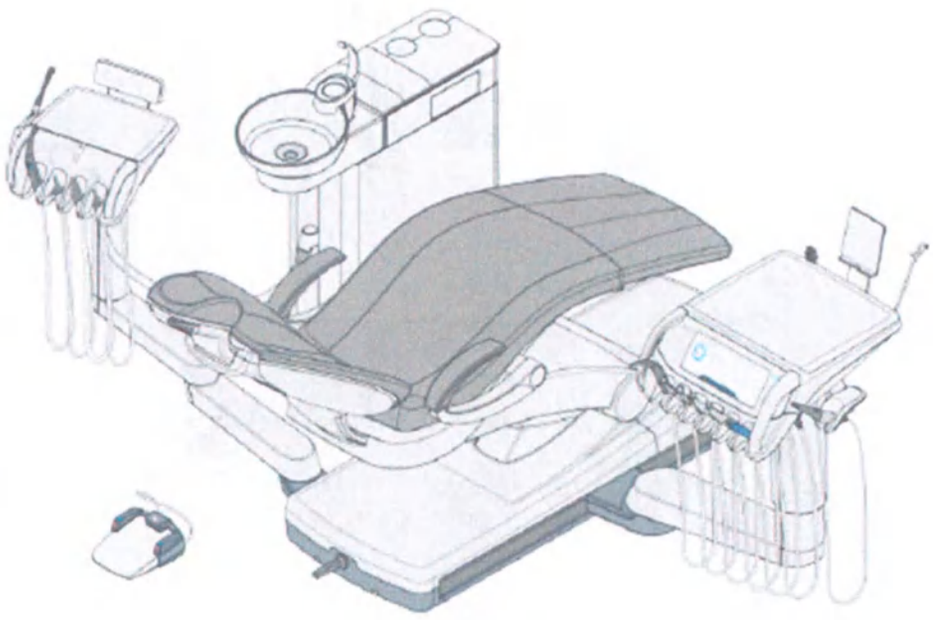

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Новый от: 03.2019

Dentsply Sirona

Hugo, Theo

Инструкция по эксплуатации

Русский



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Новый от: 06.2019

Dentsply Sirona

Carl, Paul

Инструкция по эксплуатации

Русский



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Действует с: 04.2021

Dentsply Sirona

LEDview Plus

Инструкция по эксплуатации

Русский

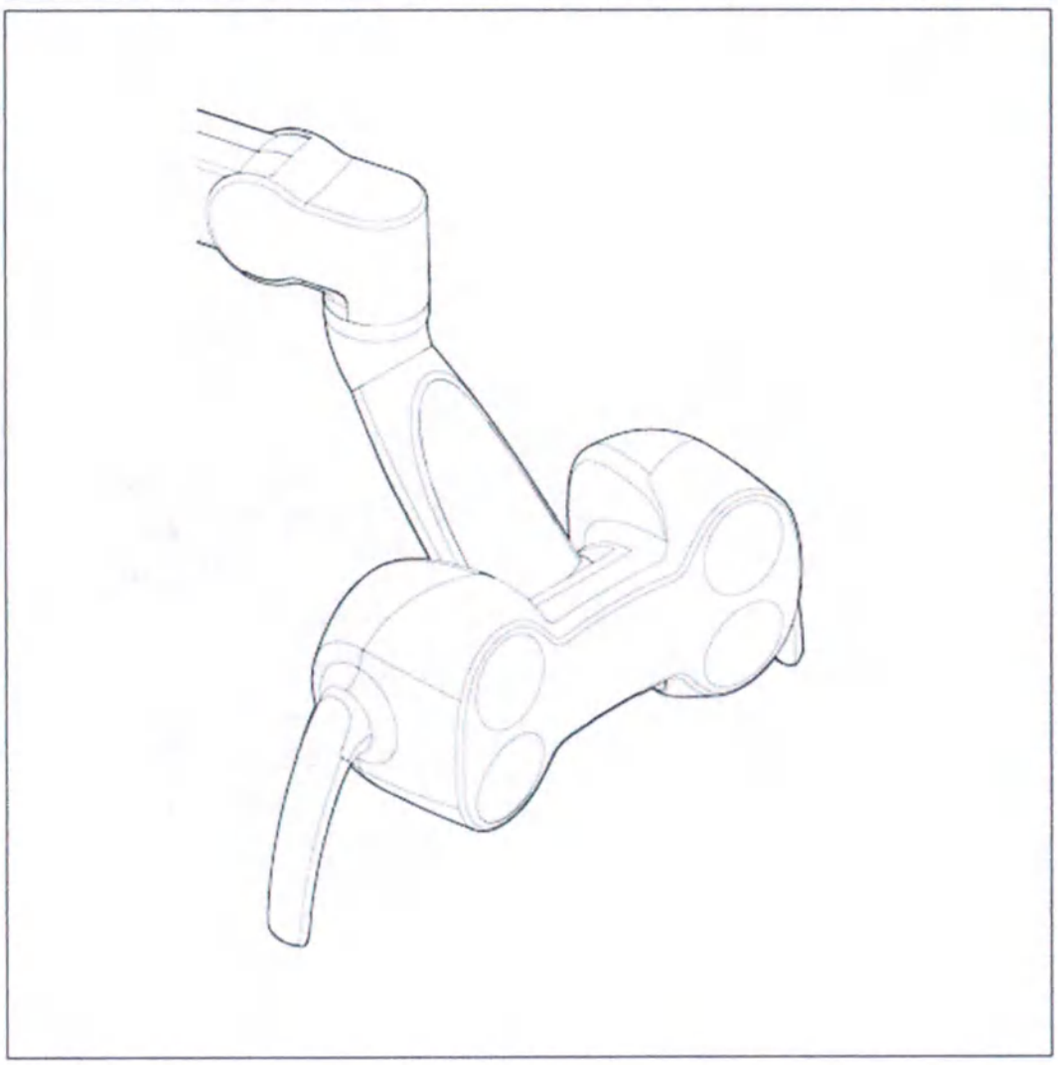

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Действует с: 03.2017


Dentsply Sirona

SIVISION digital

Инструкция по эксплуатации
22-дюймового монитора

REF 6497452 D3655
REF 6576248 D3678


Русский

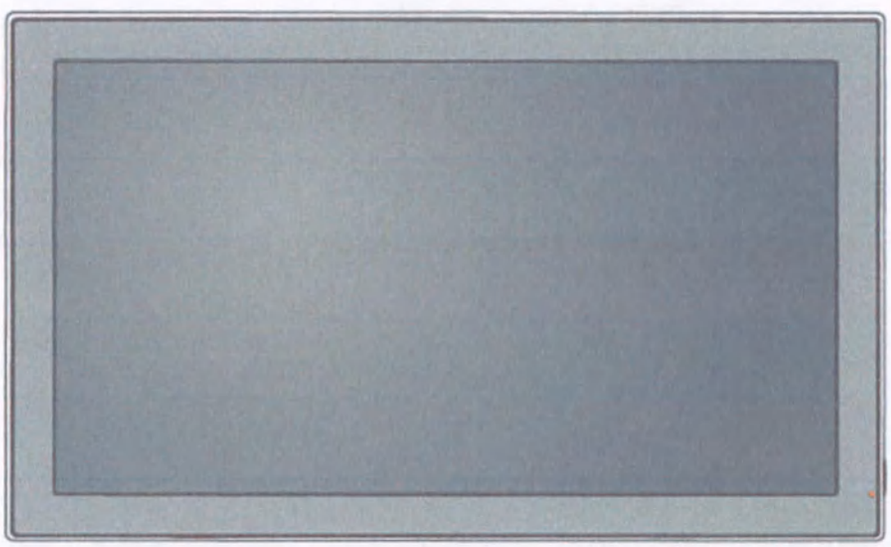

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SiroSonic/L/TL
PerioSonic

Dentsply Sirona

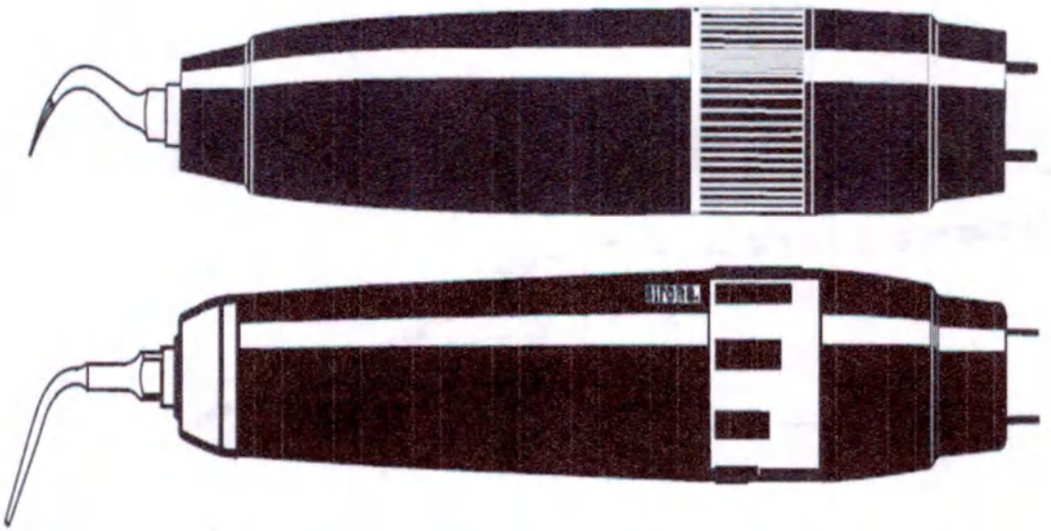

Русский

Инструкция по эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Dentsply Sirona

Русский

Endo 6:1

Инструкция по эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Новый от: 07.2017

sirona
The Dental Company

T1 CLASSIC / T1 LINE/ T2 LINE/ T3 LINE/ T4 LINE

Инструкция по эксплуатации

Русский

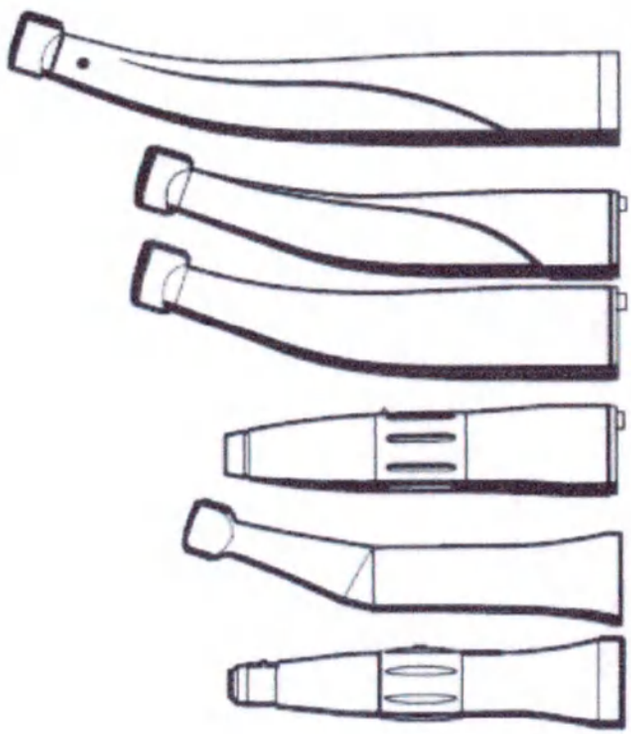

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

58.8. инструкция по эксплуатации CA 20:1 L MICRO-SERIES

Bien Air Dental

CA 20:1 L, CA 20:1
CA 20:1 L KM
CA 20:1 L Micro-Series
CA 20:1 L KM Micro-Series



РУС ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Другие языки доступны на
https://dental.bienair.com/ifu

CE 0123 Rx Only REF 2100209-0007/2022.03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

II. Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Стоматологическое кресло, с элементами для подключения.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Педальный переключатель,
вариант исполнения: Smart Control



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Classic

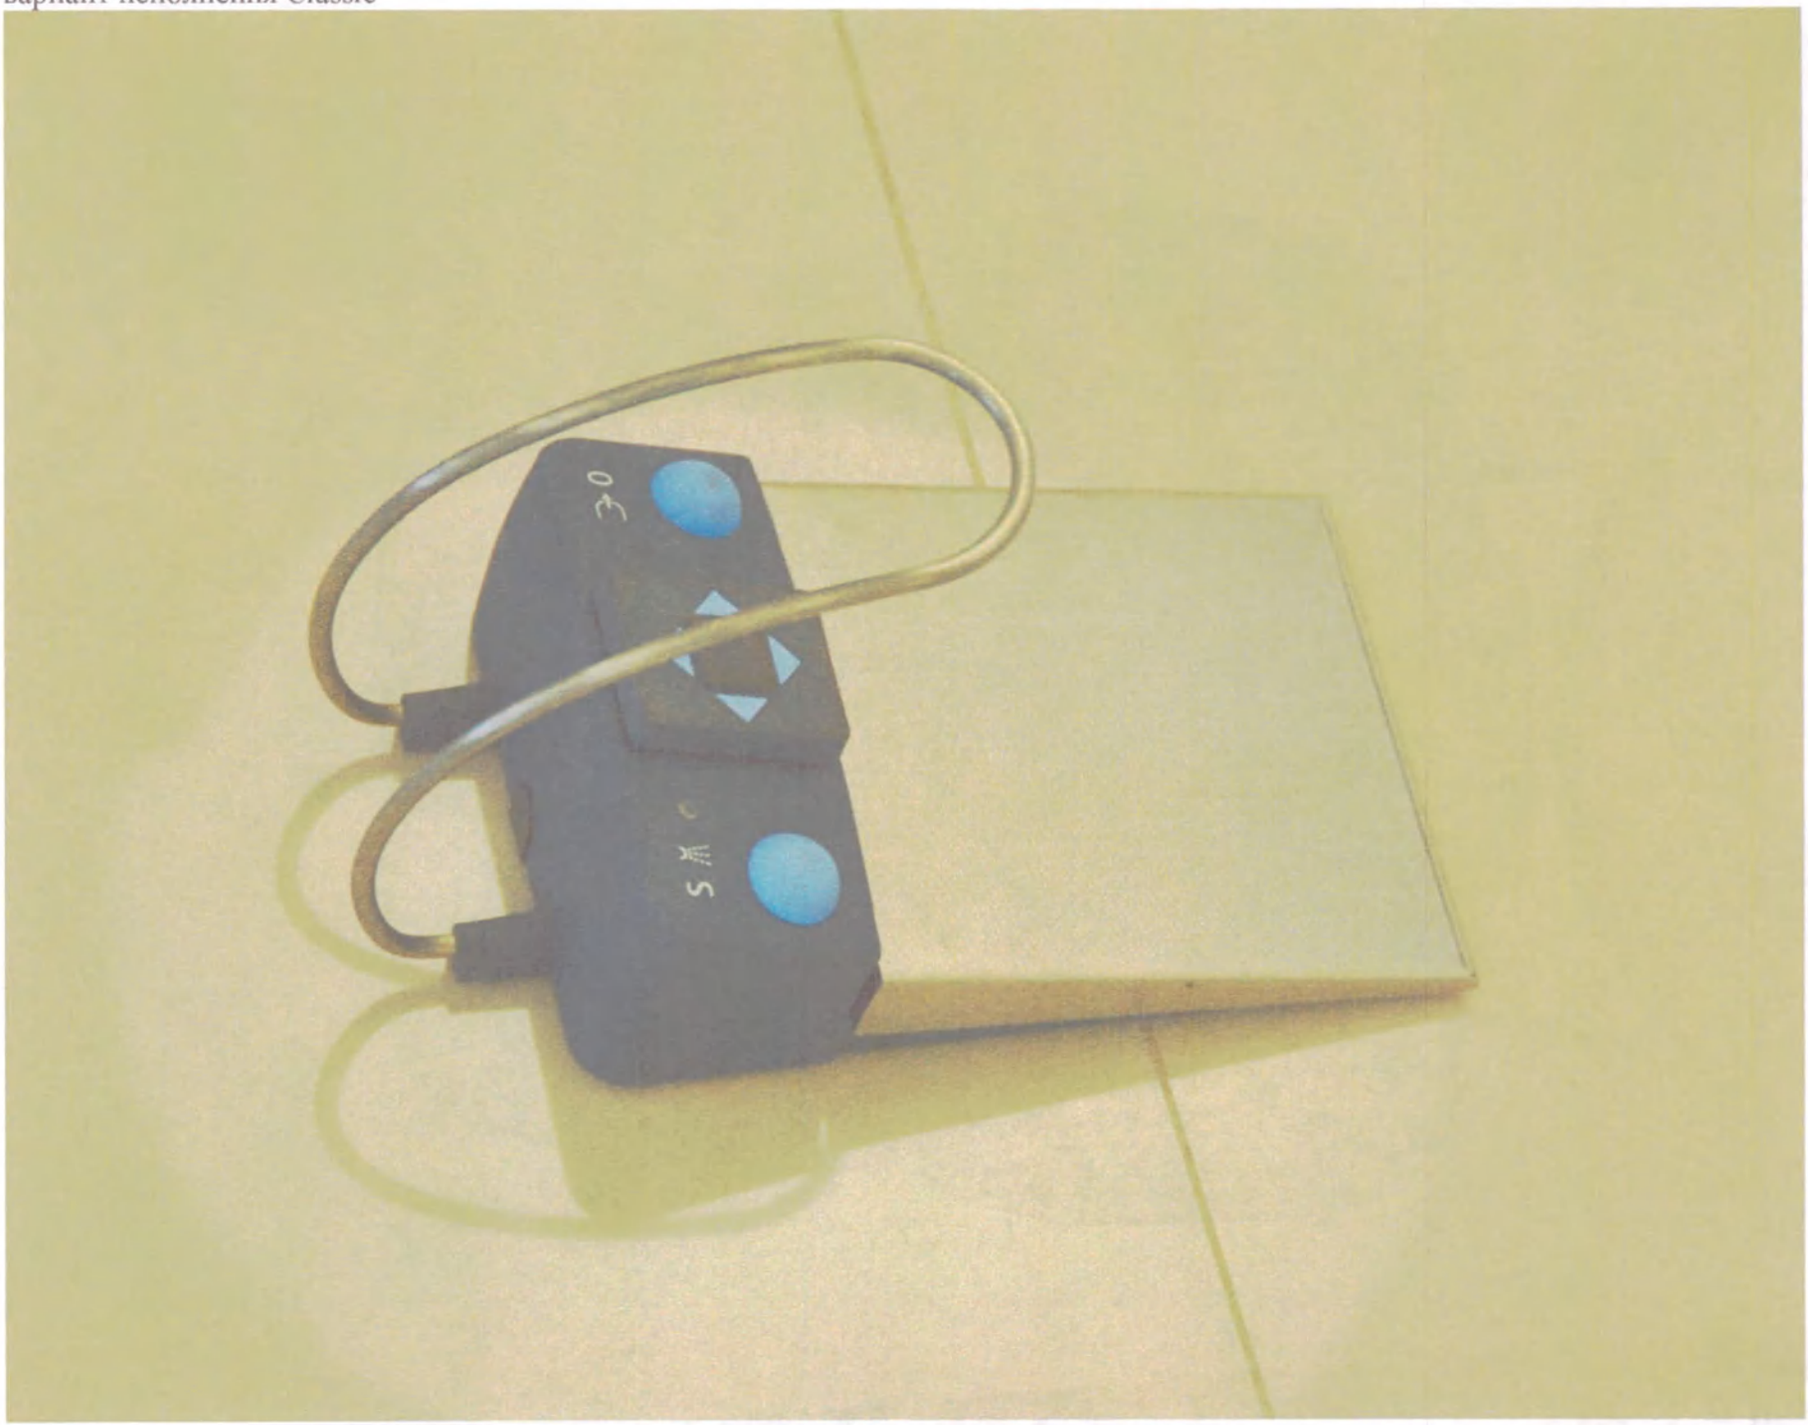

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Моторизованный подголовник.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подгодовник с двойным шарниром



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Подушка для подголовника.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Подлокотники (правый и/или левый).


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Подушка корректирующая на сиденье кресла пациента.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Разъём для сторонних устройств.

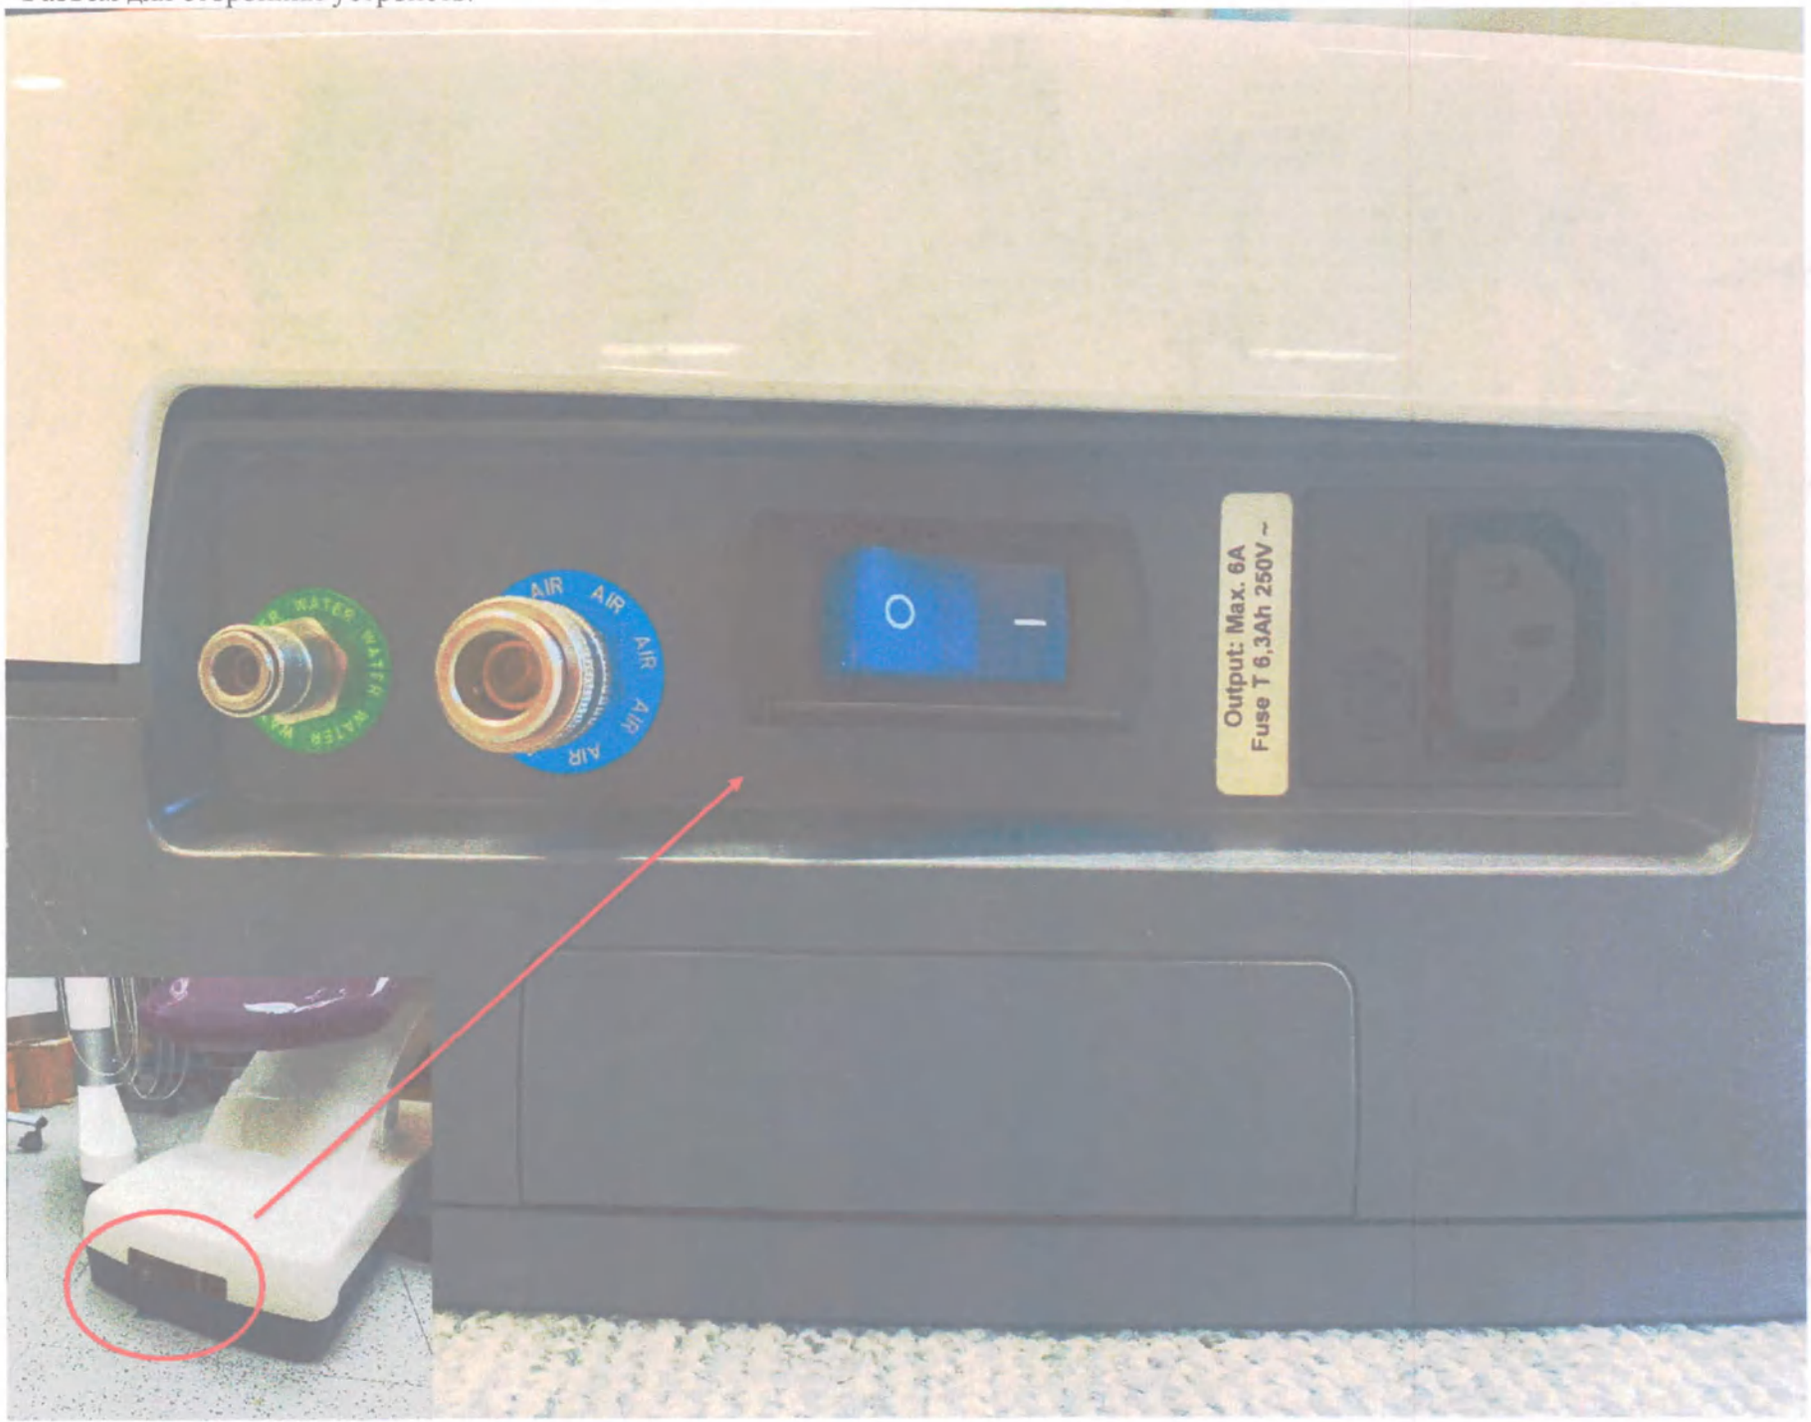


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Плита установочная, вариант исполнения стандартная



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения демонстрационная

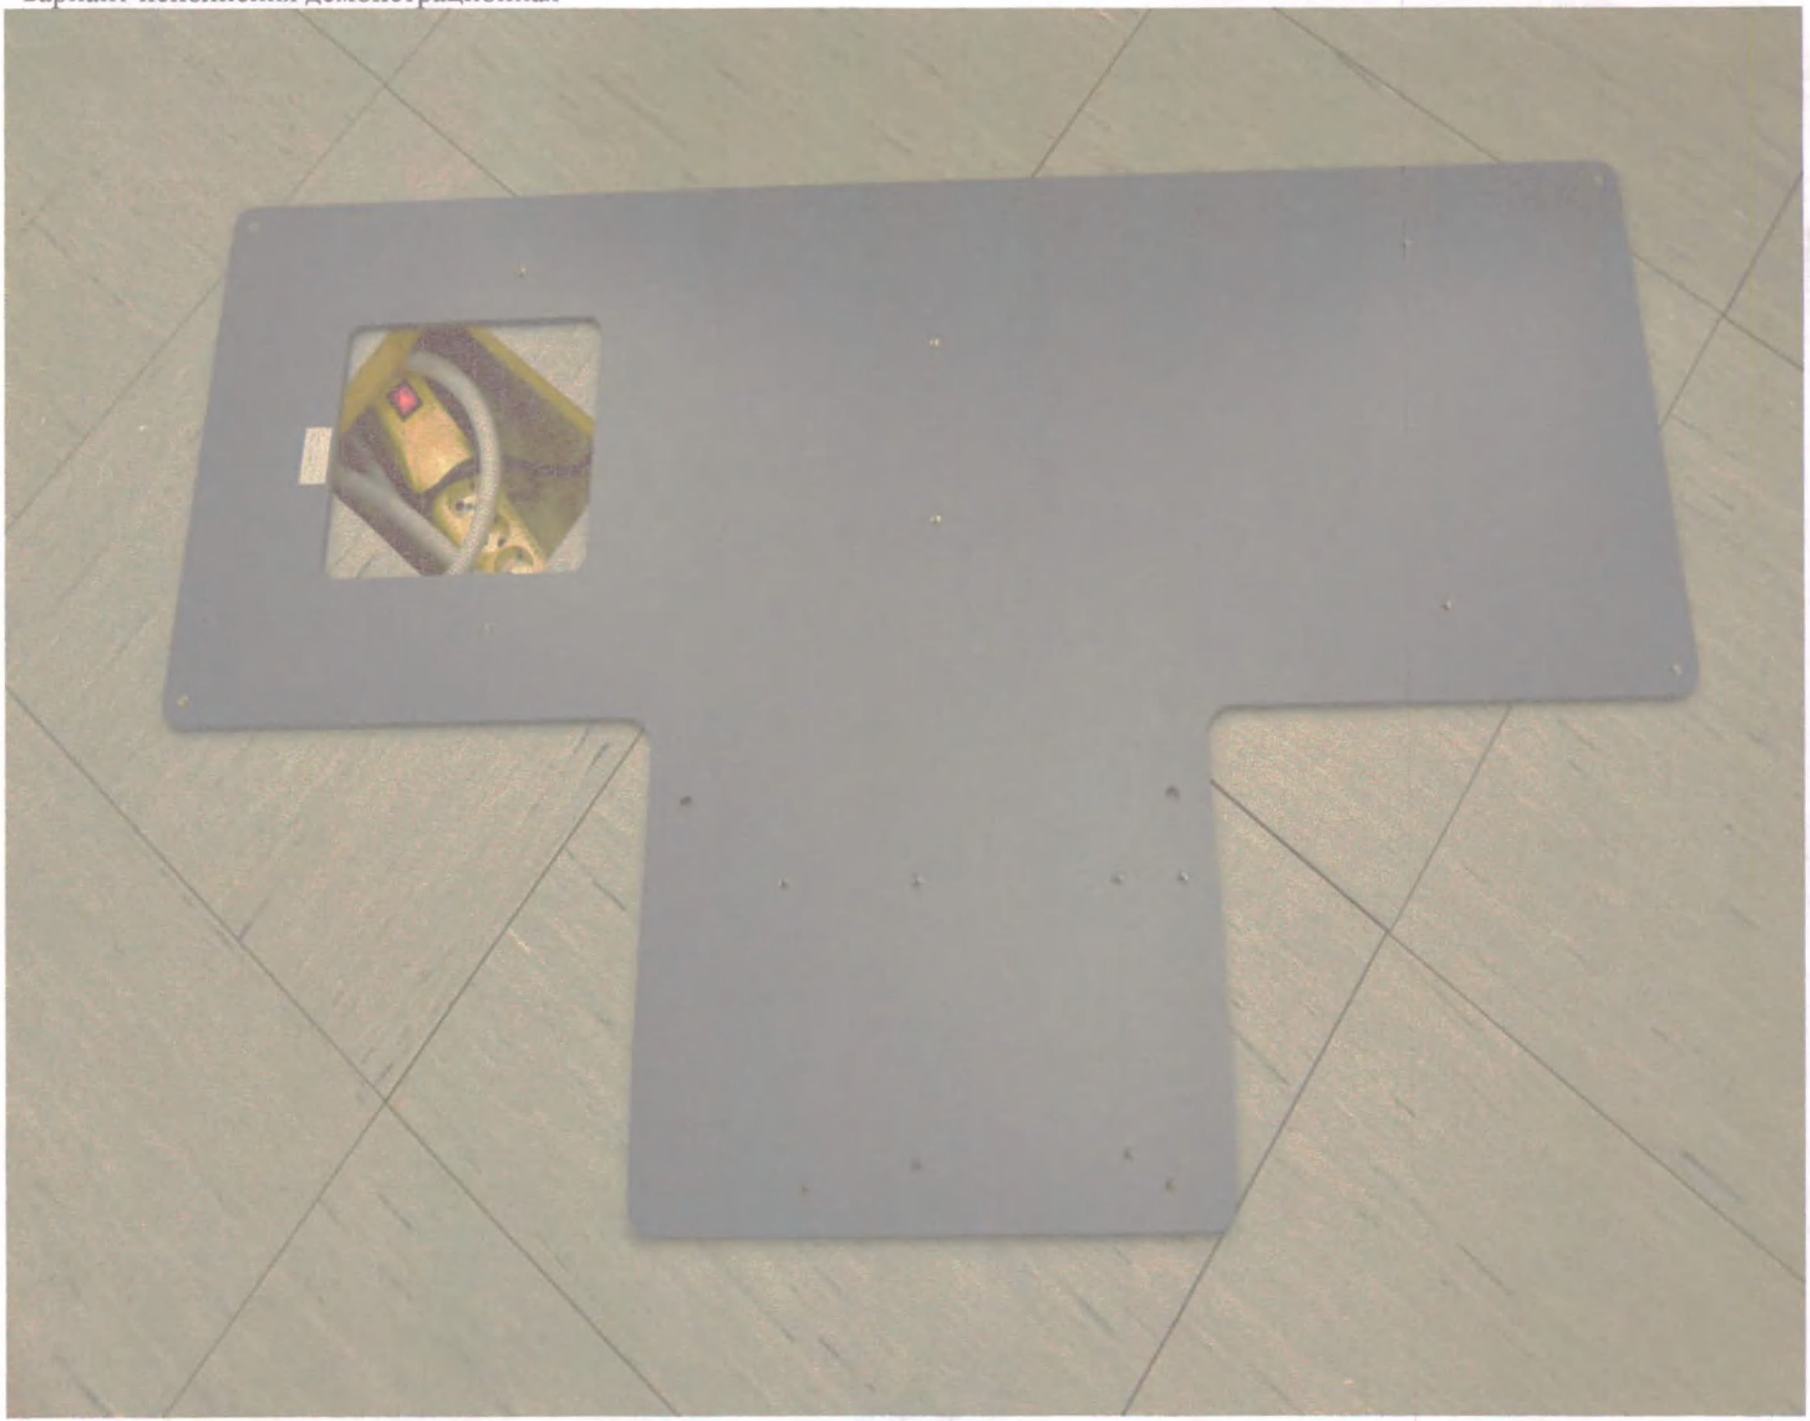


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Блок врача с элементами для подключения.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10. Нескользящий силиконовый мат, вариант исполнения для блока врача

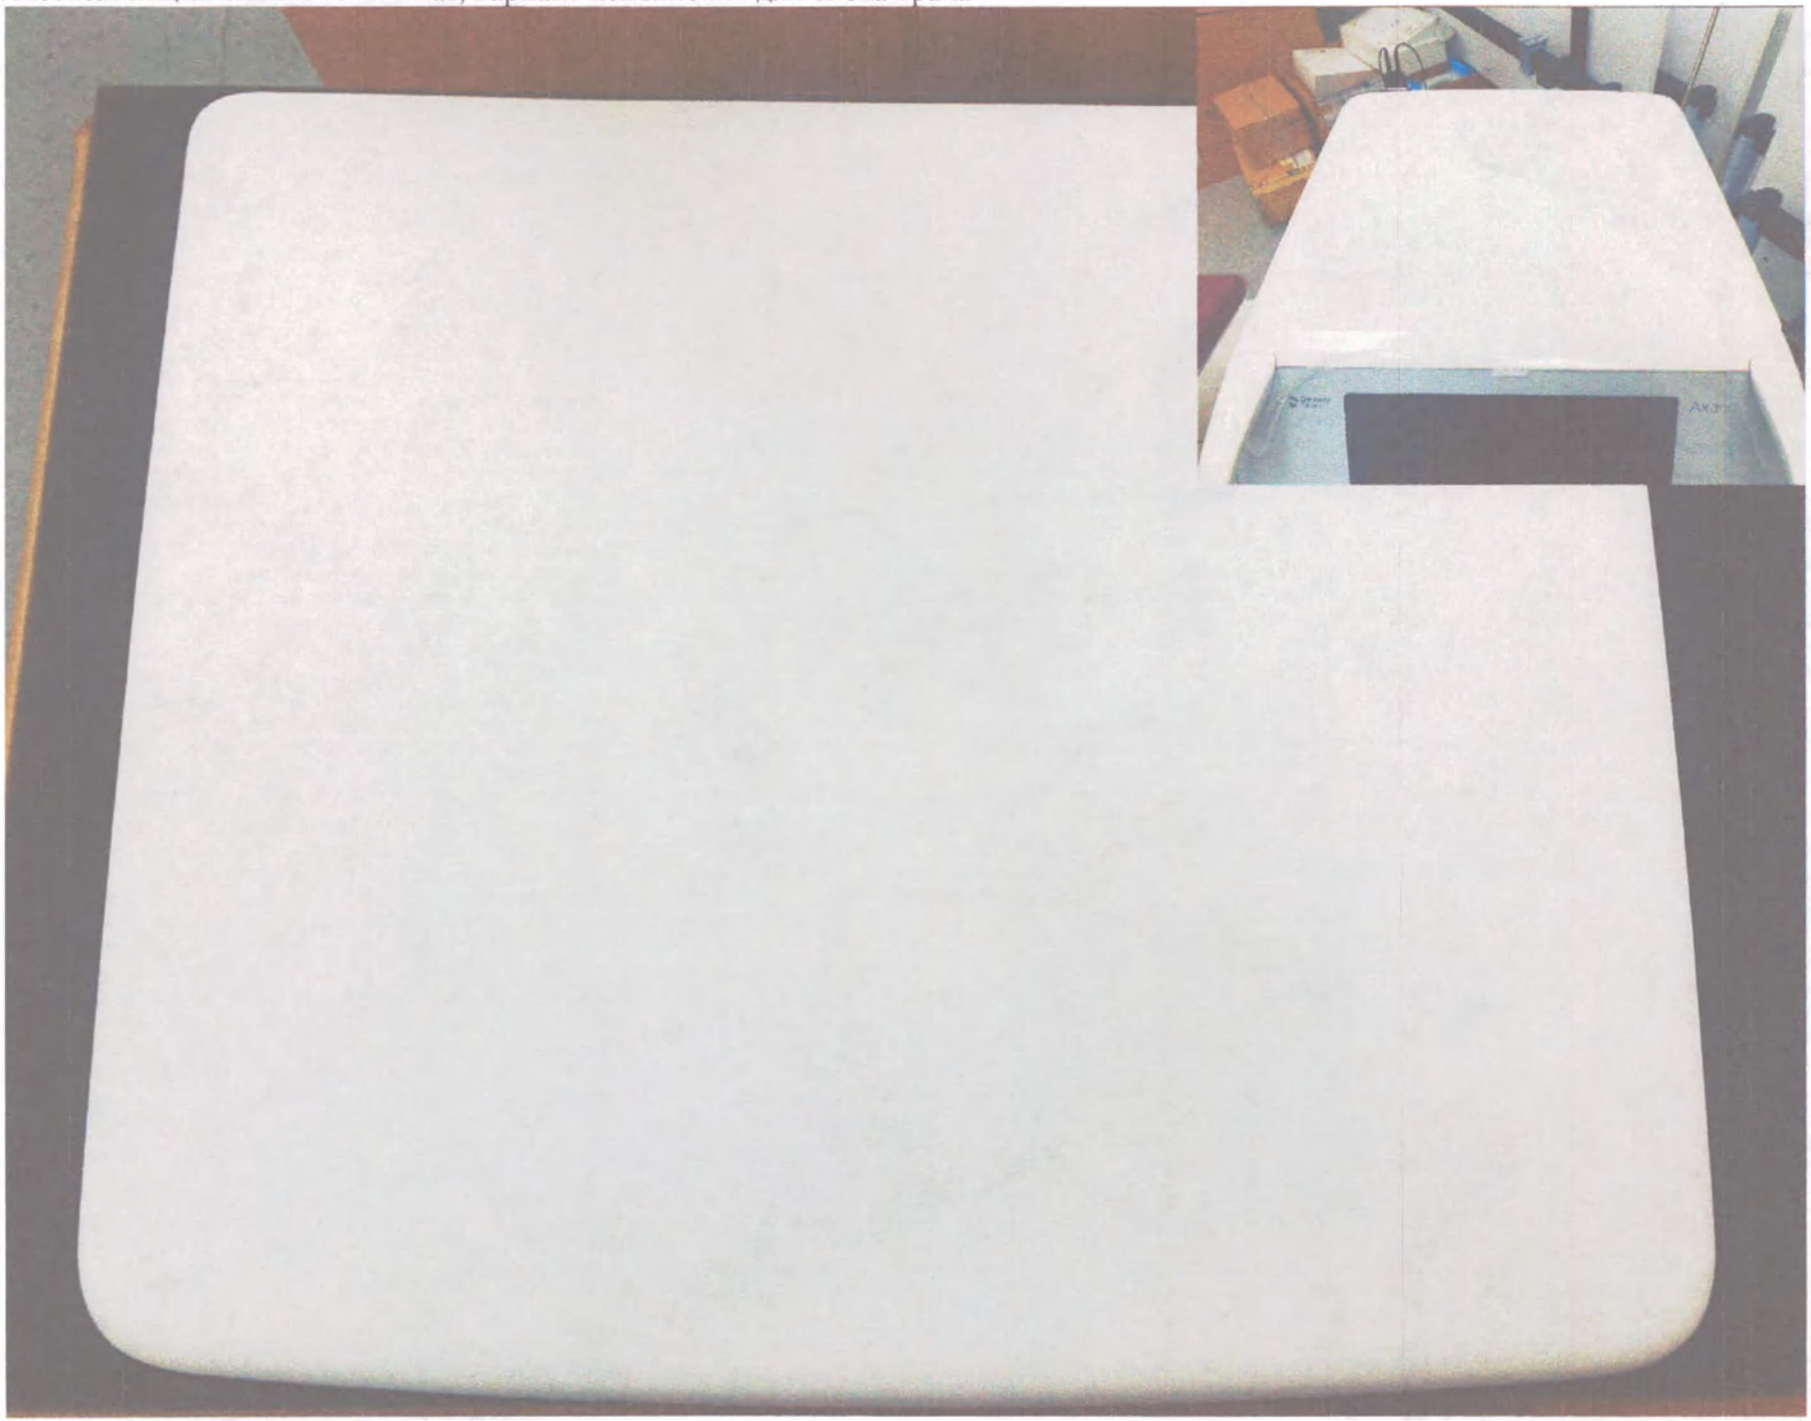

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения для блока ассистент

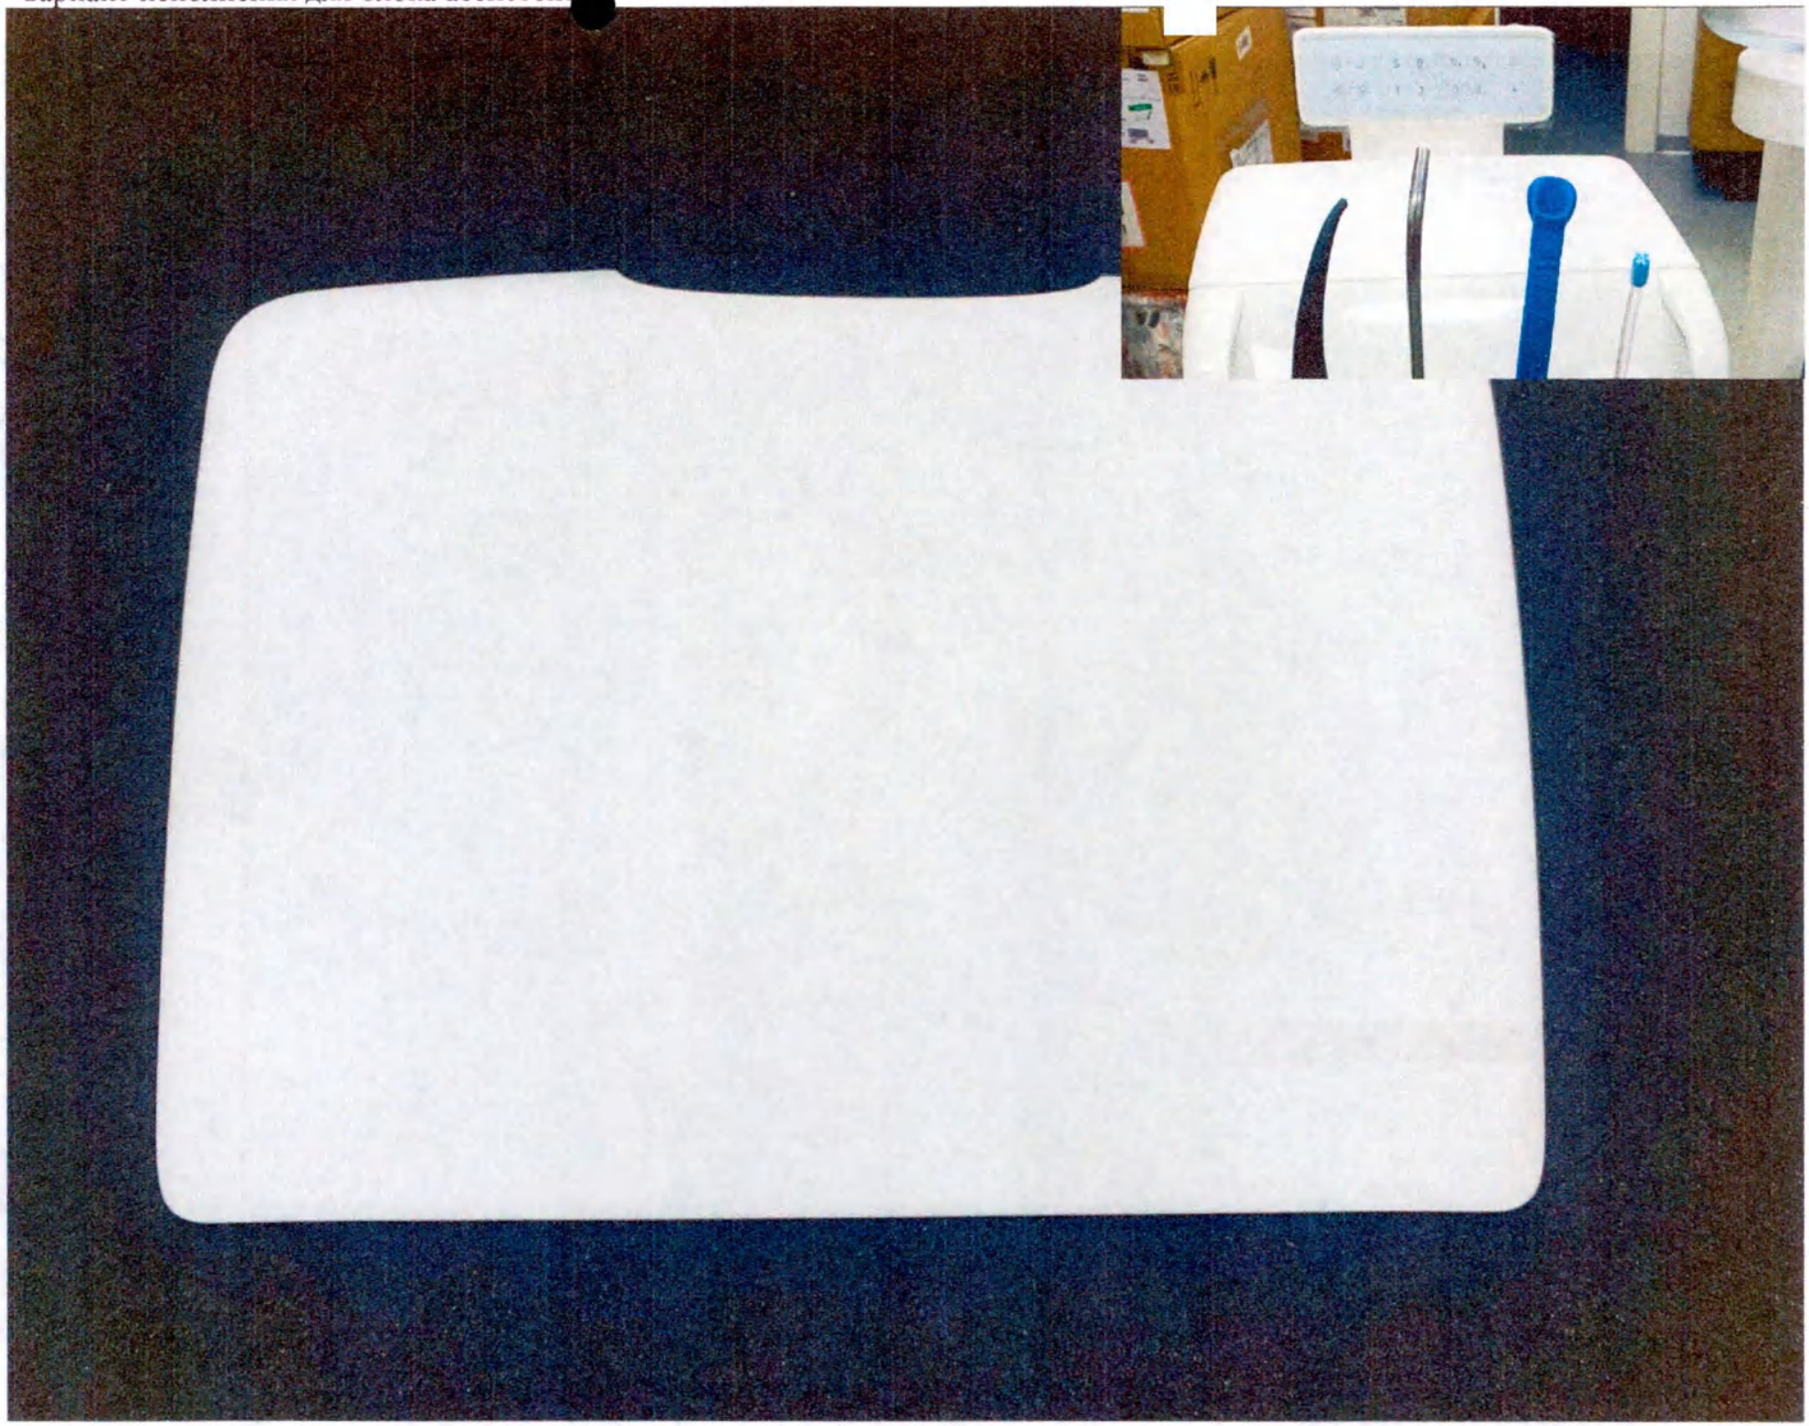

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения для лотка



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

11. Универсальный пистолет (пустер) Sprayv[illegible]prayvit M) со шлангом, варианты испол[illegible]я: (левосторонний и/или правосторонний).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. Ультразвуковой наконечник (скейлер) SiroSonic TL со шлангом.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

13. Моторы со шлангами,
вариант исполнения BL E



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

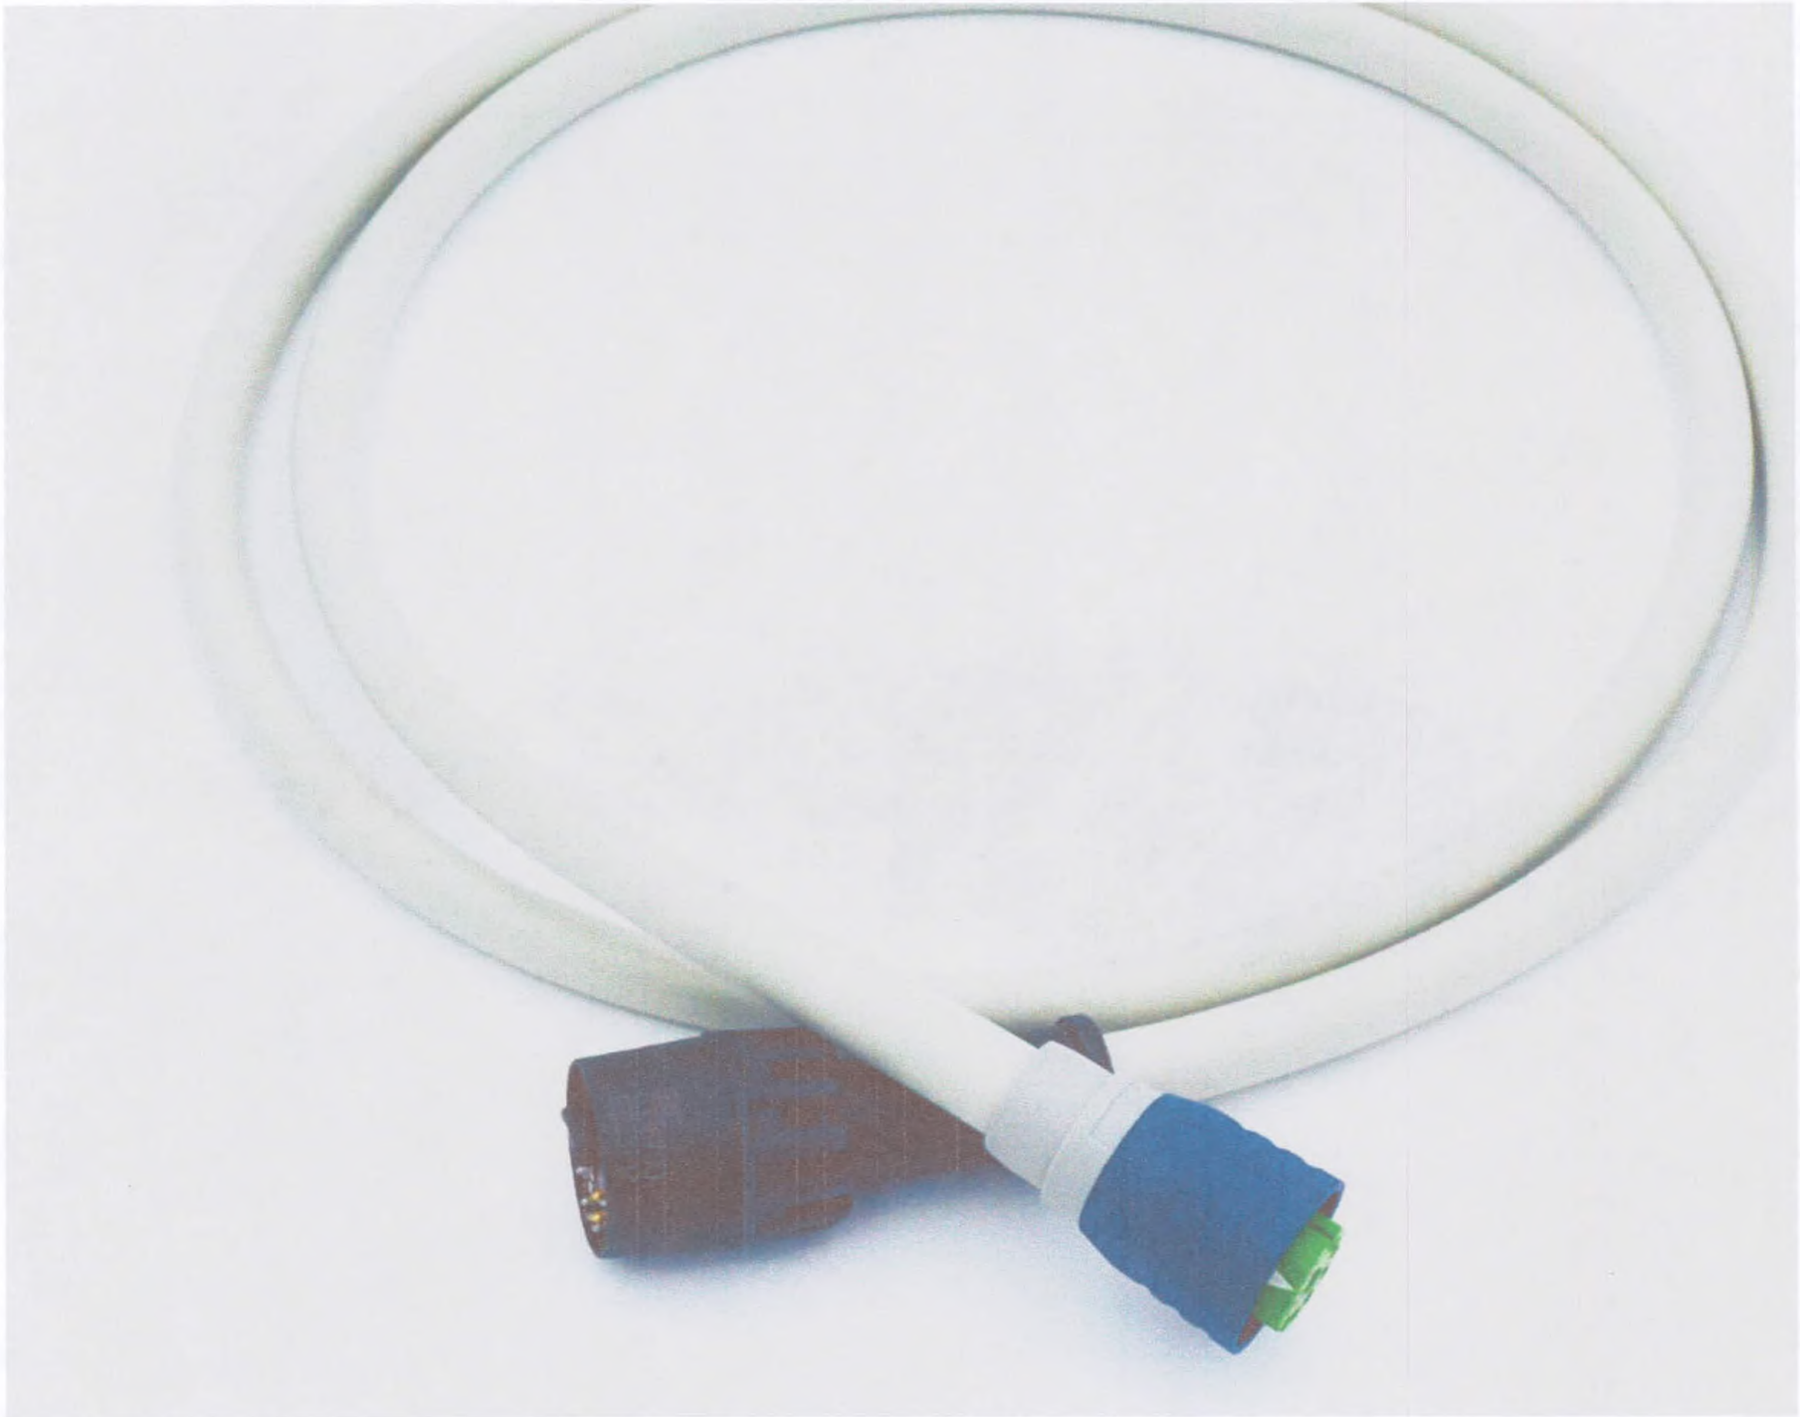

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения BL ISO F






ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения BL Implant E



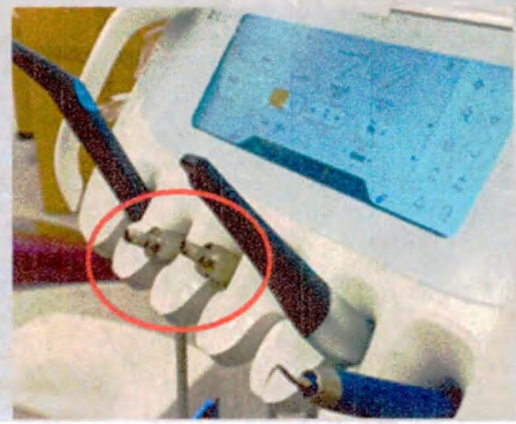

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14. Шланг для турбин.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

15. Быстросъемное соединение quick coupling R (LED) для турбин.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

16. Внутриротовая камера SiroCam AF, с эле[illegible]гами для подключения.

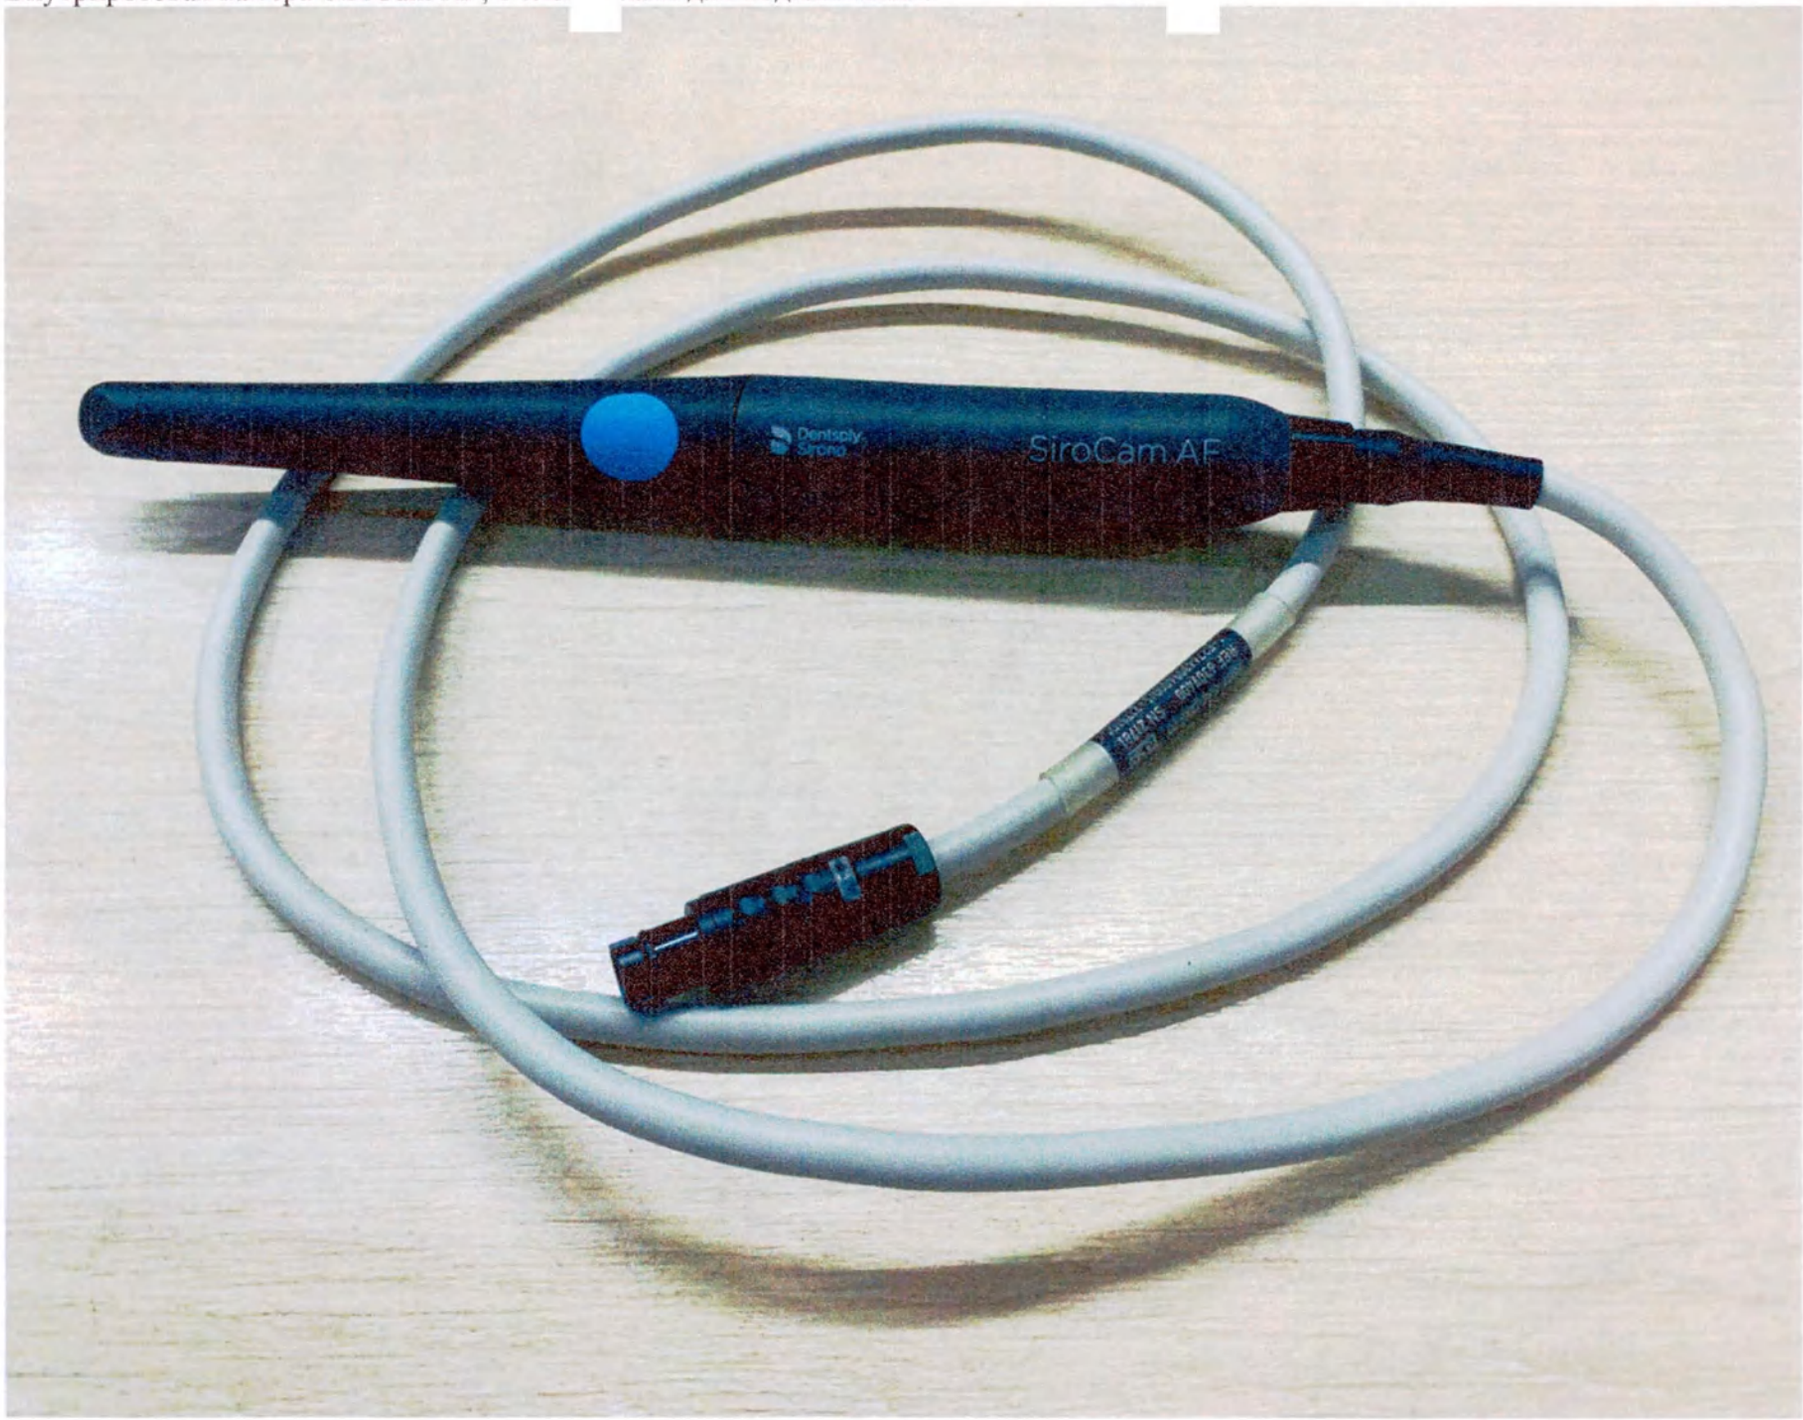


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Внутриротовая камера SiroCam AF+, с элементами для подключения.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

17. Компоненты встроенного ApexLocator, в составе: электрод (A), зажим для губ (B), зажим файла (C), кабель (D)

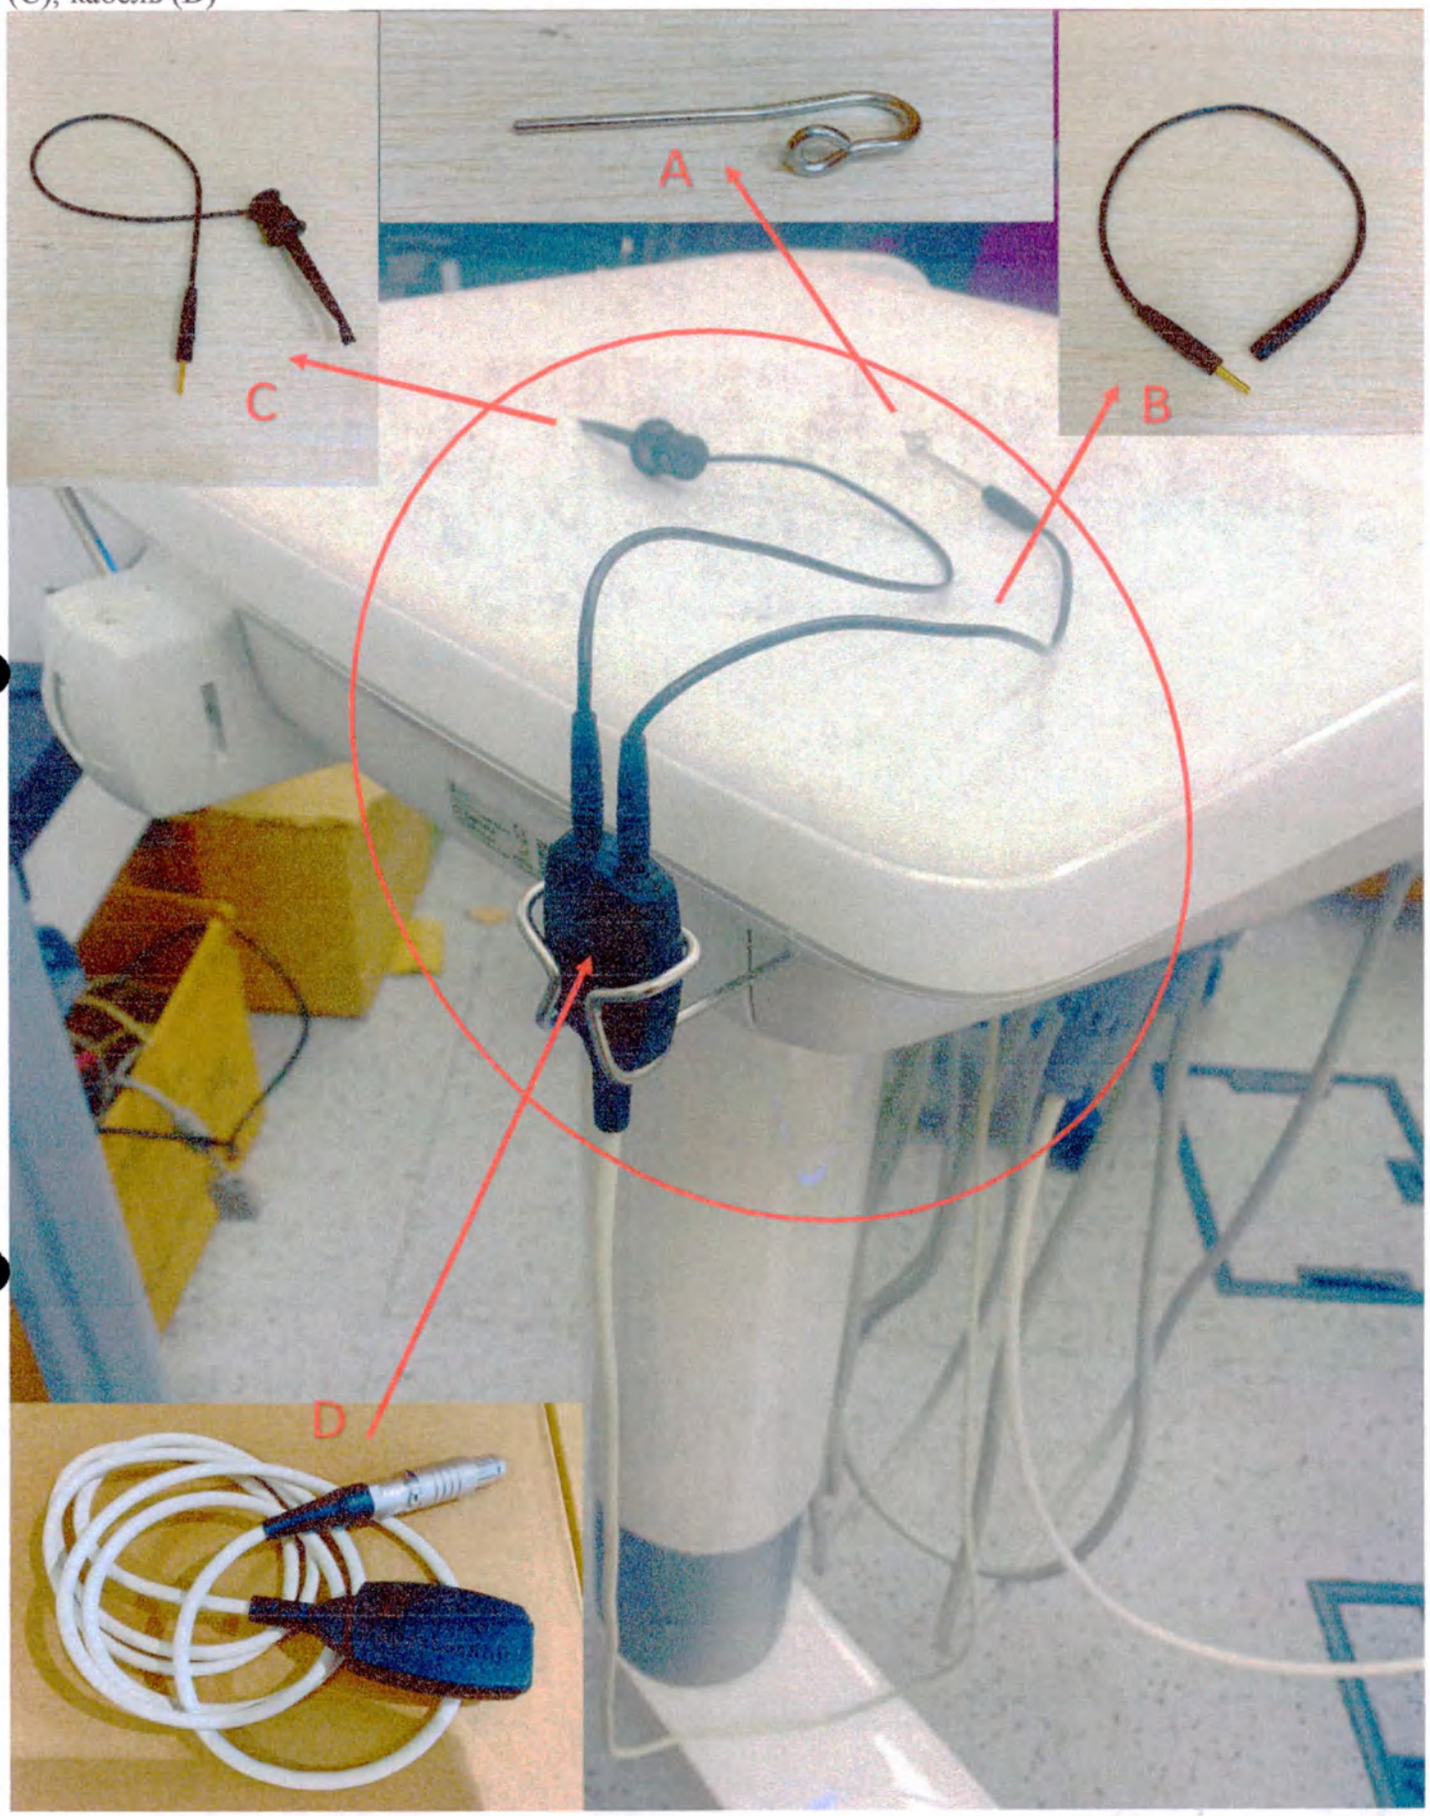

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

18. Наконечник эндодонтический угловой T1 Line Endo 6 L





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наконечник эндодонтический угловой Endo 6:1




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

19. Изолирующая силиконовая оболочка для эндодонтии с ApexLocator.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

20. Перистатический насос для подачи физиологического раствора NaCl.

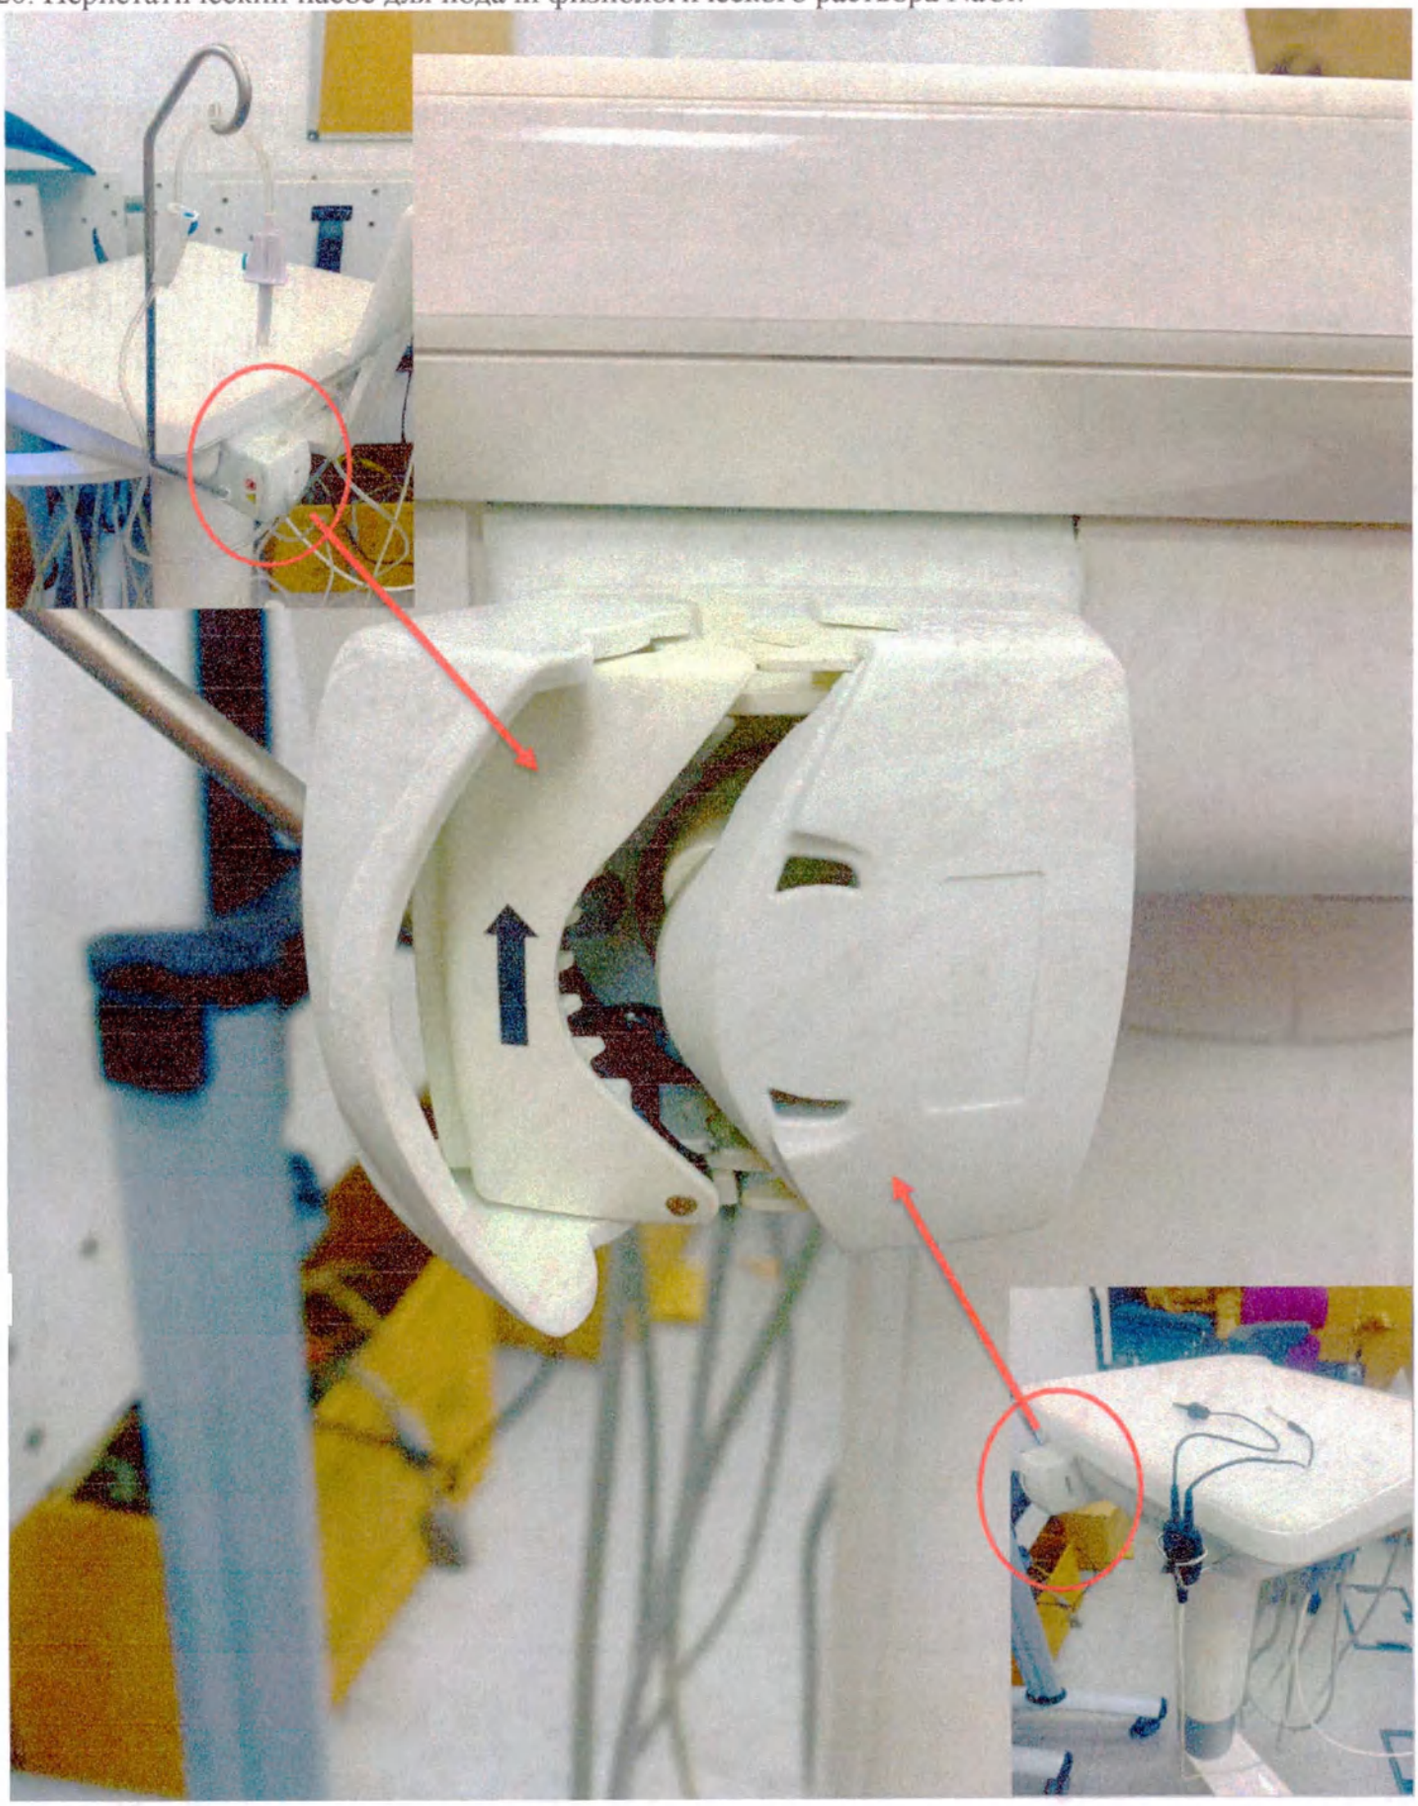


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

21. Набор шлангов для перистальтического насоса (упаковка 5 штук).

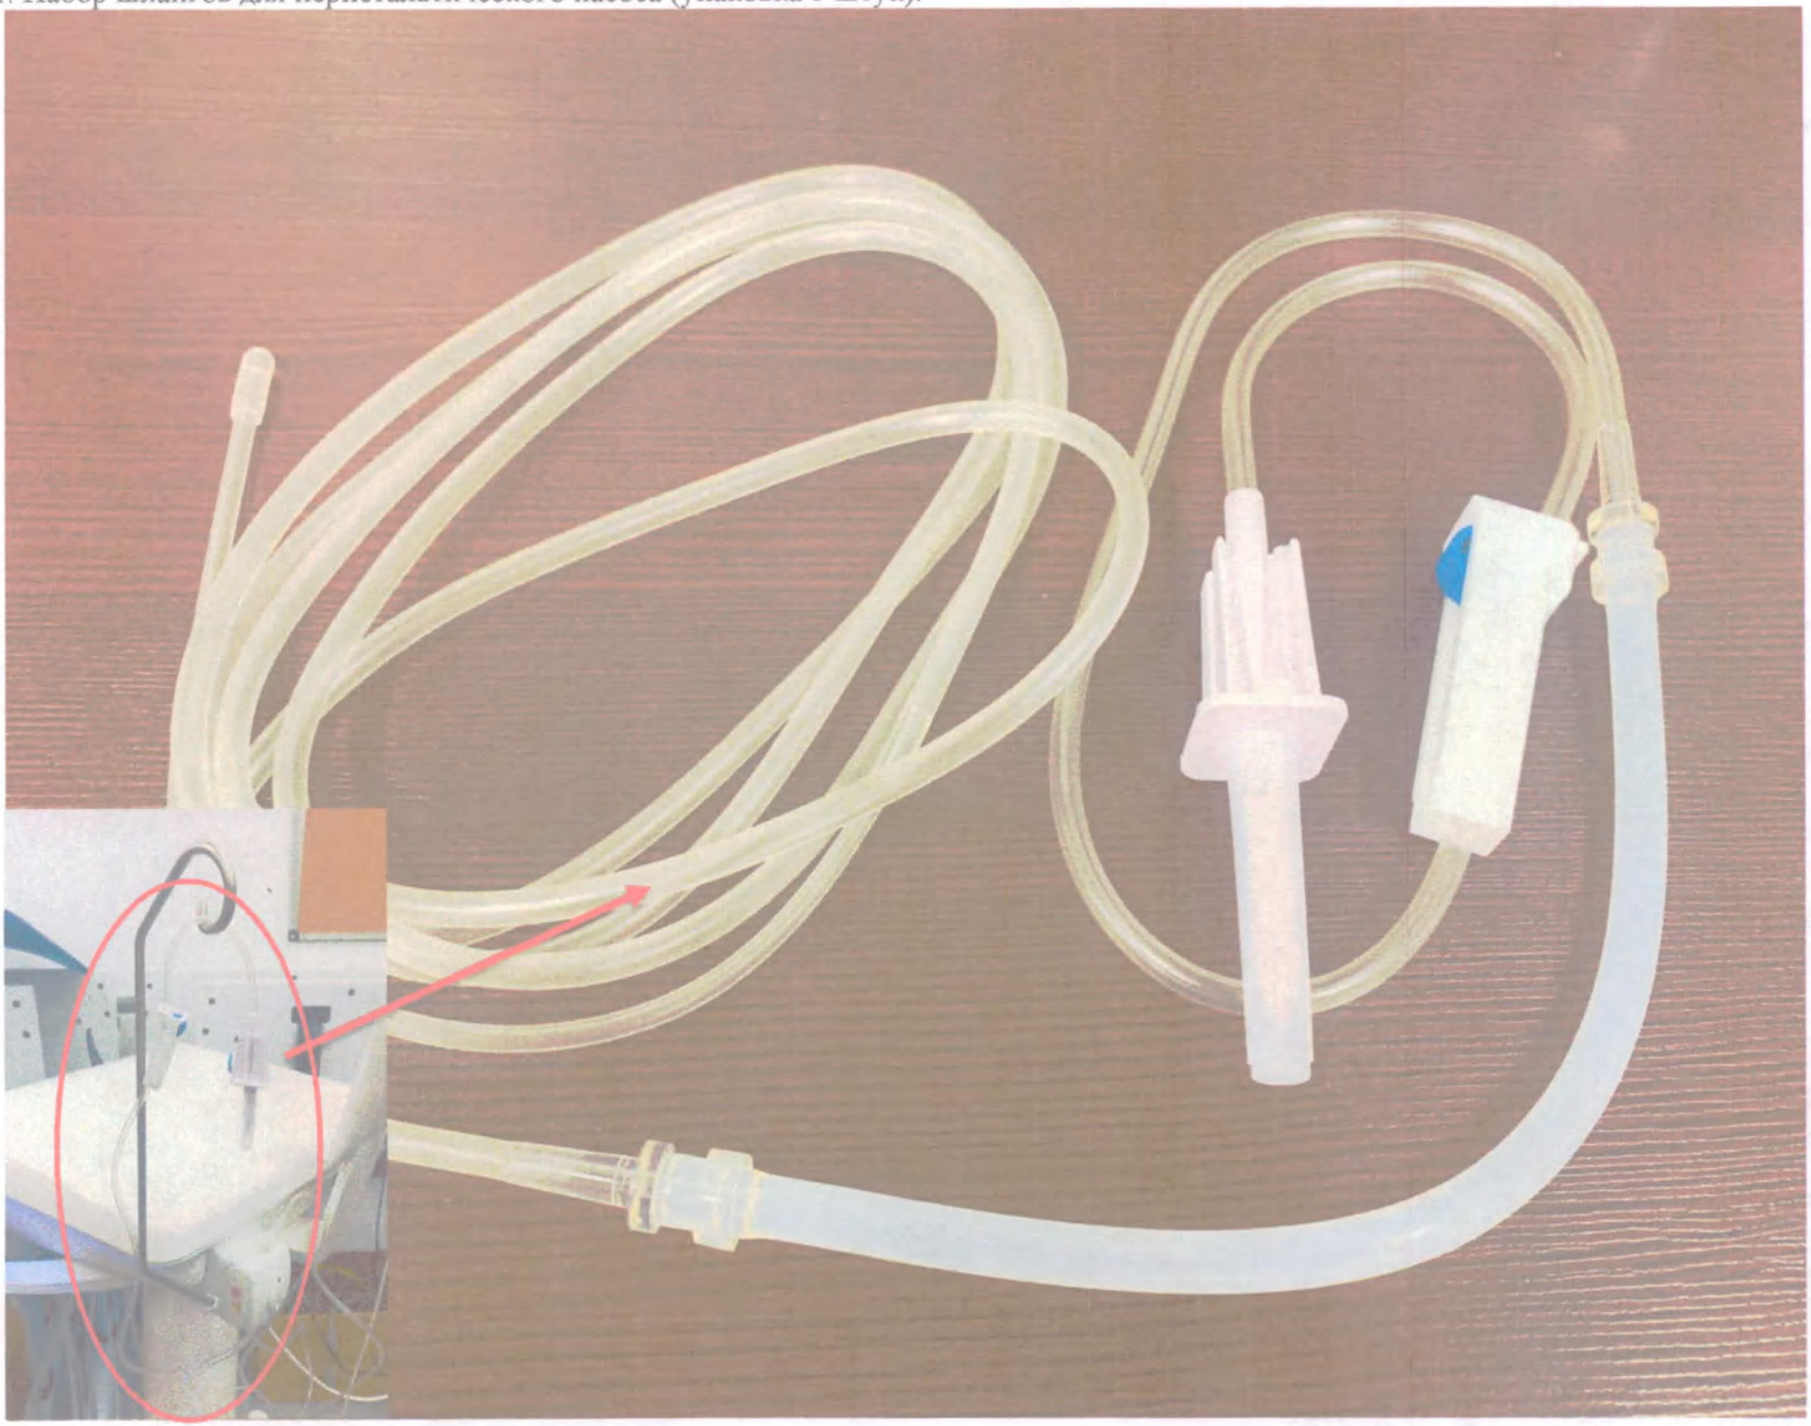

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

22. Съемный хомут для бутылки с физиолог ским раствором NaCl.

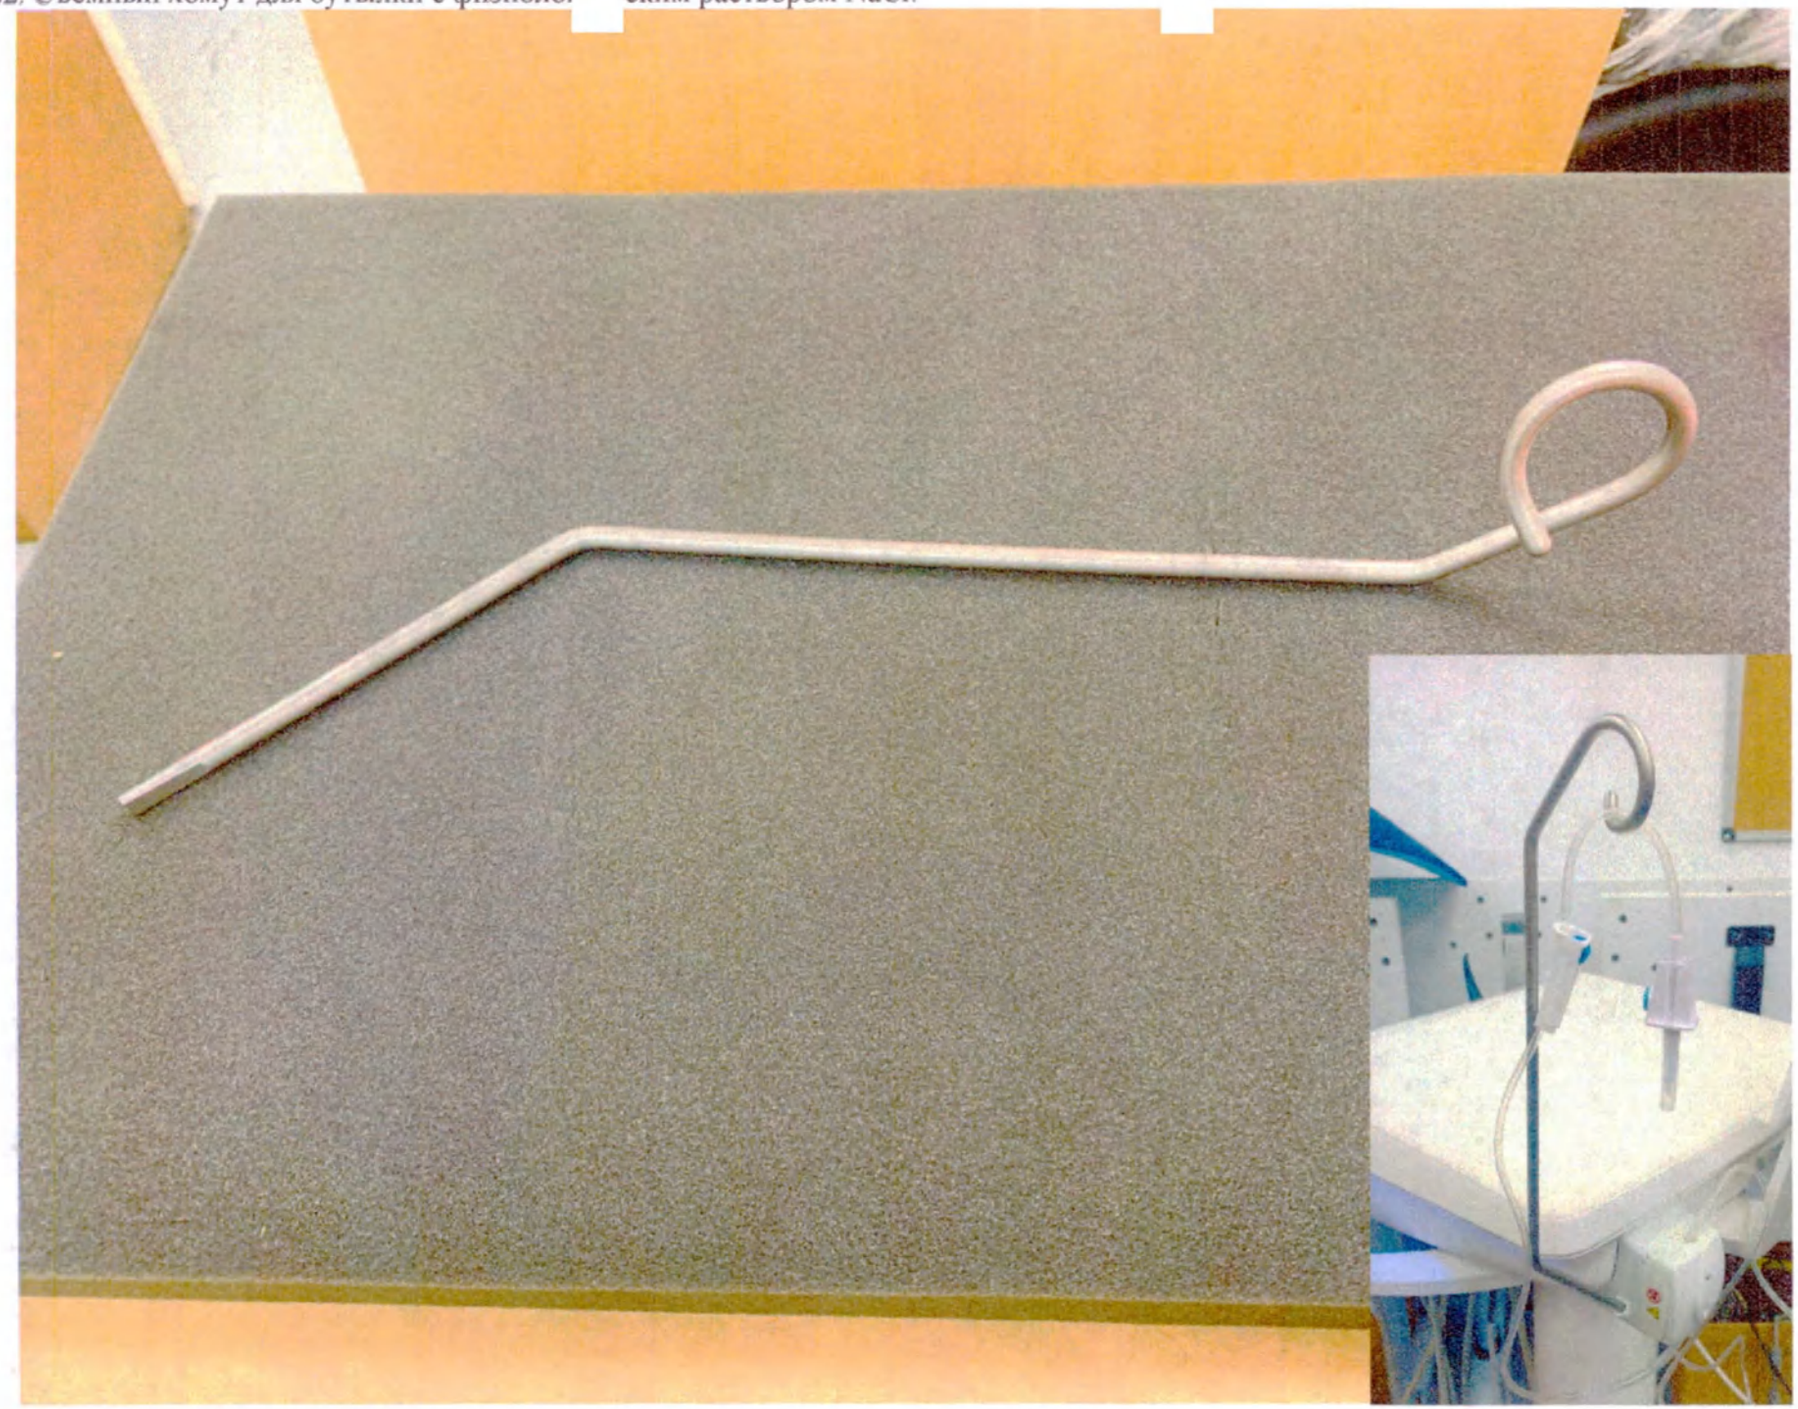

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


23. Наконечник механический угловой CA 20:1 L MICRO-SERIES.





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

24. Силиконовая подставка для стерильных трументов.

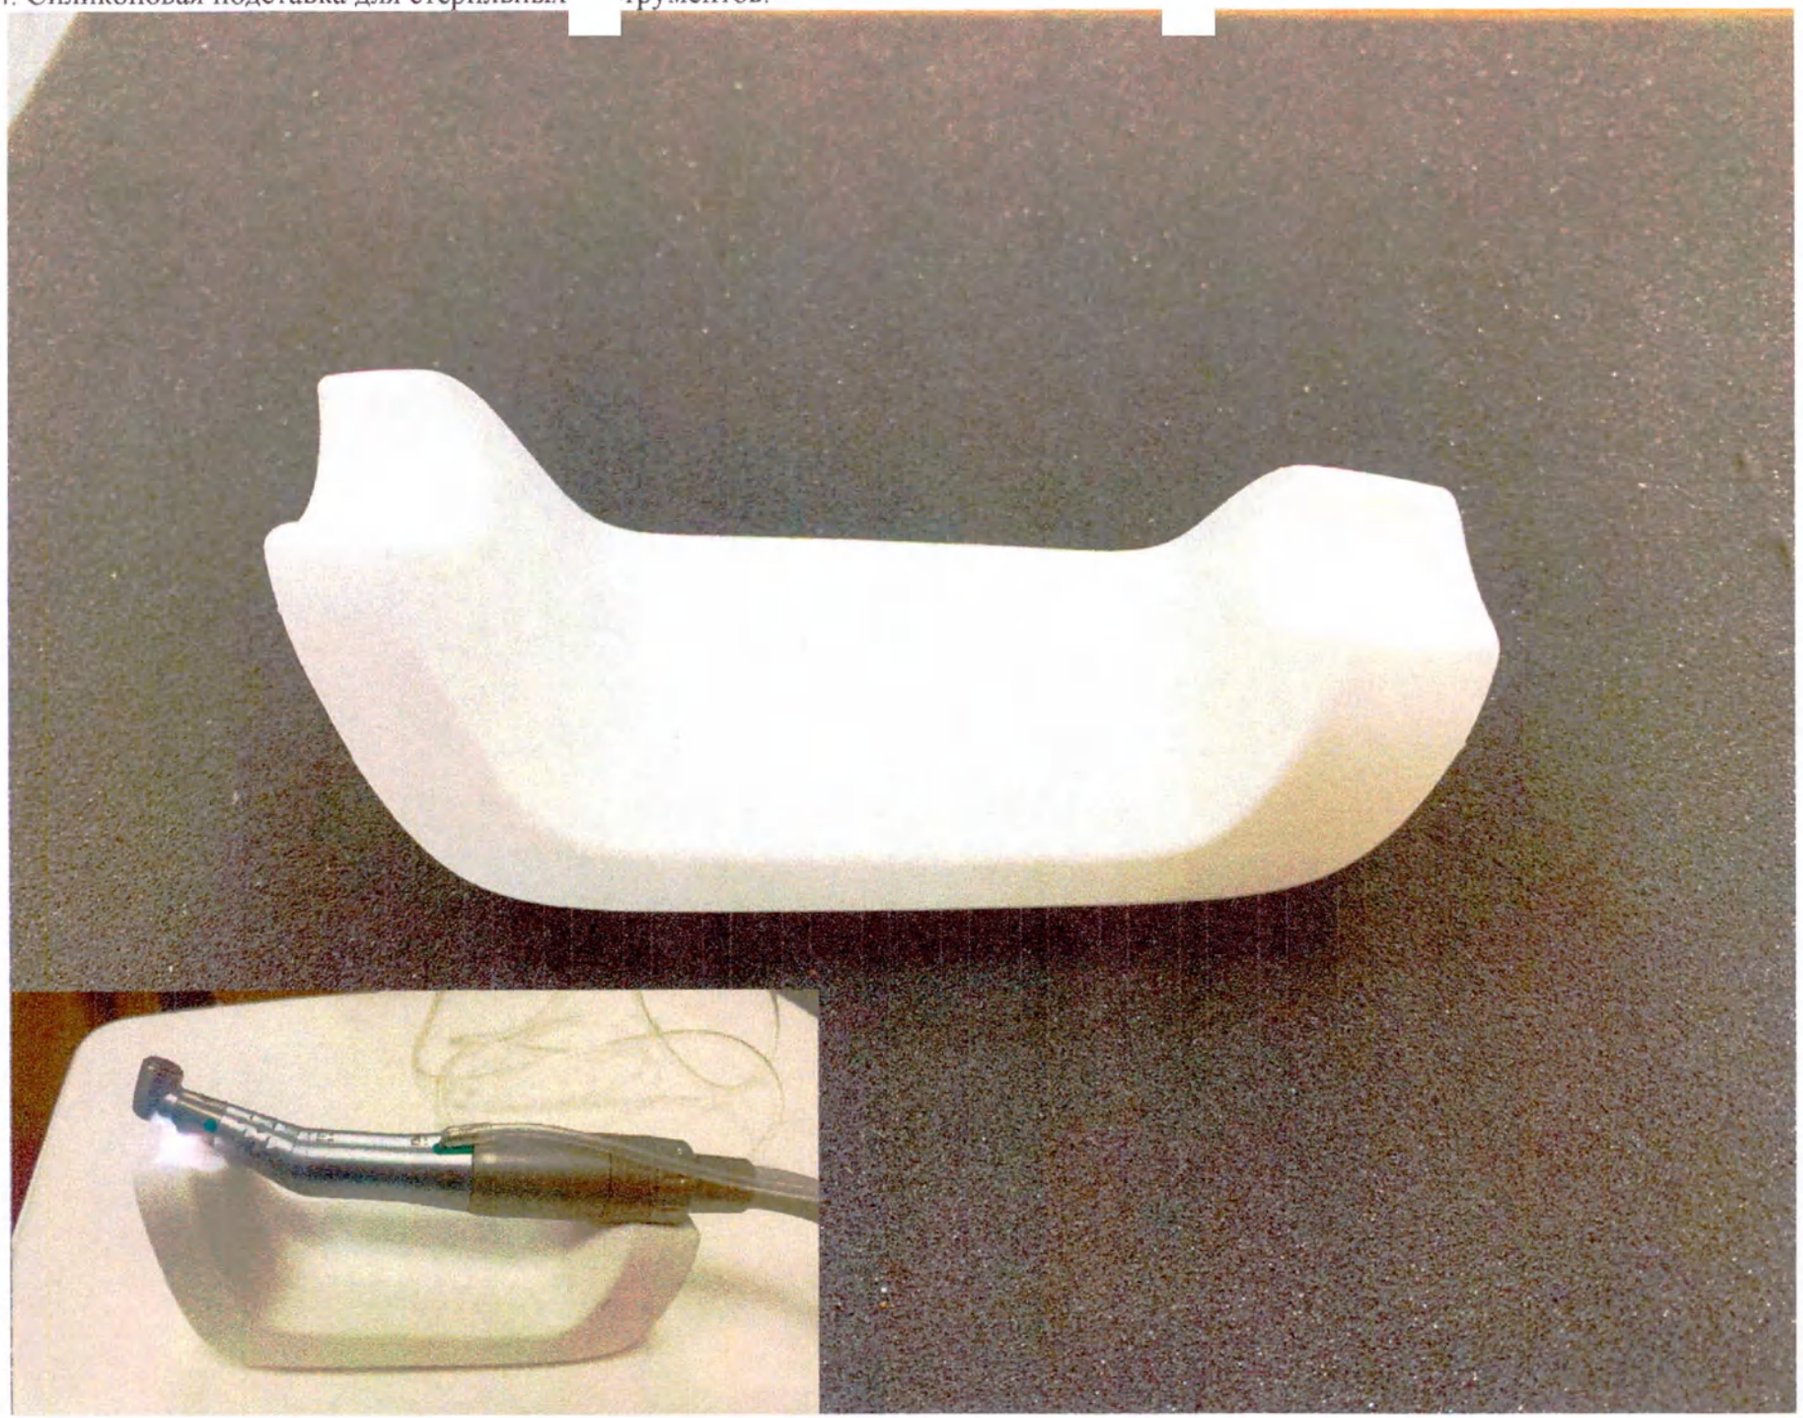


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

25. Рентгеновский негатоскоп для панорамных снимков.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

26. Магнитный держатель для смарт-устройства или негатоскопа для панорамных рентгеновских снимков.

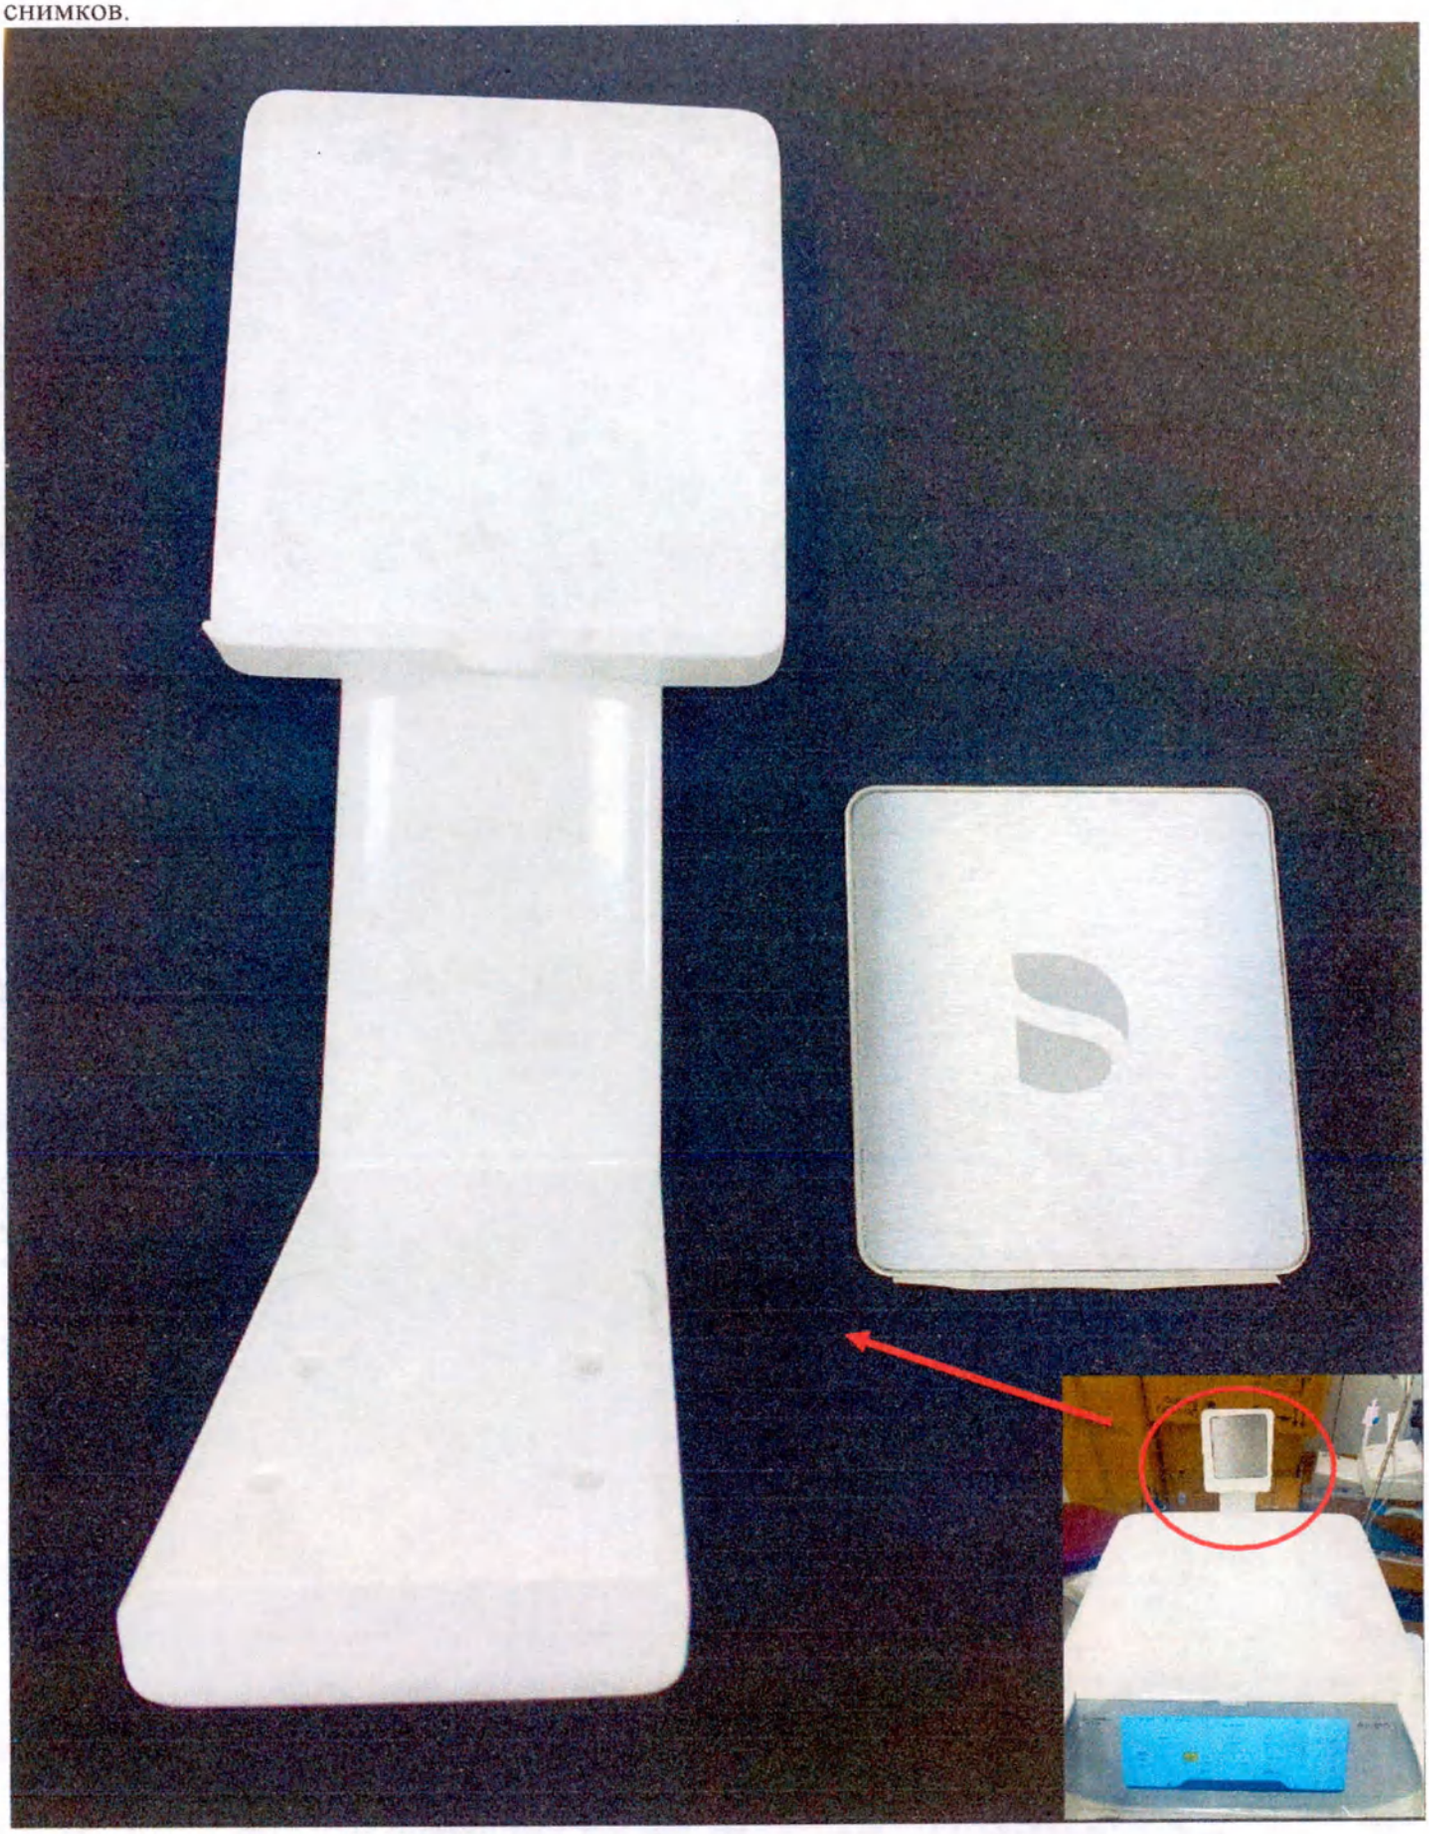


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

27. Лоток с элементами крепления.

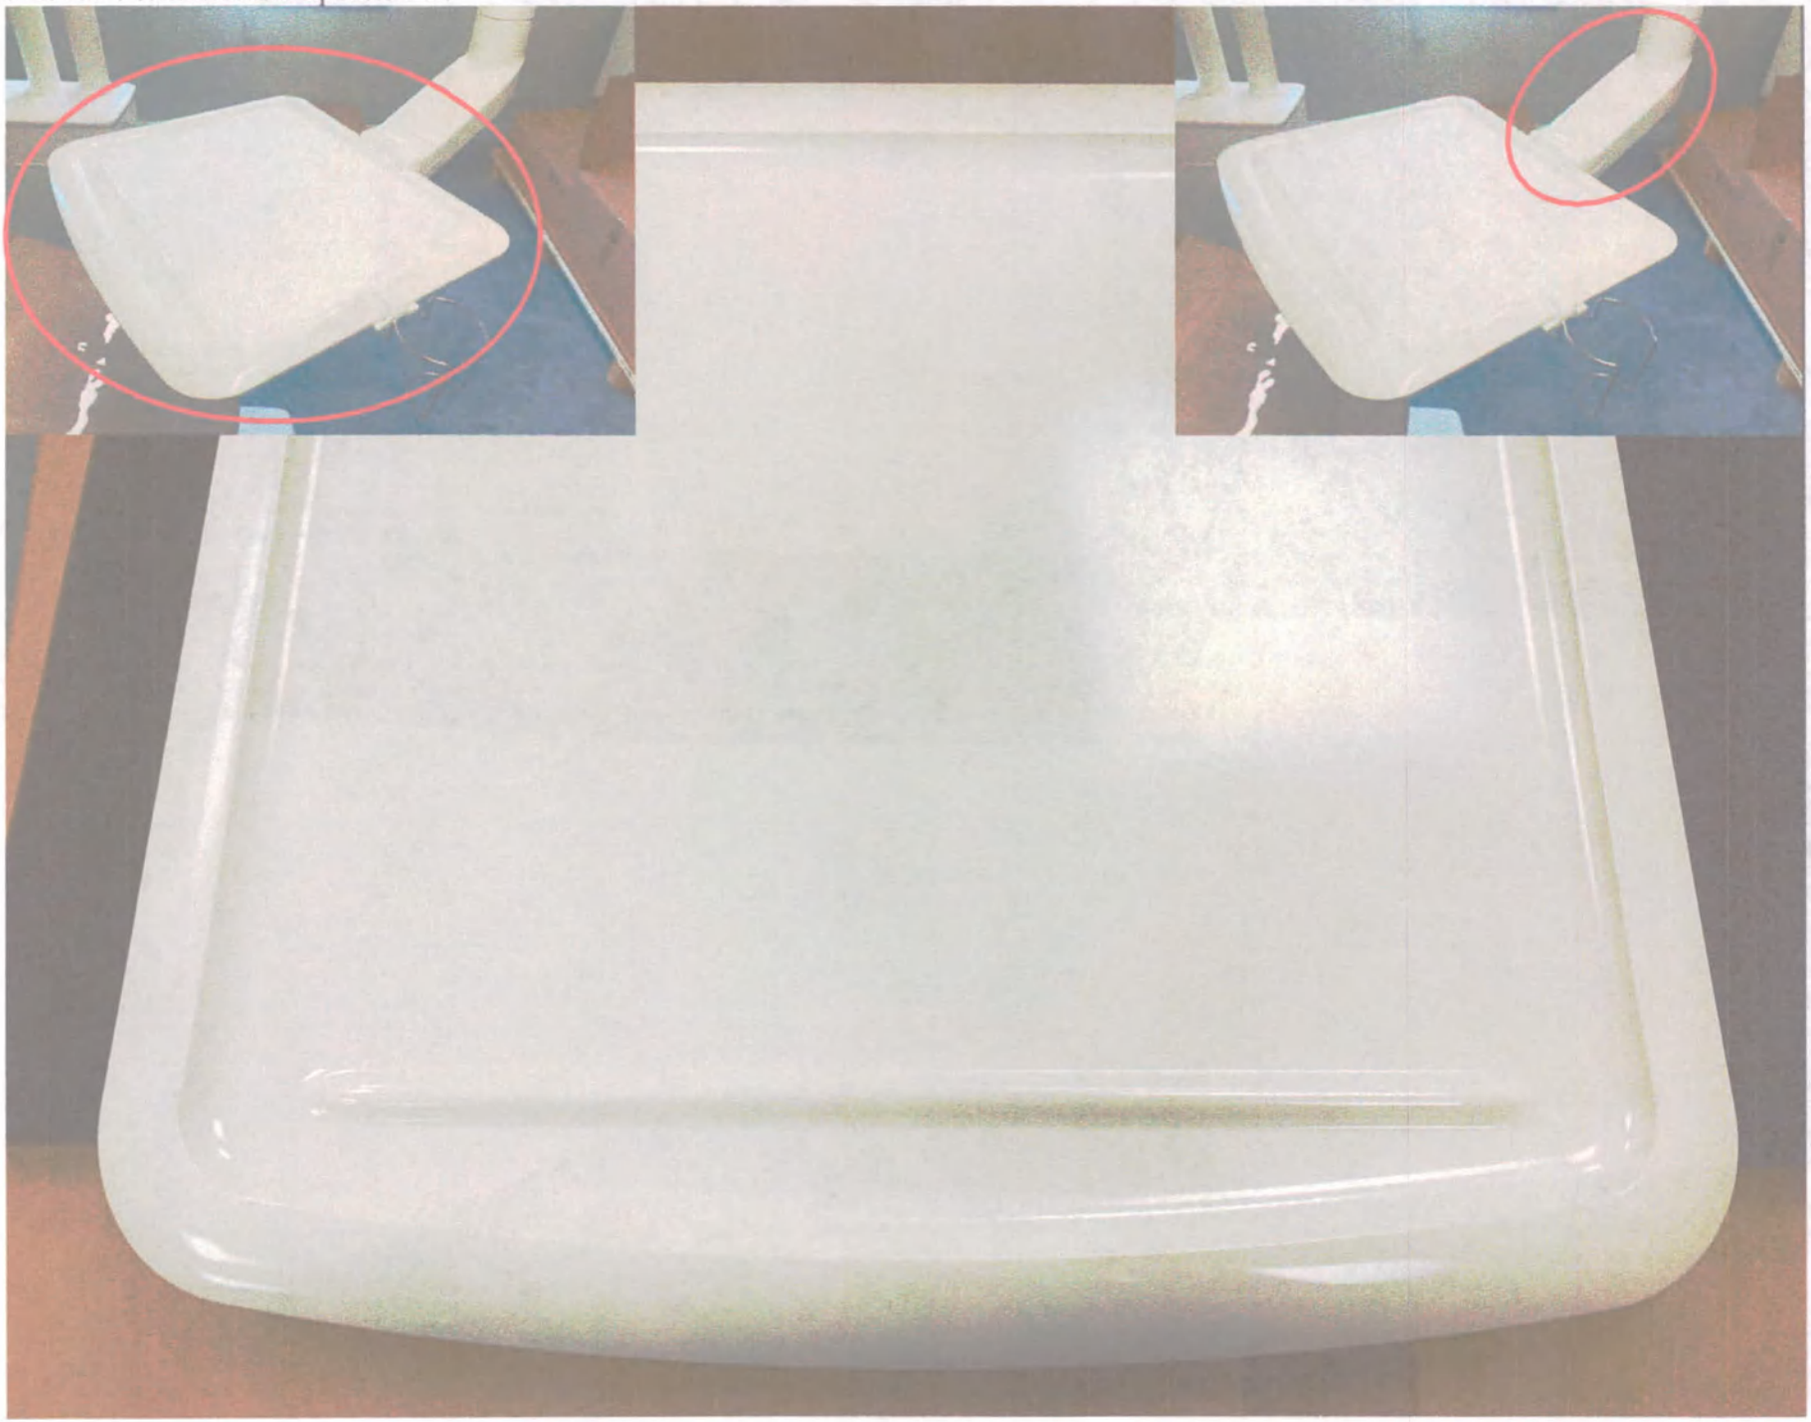


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

28. Держатель стакана.

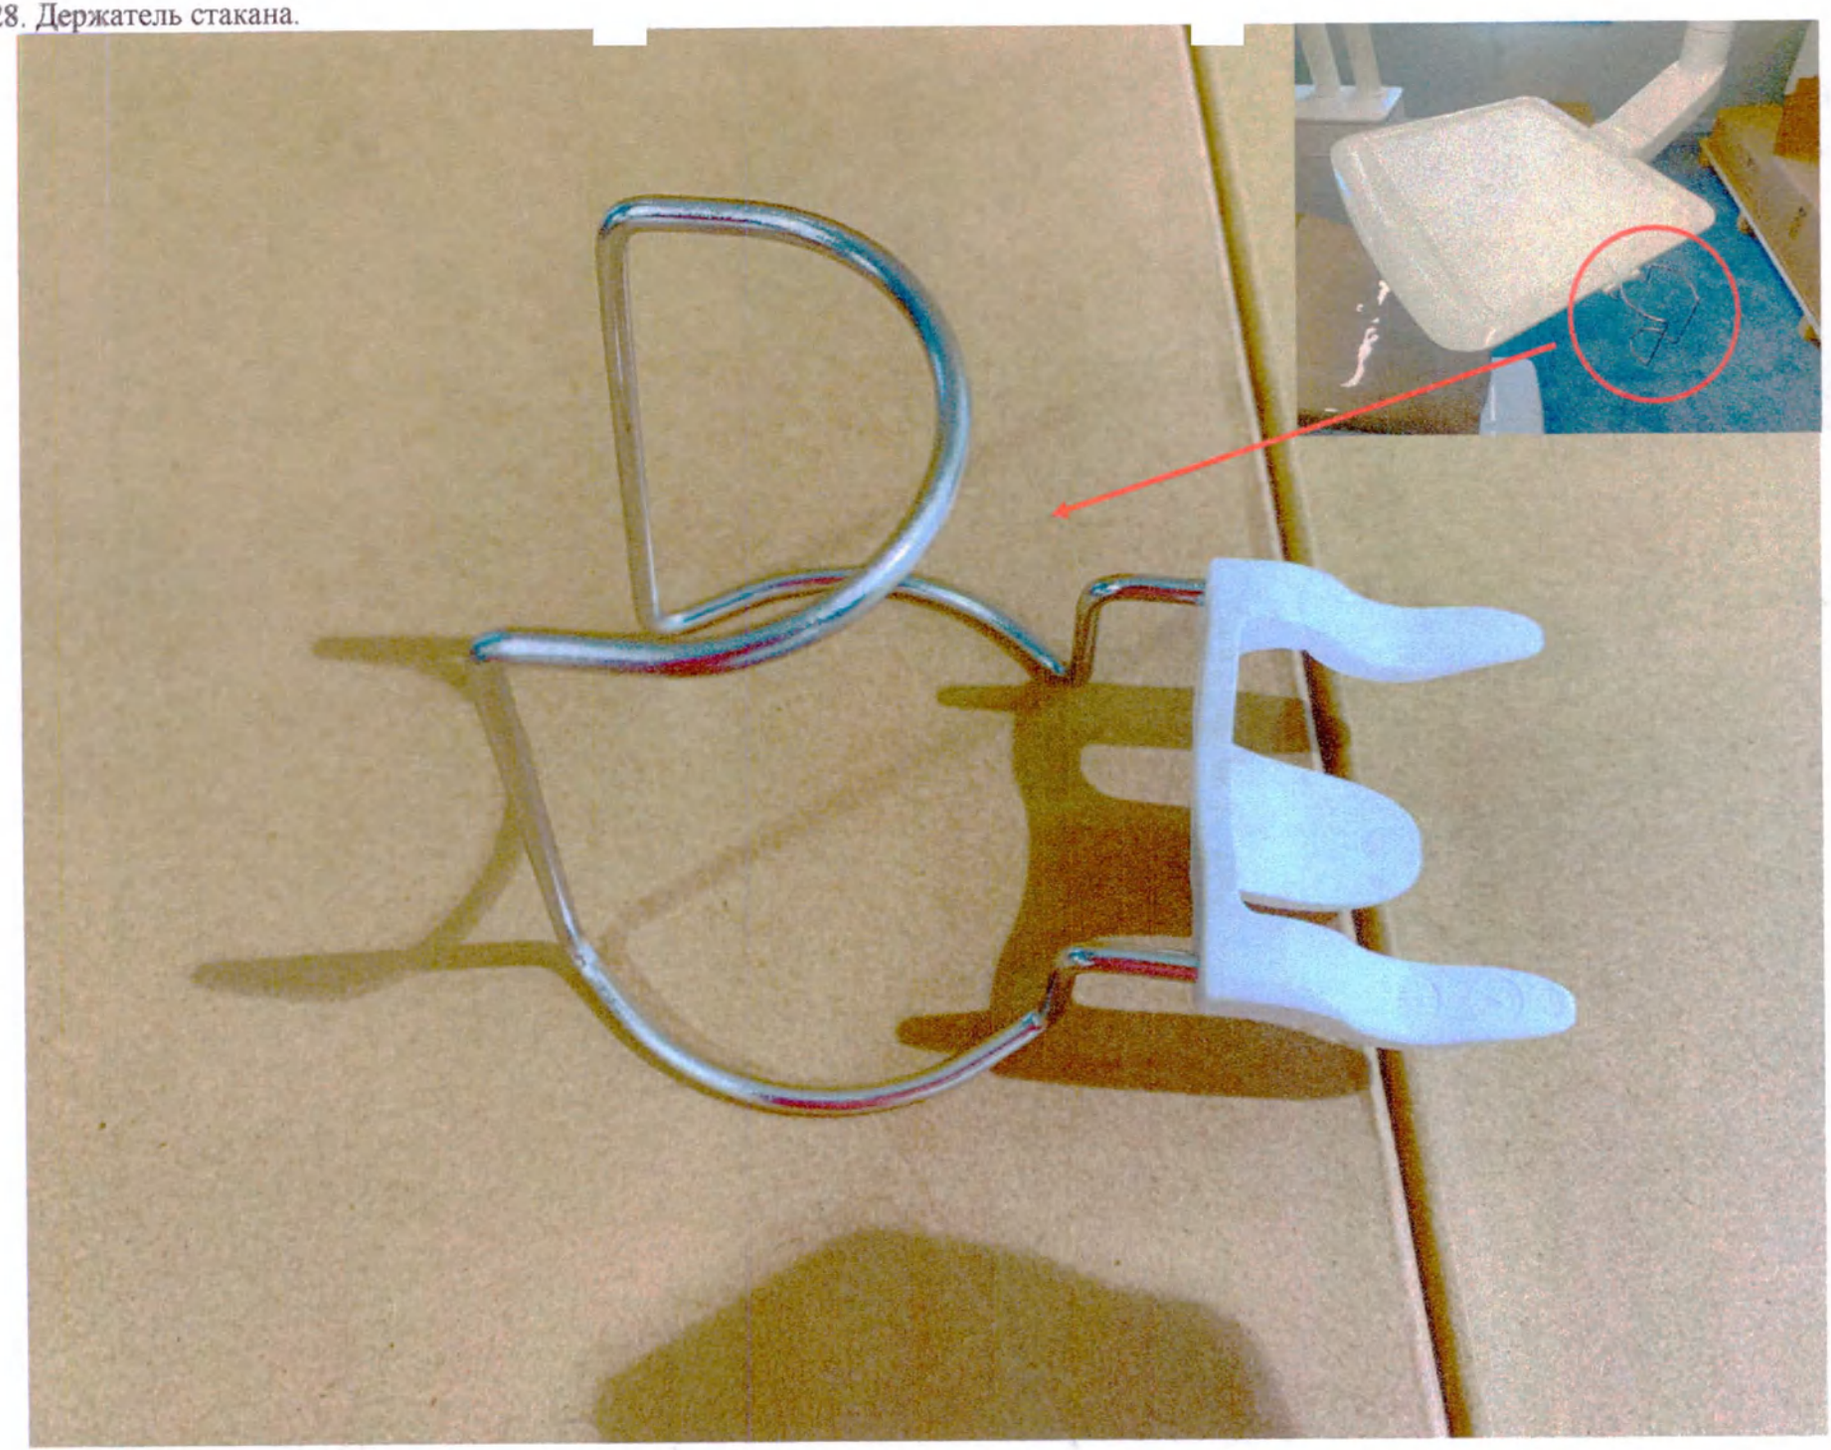

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

29. Блок ассистента с элементами для подключения.

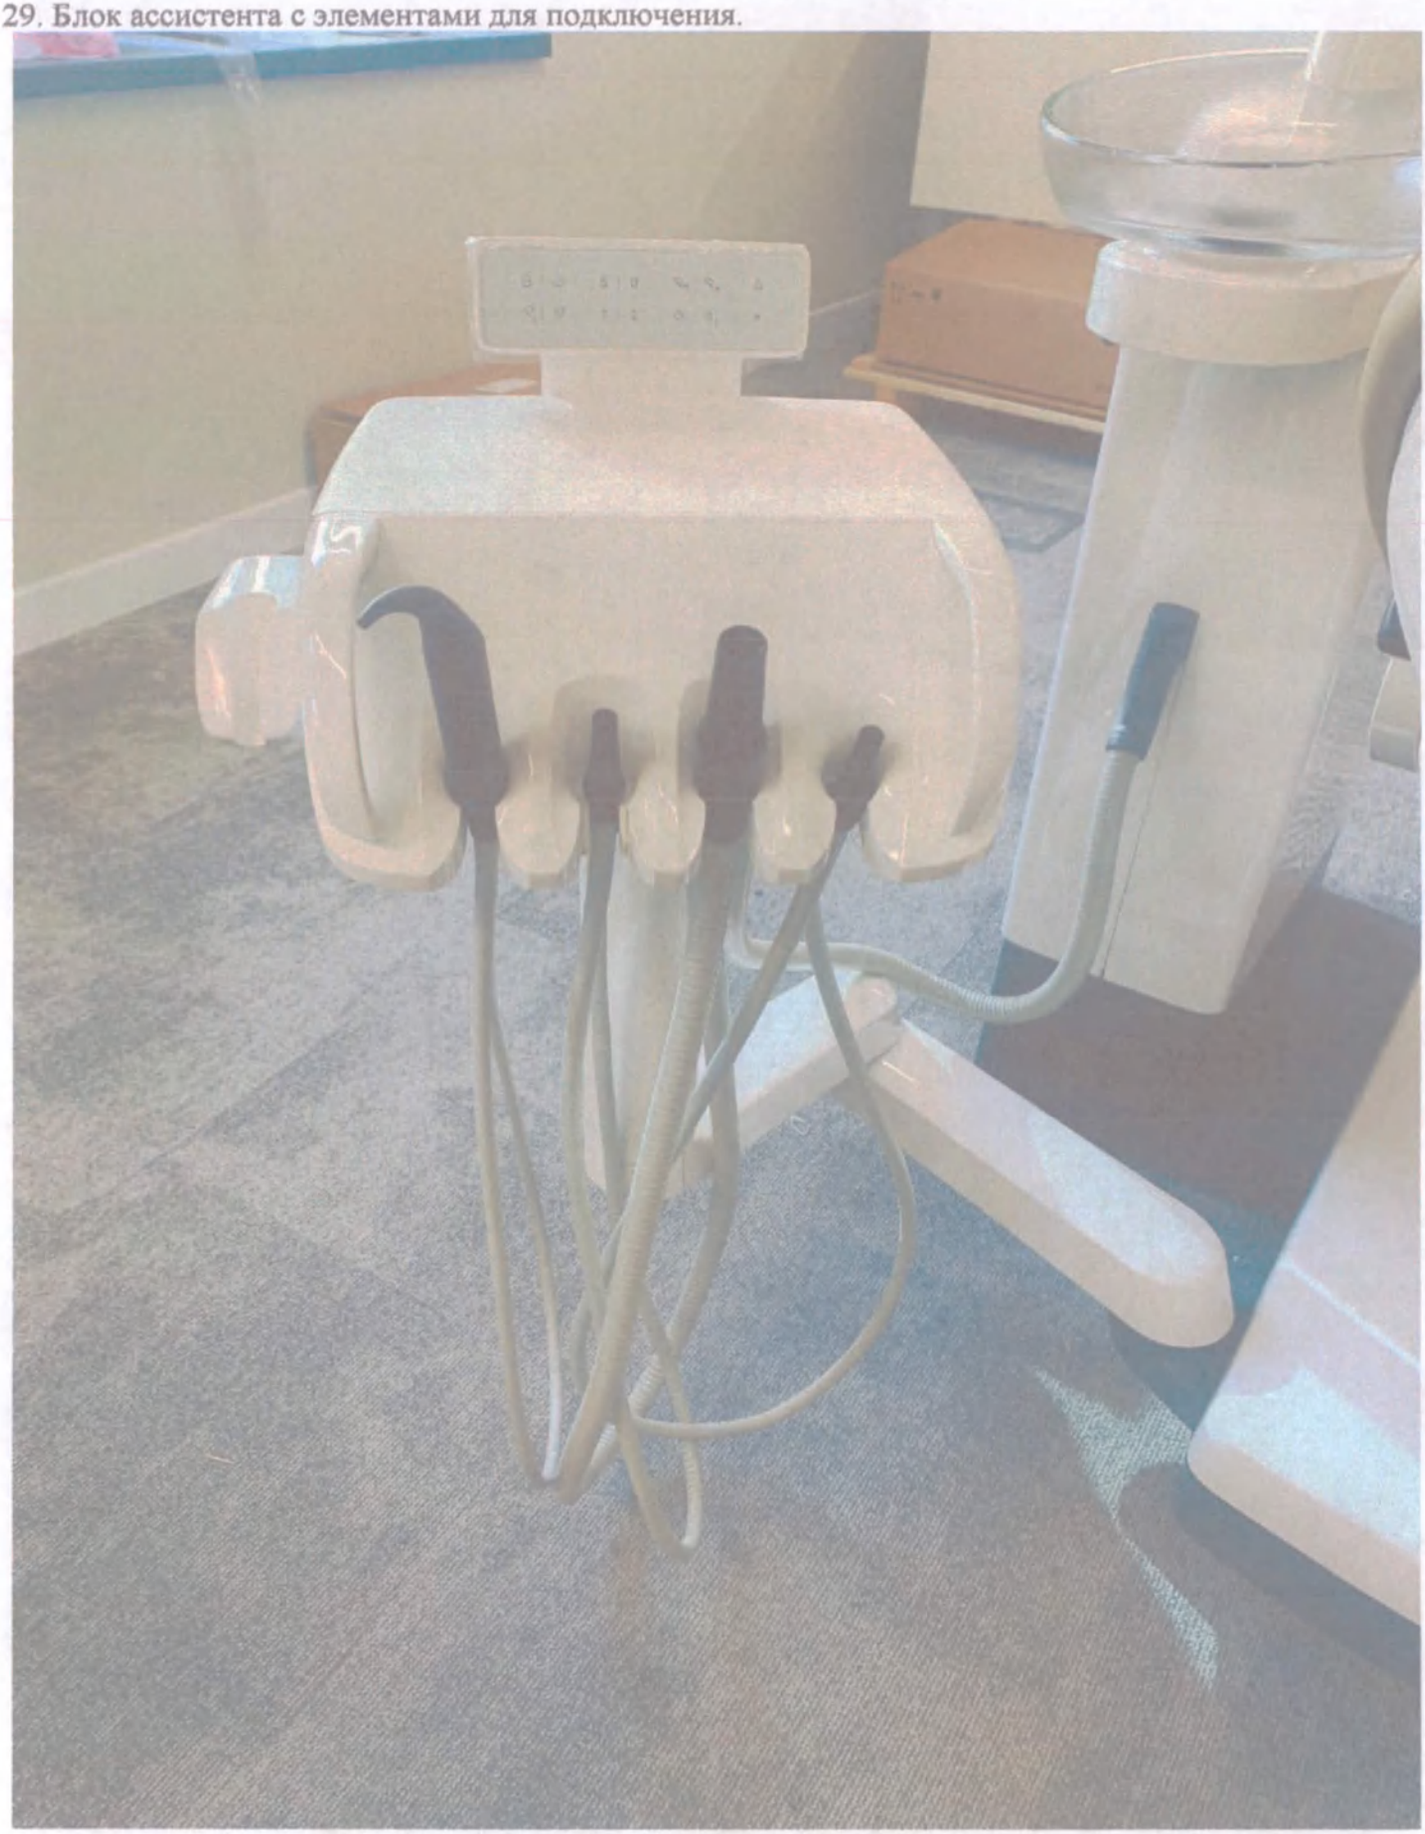

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

30. Наконечник отсасывателя аэрозольного тумана.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

31. Канюля отсасывателя аэрозольного тумана.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

32. Шланг отсасывателя аэрозольного тума

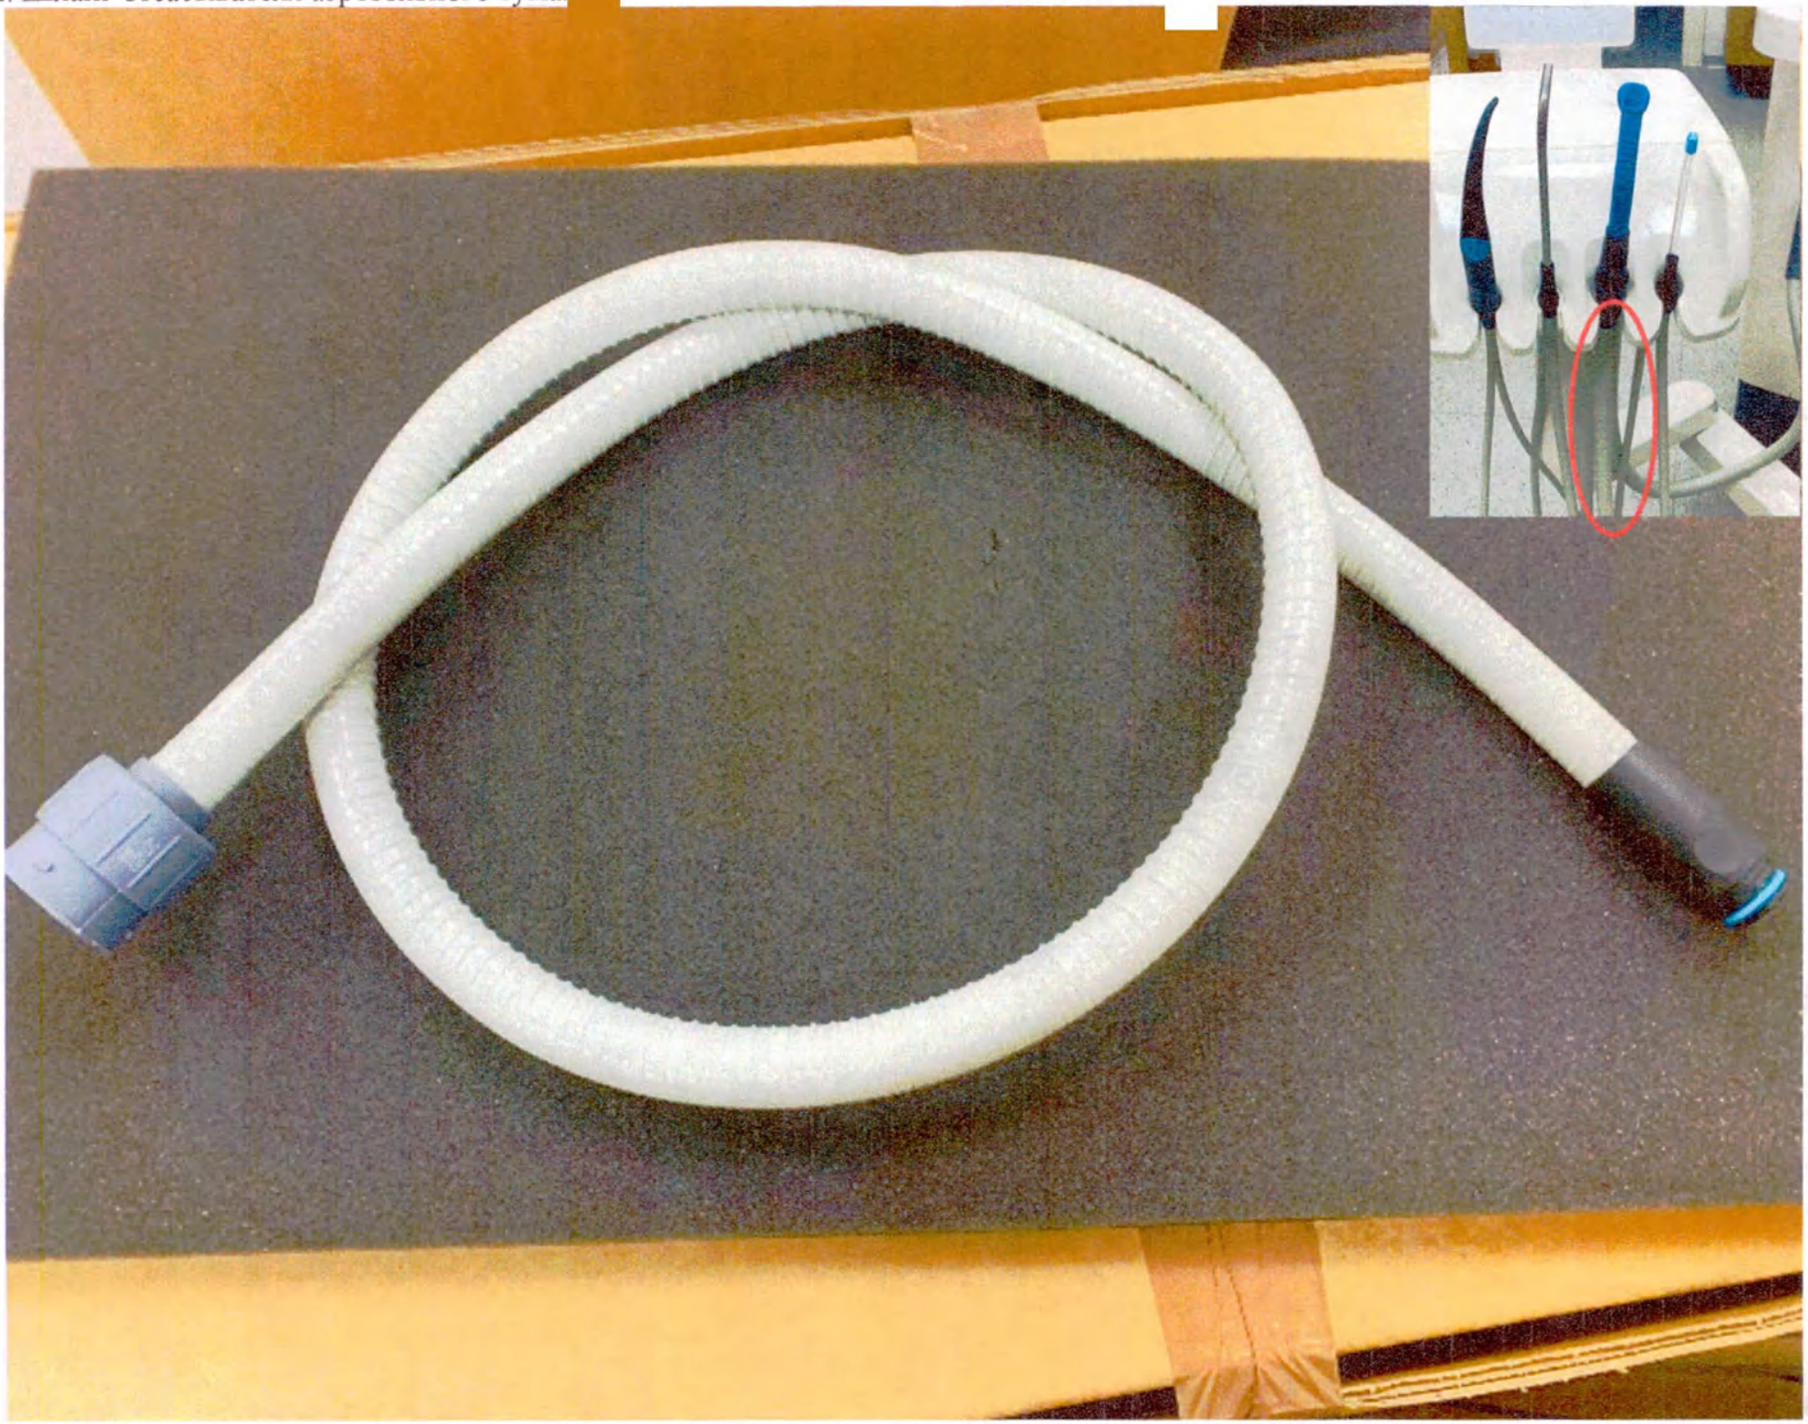


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

33. Наконечник слюноотсоса.

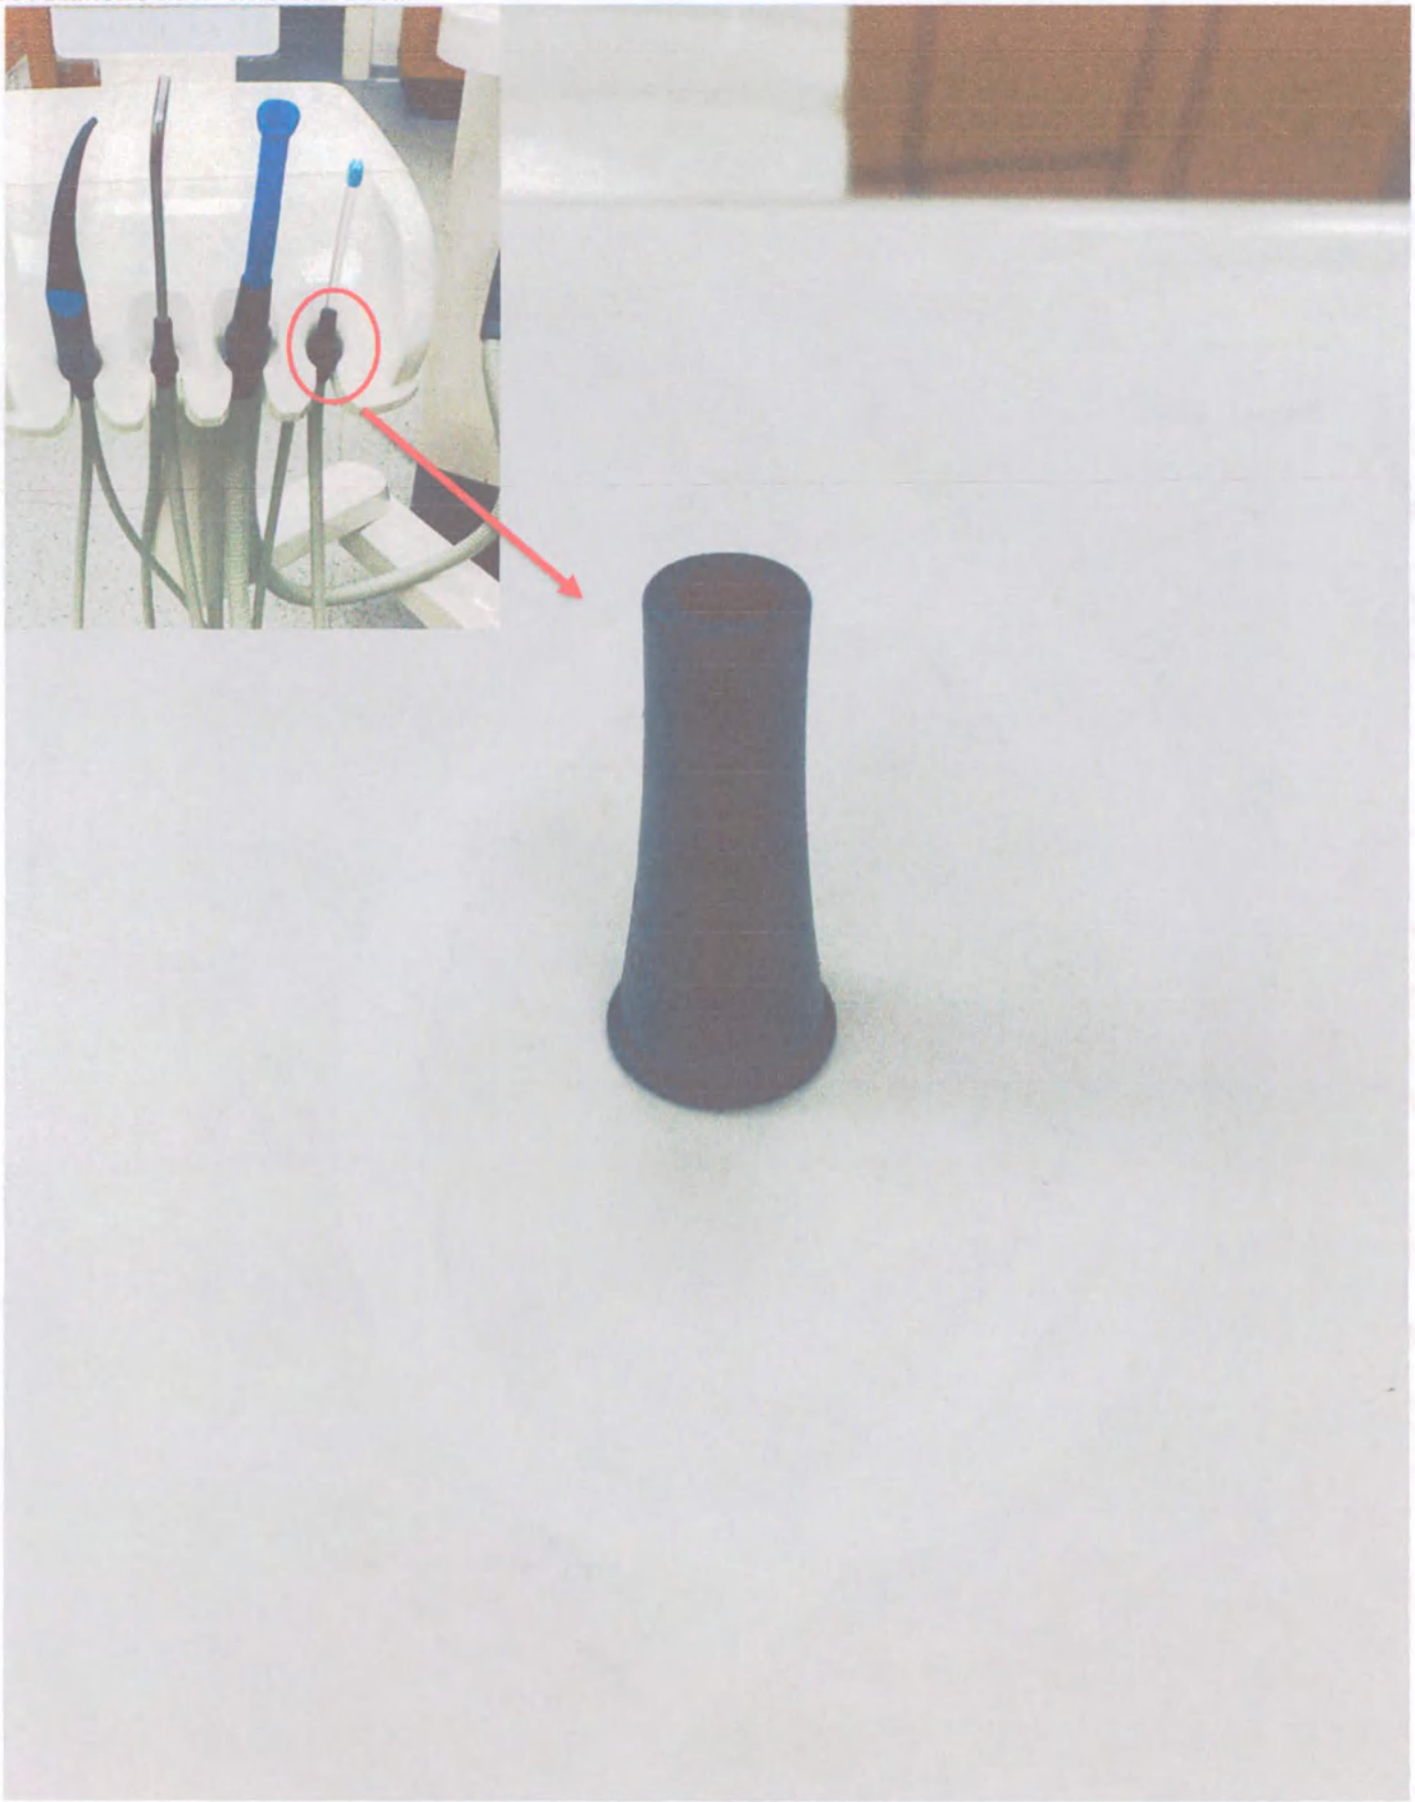


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Шланг слюноотсоса.

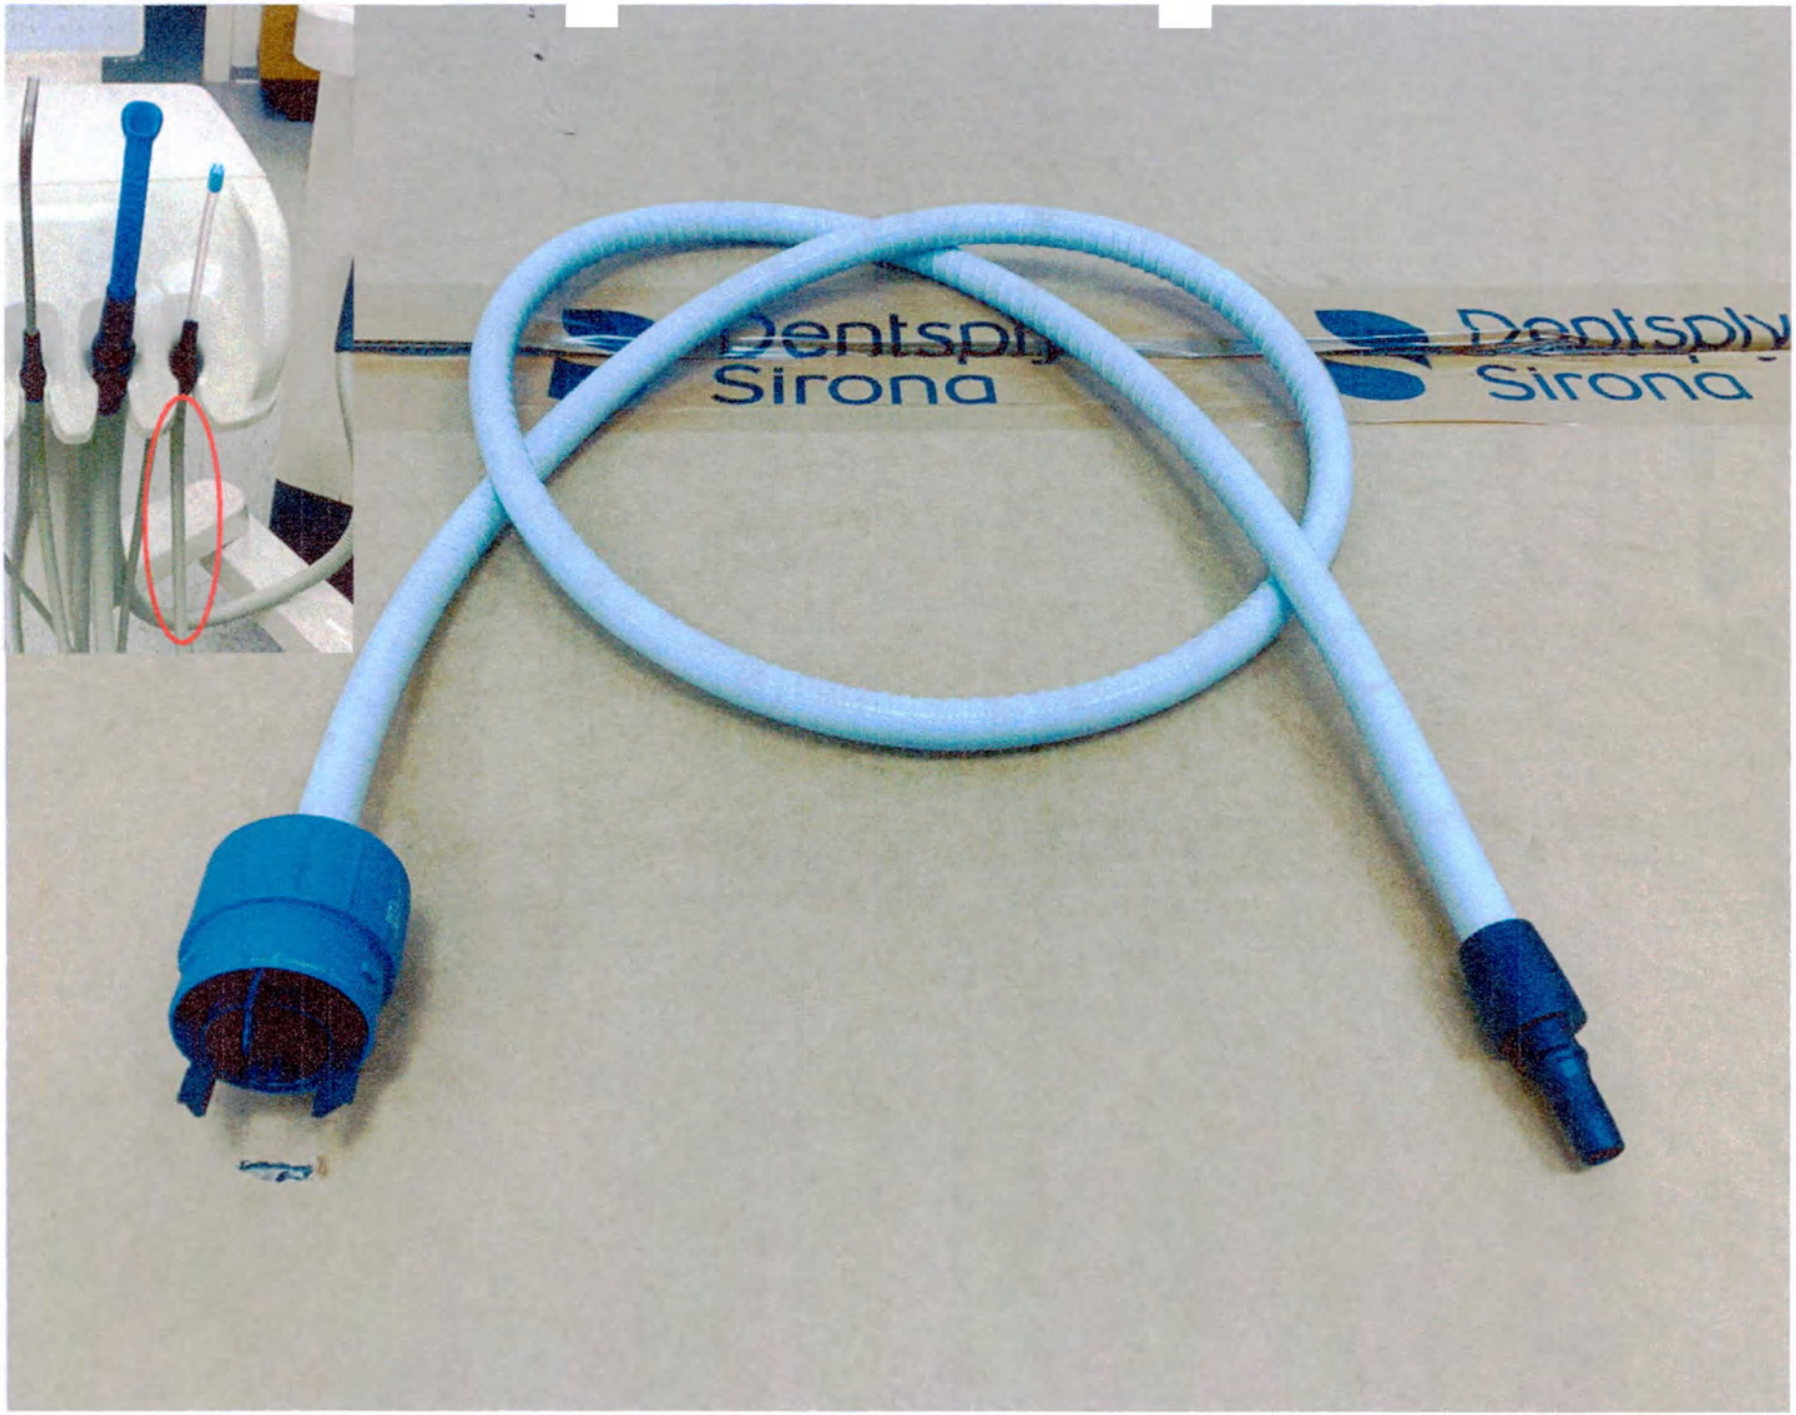


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

35. Хирургическая канюля.

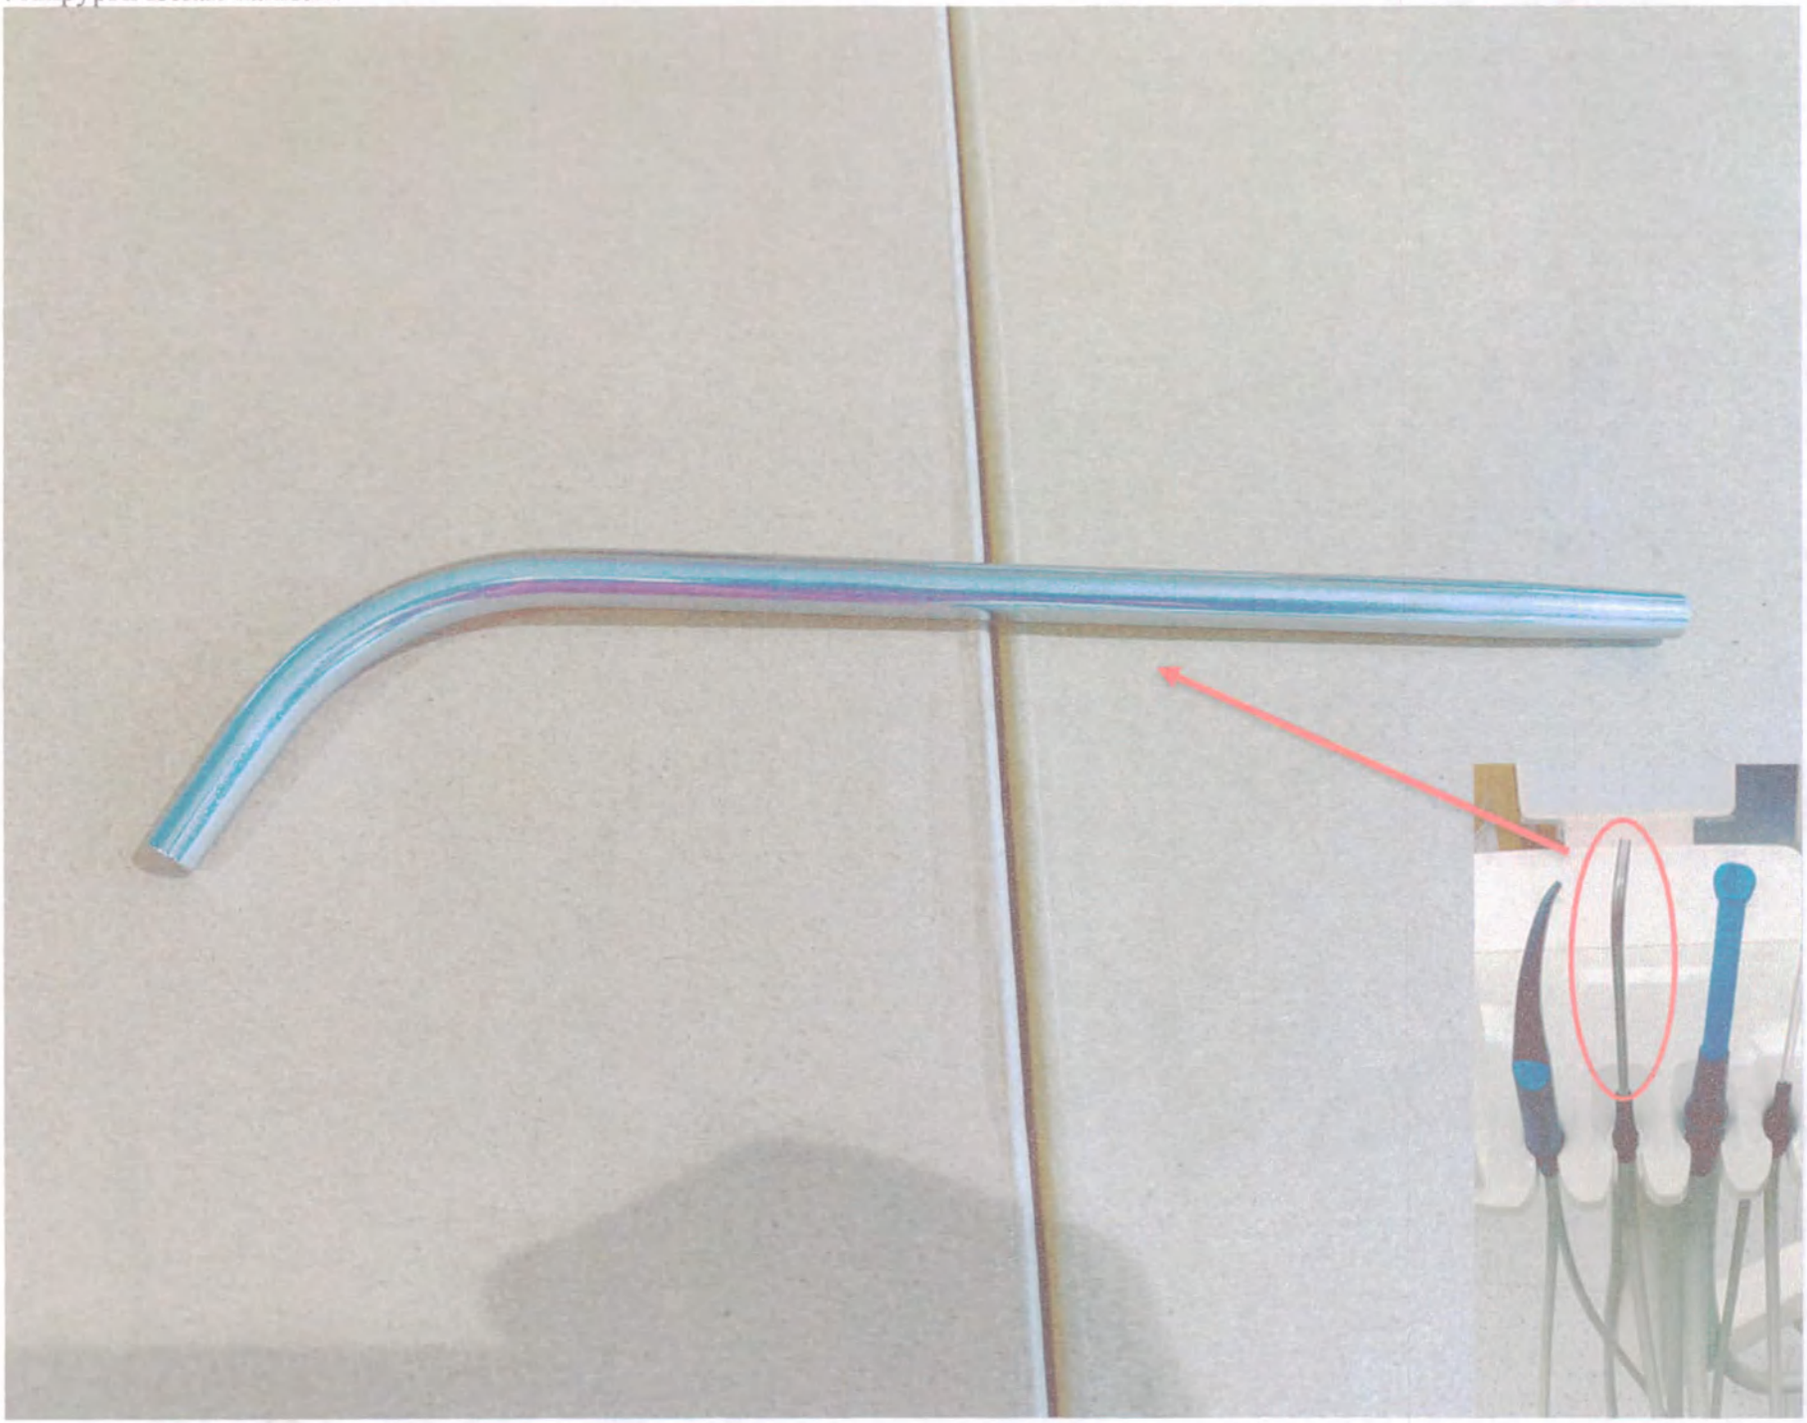


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

36. Фильтр отсасывающих шлангов.

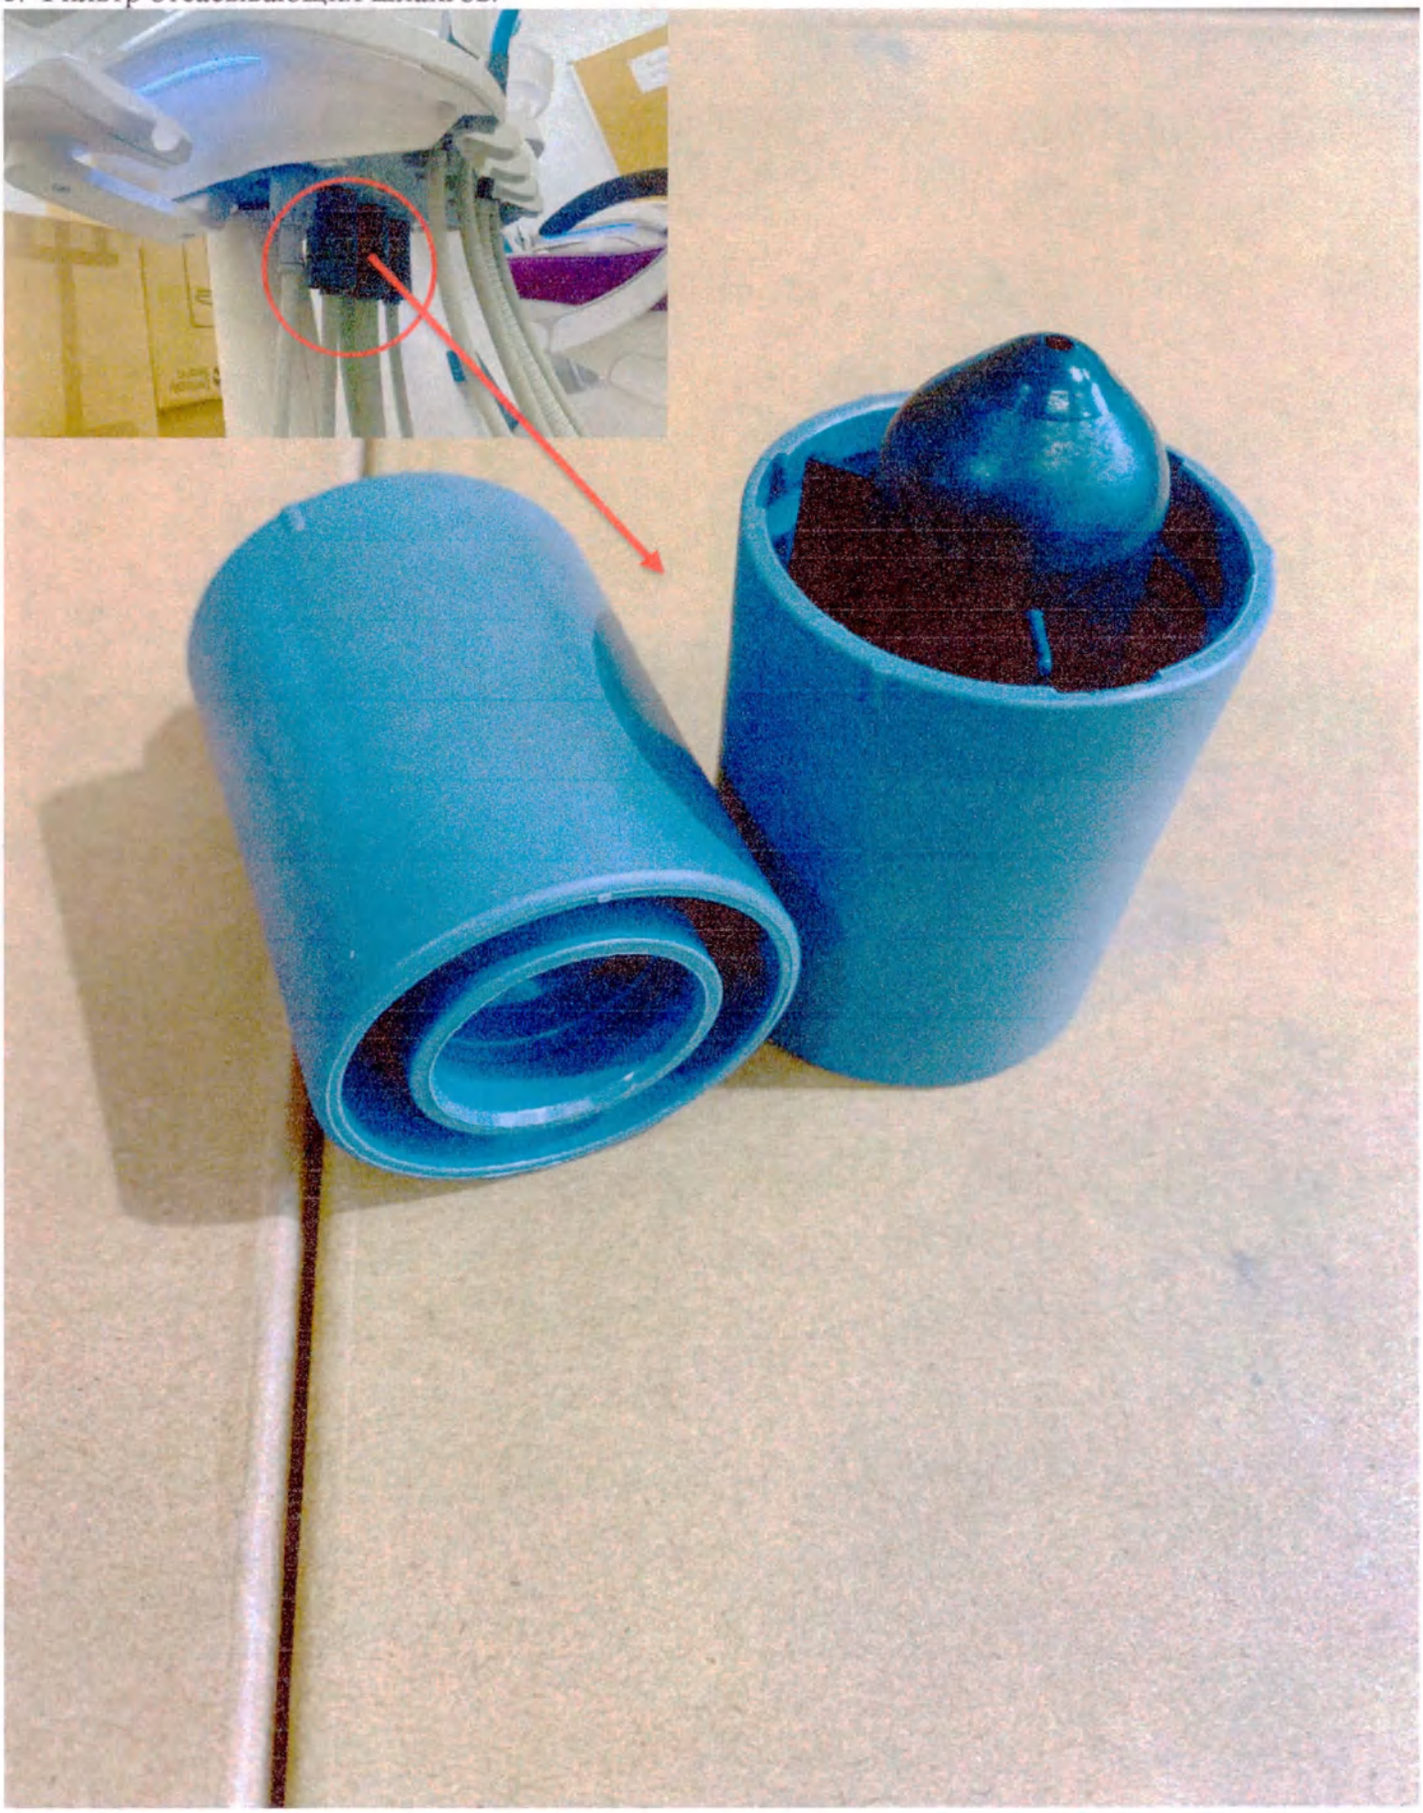

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

37. Боковая подставка для полимеризационной лампы (светильника).

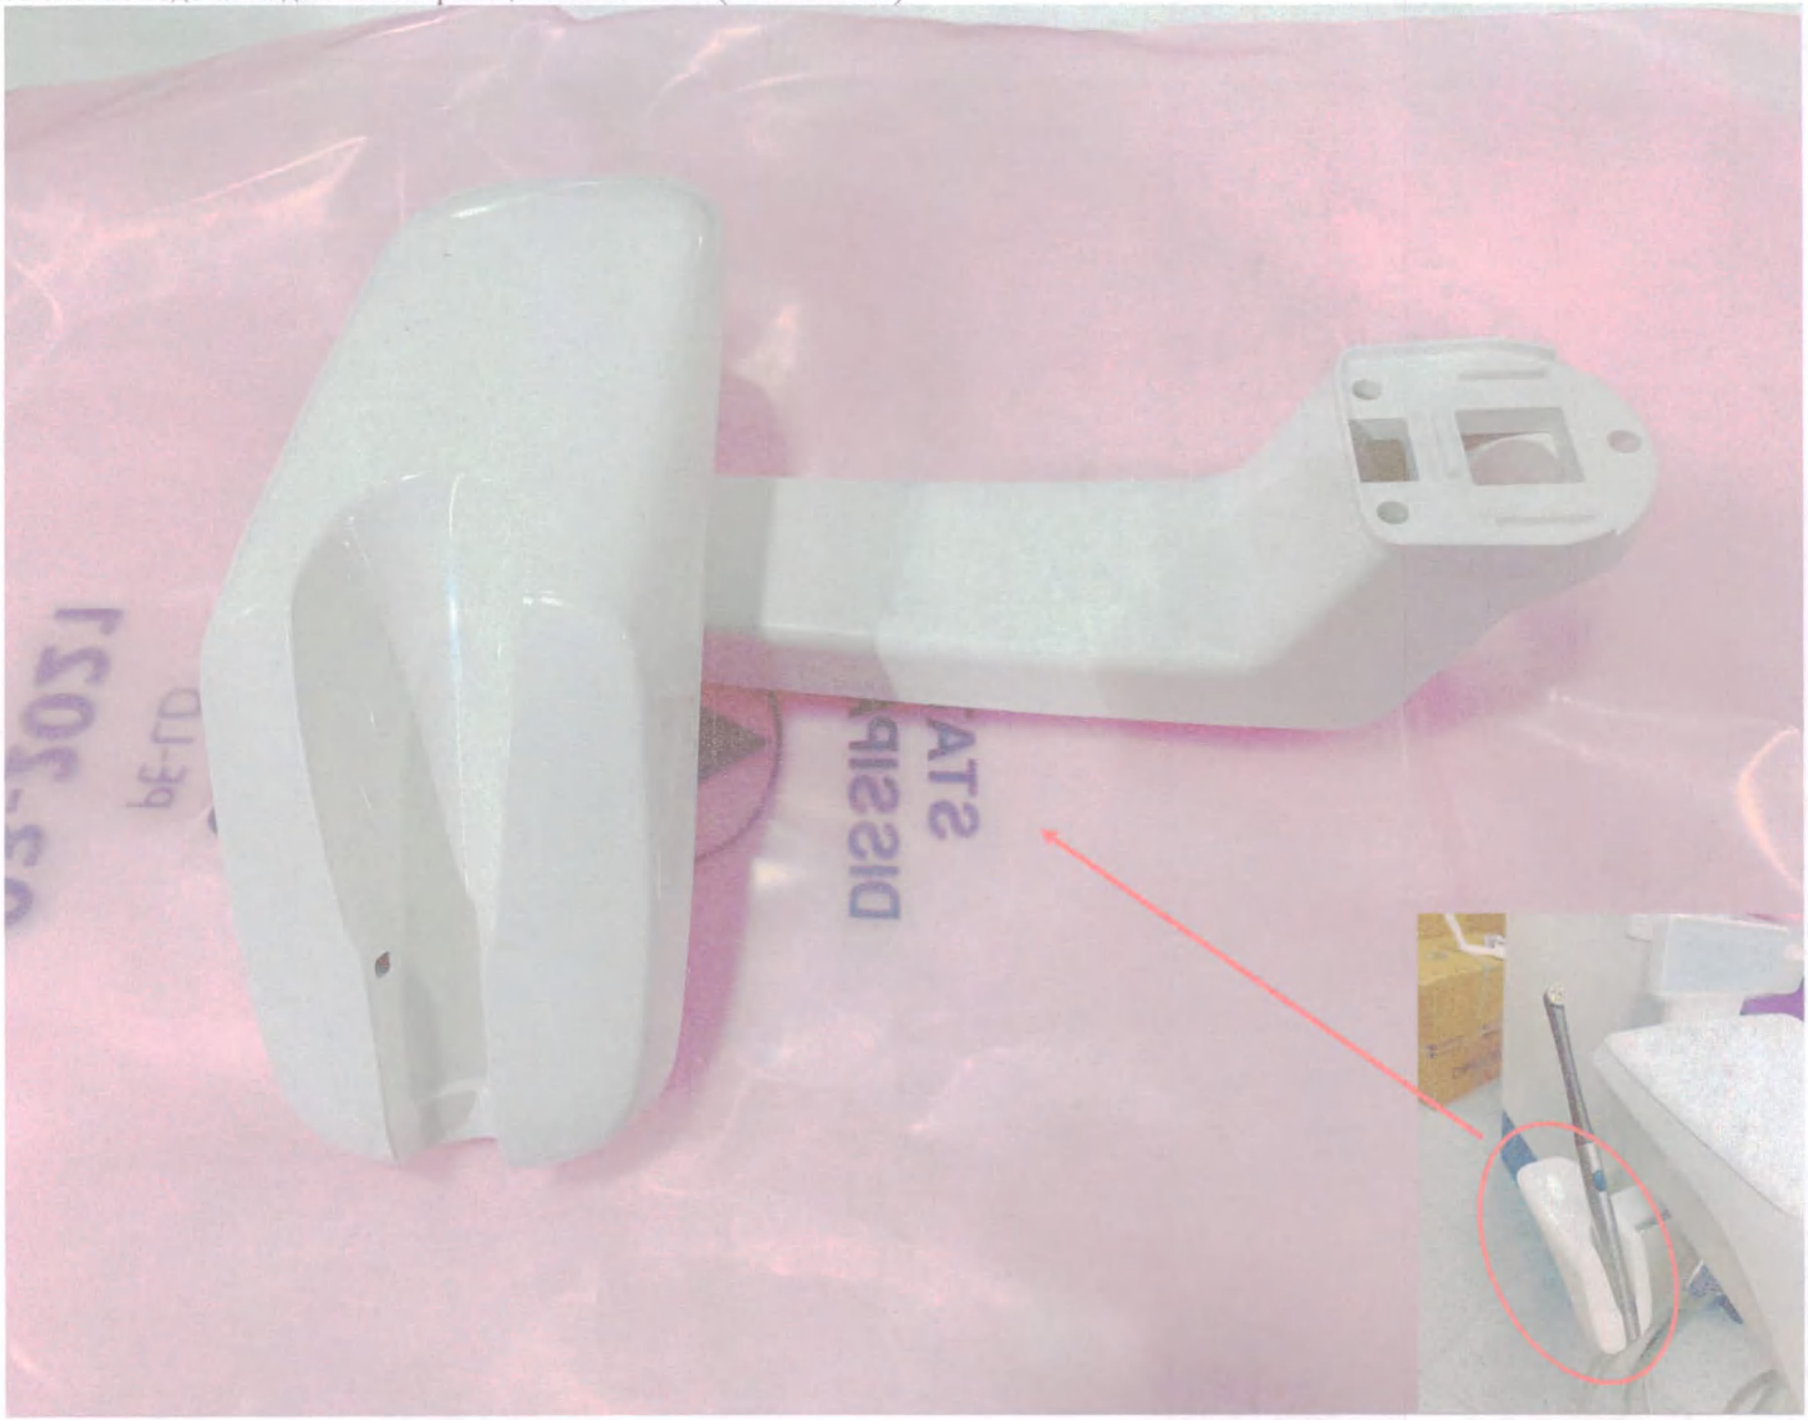


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

38. Водяной блок с элементами для подключения.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


39. Плевательница.

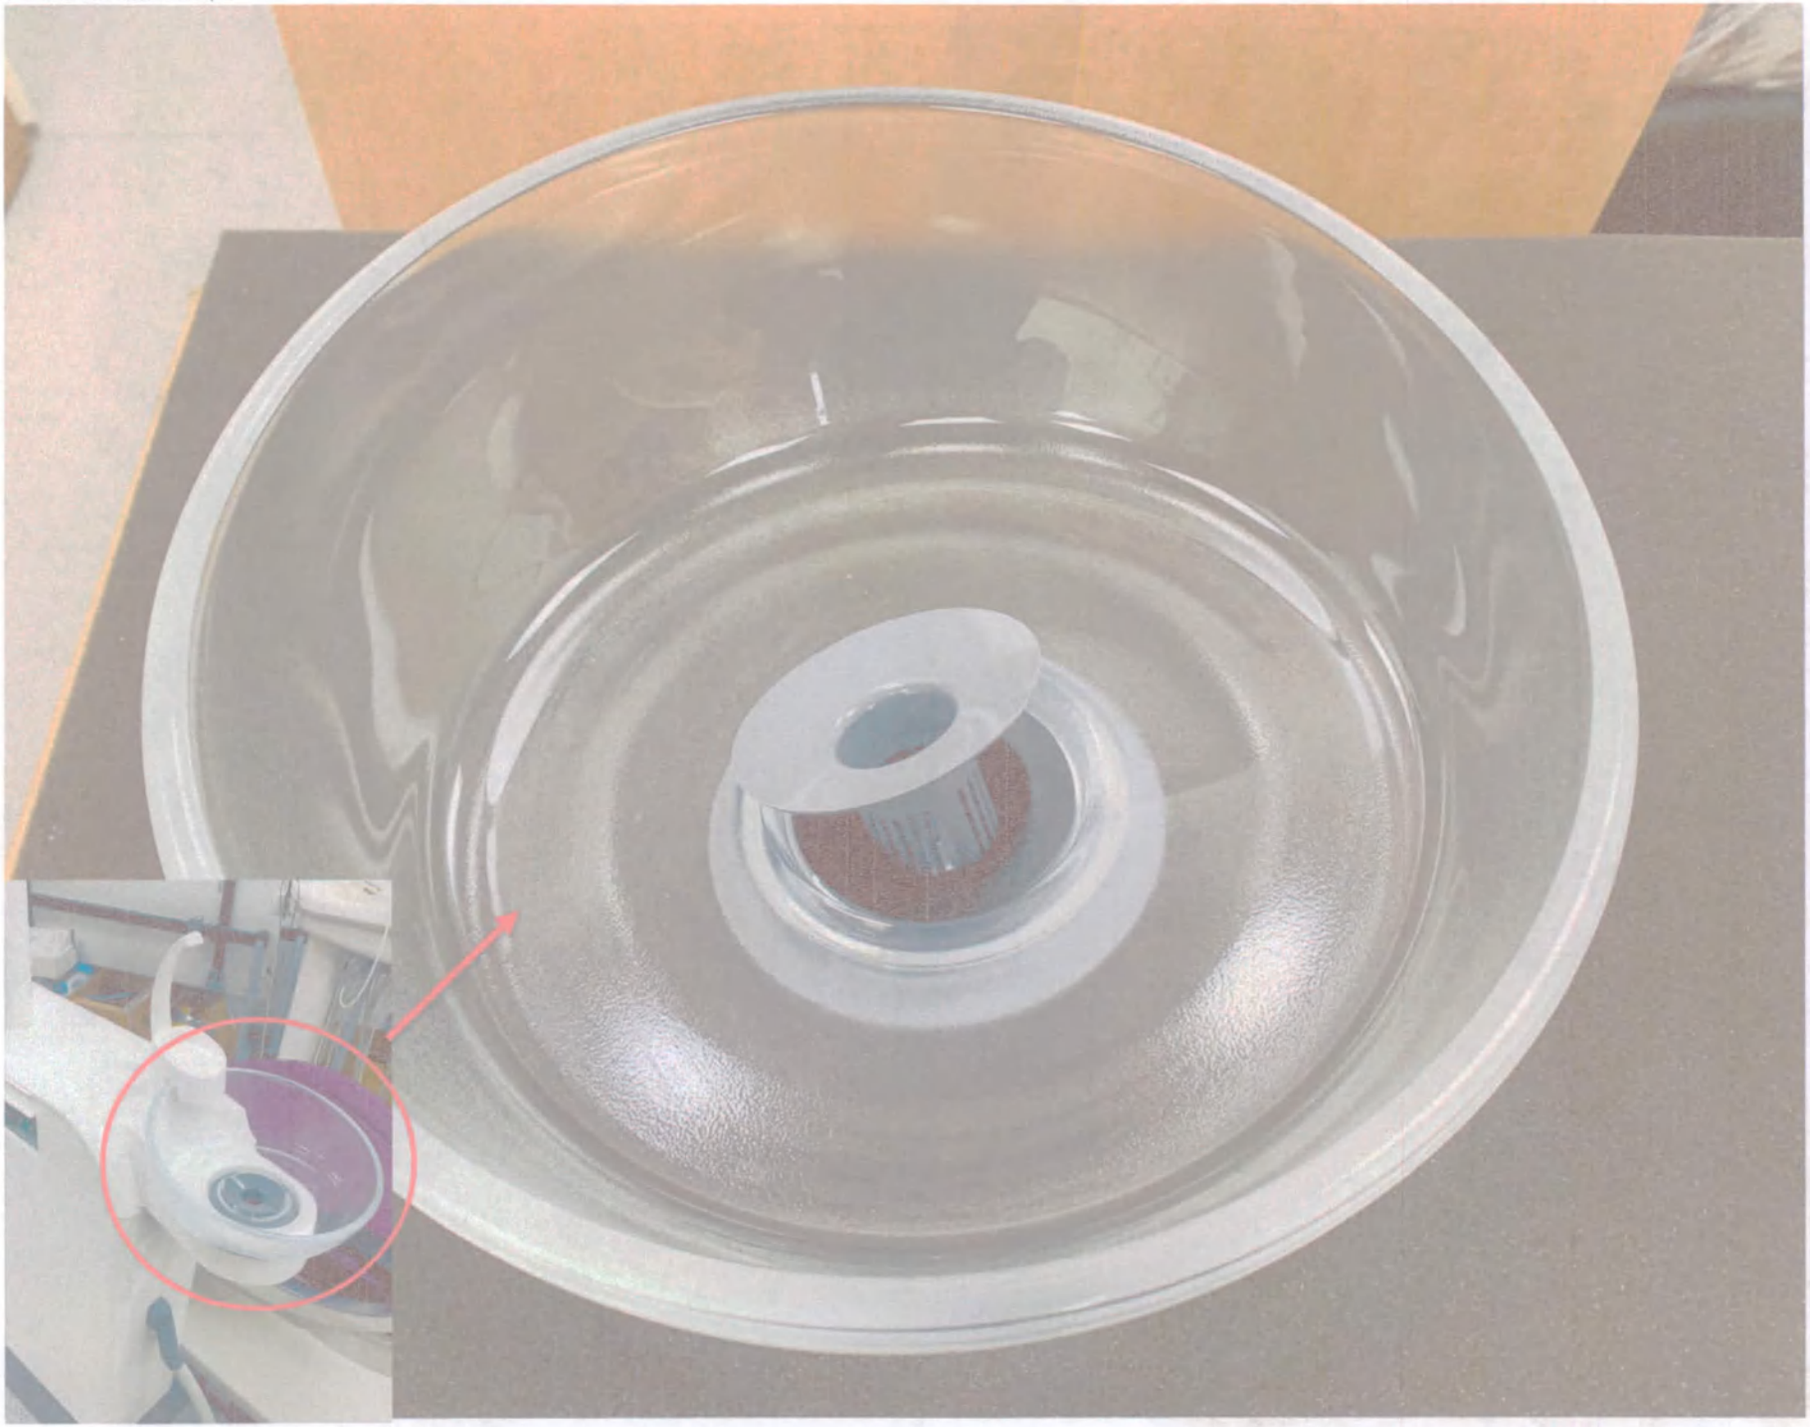


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

40. Сливная трубка стакана для полоскания рта (наполнитель стакана).

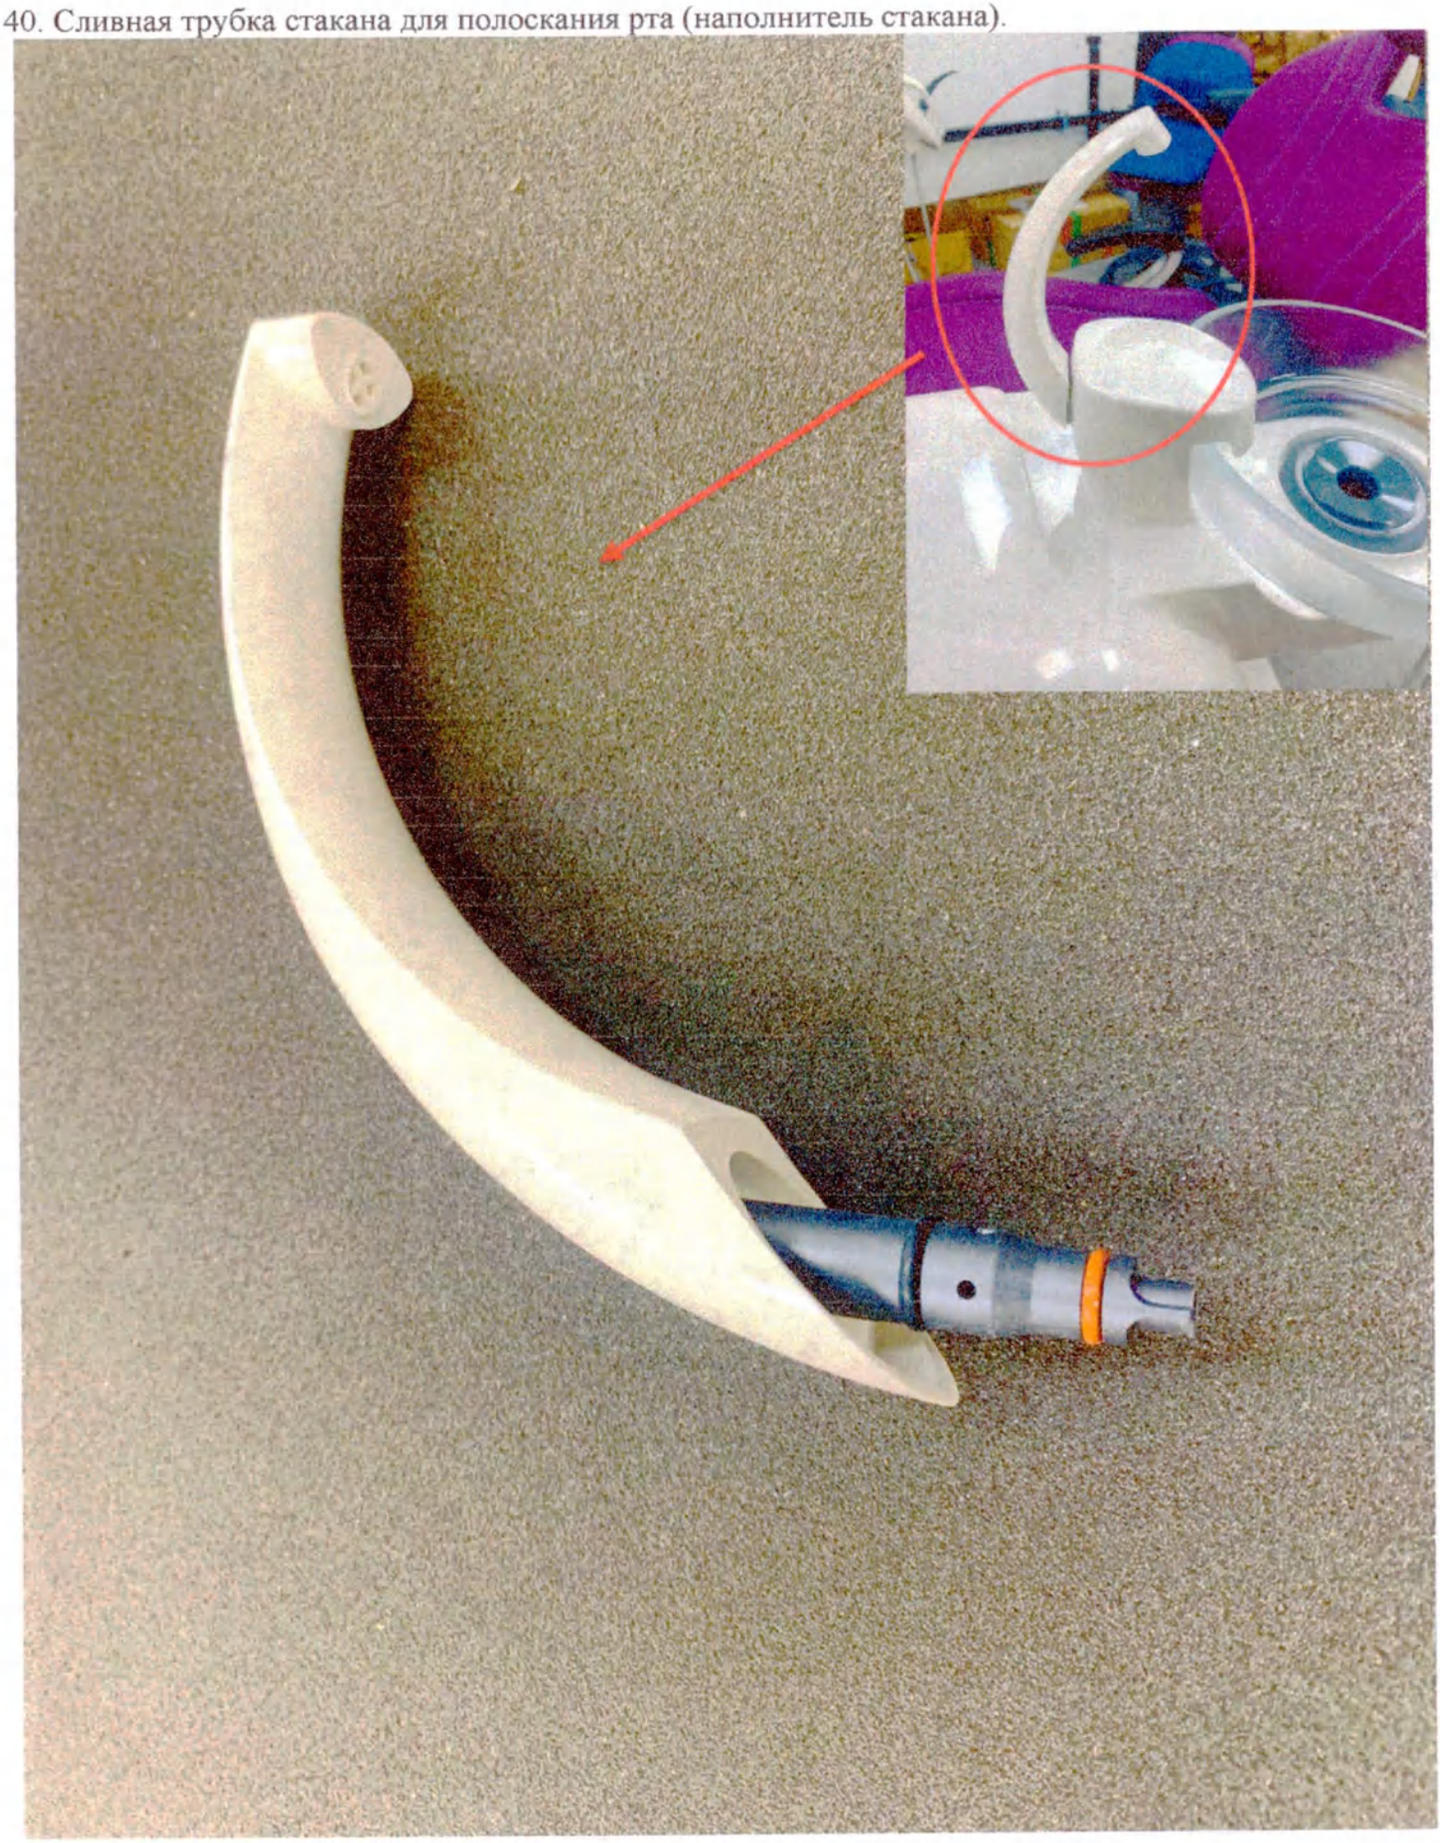


41. Переходник отсасывающих шлангов для плевательницы.

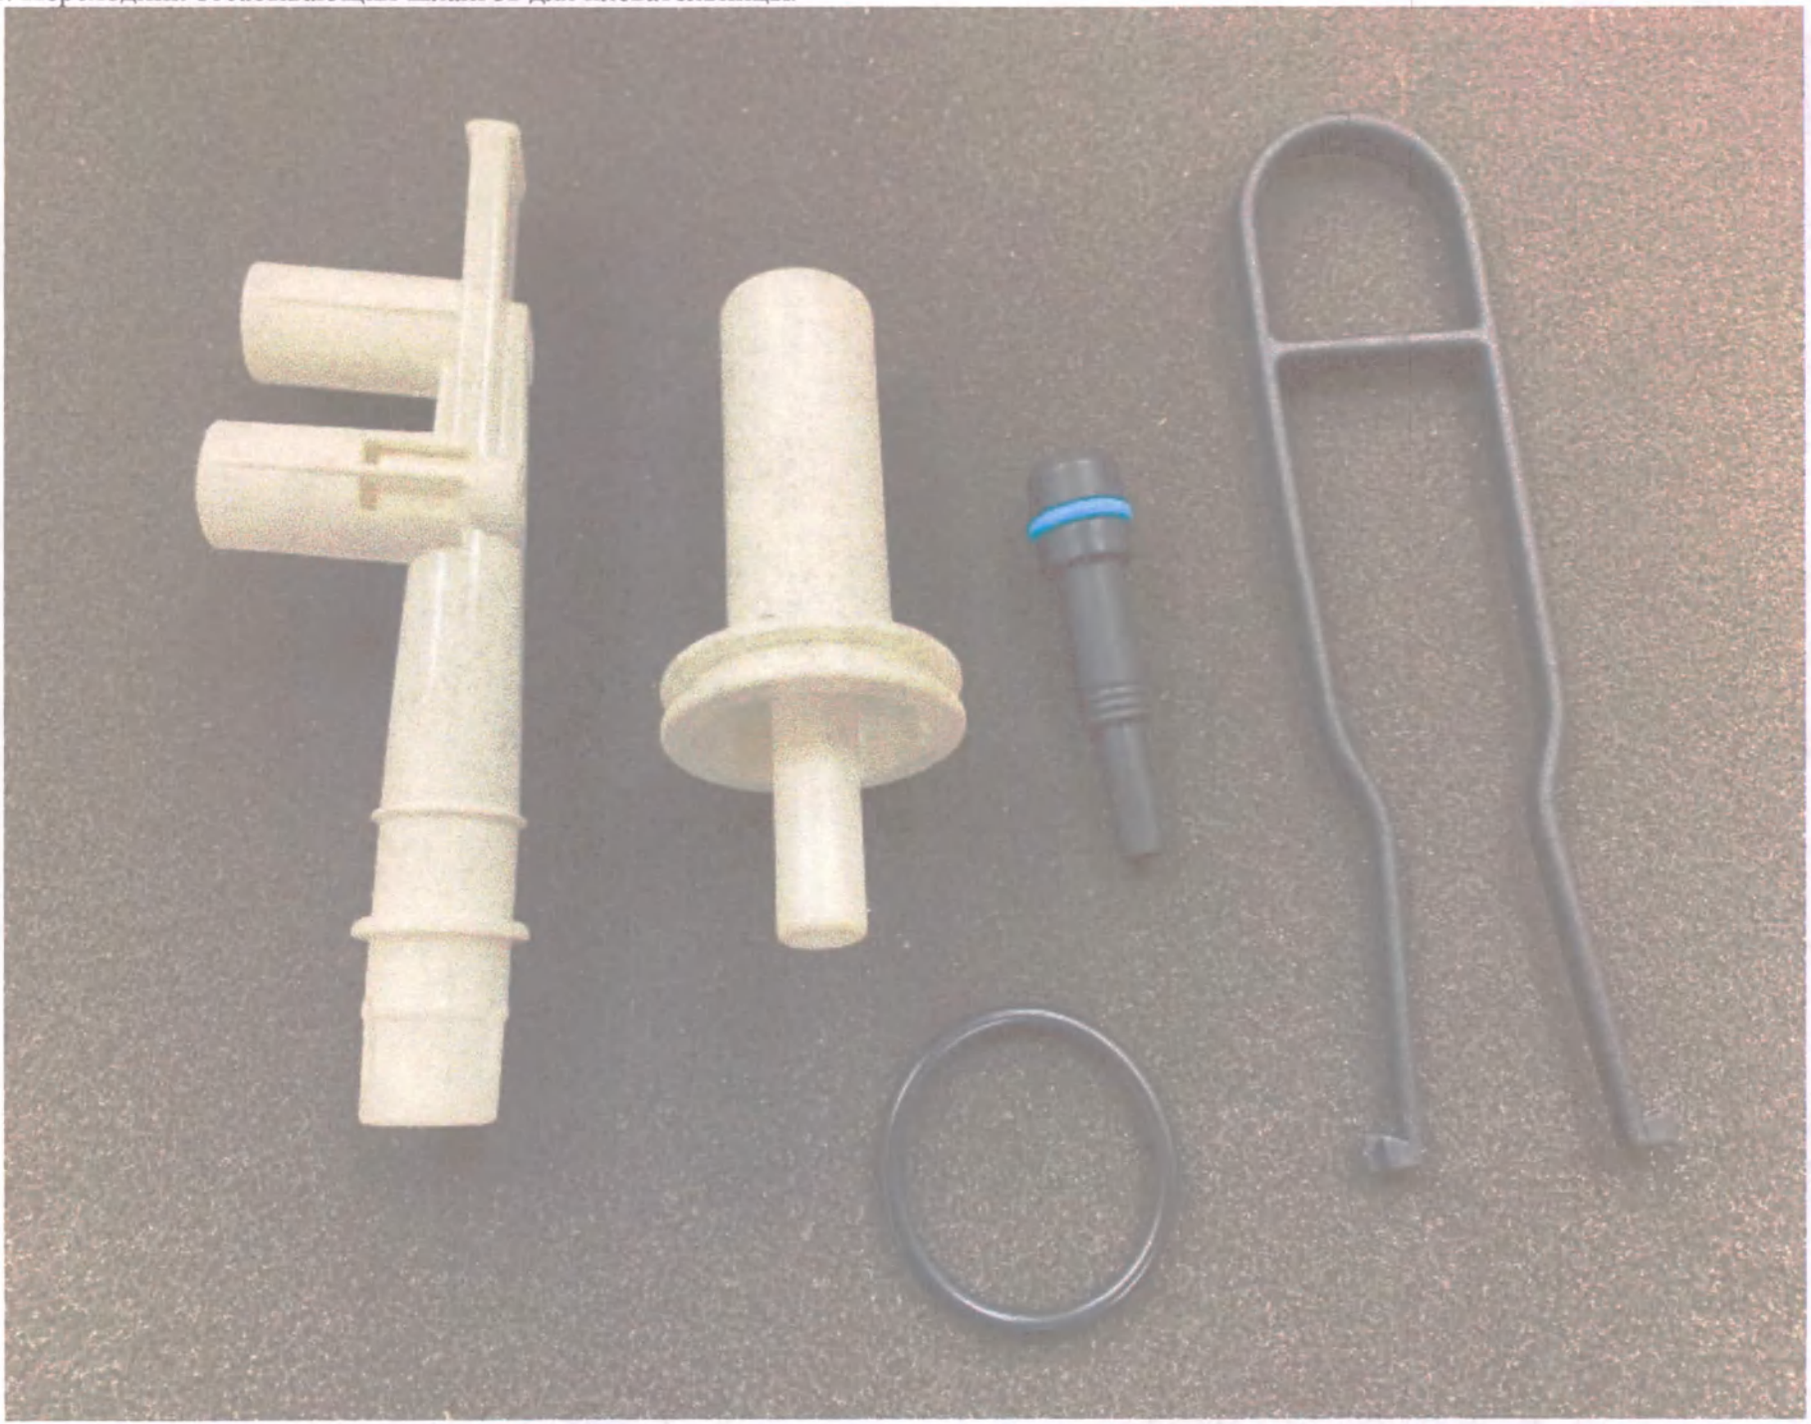


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

42. Соединительный шланг водяного блока.

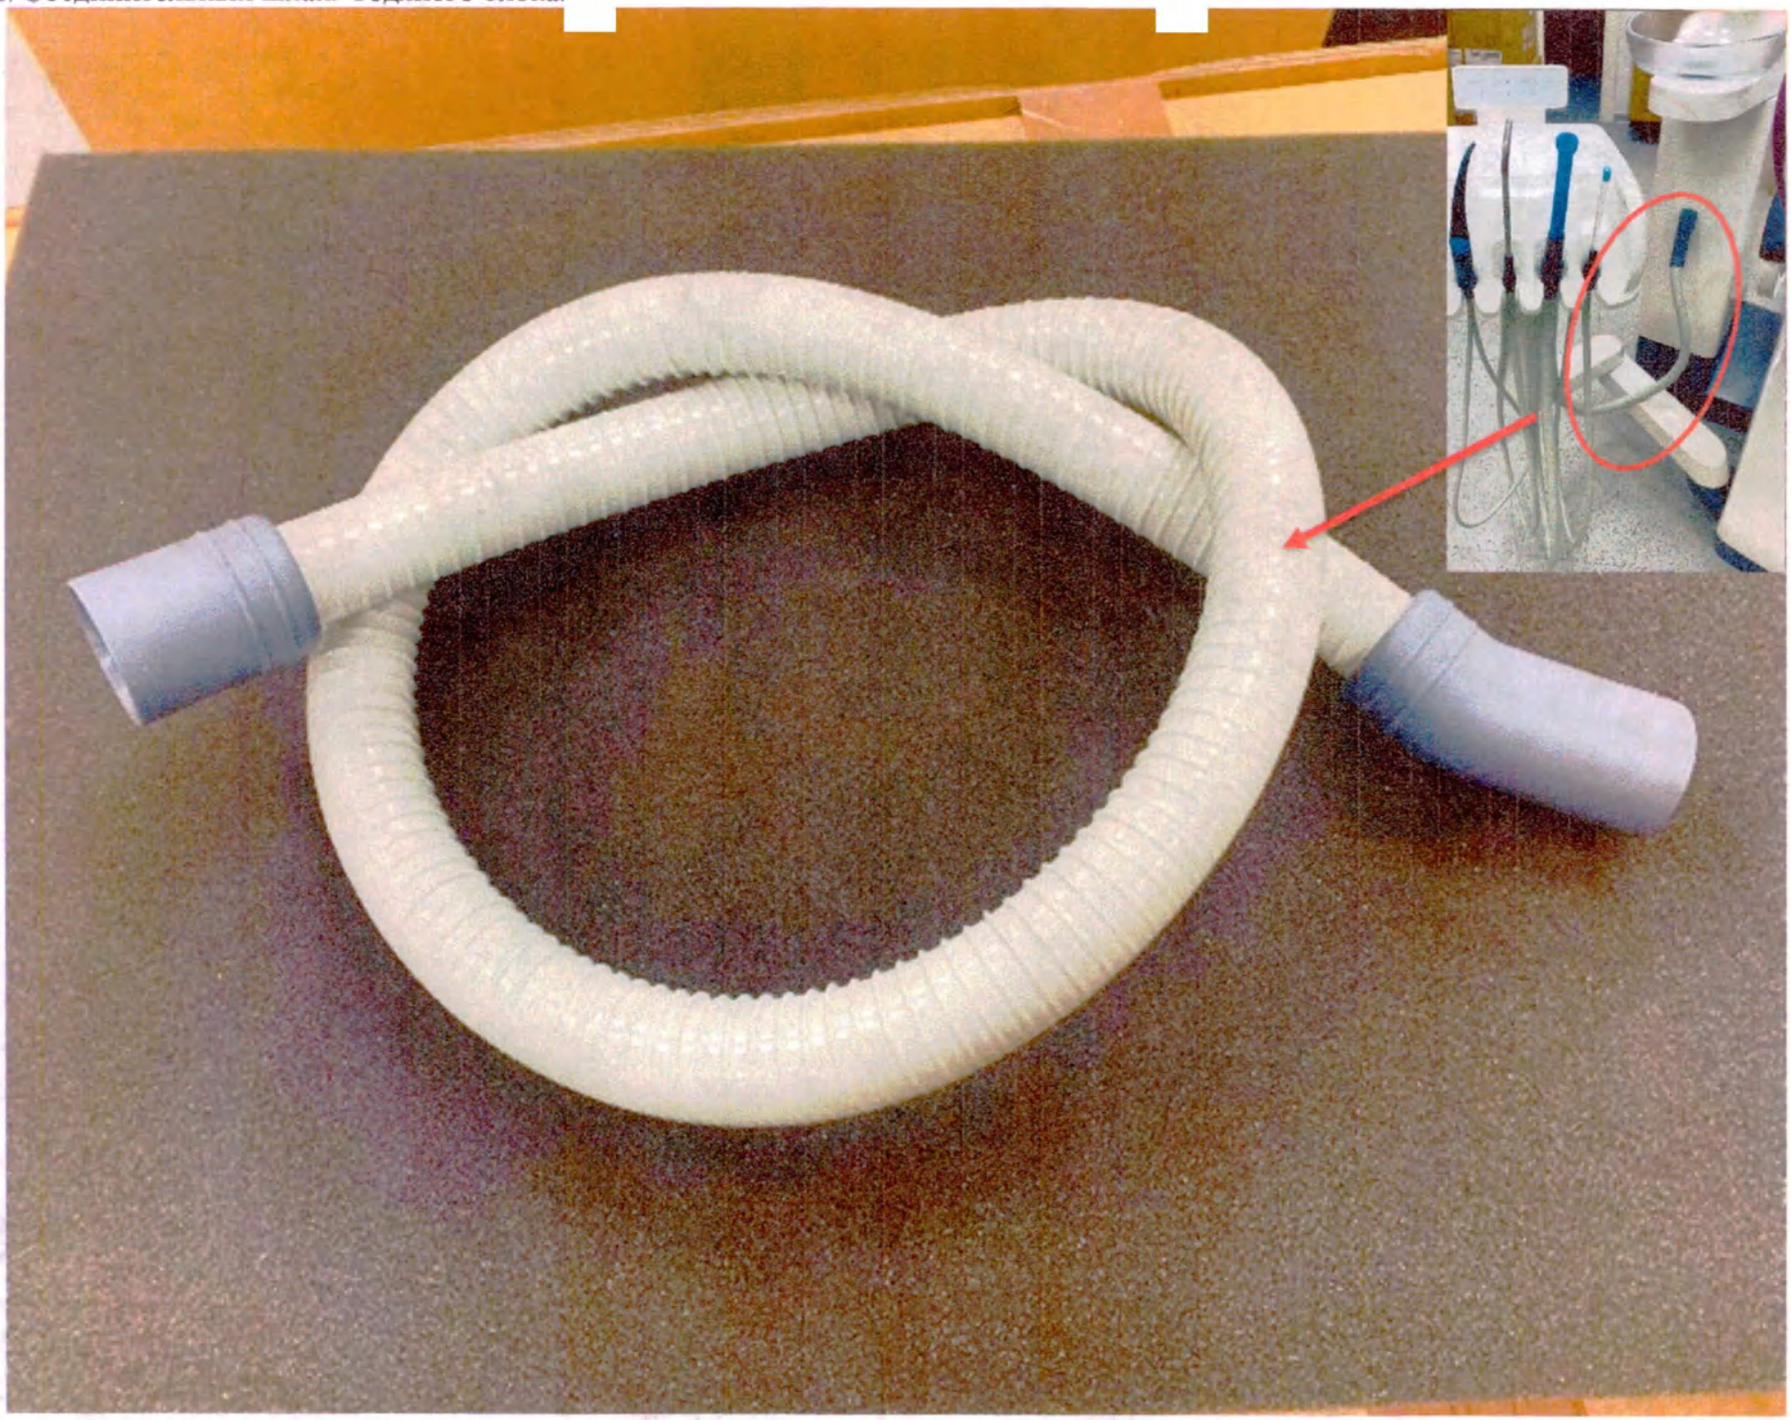


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

43. Вставной блок для очистки отсасывающих шлангов.

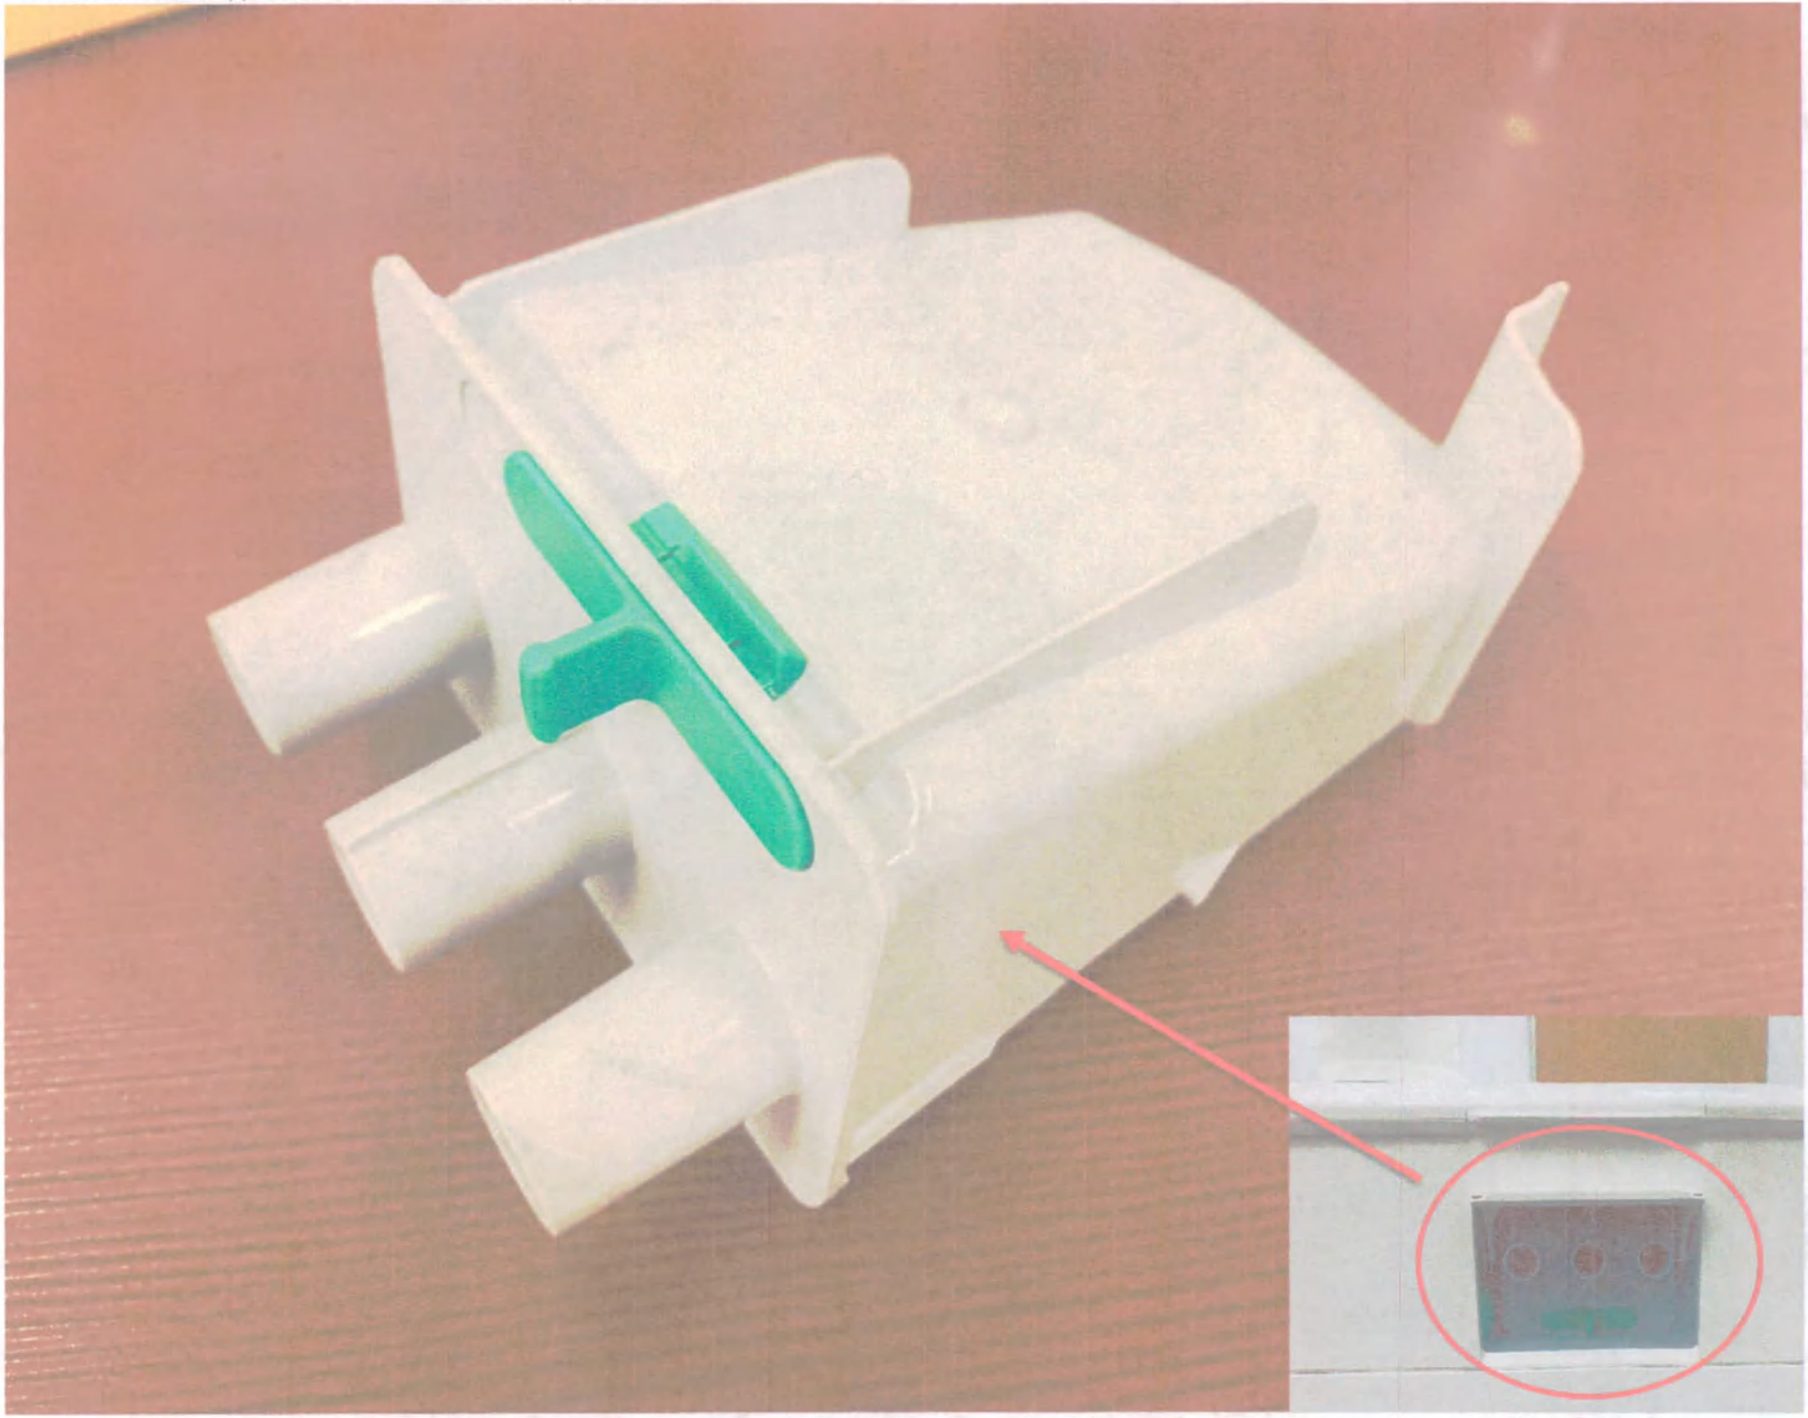

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

44. Вставной блок для автоматического про[illegible]ания Autopurge/санации.

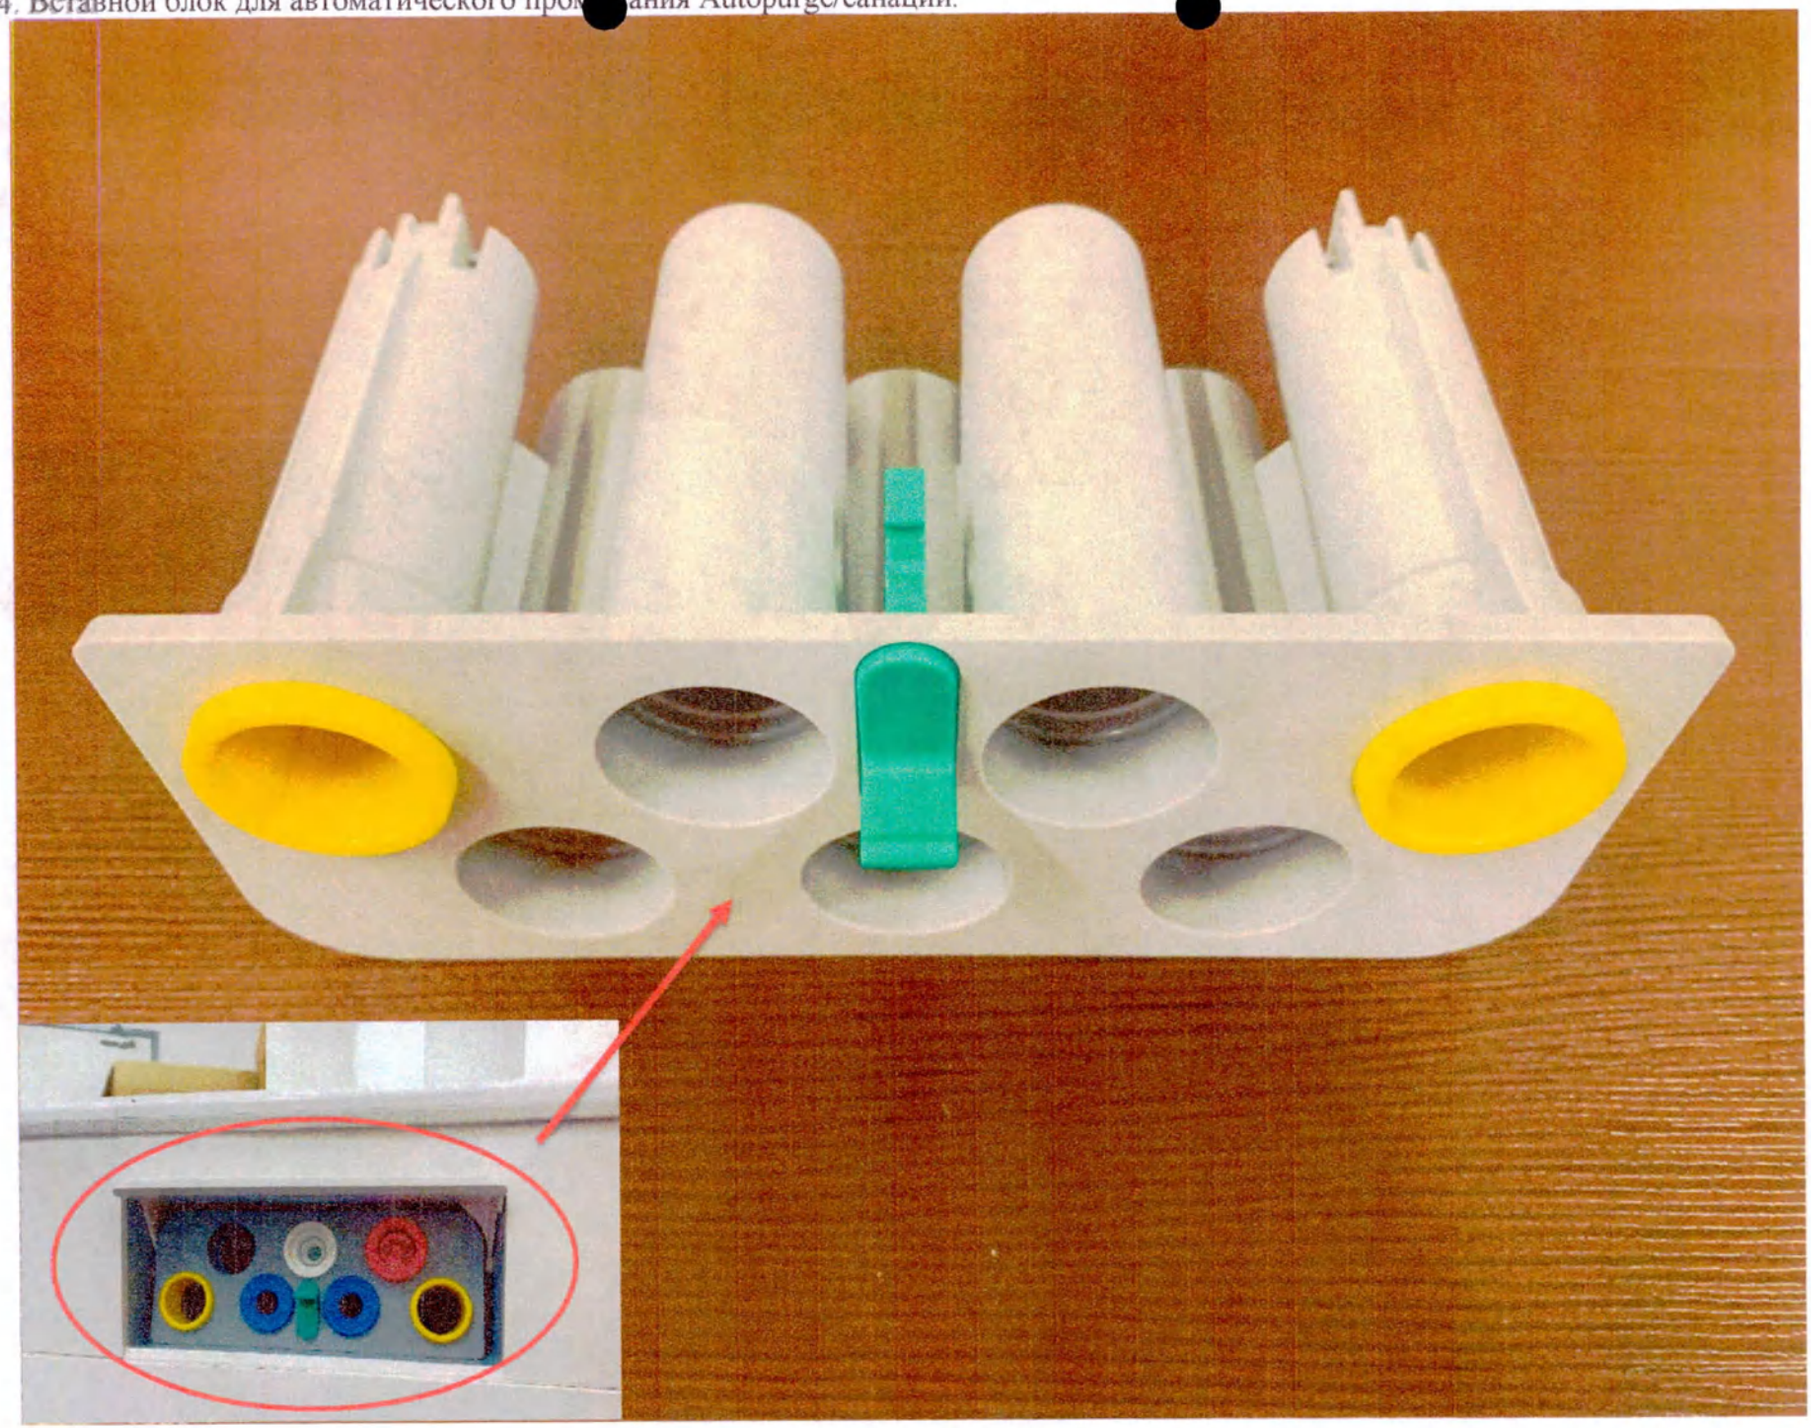


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

45. Санационные переходники:
для турбины




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для мотора BL

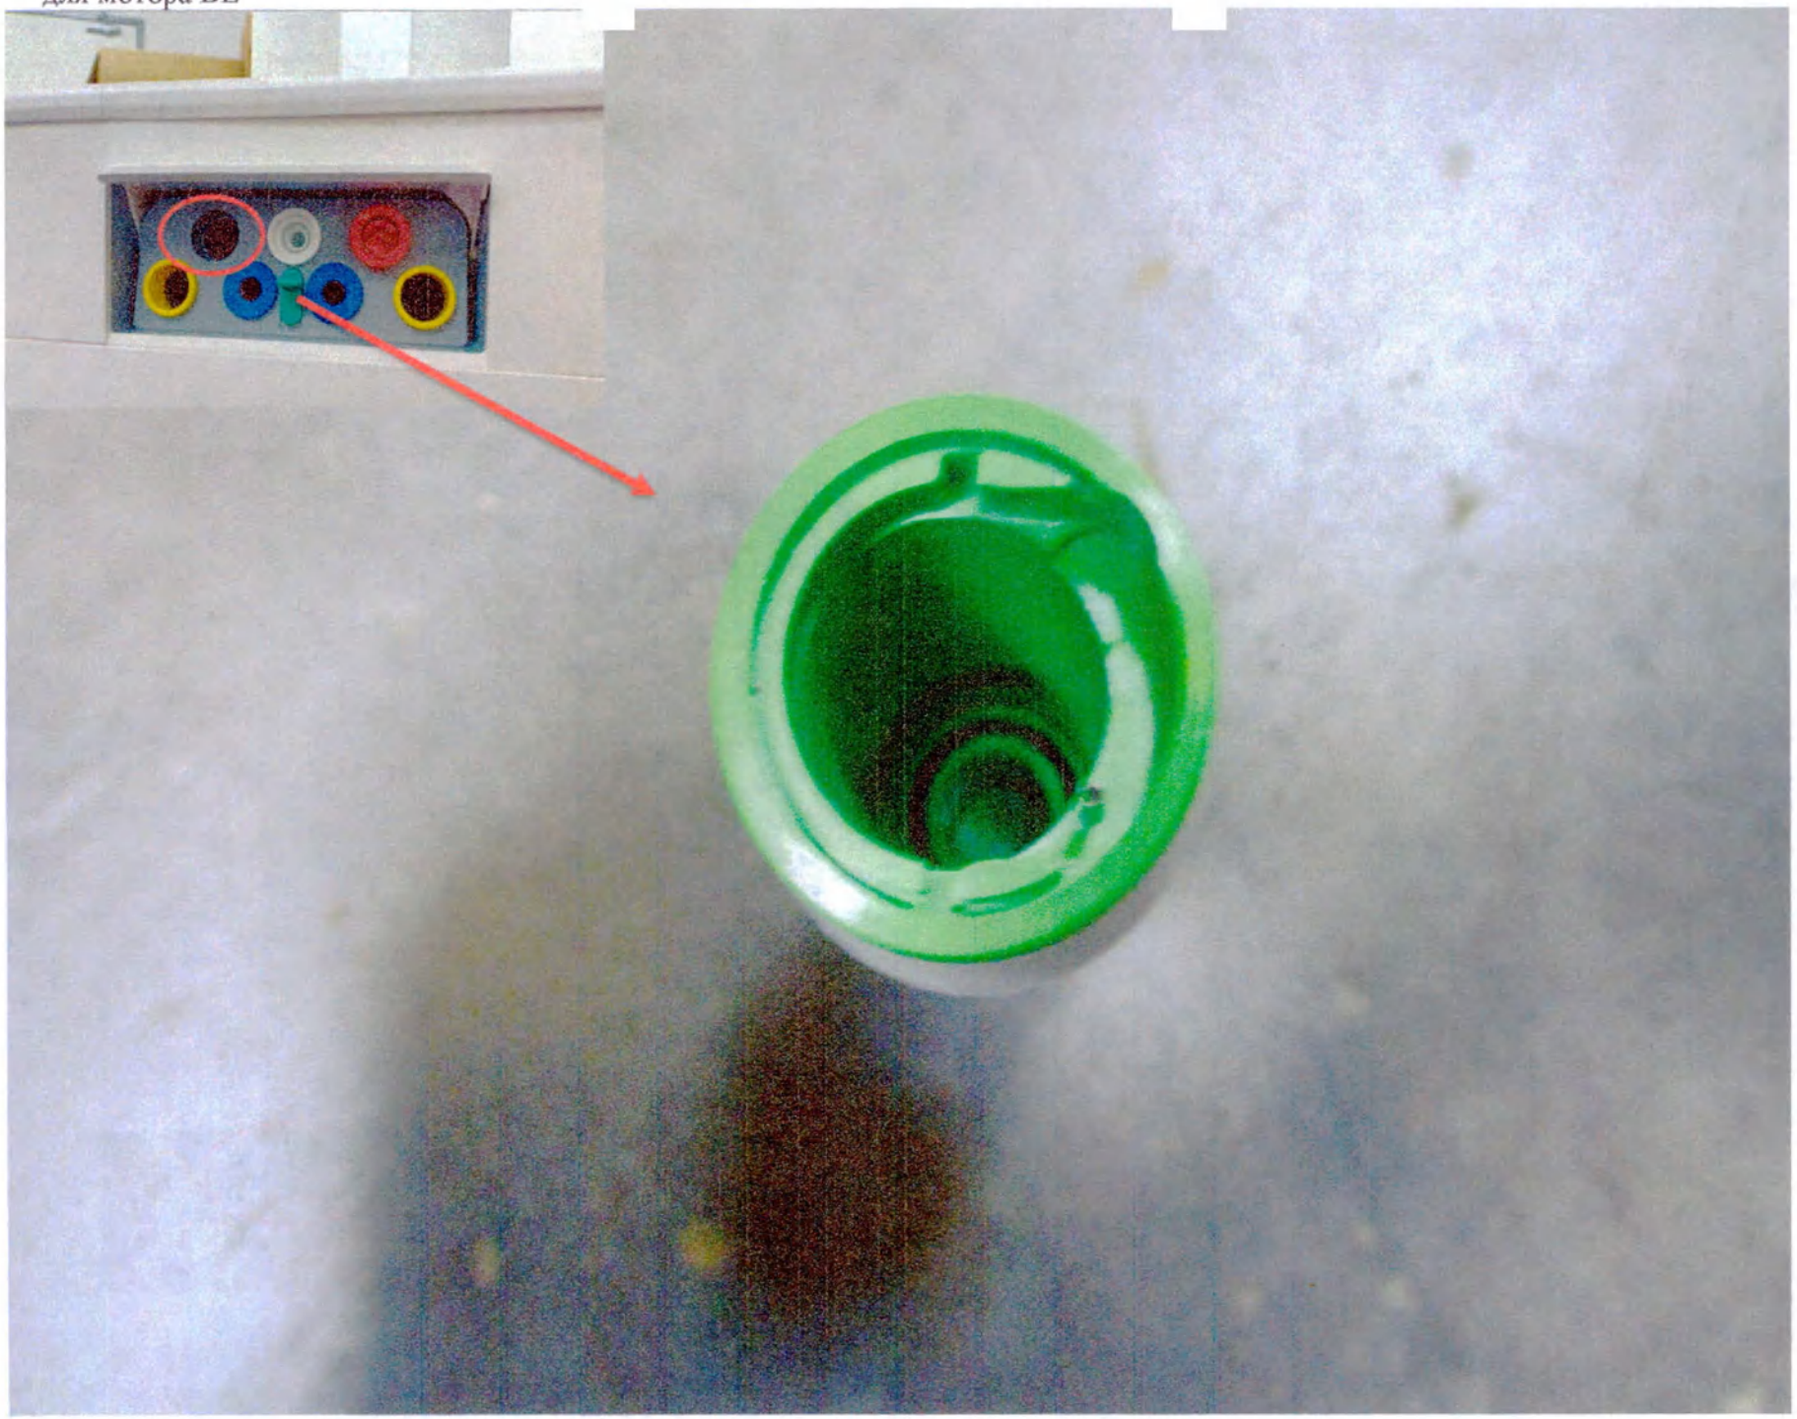


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для мотора ISO

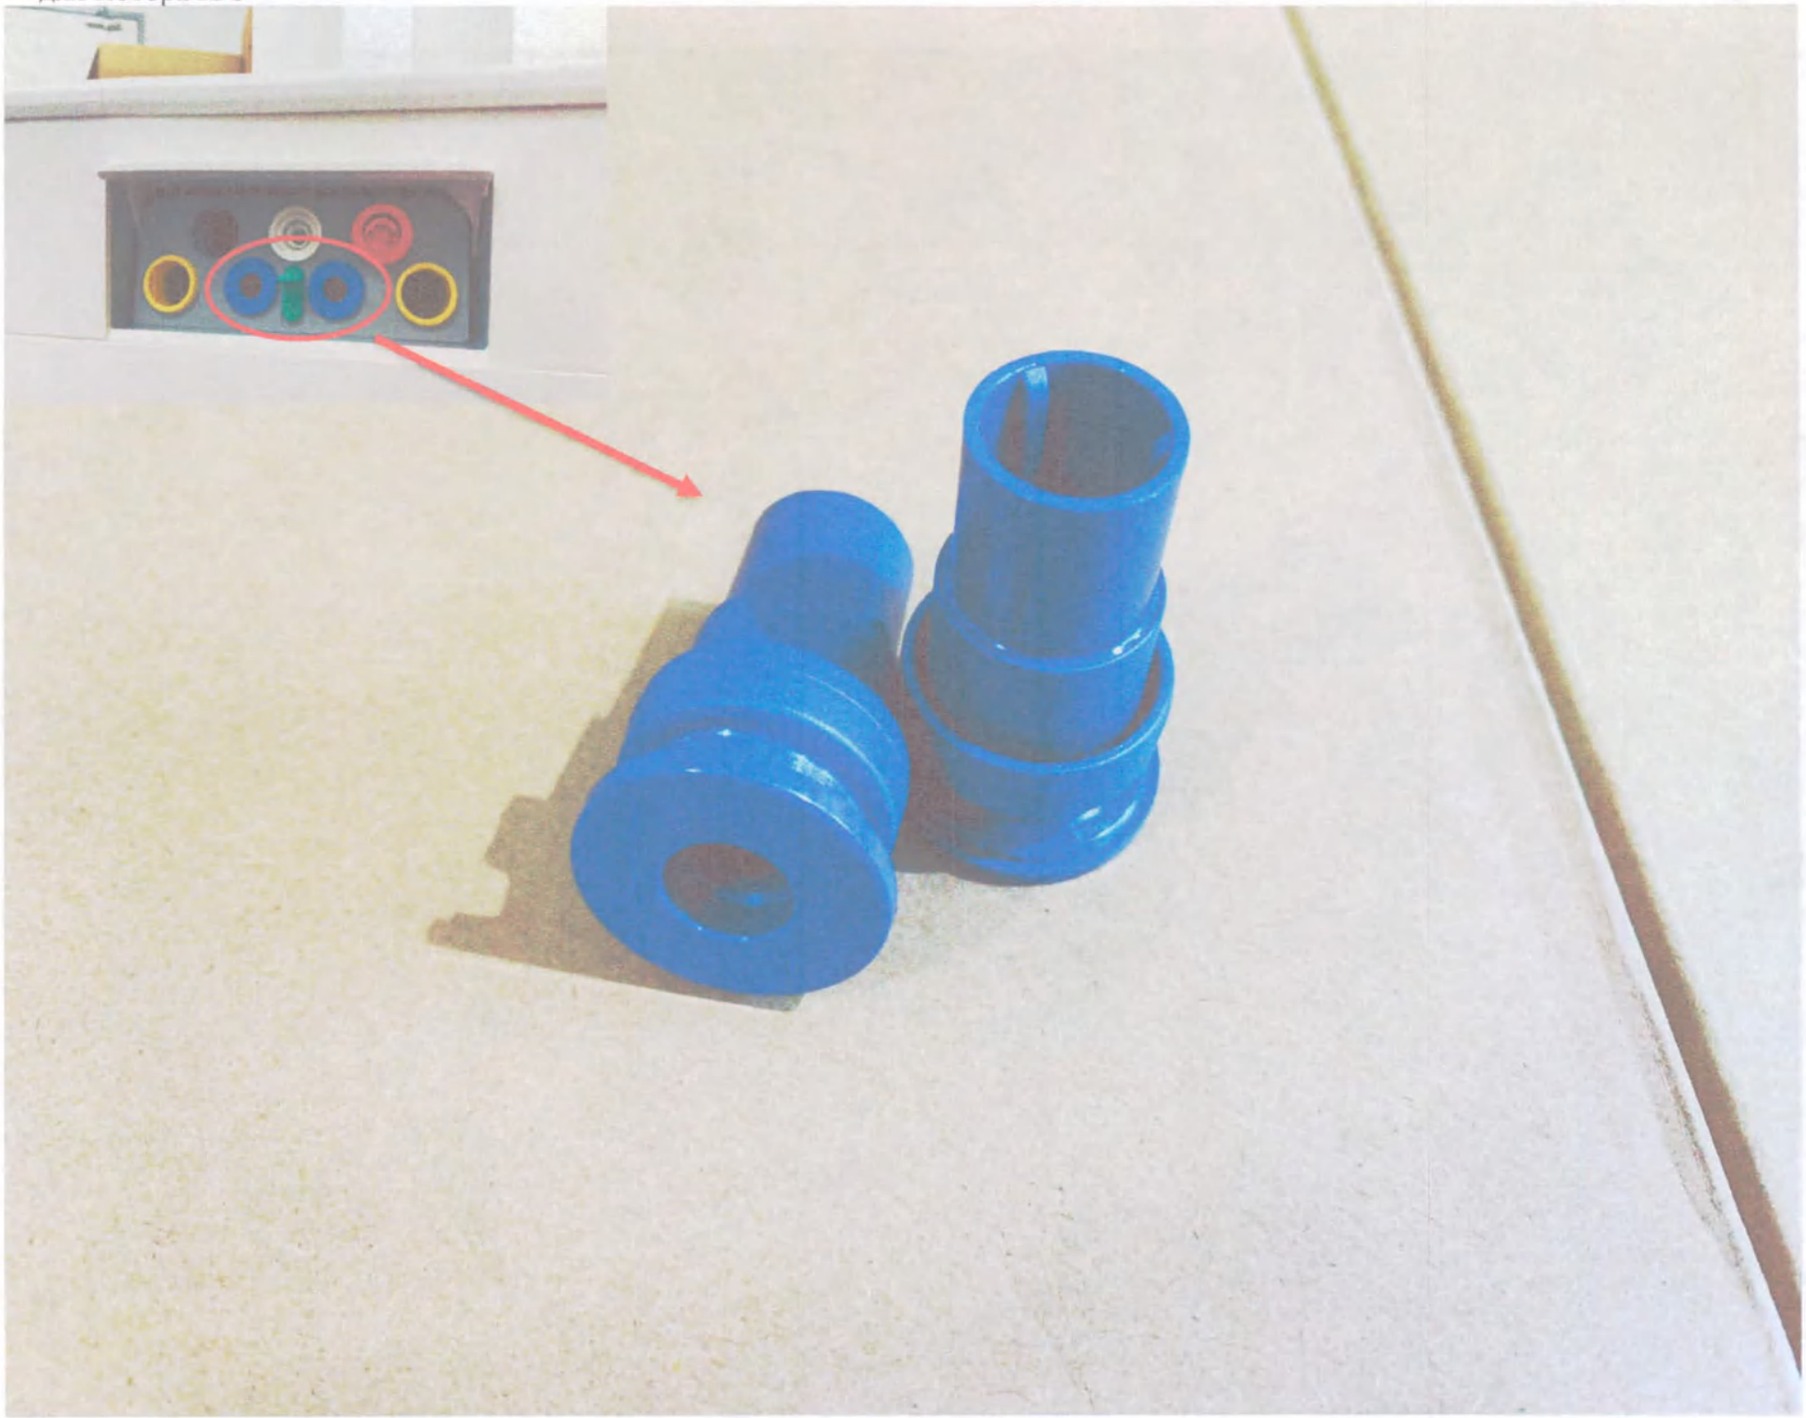

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

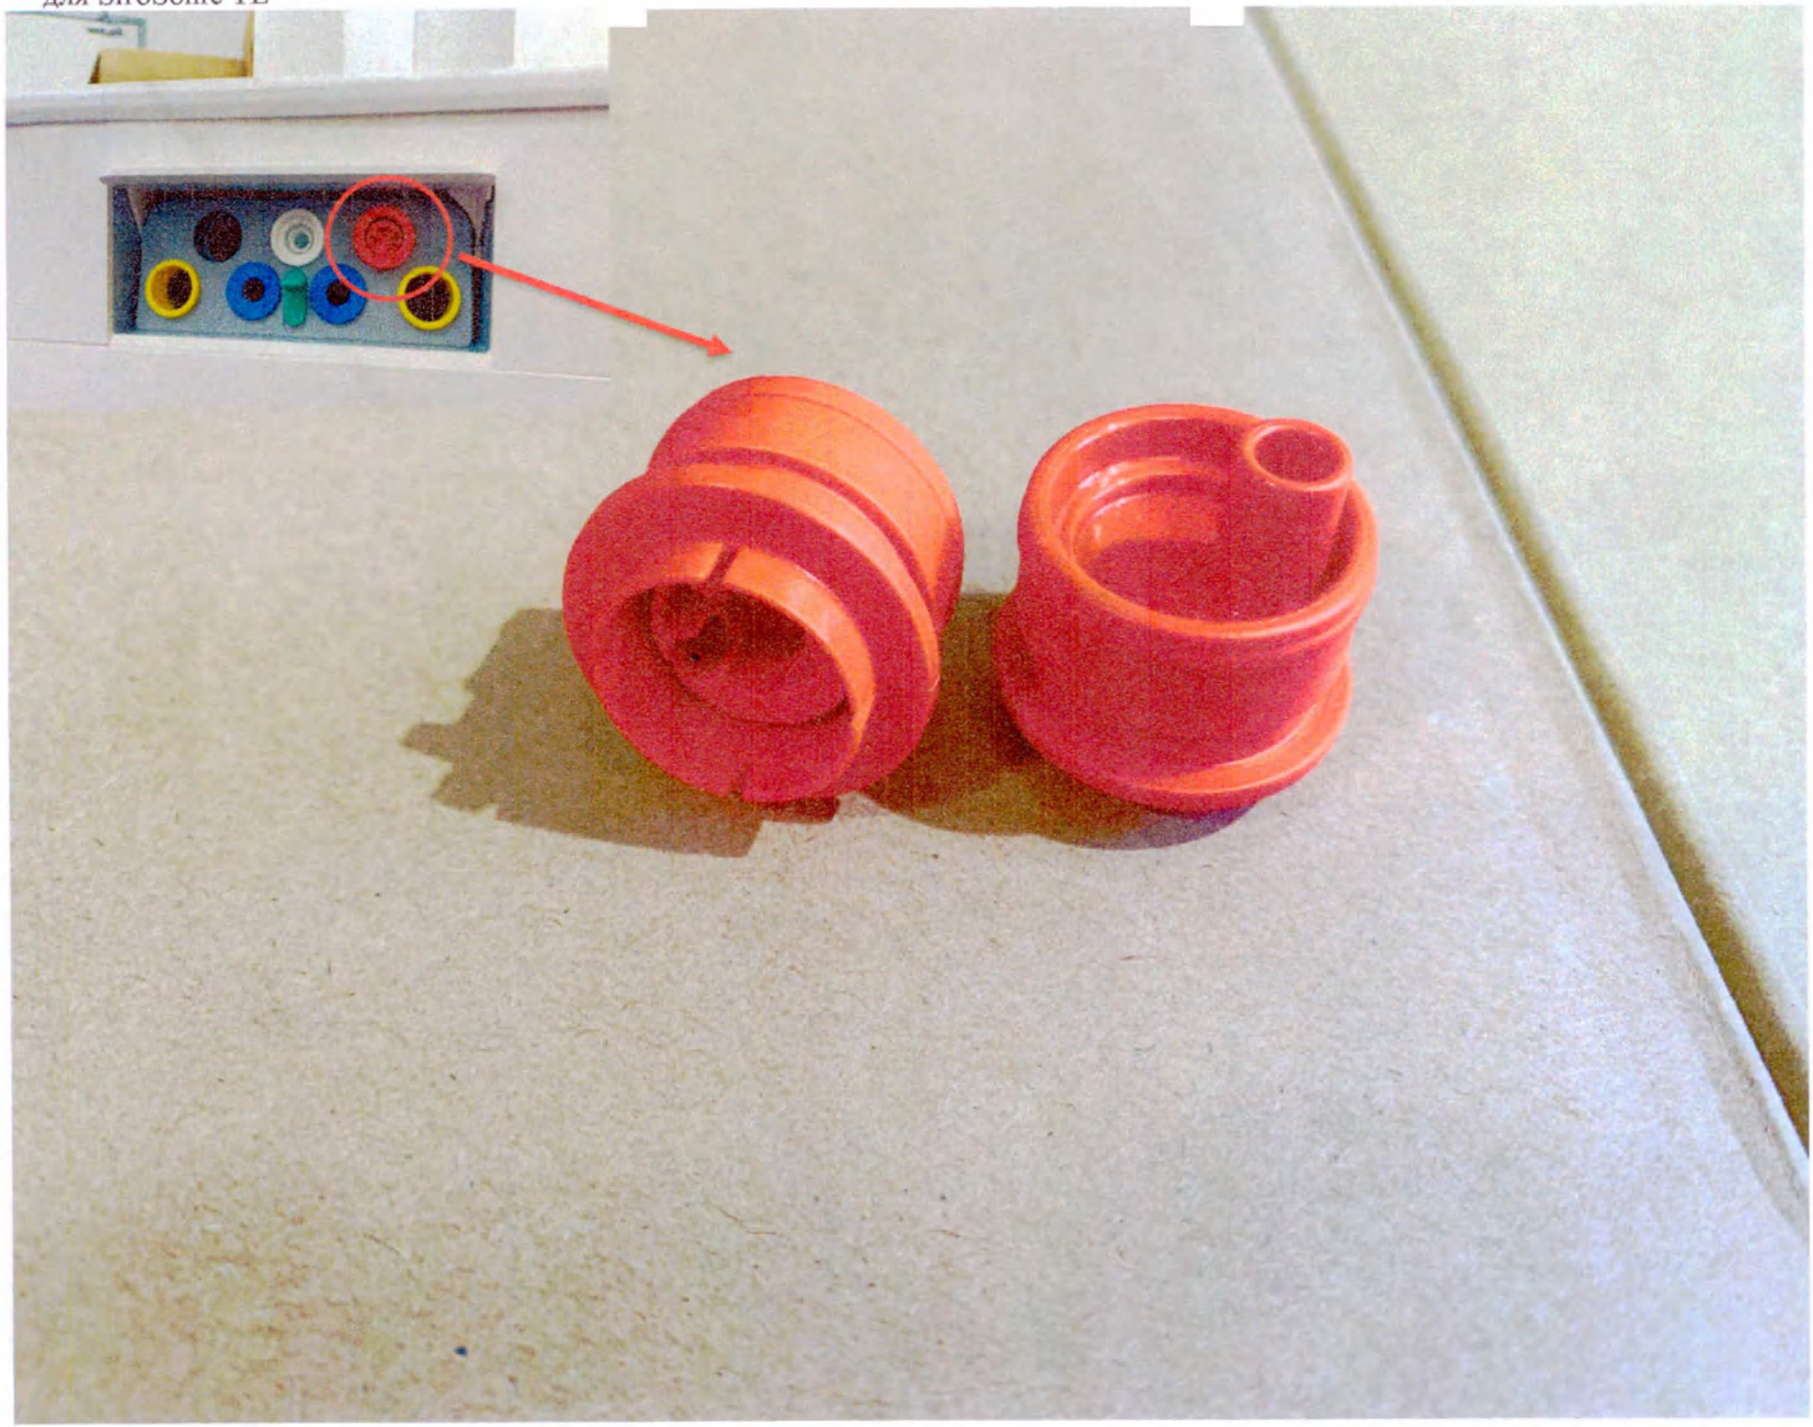


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

46. Средство для дезинфекции водопроводящих трубок Dentosept Clean.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

47. Рабочий светильник с элементами крепл[illegible], вариант исполнения LEDview Plus

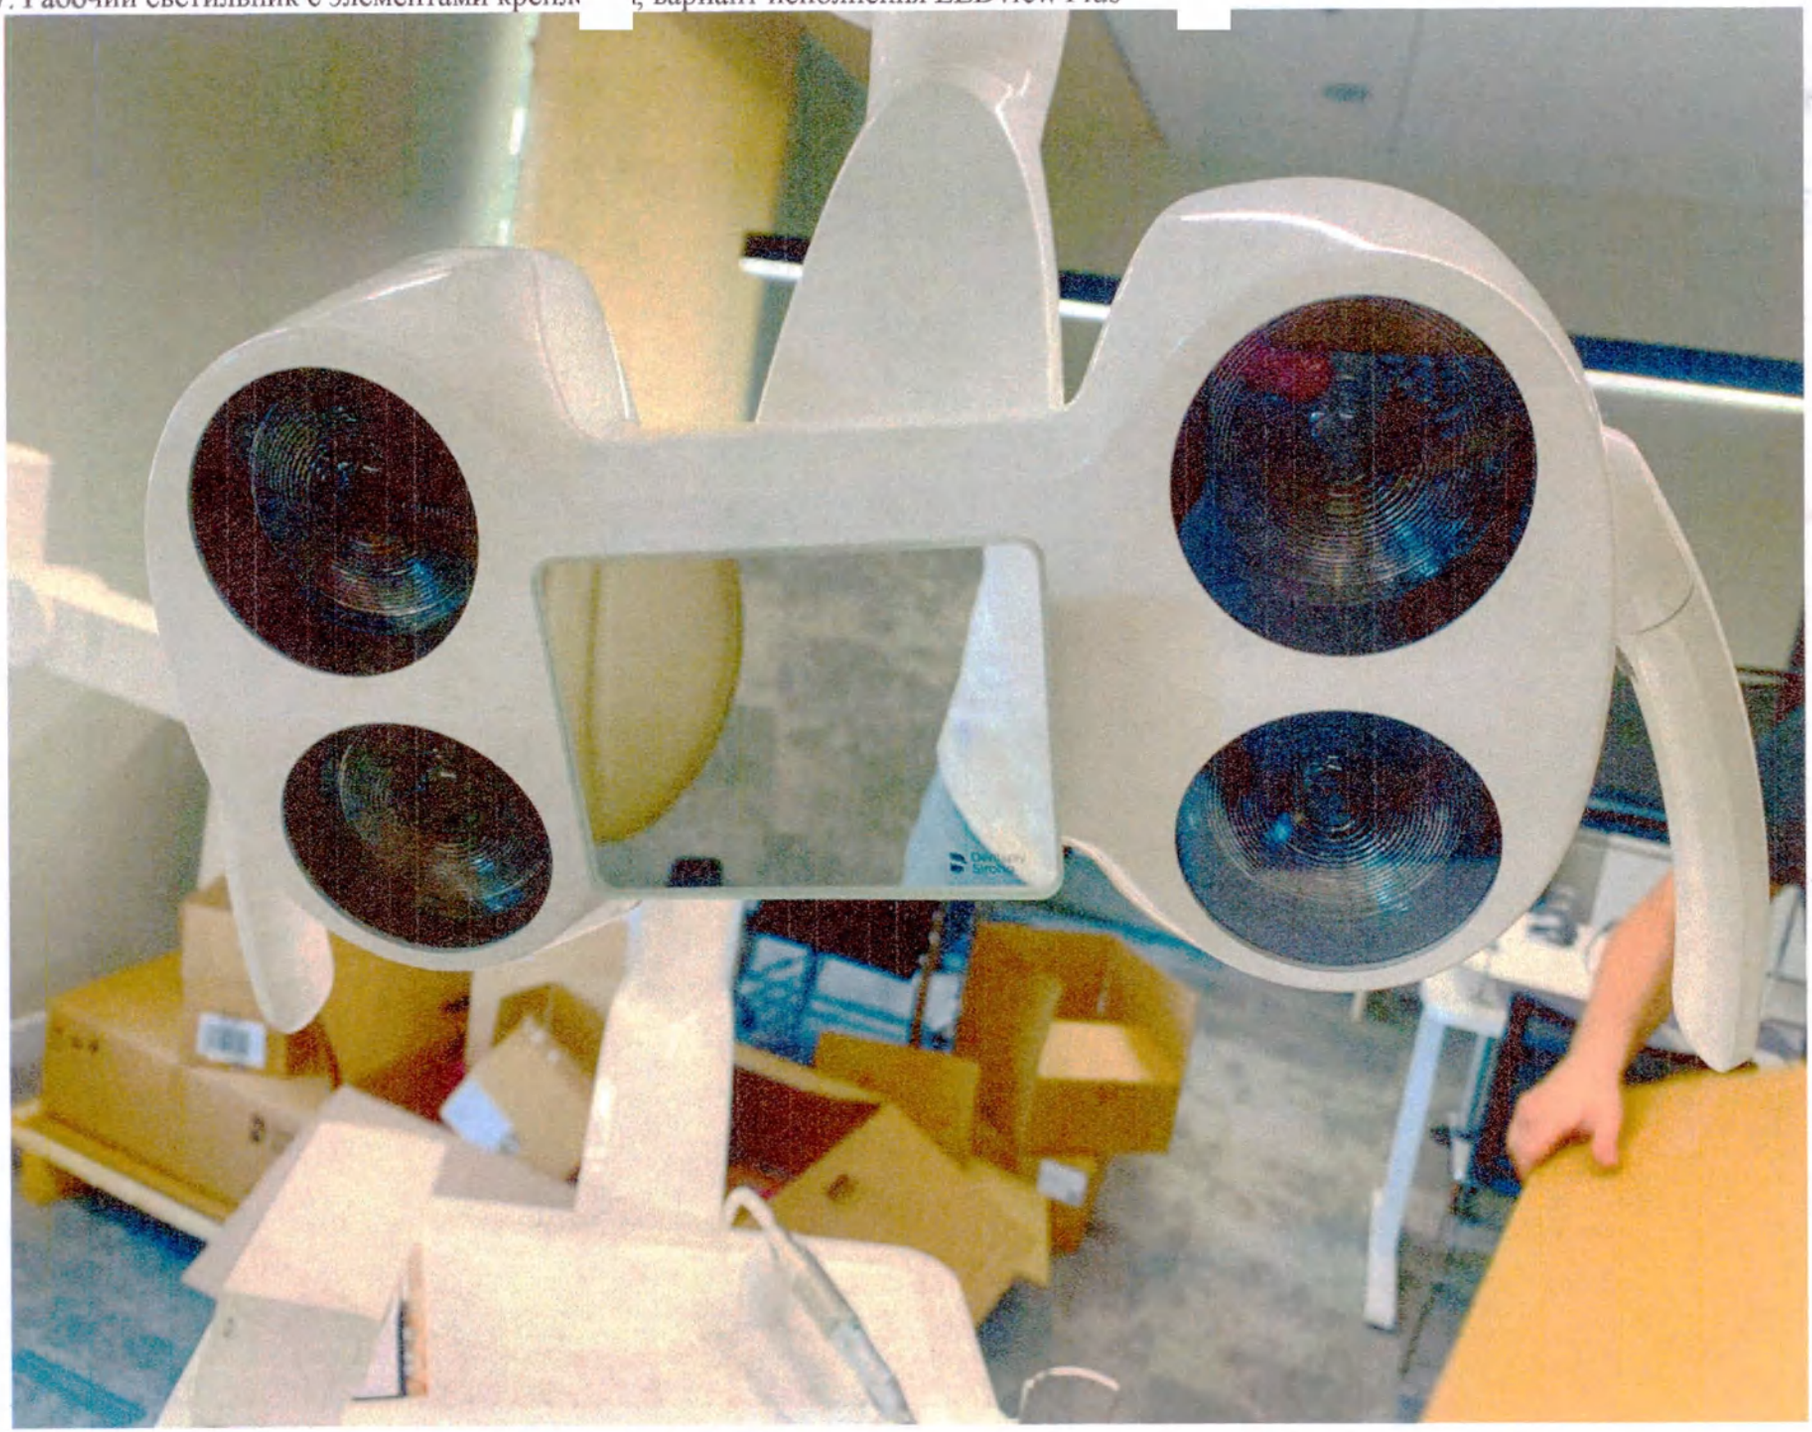



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения LEDview Plus с набором крепежных элементов на потолок (в составе: опорная стойка для потолков, крепежный адаптер для опорной стойки, кронштейн для светильника).





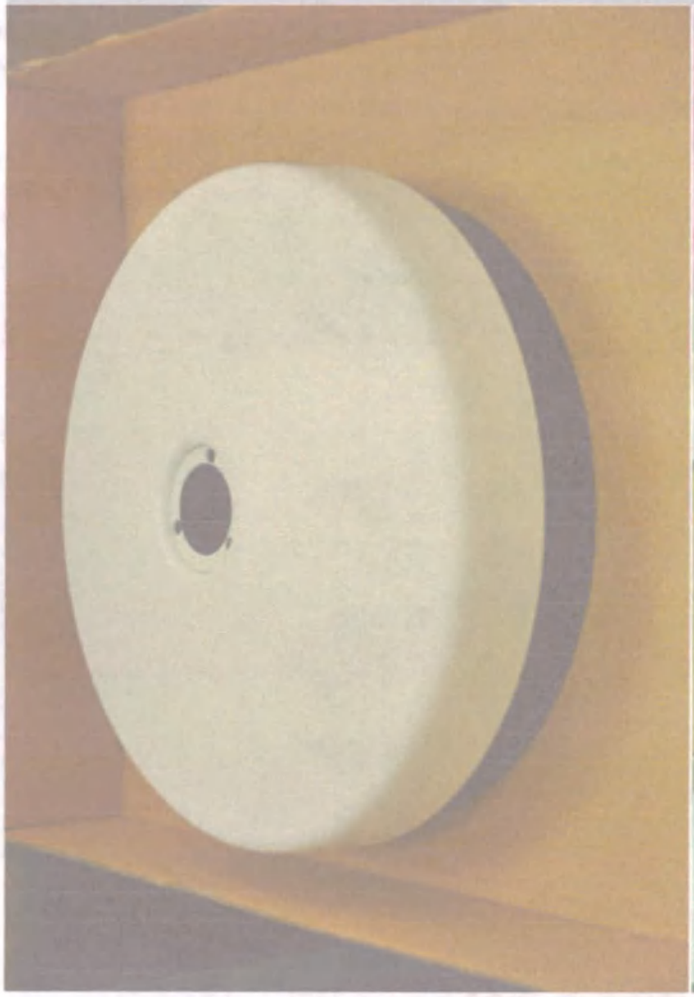

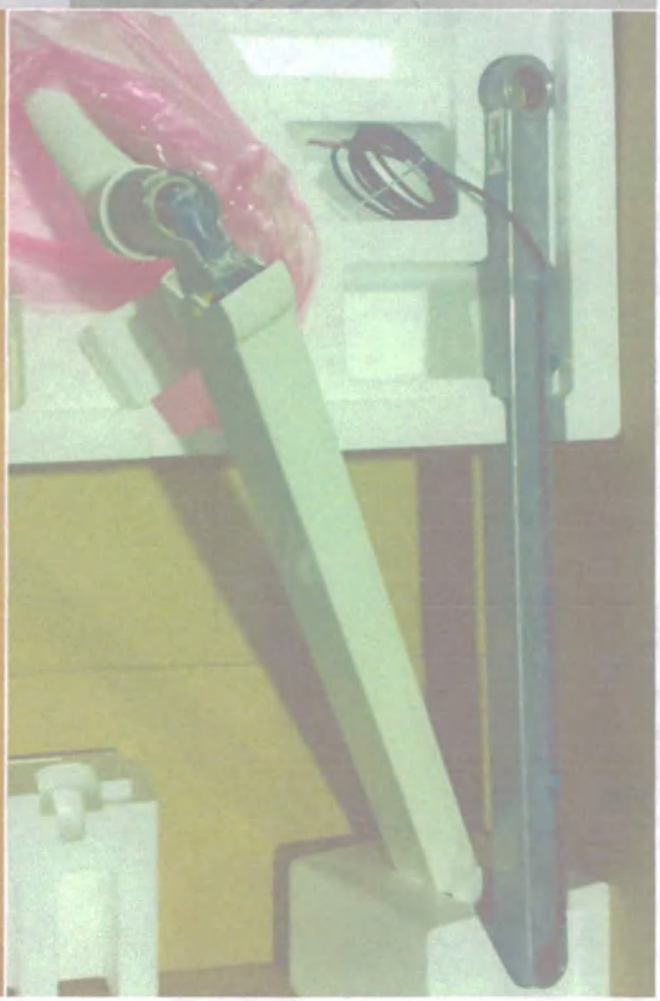

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

48. Зеркало рабочего светильника.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

49. Держатель камеры рабочего светильника.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

50. Монитор пациента 22" DC.

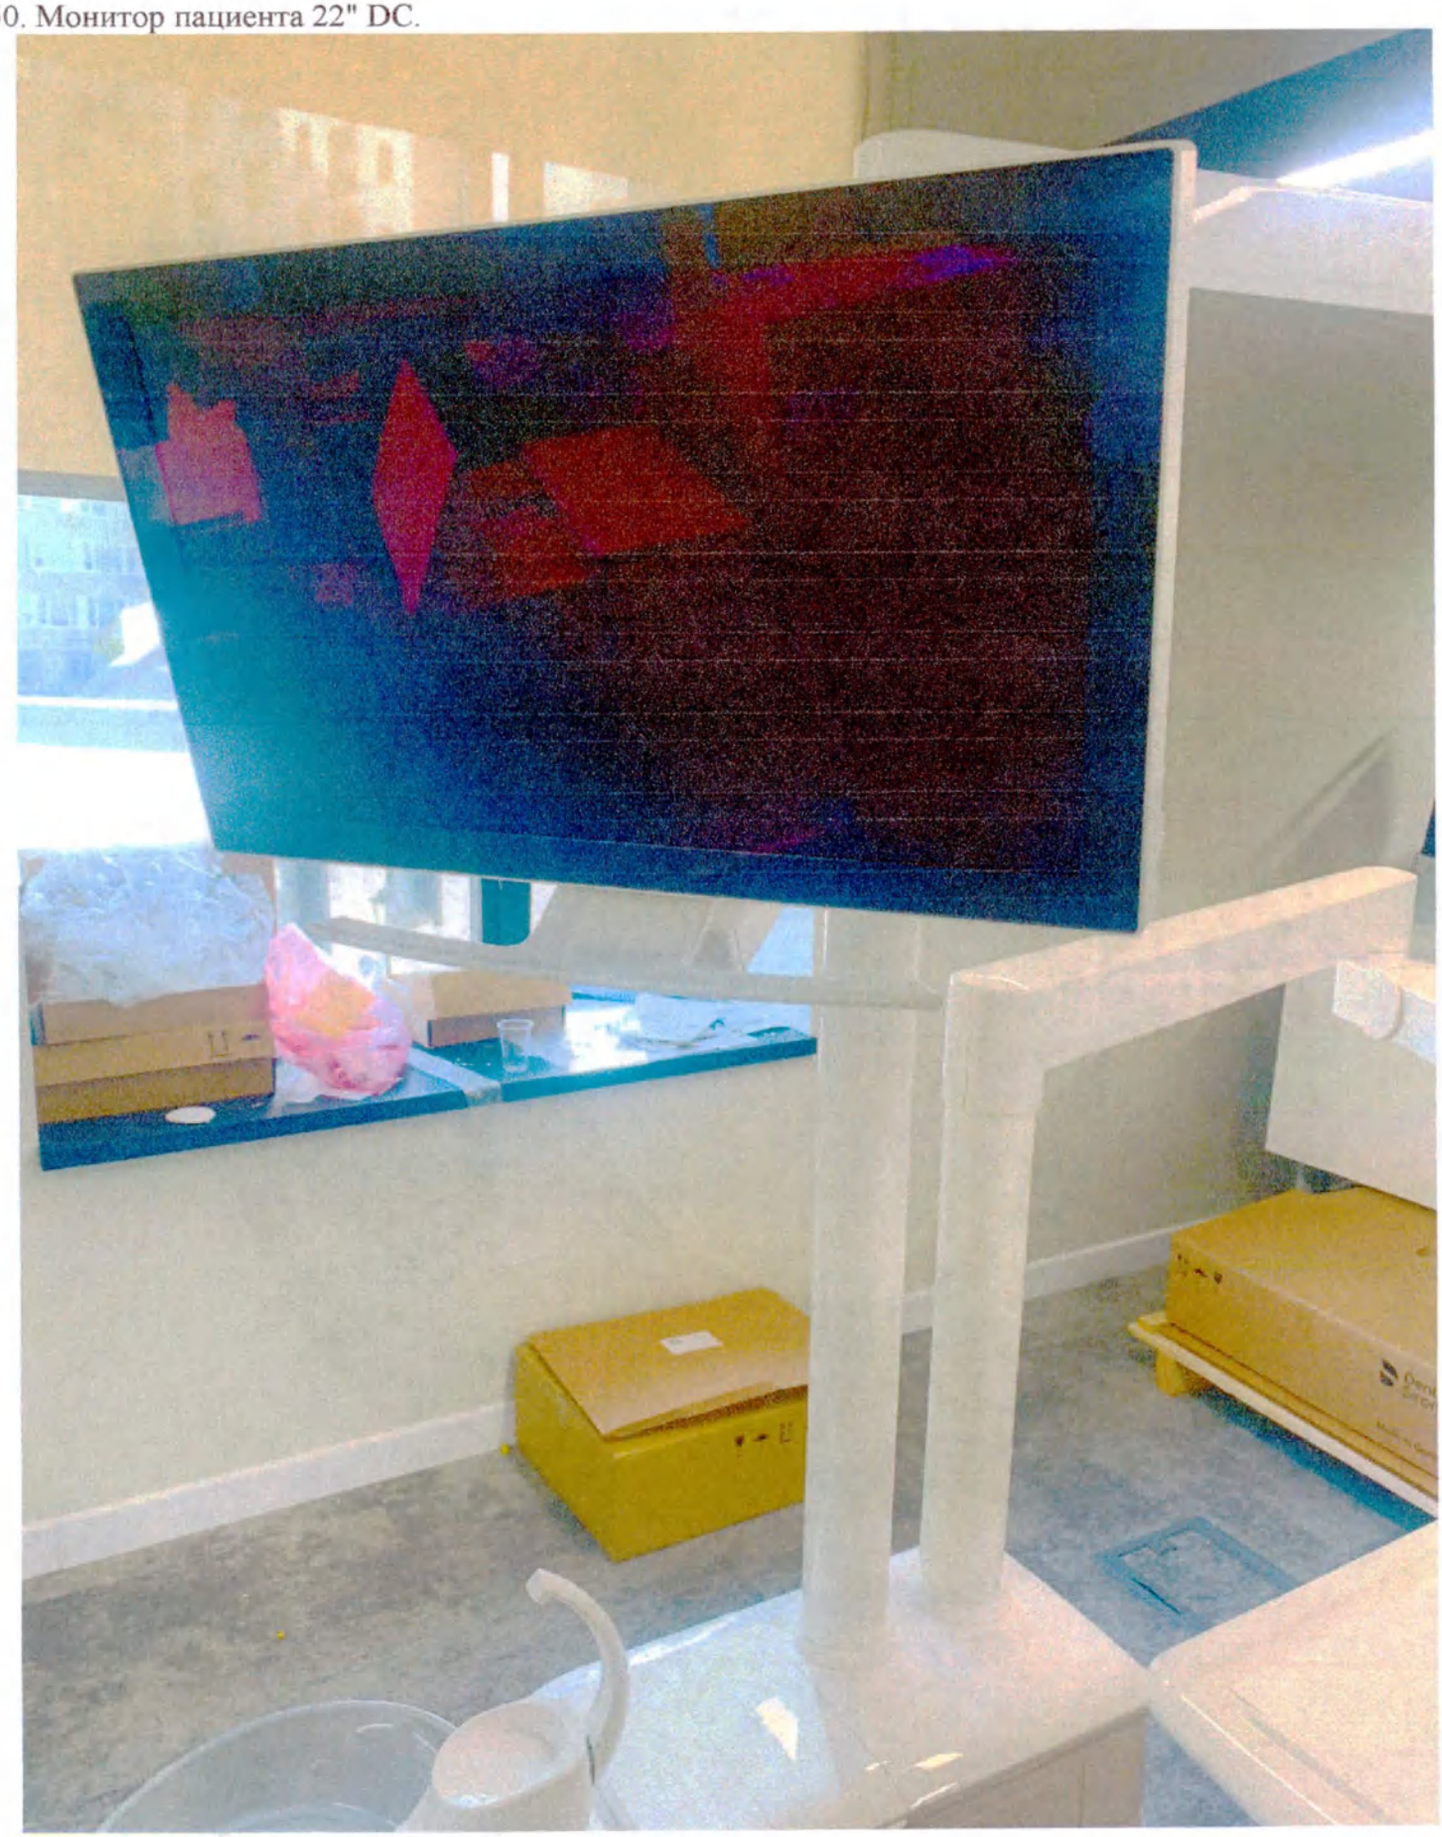

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

51. Комплект кабелей для HDMI подключения системы SIVISION.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

52. Консоли и опоры: Опора (A) для крепления консоли рабочего светильника или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus или консоли рабочего светильника и монитора или консоли рабочего светильника и консоли HELIODENT Plus и монитора; Консоль для крепления рабочего светильника (B); Консоль для крепления лотка или лотка и монитора (C).

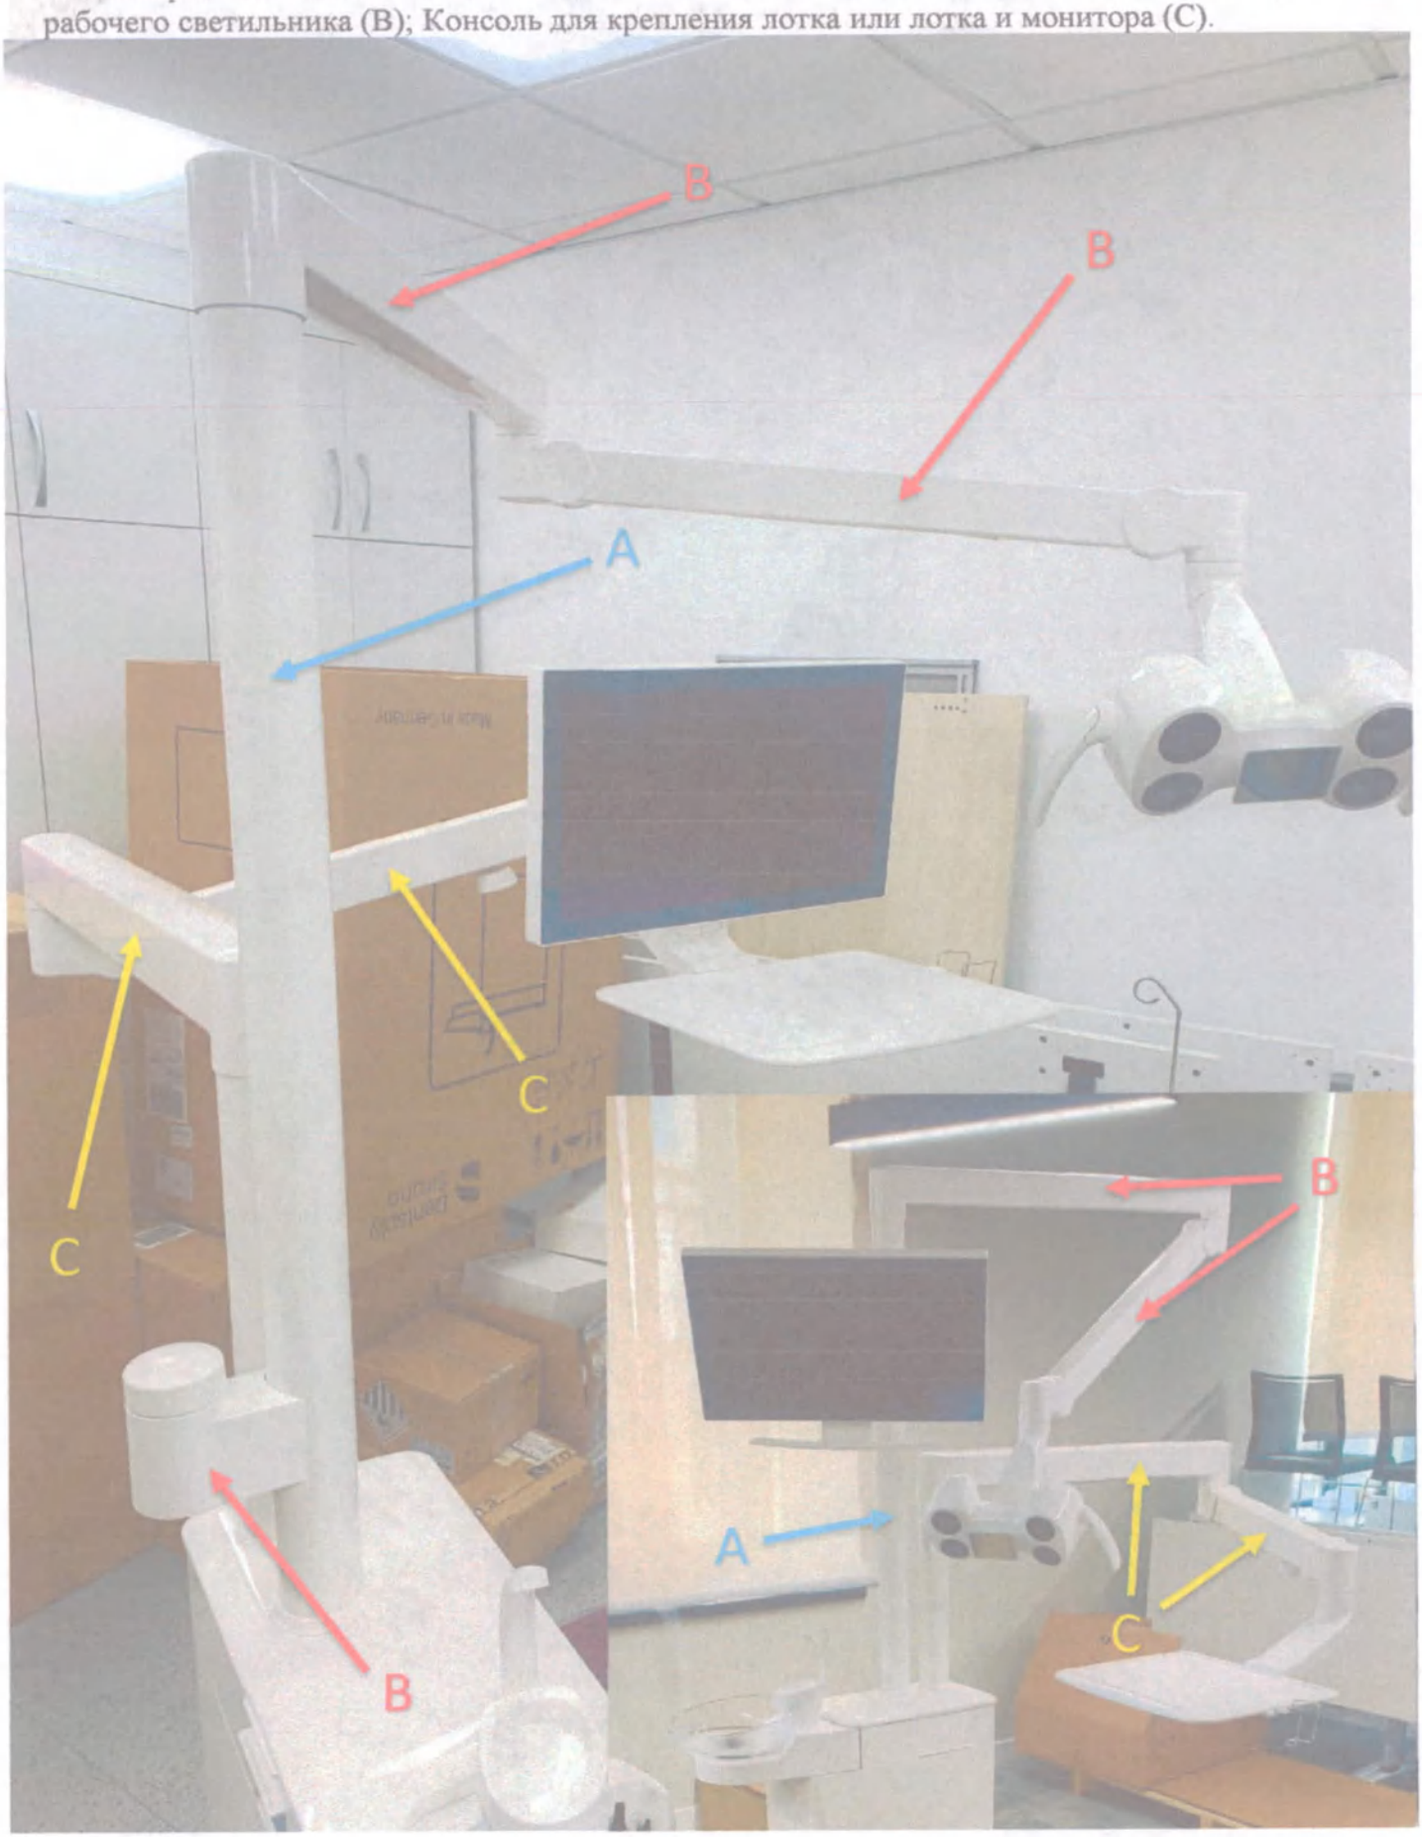

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

53. Стоматологические рабочие кресла
вариант исполнения Hugo



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Theo



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Carl




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

вариант исполнения Paul




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


54. Программное обеспечение Sidexis 4 на электронном носителе.

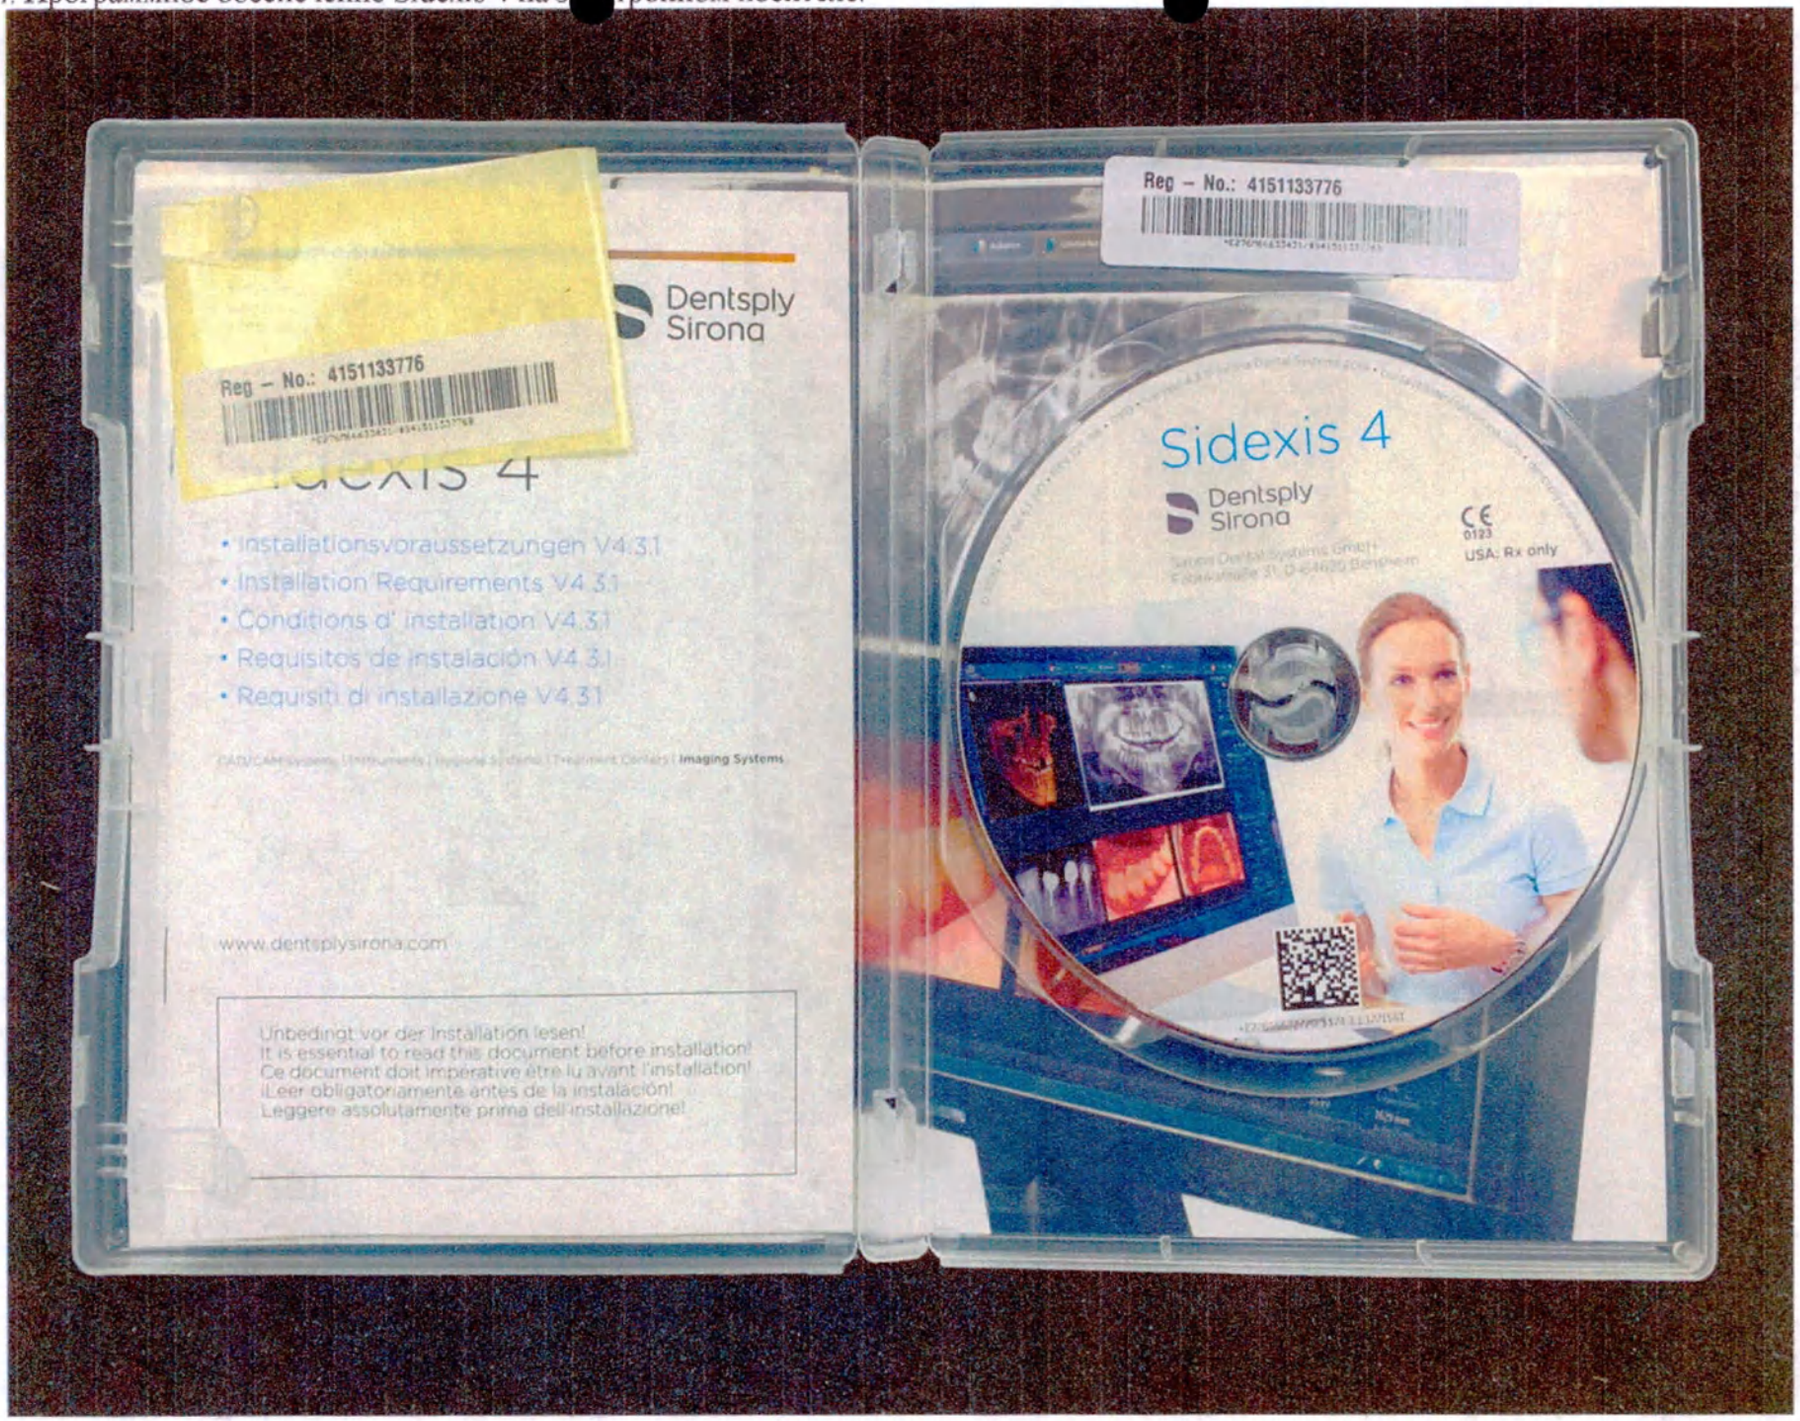

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


55. Лицензионный код для активации Sidexis 4.

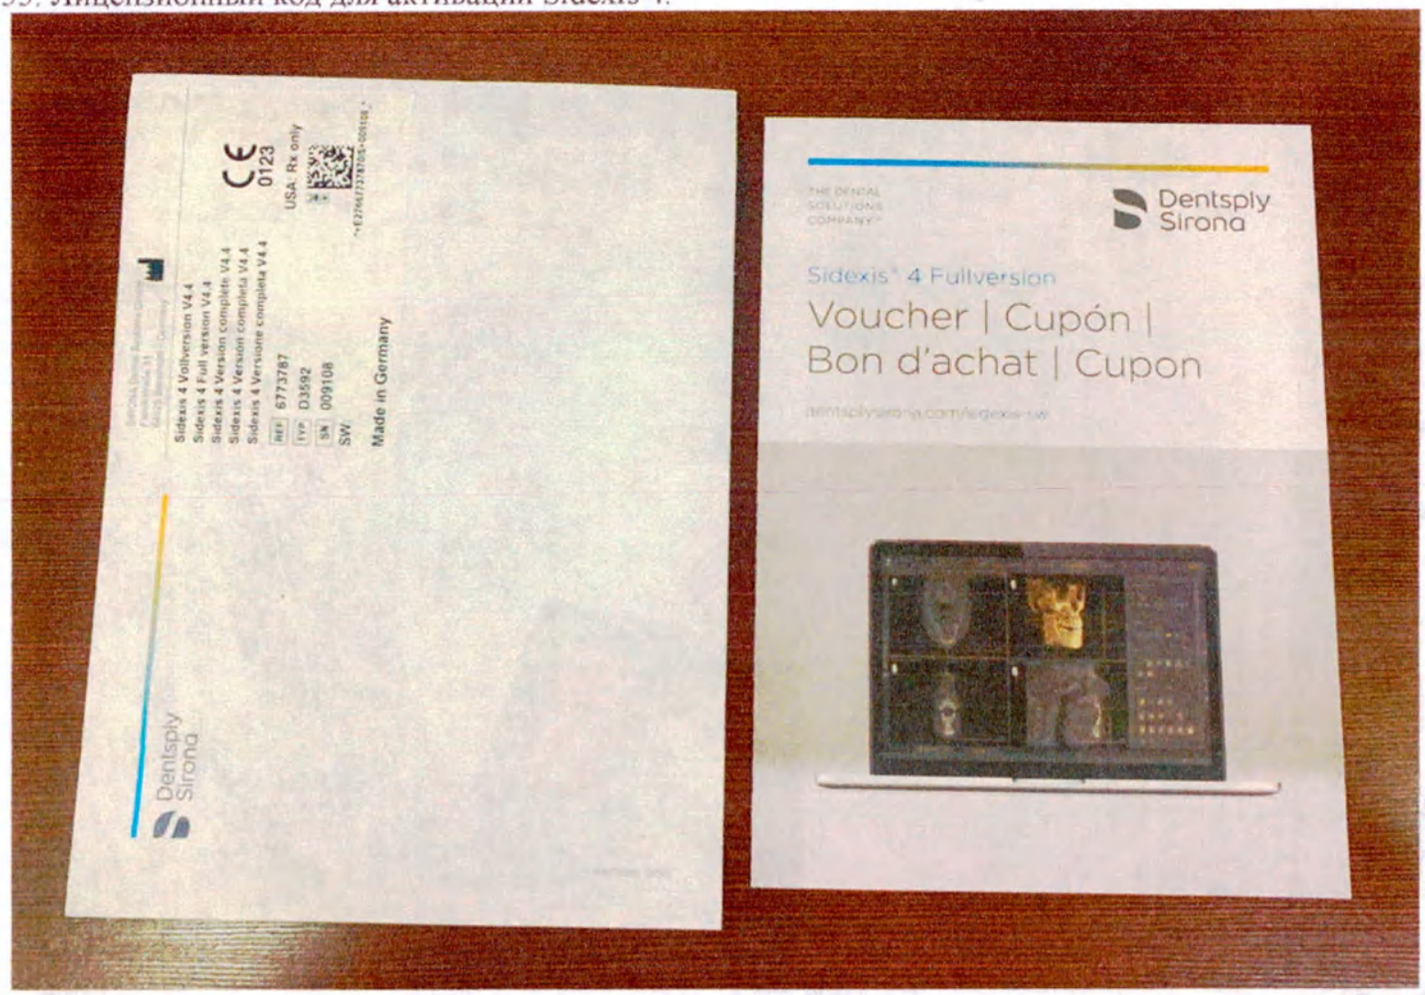

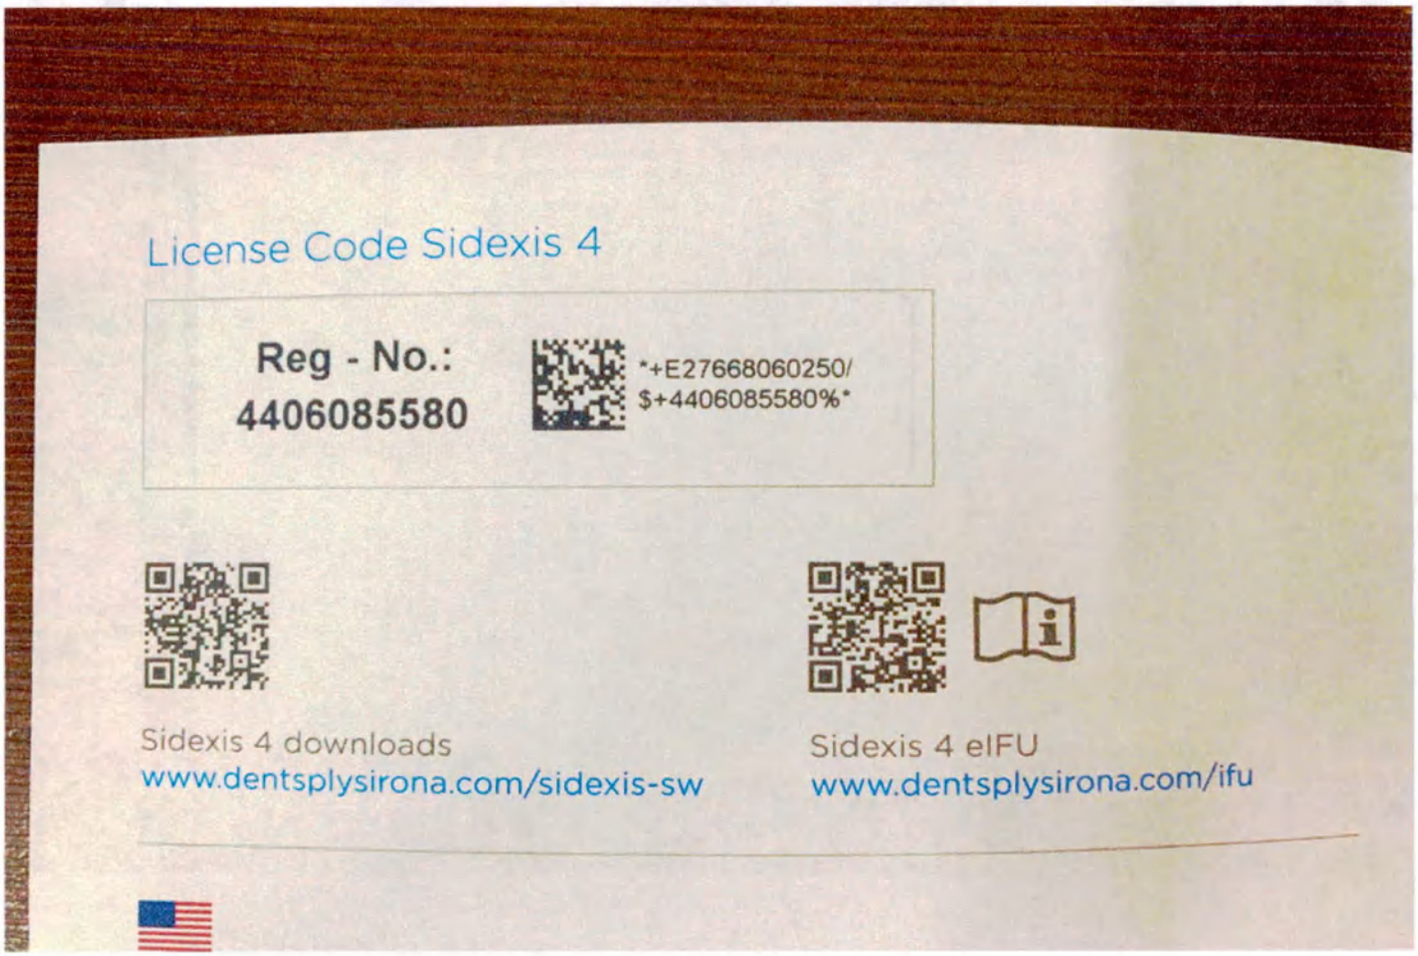

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

56. Элементы для инсталляции установки стоматологической.

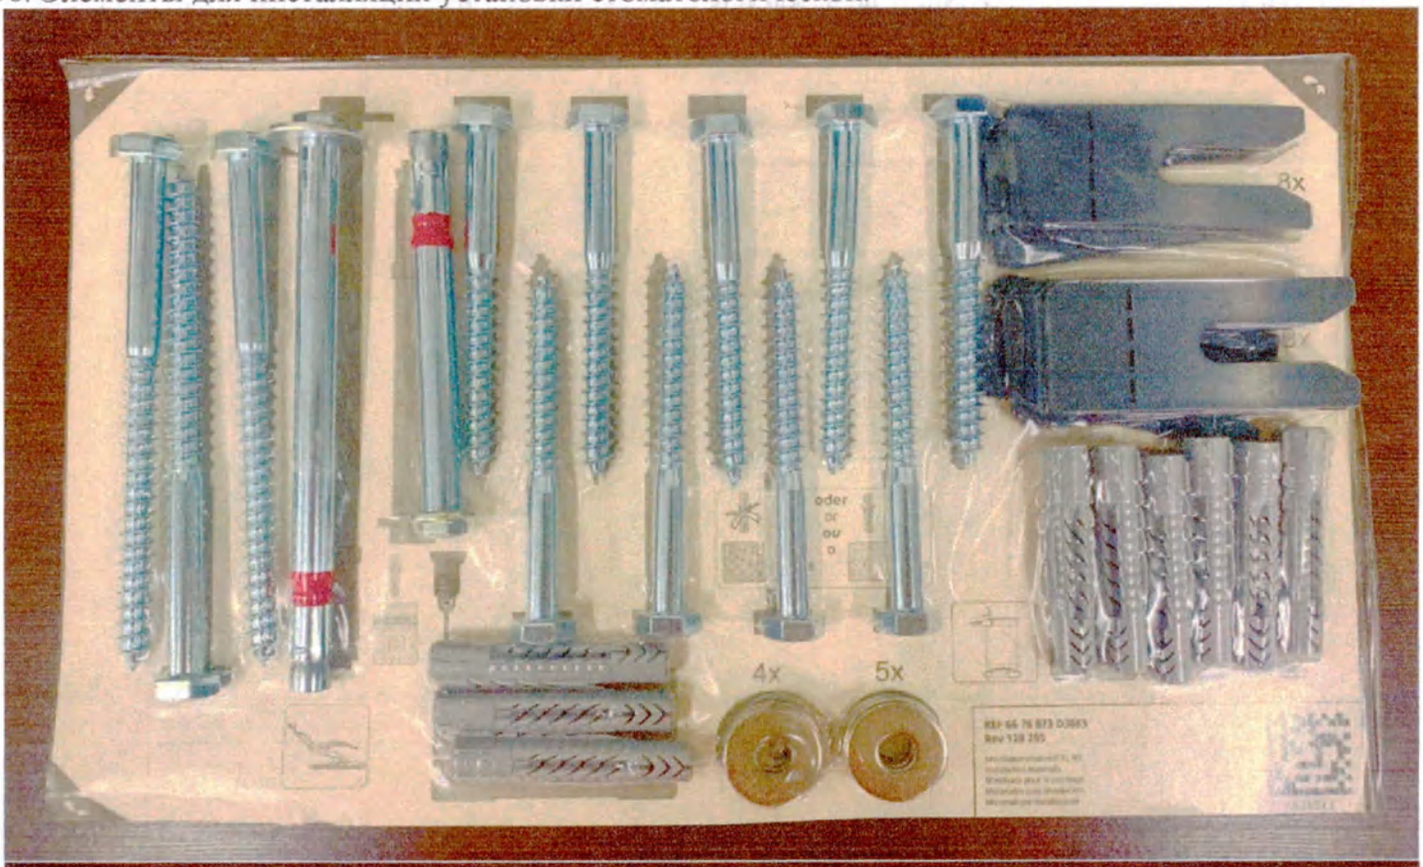



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

57. Эксплуатационная документация, загружаемая с сервера и/или на электронном носителе и/или на бумажном носителе, в составе:

57.1. инструкция по эксплуатации Treatment center, модель Axano Pure

Действует с: 2023-12


Dentsply Sirona

Treatment Center

Axano Pure

Инструкция по эксплуатации

Русский

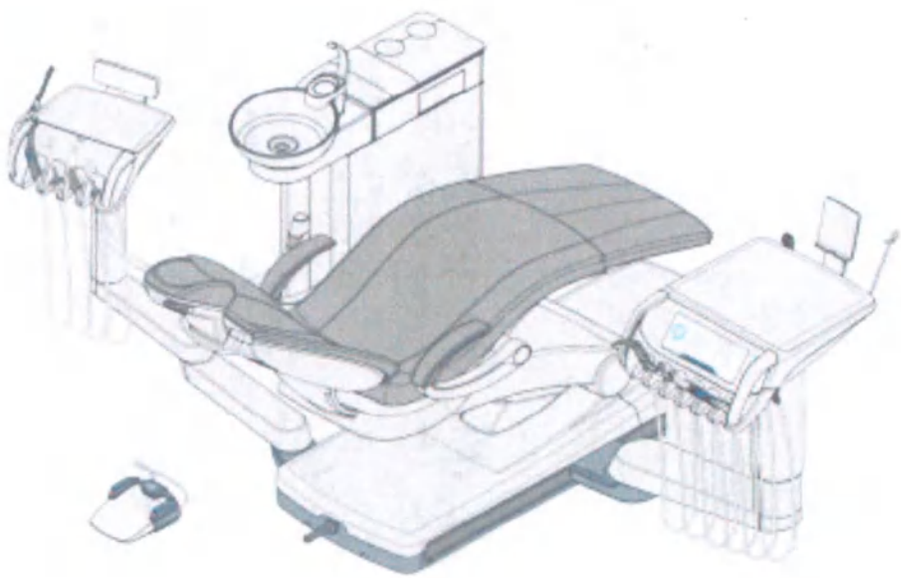

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Новый от: 03.2019

Dentsply Sirona

Hugo, Theo

Инструкция по эксплуатации

Русский



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Новый от: 06.2019

Dentsply Sirona

Carl, Paul

Инструкция по эксплуатации

Русский



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Действует с: 04.2021

Dentsply Sirona

LEDview Plus

Инструкция по эксплуатации

Русский

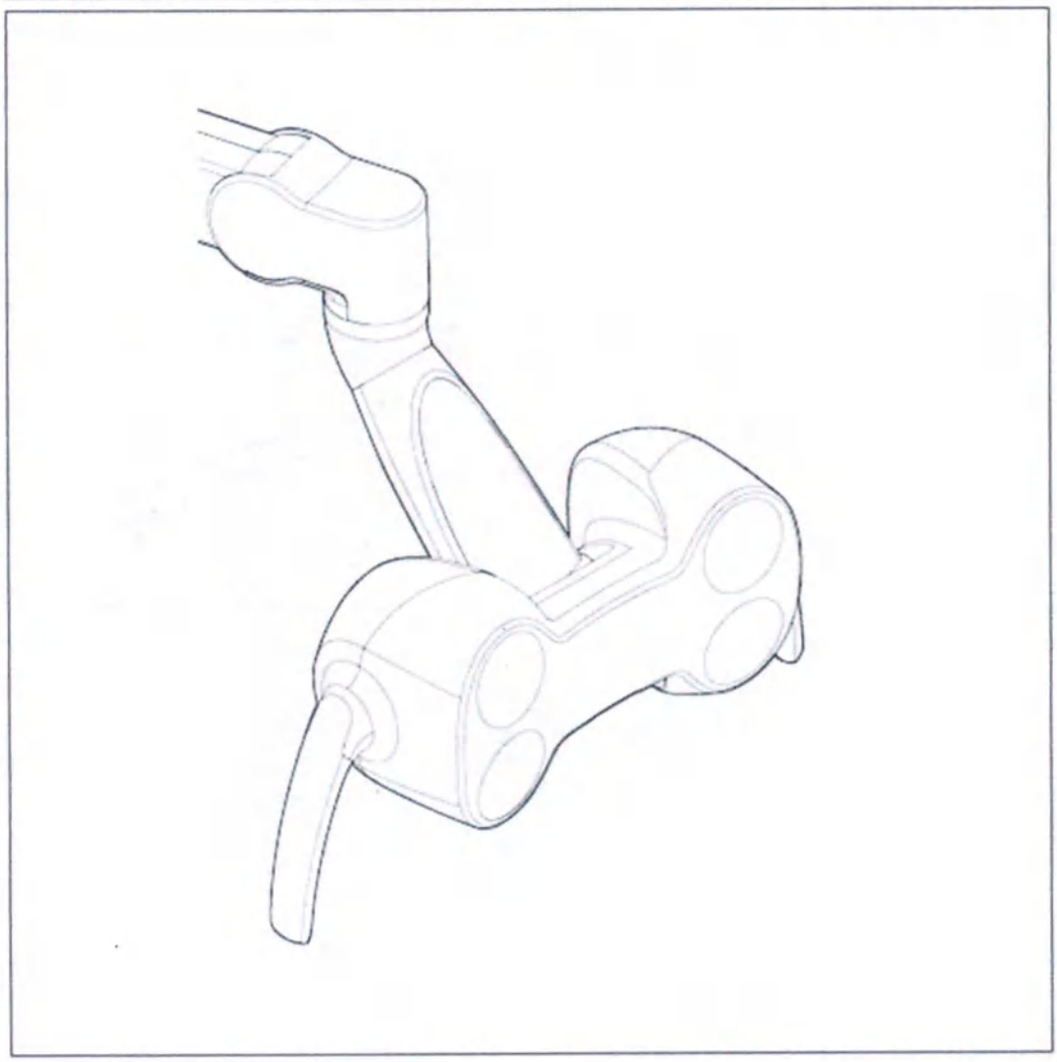

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Действует с: 03.2017


Dentsply Sirona

SIVISION digital

Инструкция по эксплуатации
22-дюймового монитора

REF 6497452 D3655
REF 6576248 D3678


Русский

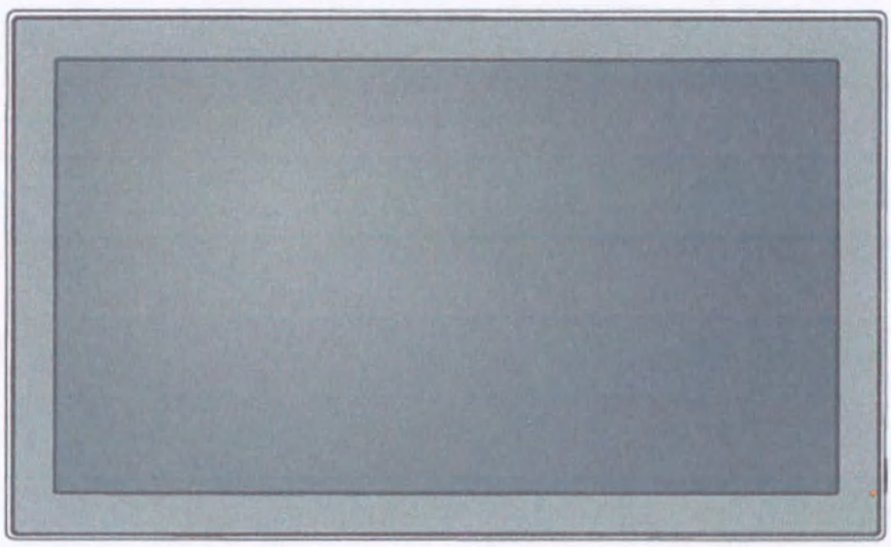

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SiroSonic/L/TL
PerioSonic

Dentsply Sirona

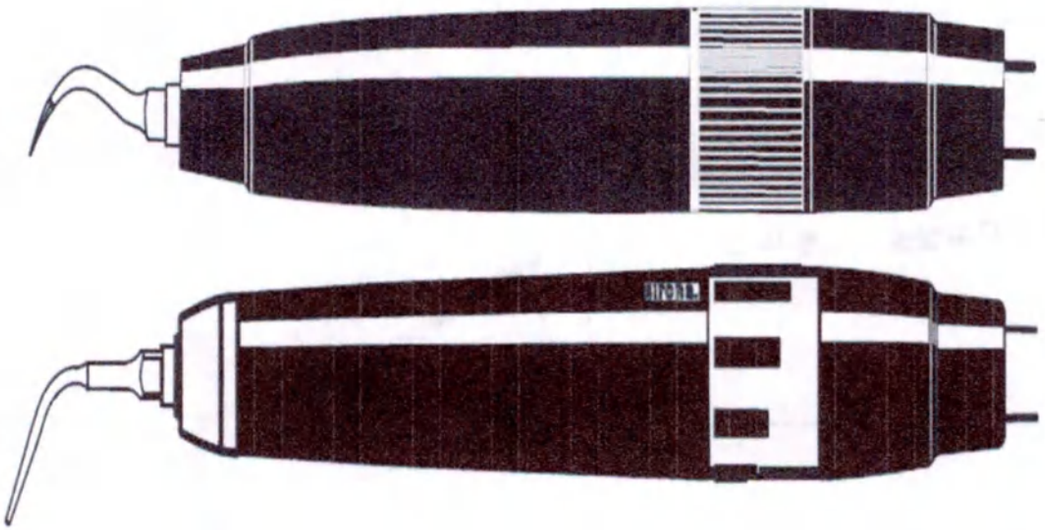

Русский

Инструкция по эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Dentsply Sirona



Русский

Endo 6:1

Инструкция по эксплуатации

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Новый от: 07.2017

sirona
The Dental Company

T1 CLASSIC / T1 LINE/ T2 LINE/ T3 LINE/ T4 LINE

Инструкция по эксплуатации

Русский

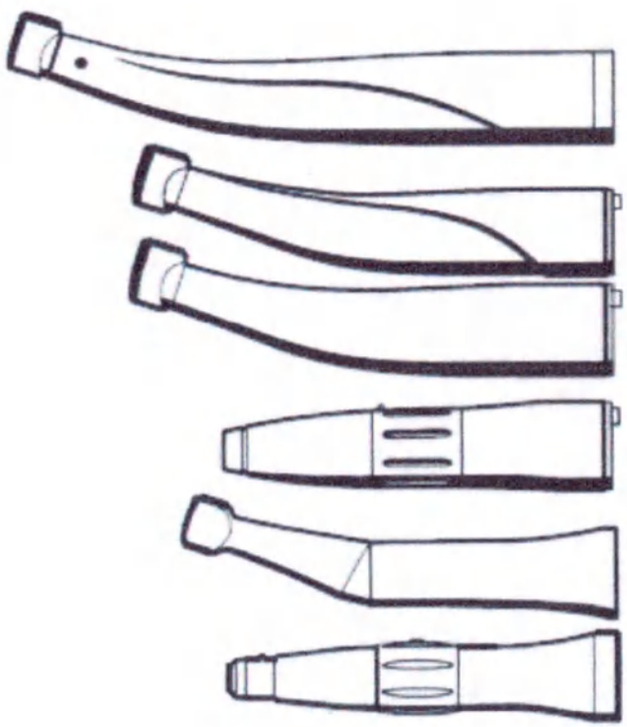

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Bien Air Dental

CA 20:1 L, CA 20:1
CA 20:1 L KM
CA 20:1 L Micro-Series
CA 20:1 L KM Micro-Series



РУС ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Другие языки доступны на https://dental.bienair.com/ru

CE 0123 Rx Only REF 2100209-0007/2022.03

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макеты маркировки на русском языке

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano:

Dentsply Sirona

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano

РУ № РЗН 2024/22588 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:
Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, тел.: +7 (495) 725 10 87

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure:

Dentsply Sirona

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure

РУ № РЗН 2024/22588 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:
Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, тел.: +7 (495) 725 10 87

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 91 лист (ов)

К.Г. Левин

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Дентсплай Сирона» Dentsply Sirona LLC МОСКВА

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО «Дентсплай Сирона»
115035, Москва, Овчинниковская
набережная, д. 18/1, стр. 2,
БЦ «Овчинниковский»
Тел.: +7 (495) 725-10-87
E-mail: CIS-Info@dentsplysirona.com

Dentsply Sirona

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»

_____ К.Г. Левин

"15" октября 2024 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/23 ОТ 22.06.2023

ДИРЕКТОР
ПО РЕГИСТРАЦИИ,
СНГ
ХАИНДРАВА В.Г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ
медицинского изделия на русском языке

«Установка стоматологическая Treatment center,
модель Axano; модель Axano Pure.»,

производства Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ), Германия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano:

Dentsply Sirona

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano

РУ № РЗН 2024/22588 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:
Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, тел.: +7 (495) 725 10 87

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure:

Dentsply Sirona

Установка стоматологическая Treatment center, модель Axano Pure

РУ № РЗН 2024/22588 от XX.XX.202X

Информация о технике безопасности и использовании по назначению представлена в инструкции по эксплуатации. Информация об условиях транспортировки и хранения представлена на упаковке и в инструкции по эксплуатации.

Производитель:
Sirona Dental Systems GmbH
(Сирона Дентал Системс ГмбХ)
Fabrikstr. 31, 64625 Bensheim,
Germany (Германия)

Уполномоченный представитель:
ООО «Дентсплай Сирона»
Россия, 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н, тел.: +7 (495) 725 10 87

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU