ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЕЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Анализатор гематологический оптический careSTART™ S1»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Рисунок 1. Общий вид МИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 2. Анализатор гематологический оптический careSTART™ S1 (вид сверху)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

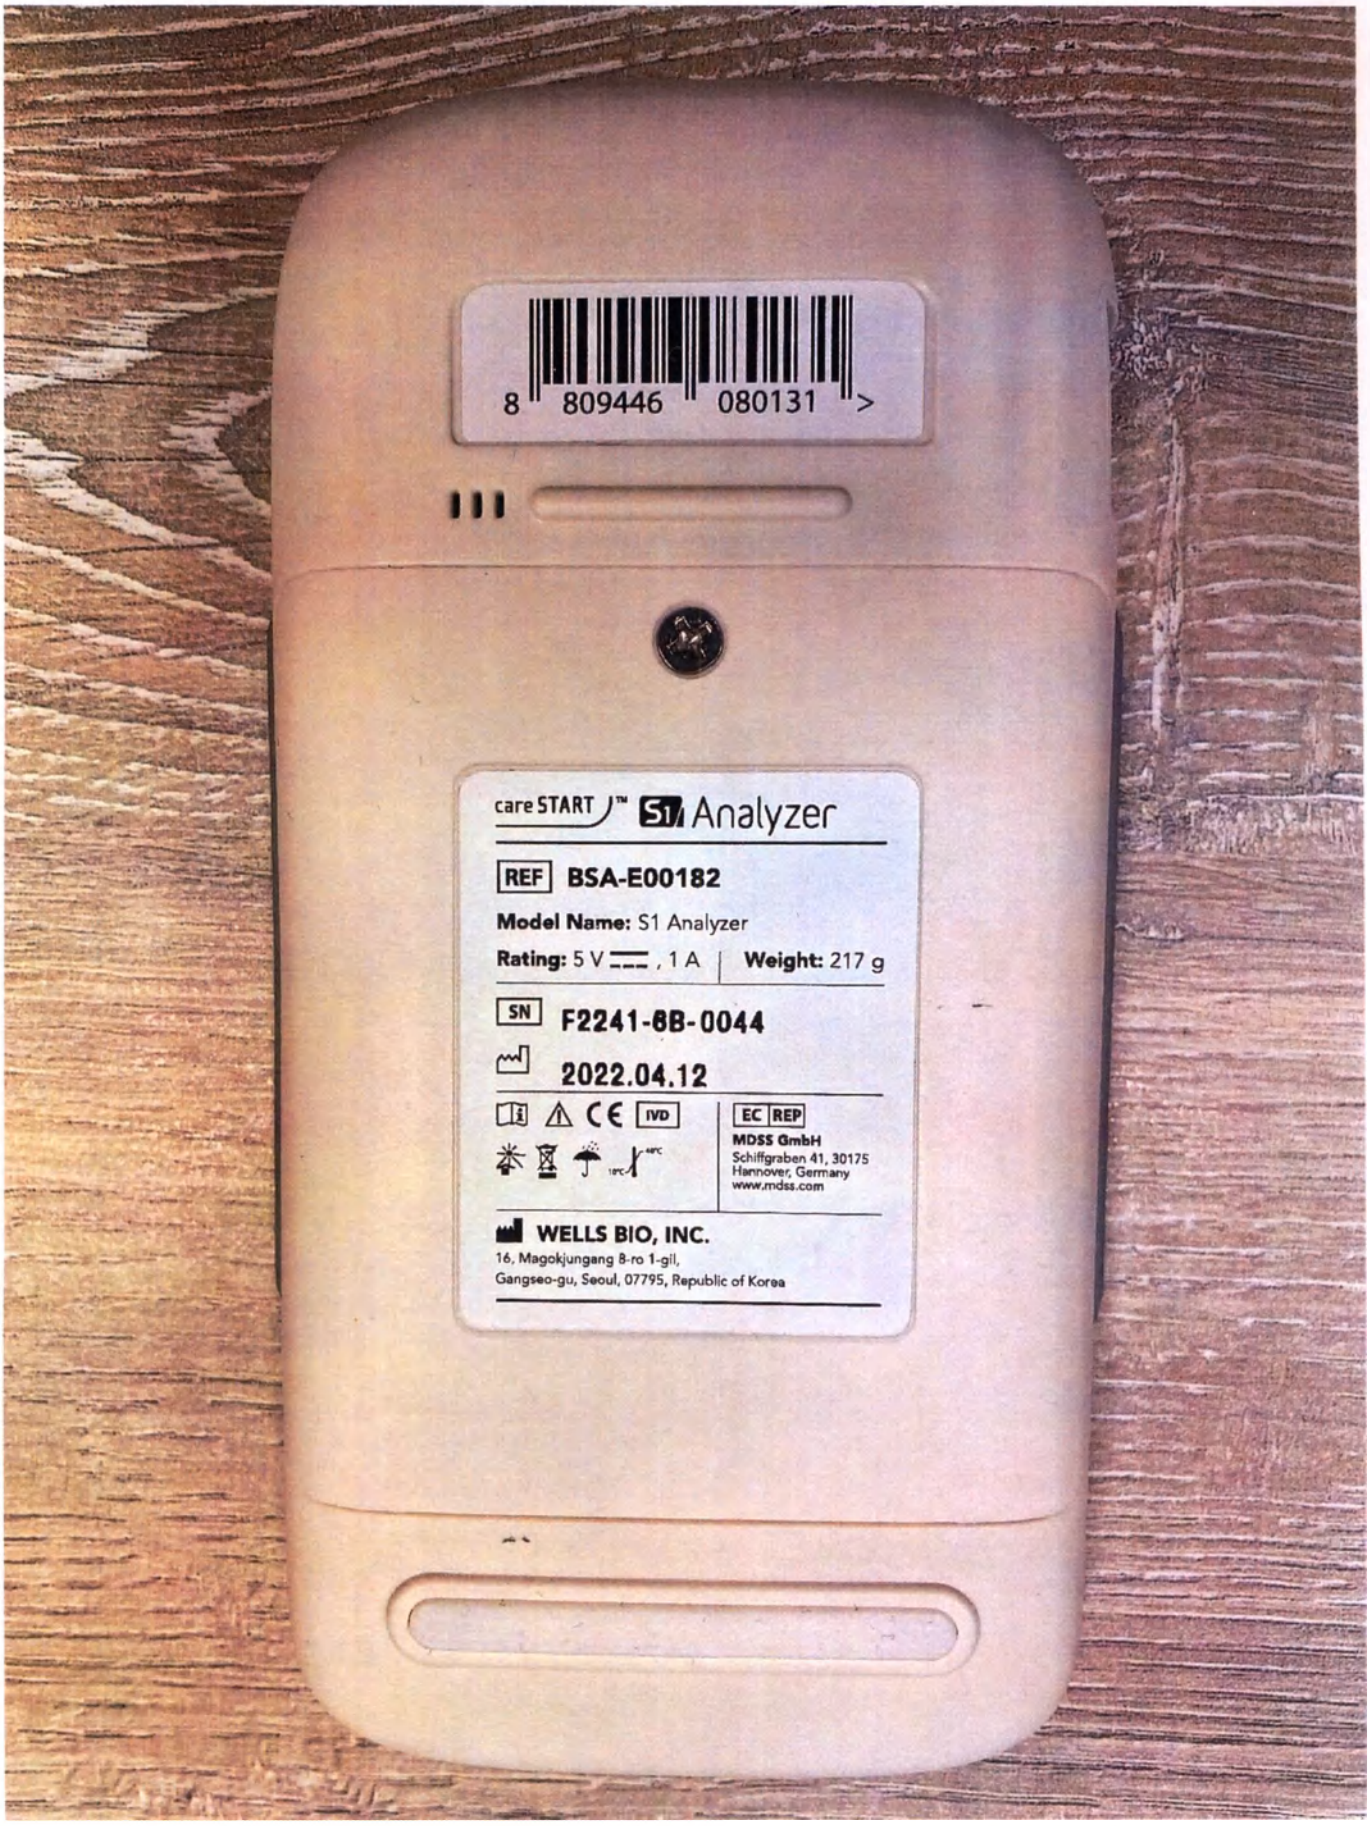


Рисунок 3. Анализатор гематологический оптический careSTART™ S1 (вид снизу)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 4. Анализатор гематологический оптический careSTART™ S1 (вид сбоку)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

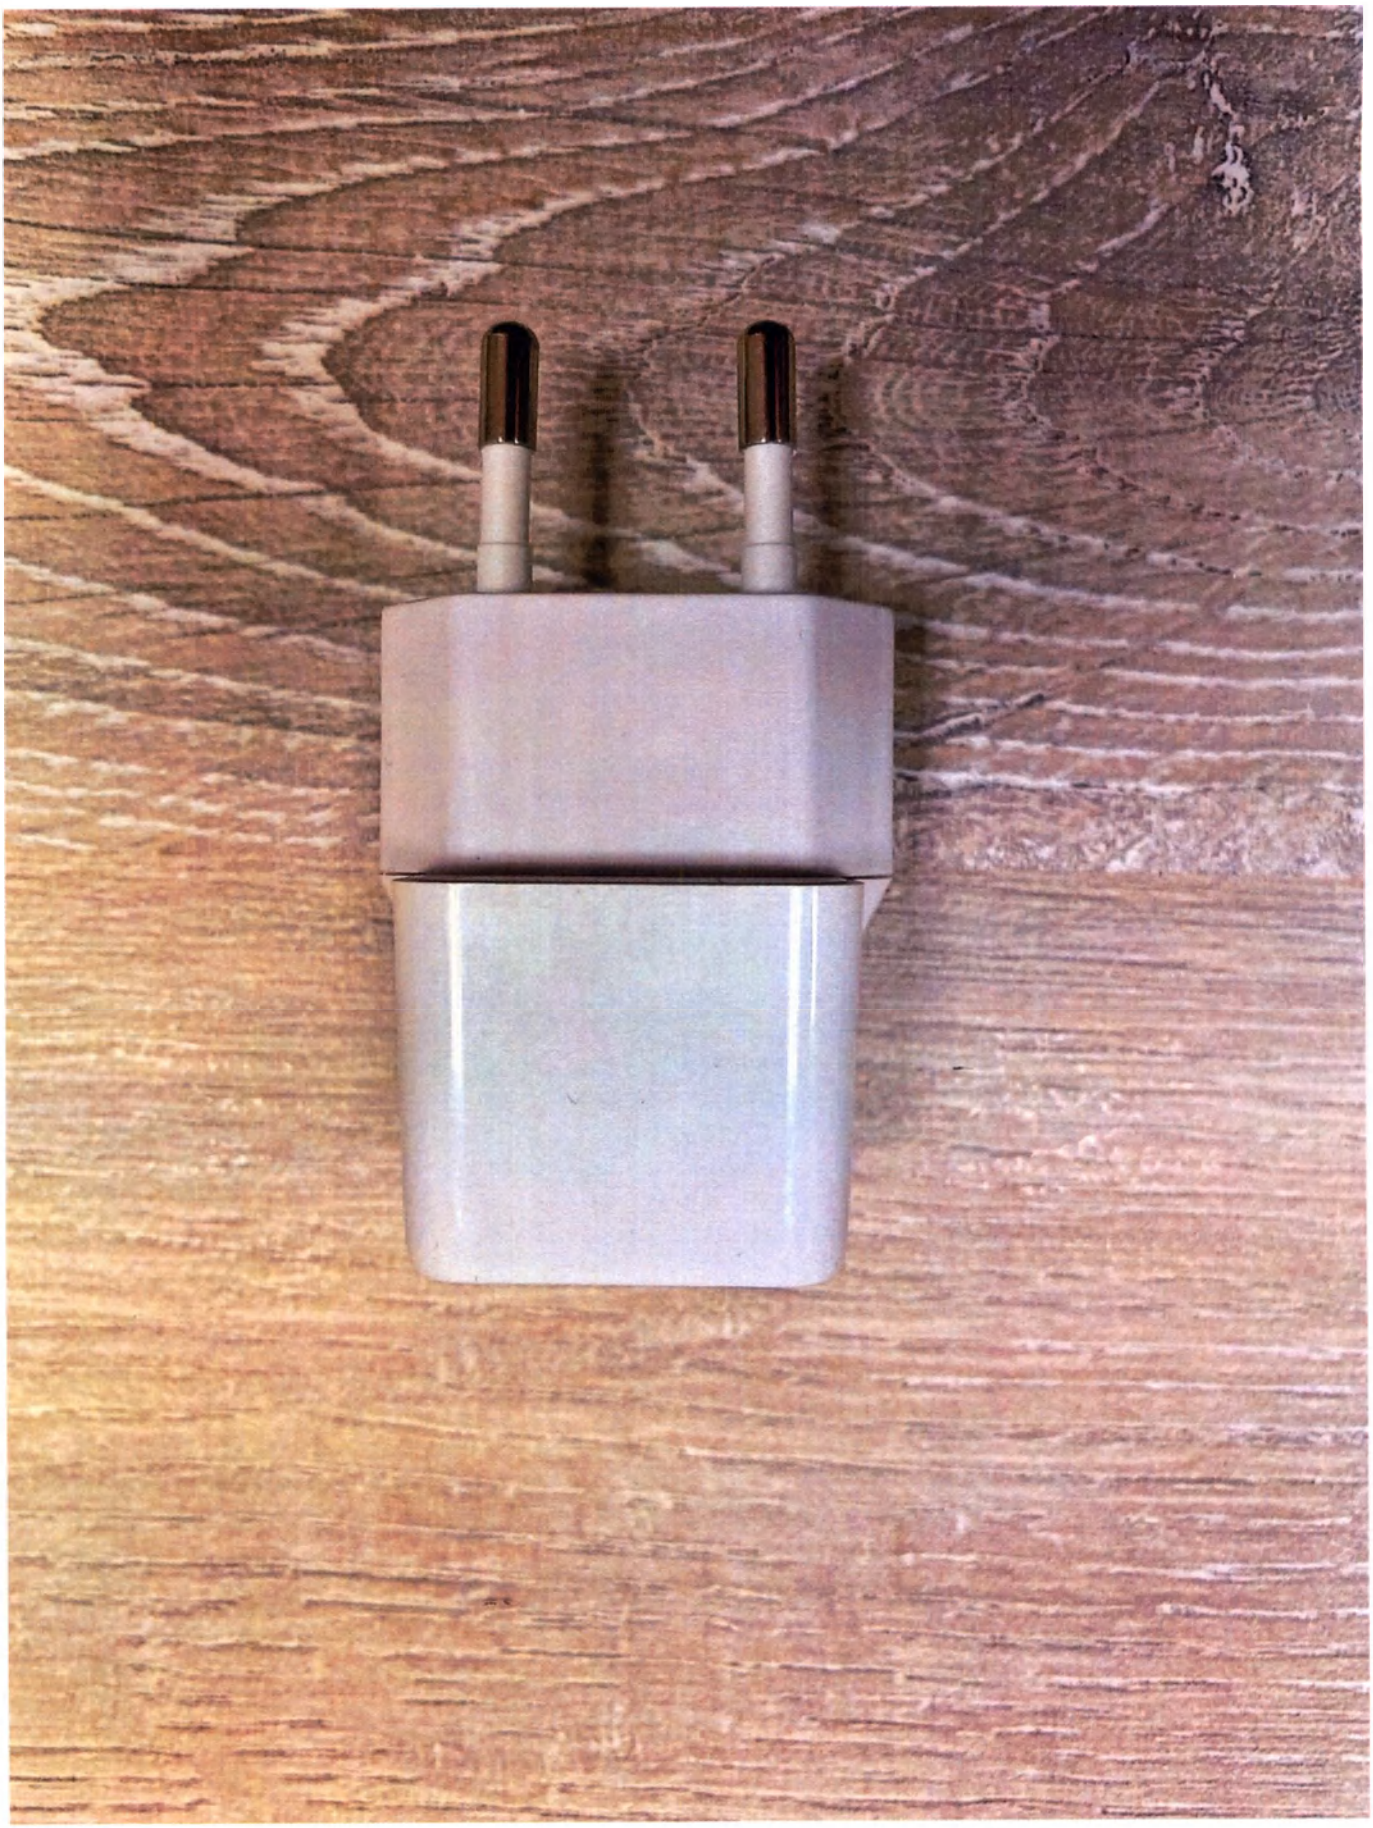


Рисунок 5. Сетевое зарядное устройство

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

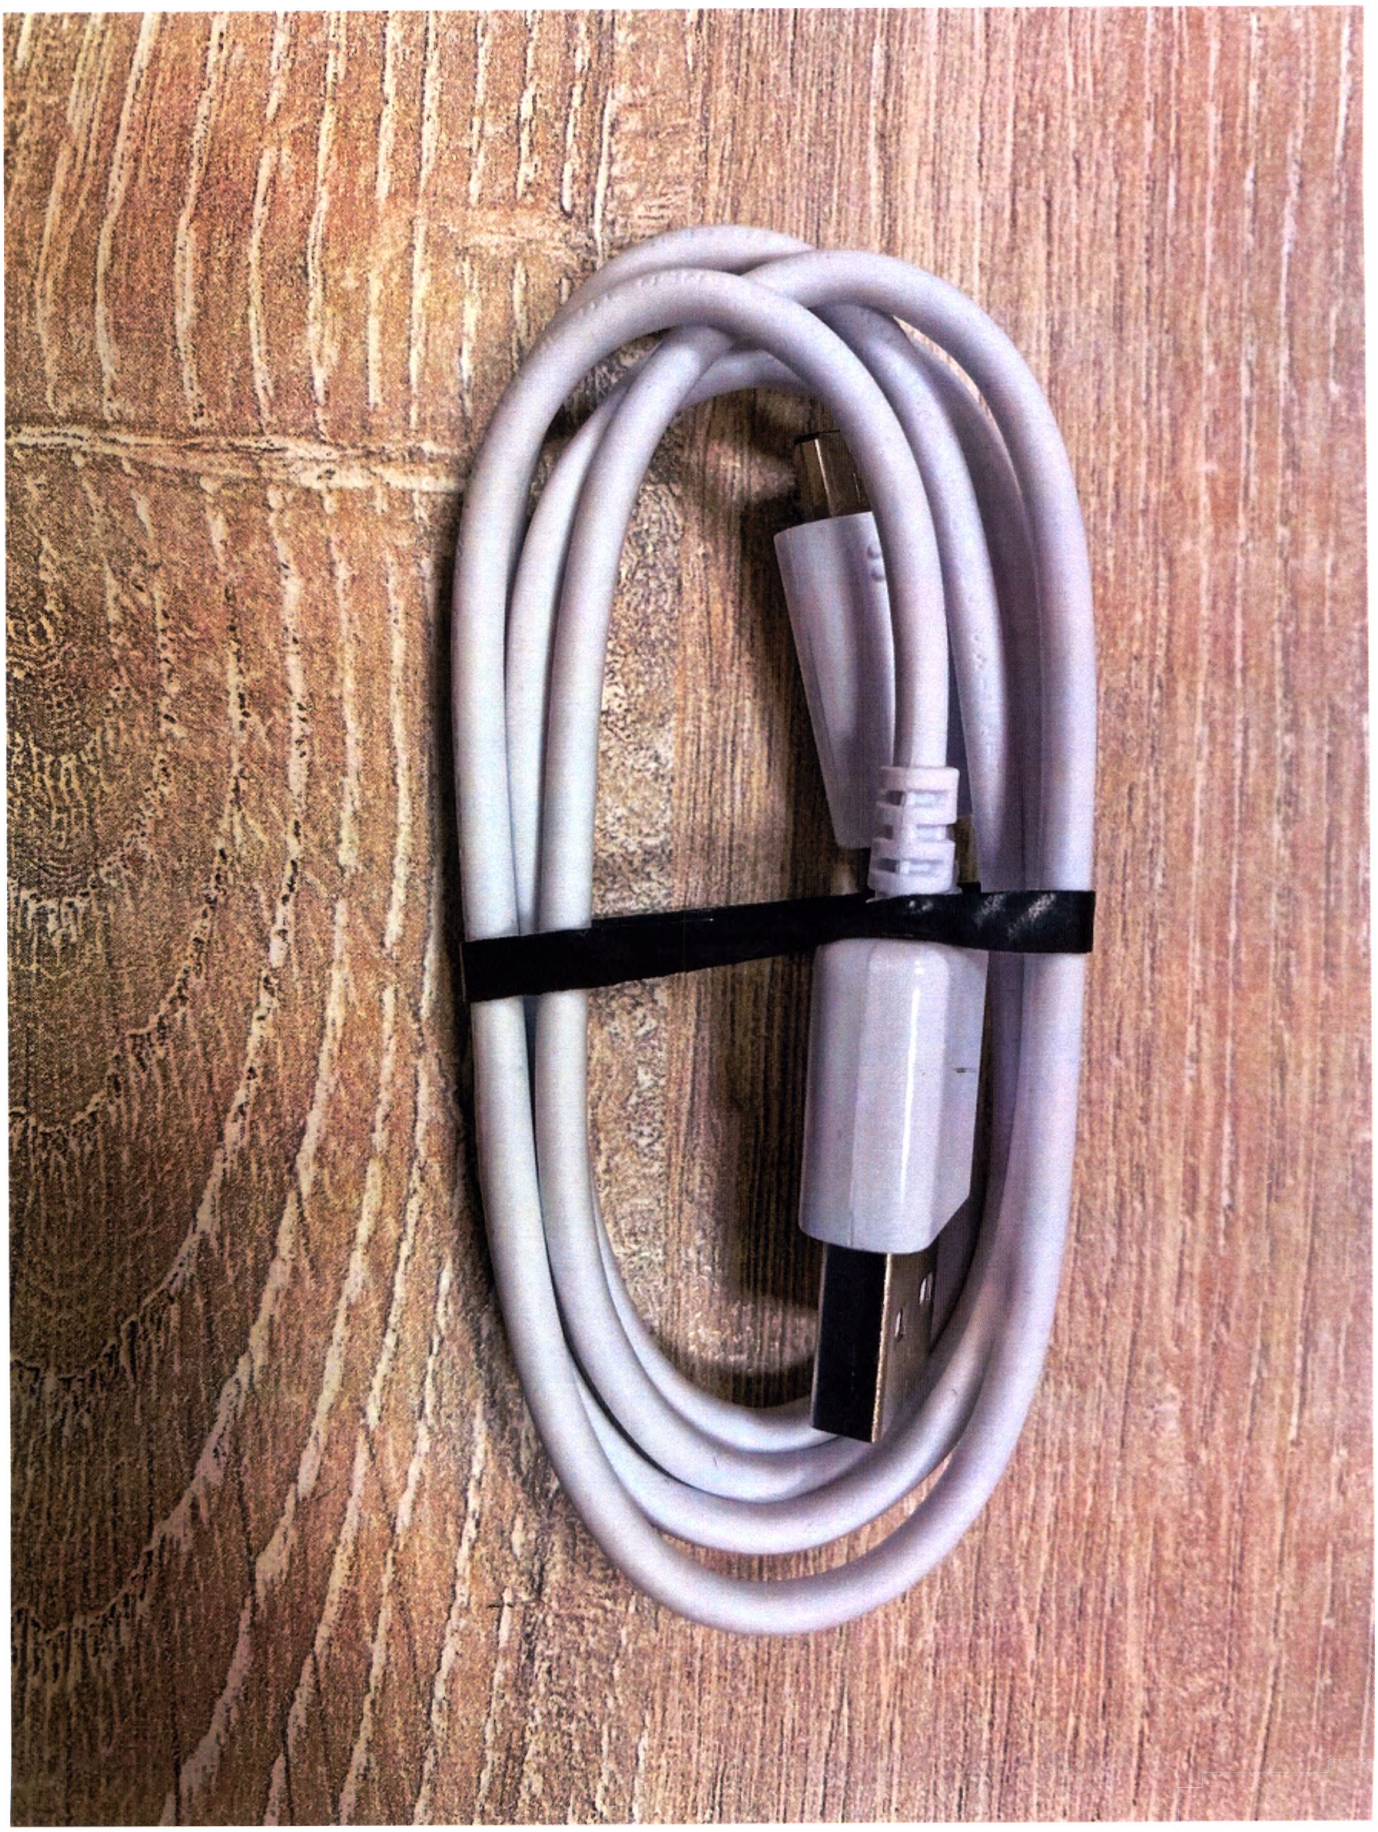


Рисунок 6. Кабель питания и данных

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

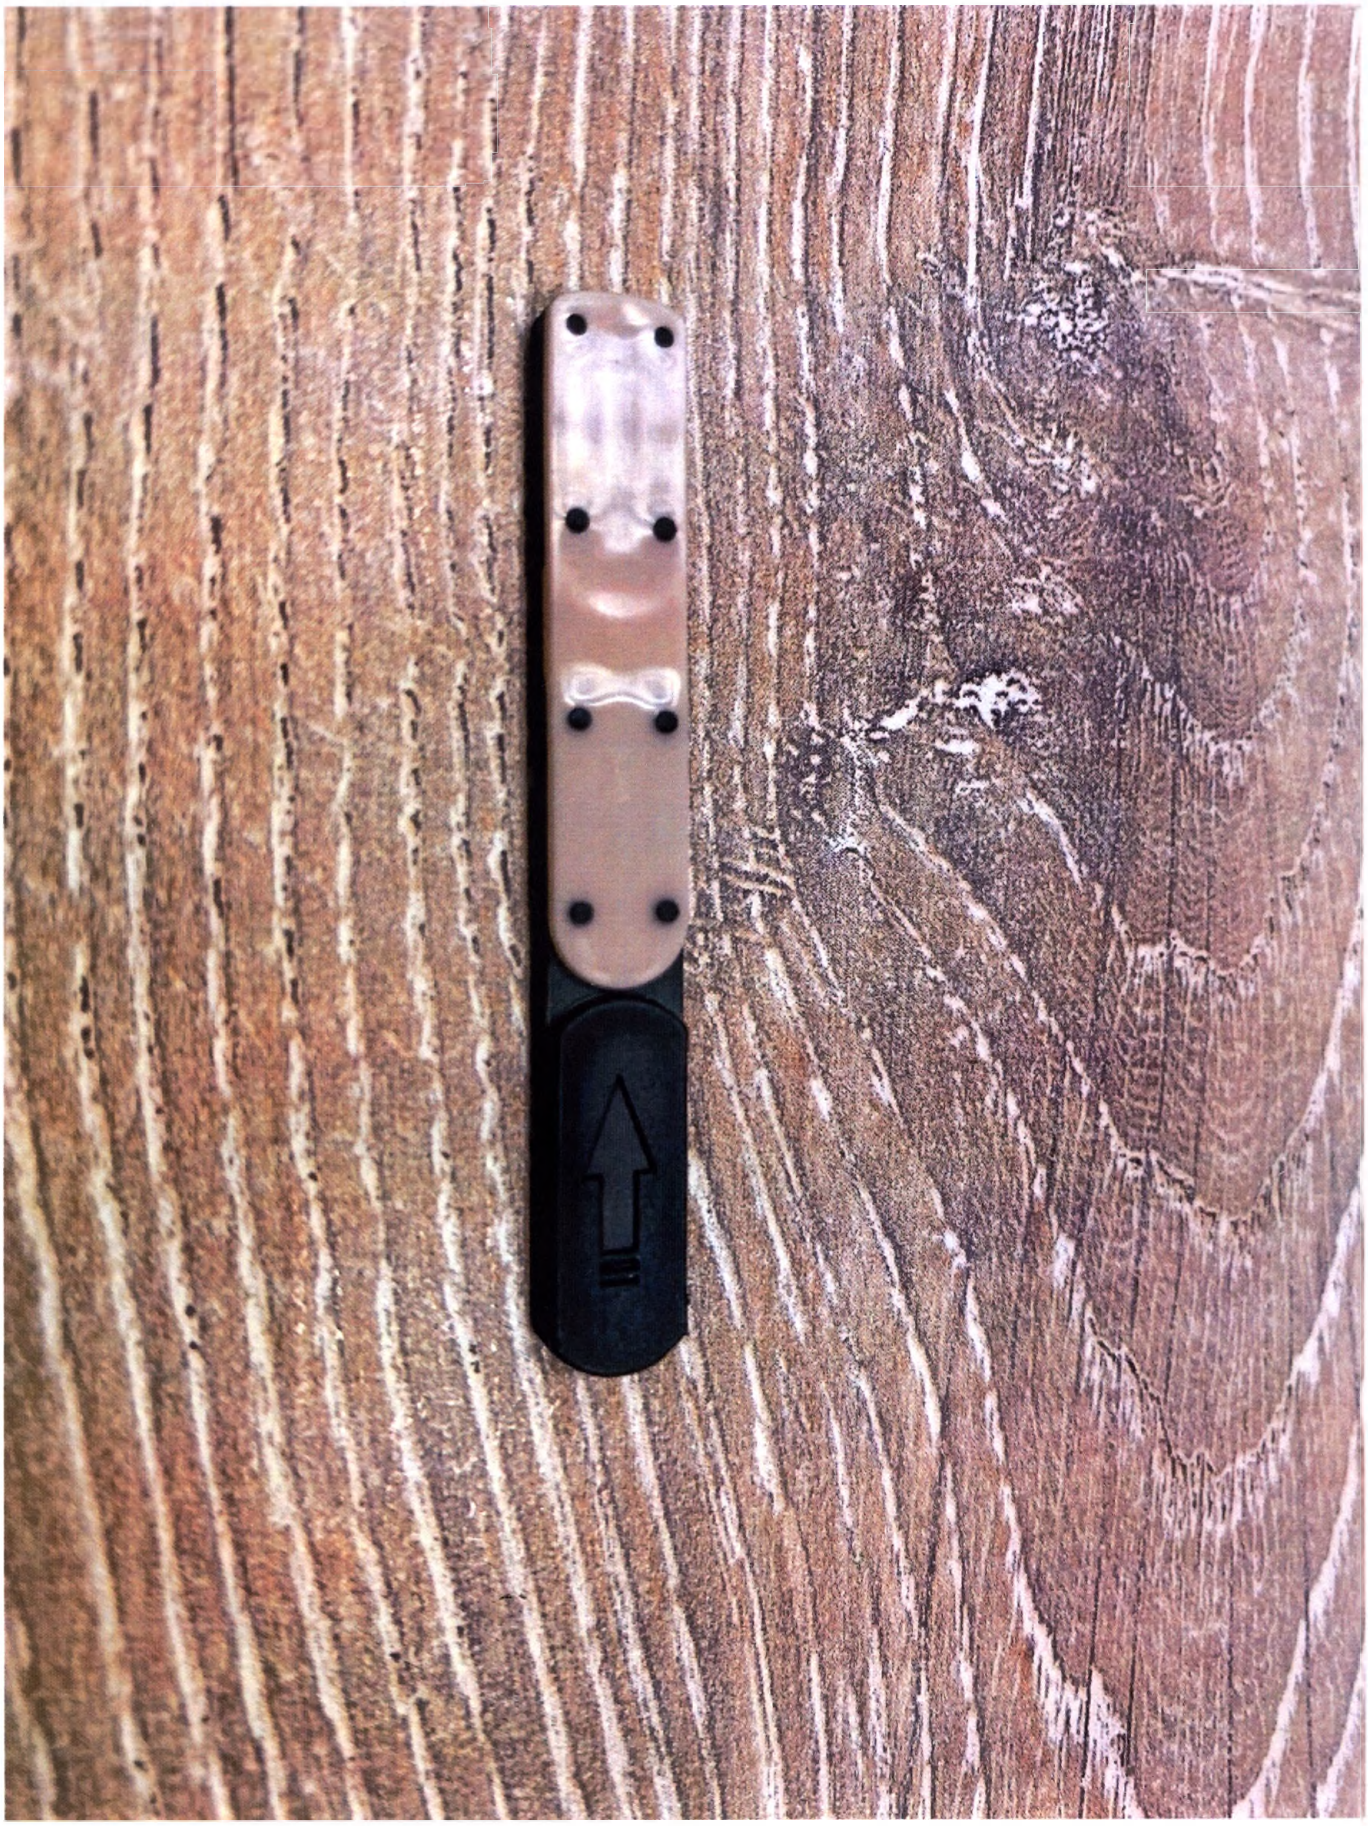


Рисунок 7. Контрольная полоска для анализатора S1 для порта оптического датчика

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 8 Упаковка Анализатора гематологического оптического careSTART™S1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

количество листов 9 (девять)

_____ /Ногин Д.Н./

Подпись ФИО

Генеральный директор ООО «Смарт Медика»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU