УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Дентал-Ист»
_____ А.Н. Афанасьев
«09» ноября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million

2024 г.


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ


1. Зубы акриловые, вариант исполнения PX

1.1.Фронтальные зубы CROWN

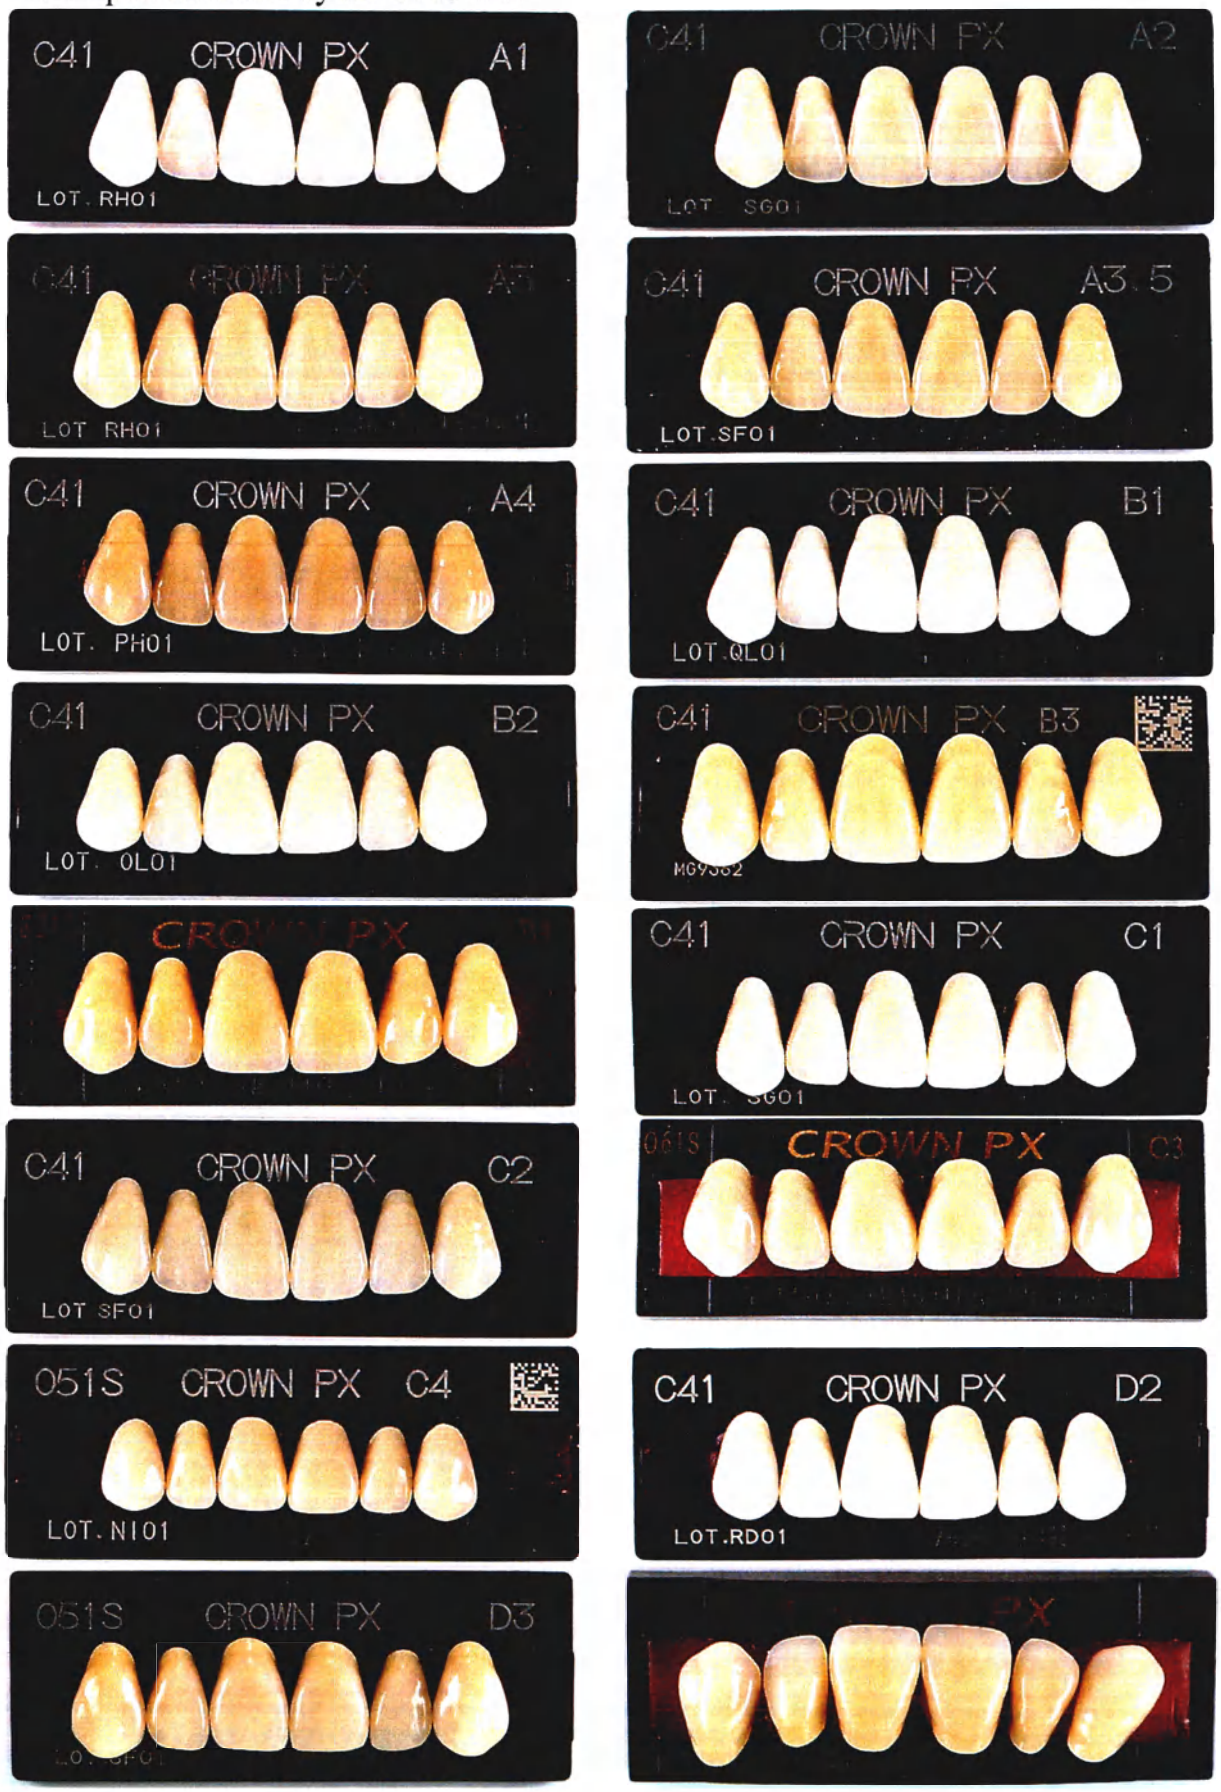


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

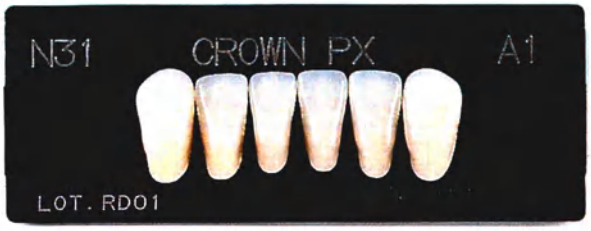


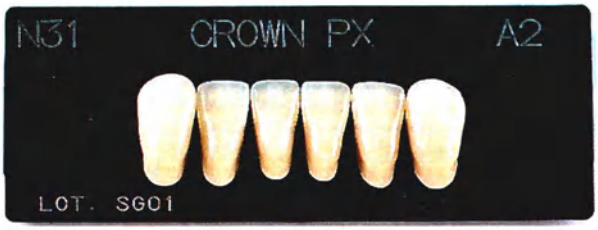





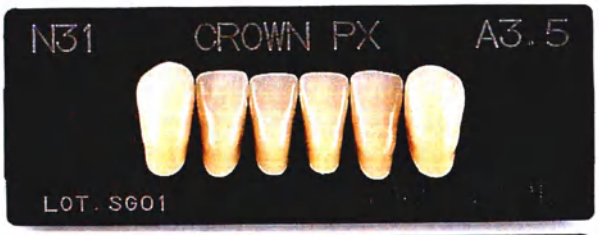





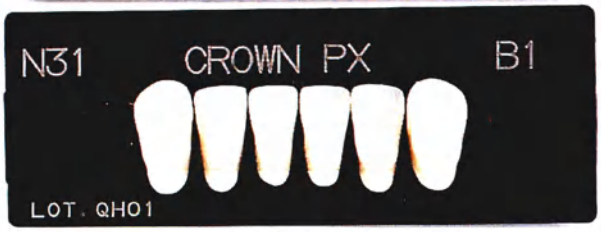

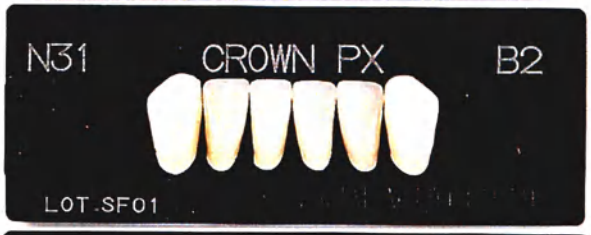


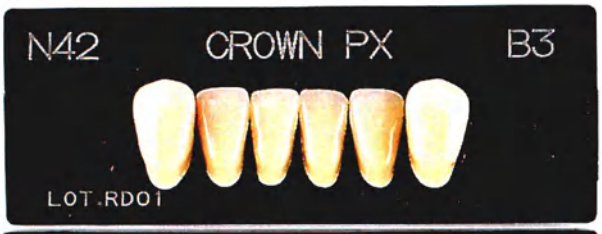


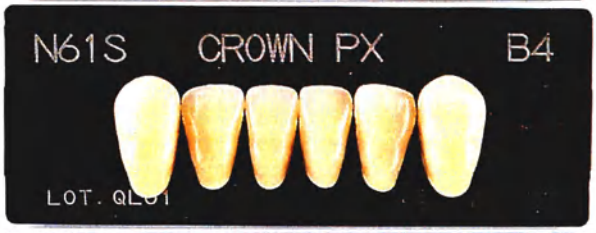


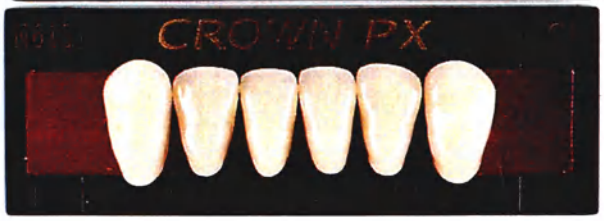





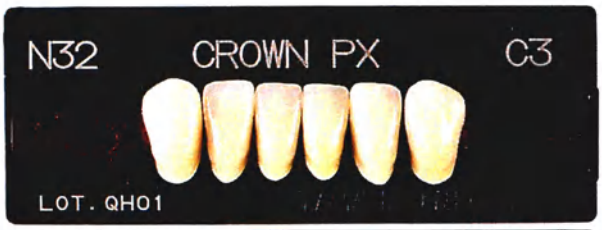

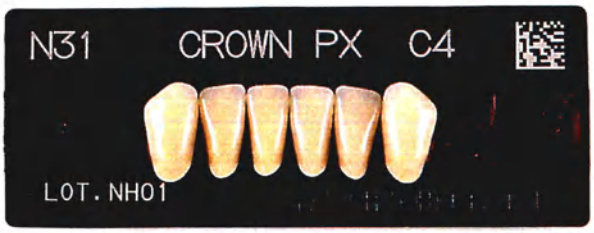

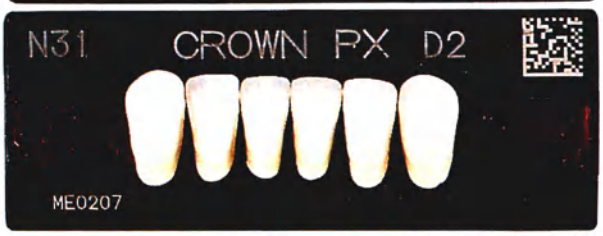

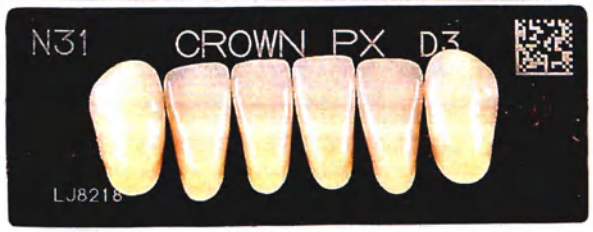

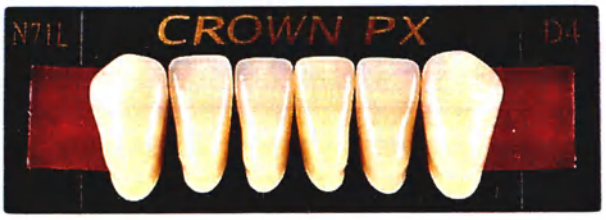


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



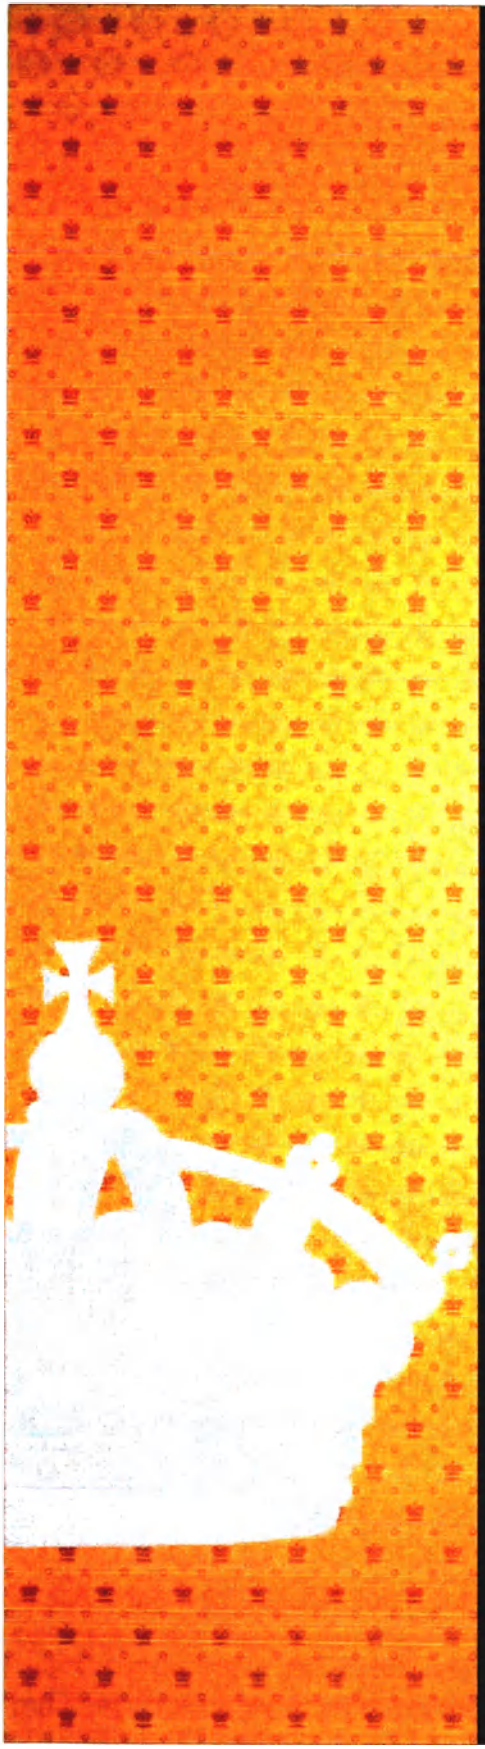

YAMAHACHI

Зубы акриловые
Crown PX
из композитной пластмассы
Фронтальные трёхслойные

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

В коробке
16 планок
На планке
6 зубов

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе,
д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16.
сайт: www.dental-east.ru e-mail: Sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:
•Рекомендуемая температура окружающей среды
при использовании 23°С ± 1°С.
•Рекомендуемая влажность окружающей среды
при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

•Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C.
•Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.


NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.2. Фронтальные зубы SOLUUT

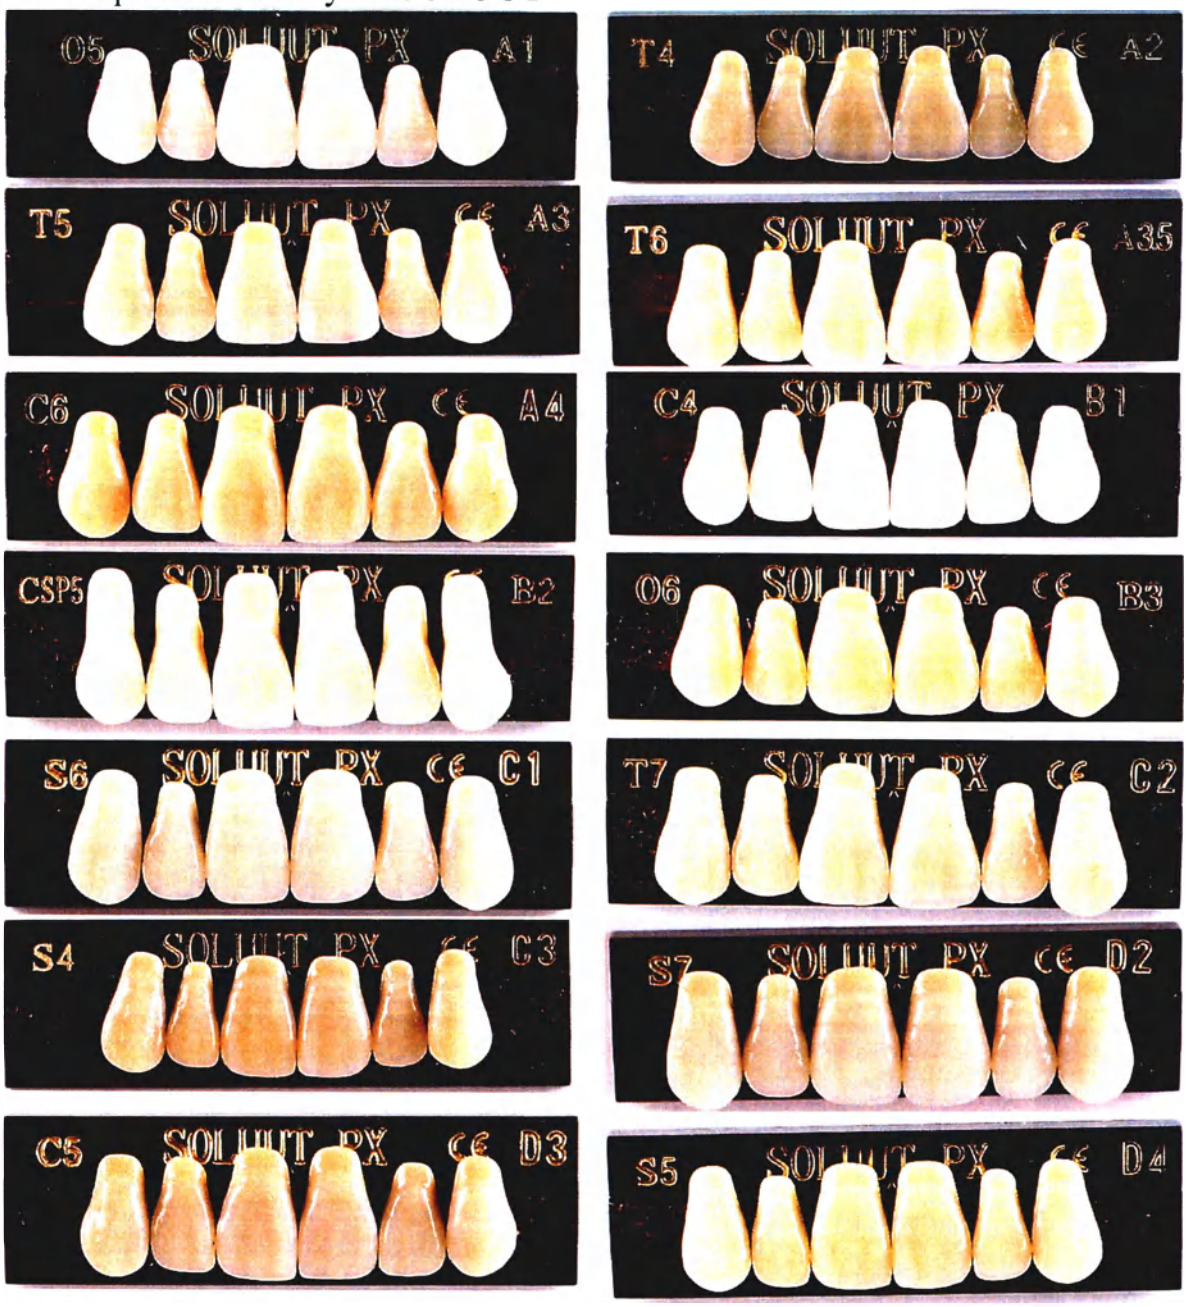


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

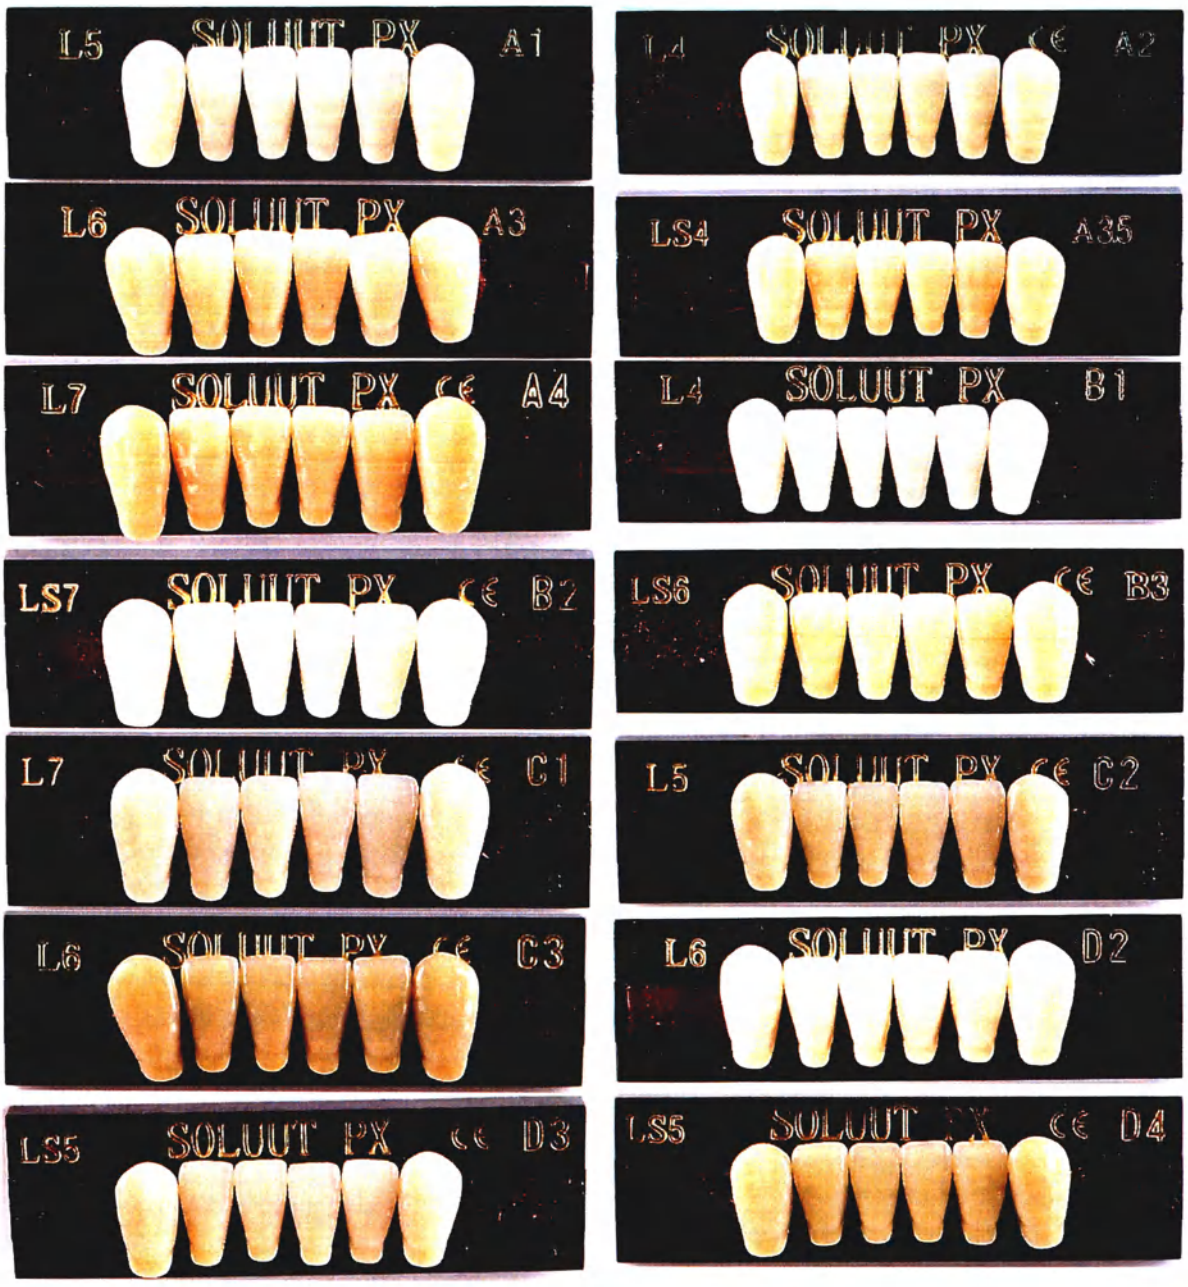

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



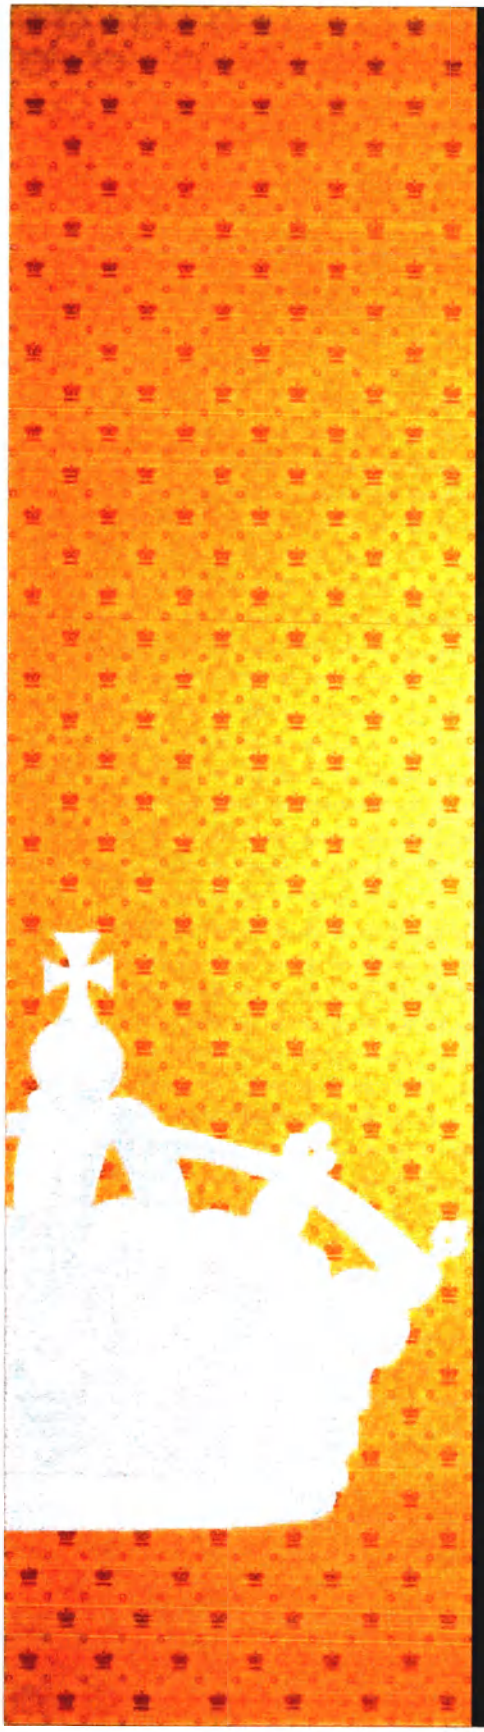

YAMAHACHI

Зубы акриловые
Soluut PX

из композитной пластмассы
Фронтальные трёхслойные

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

В коробке
18 планок
На планке
6 зубов

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе,
д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16.
сайт: www.dental-east.ru e-mail: Sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C.
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.


«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


1.3. Боковые зубы EFUCERA





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

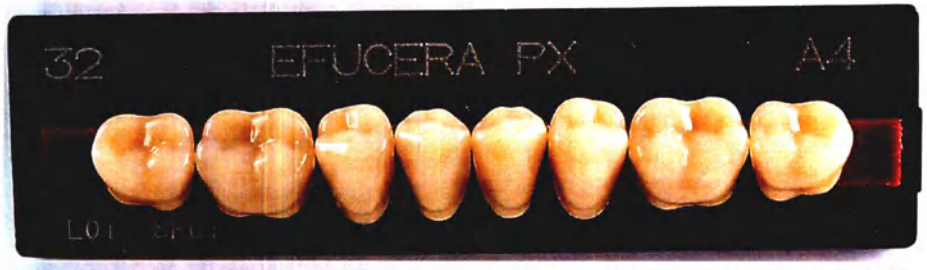

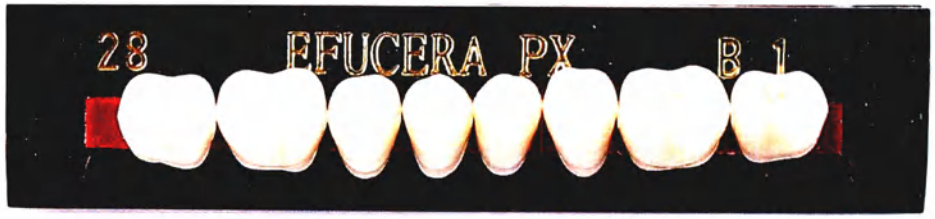


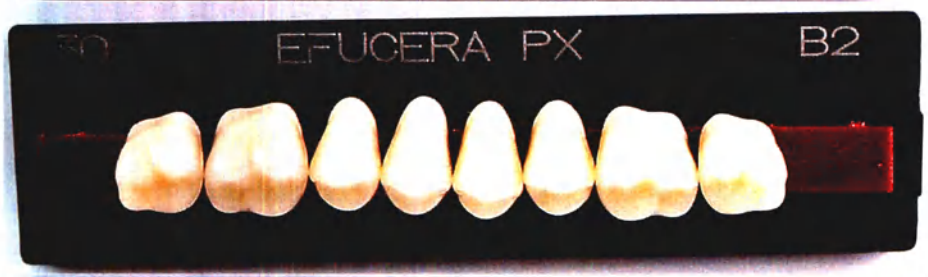


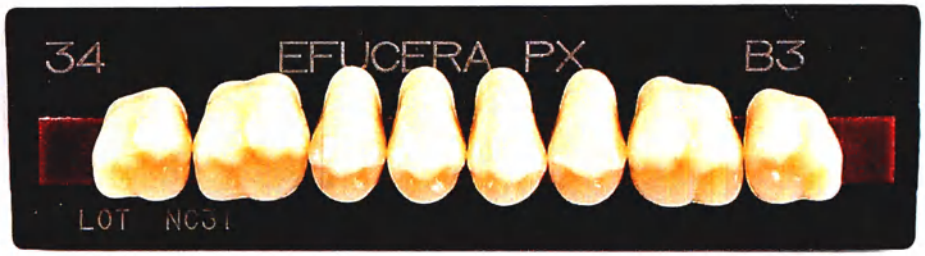

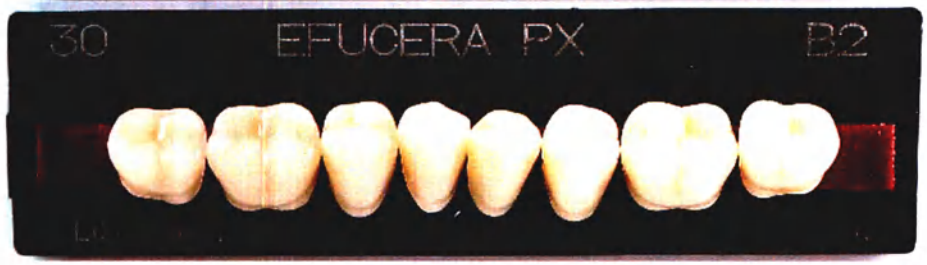




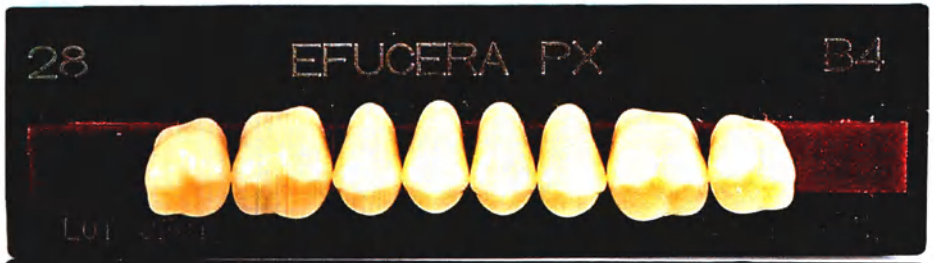


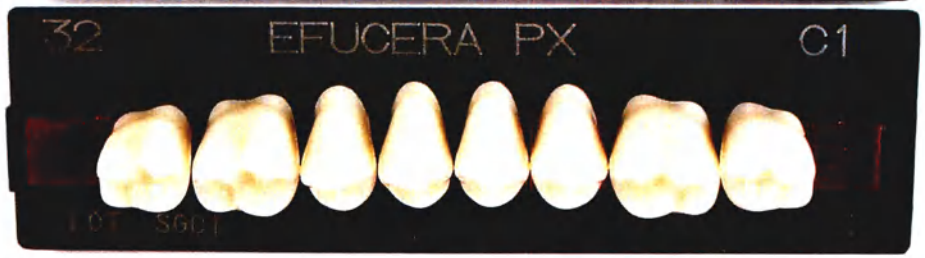




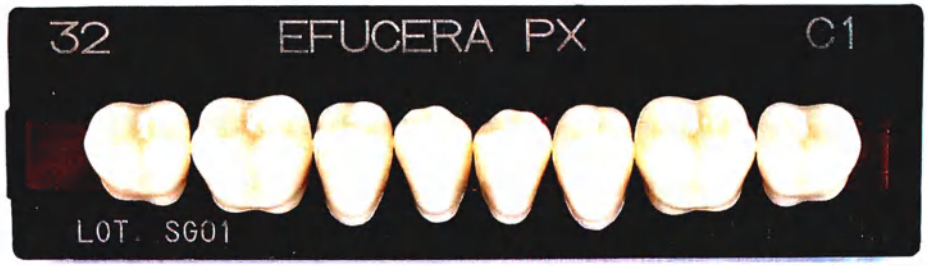



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

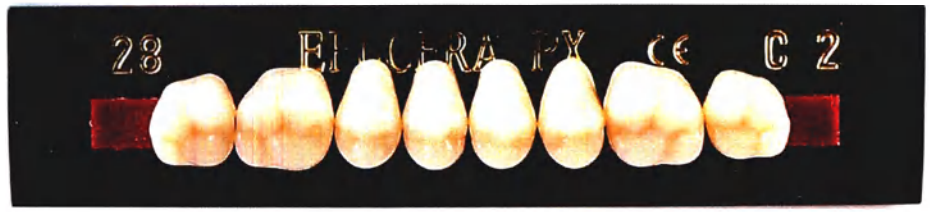





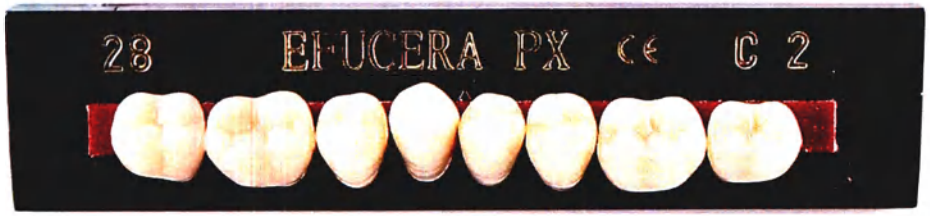


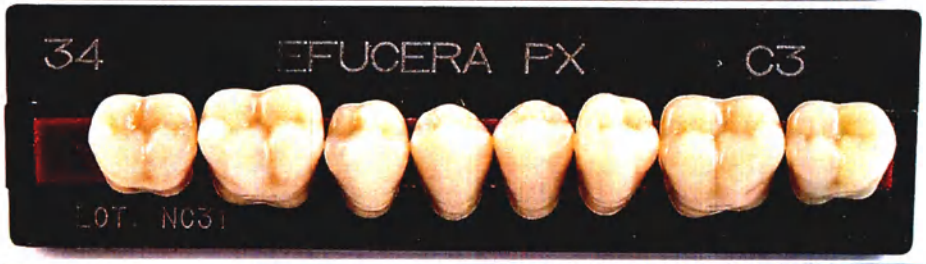

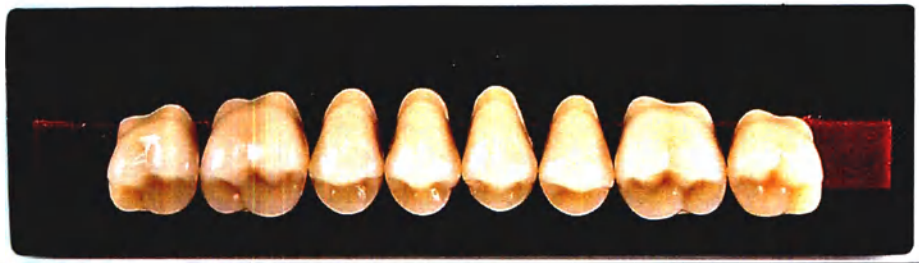


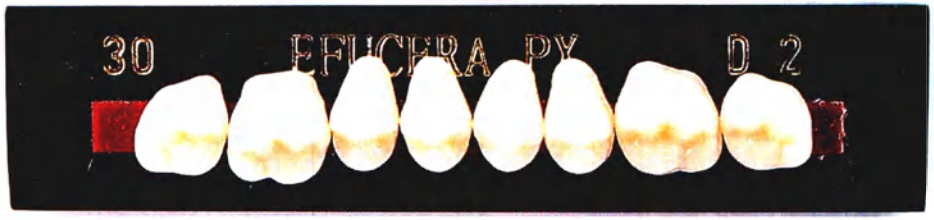

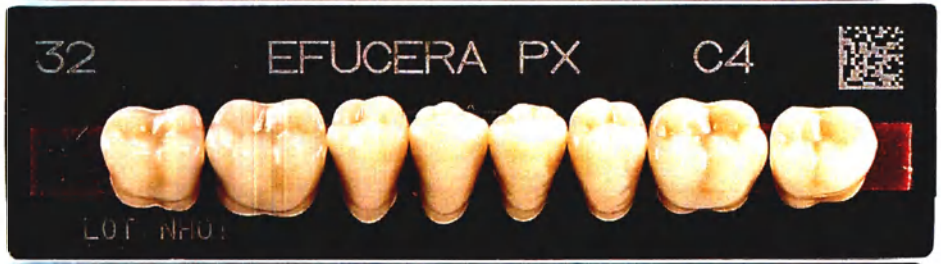

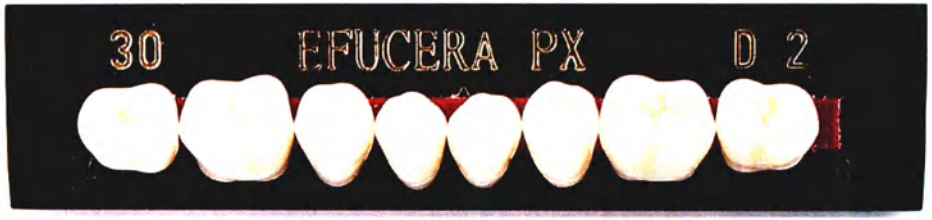



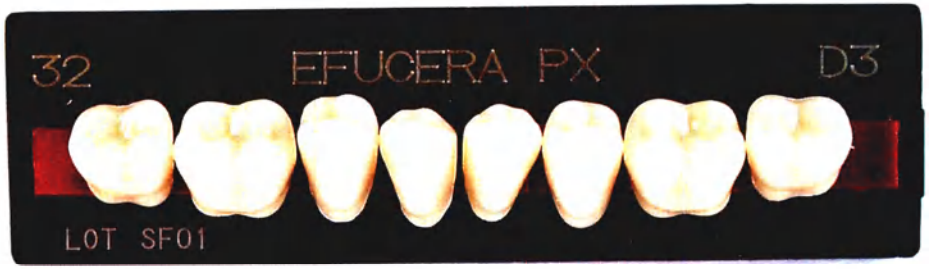

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



YAMAHACHI

Зубы акриловые Efucera PX

из композитной пластмассы

Боковые трёхслойные

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе,
д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16.
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C.
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1.4. Боковые зубы SIMPLERR




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

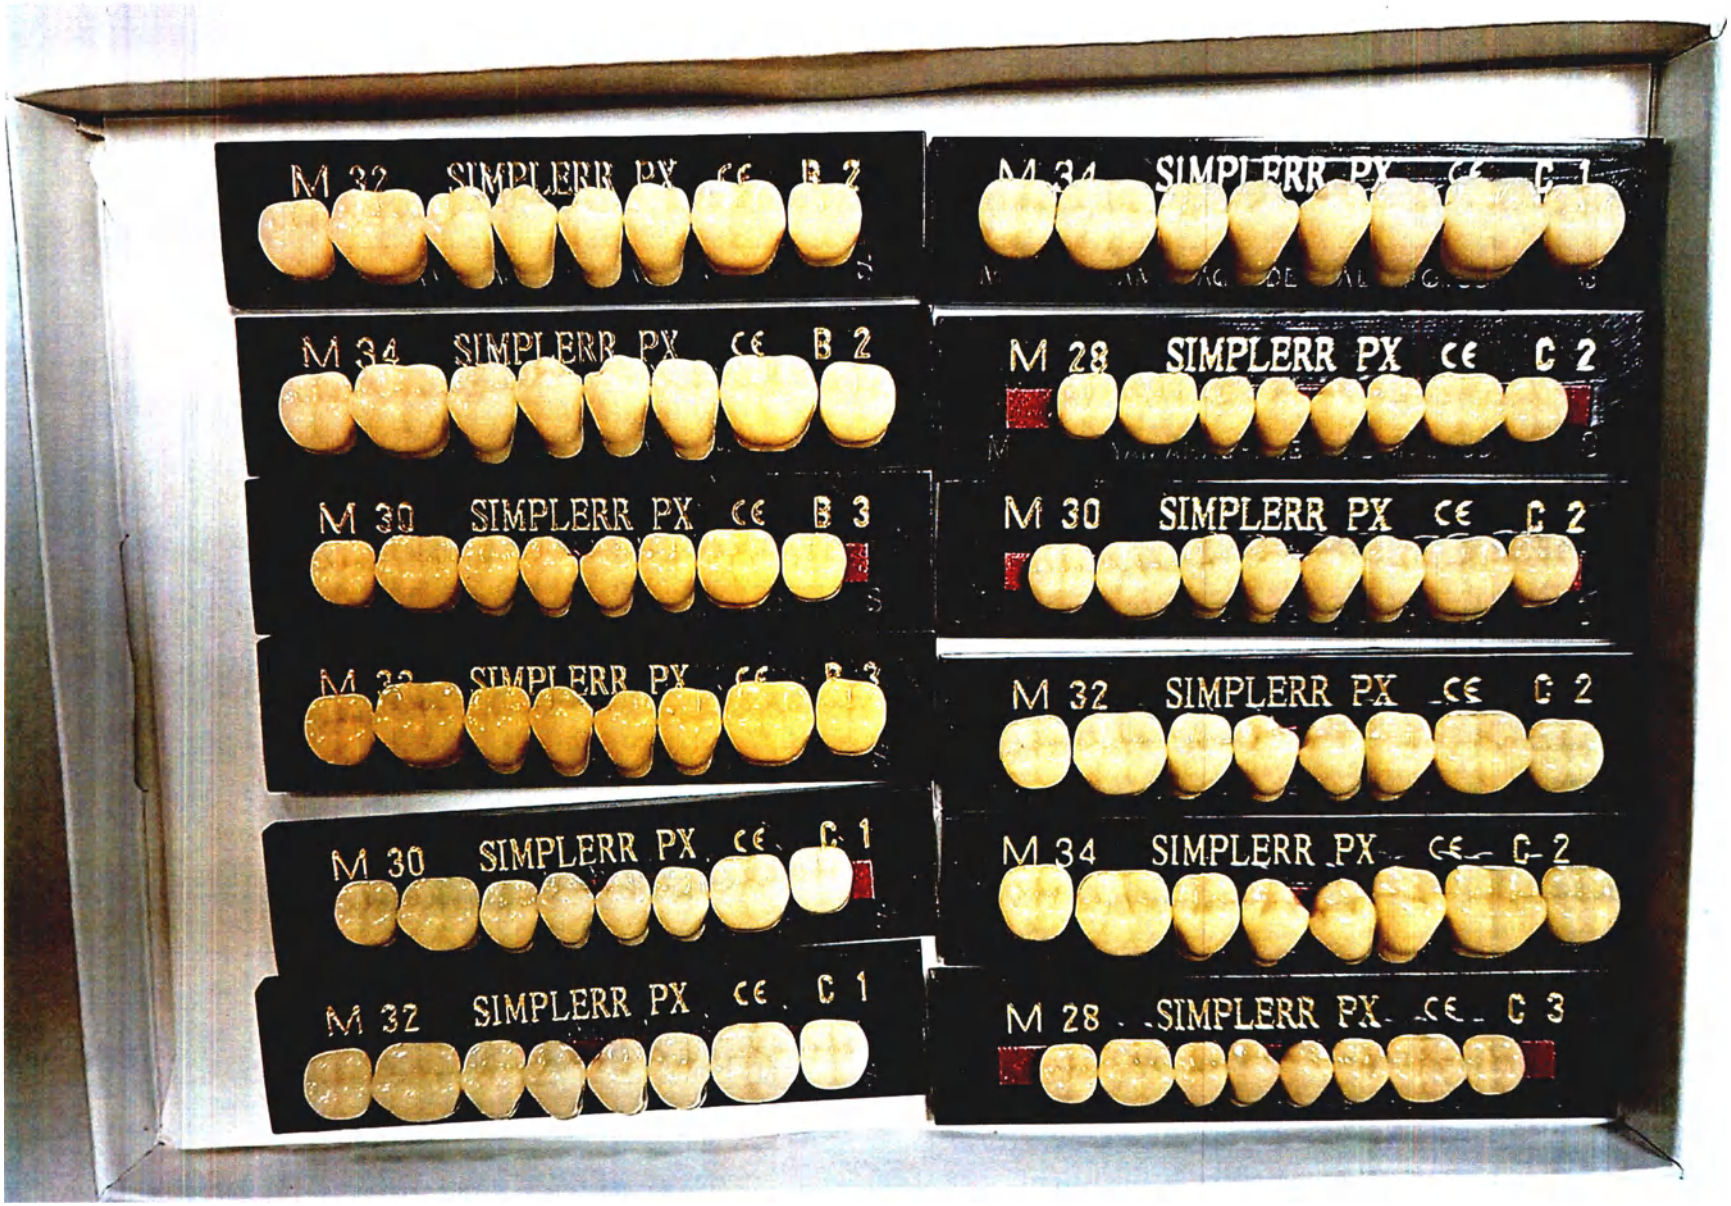

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



В коробке
12 планок
На планке
8 зубов

YAMAHACHI

Зубы акриловые
Simplerr PX
из композитной пластмассы

Боковые трёхслойные

Область применения:
Предназначены для изготовления зубных протезов.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе,
д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16.
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C.
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:
•Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
•Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010г.

LOT

Bar-code

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Зубы акриловые, вариант исполнения FX



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

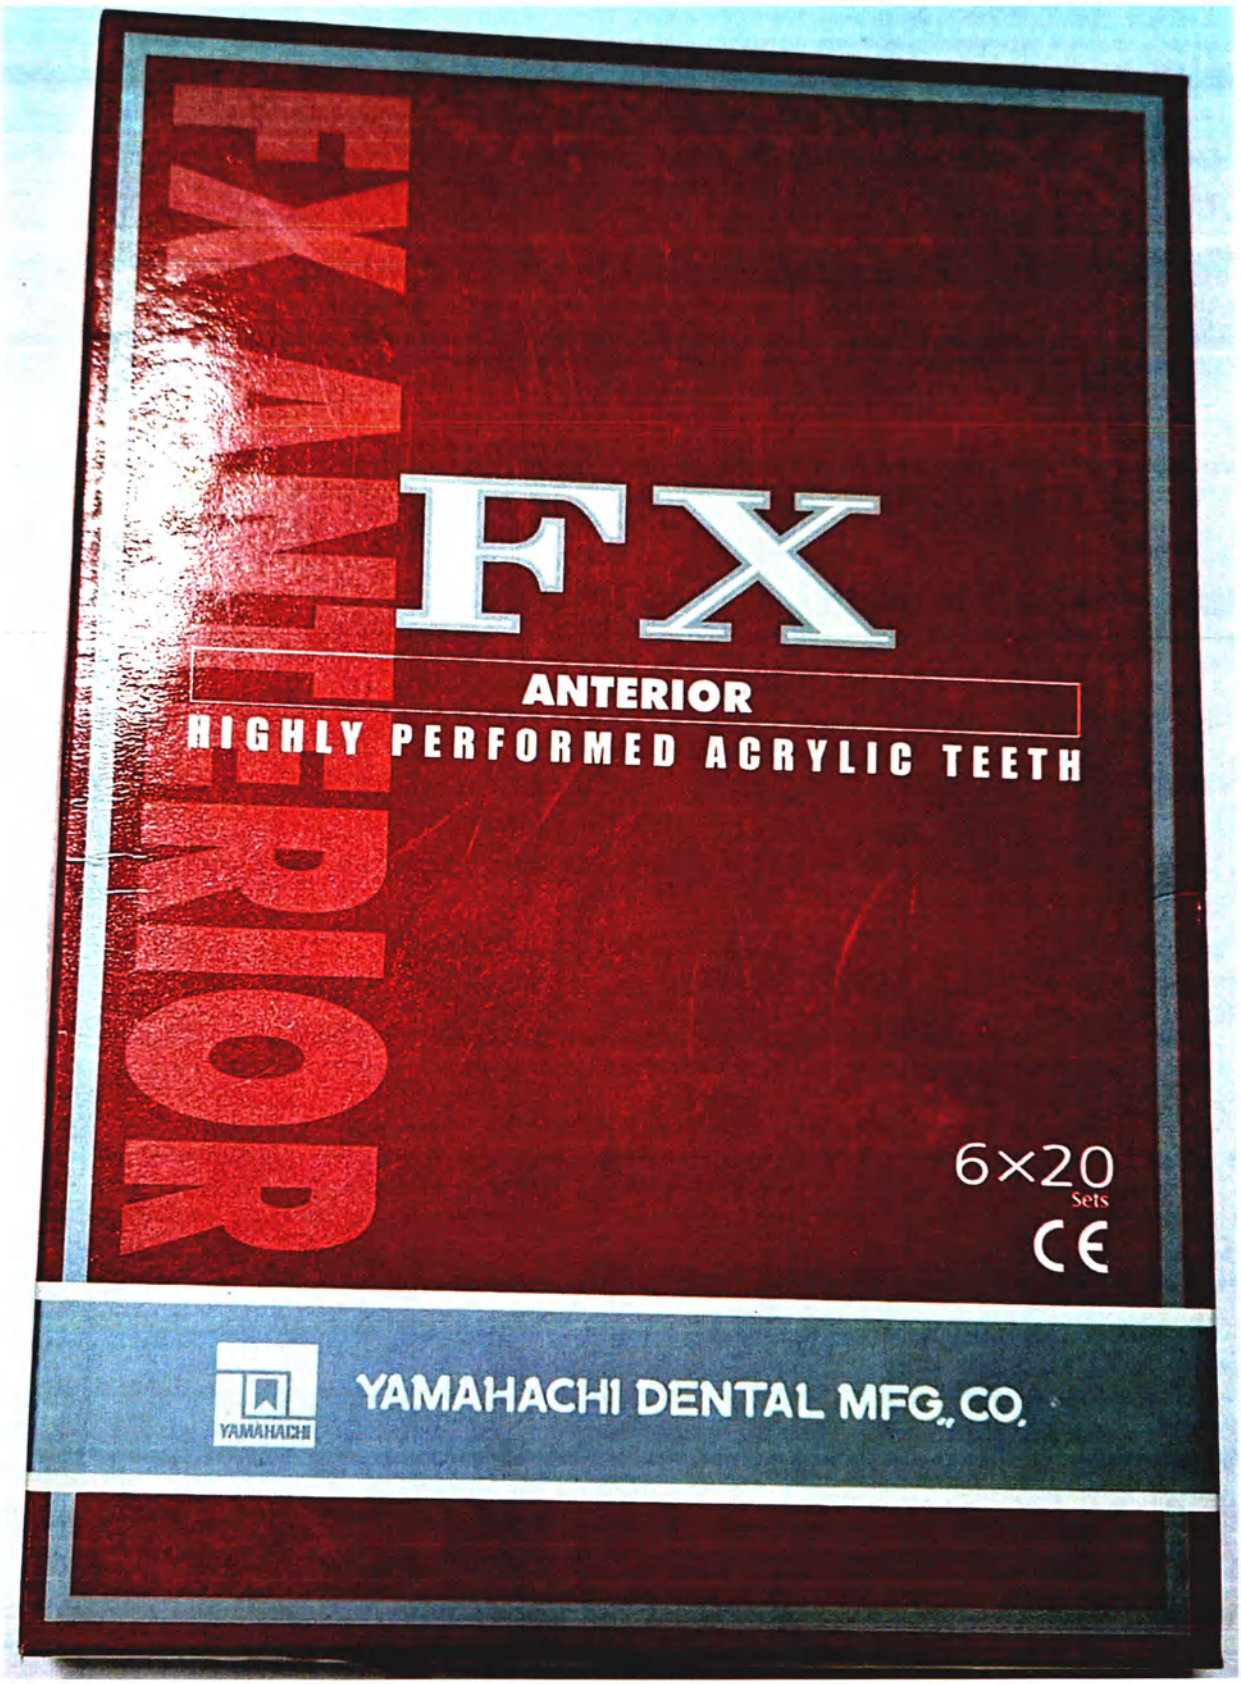

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

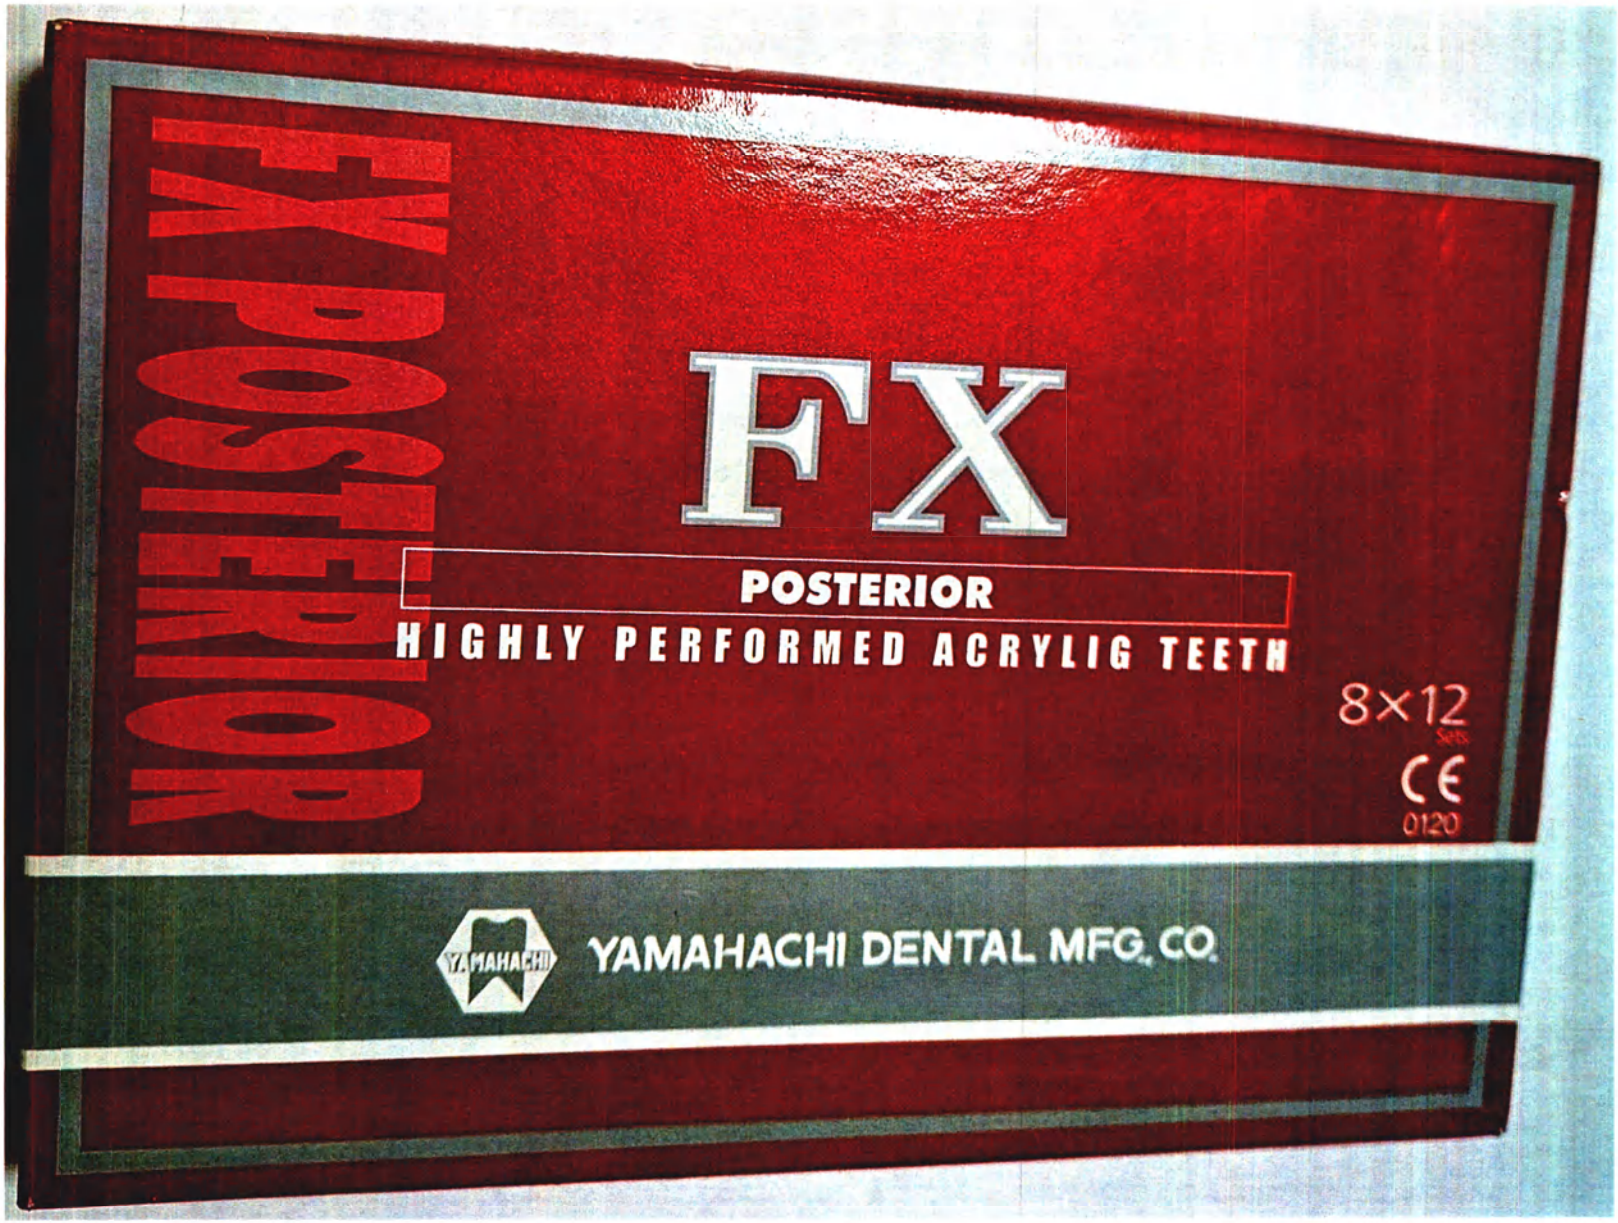

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

•Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
•Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г


NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.


«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Зубы акриловые, вариант исполнения New Ace

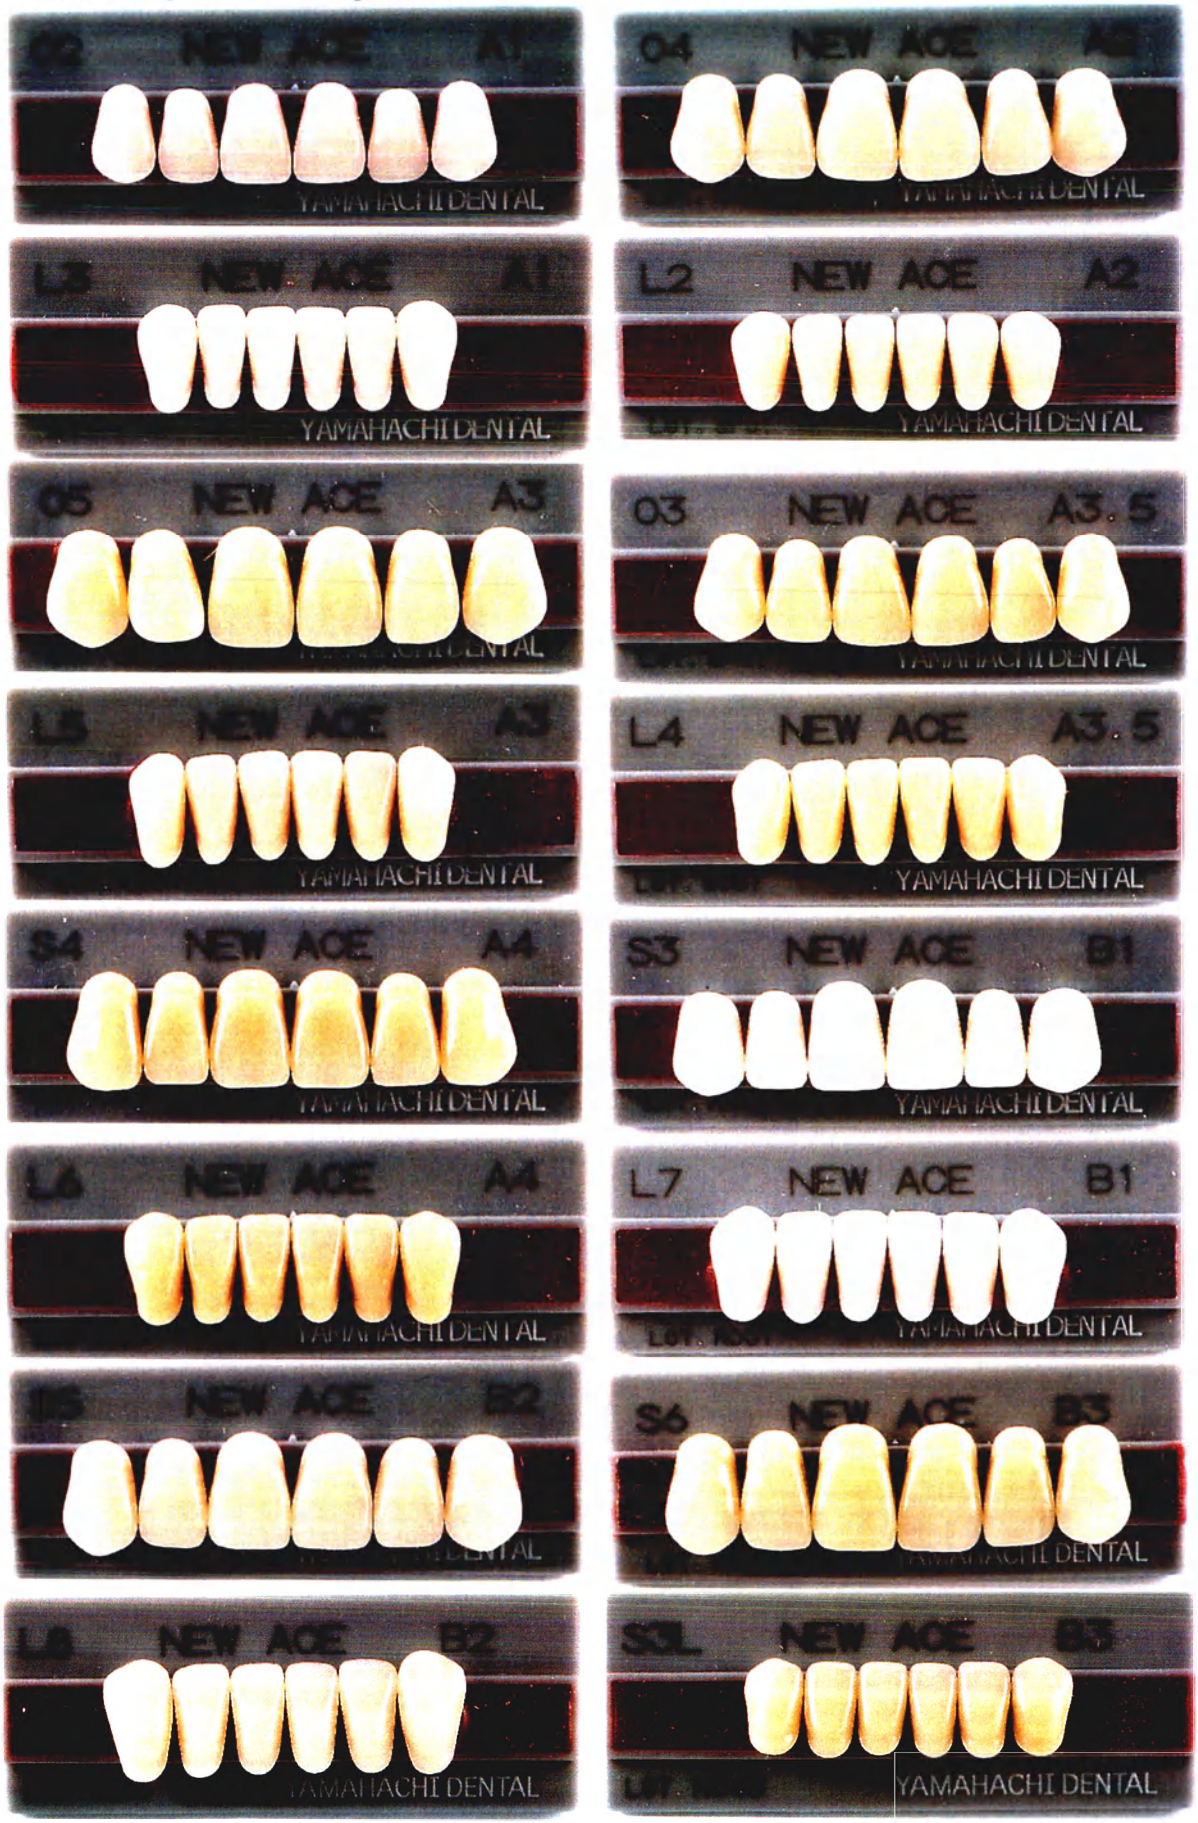

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

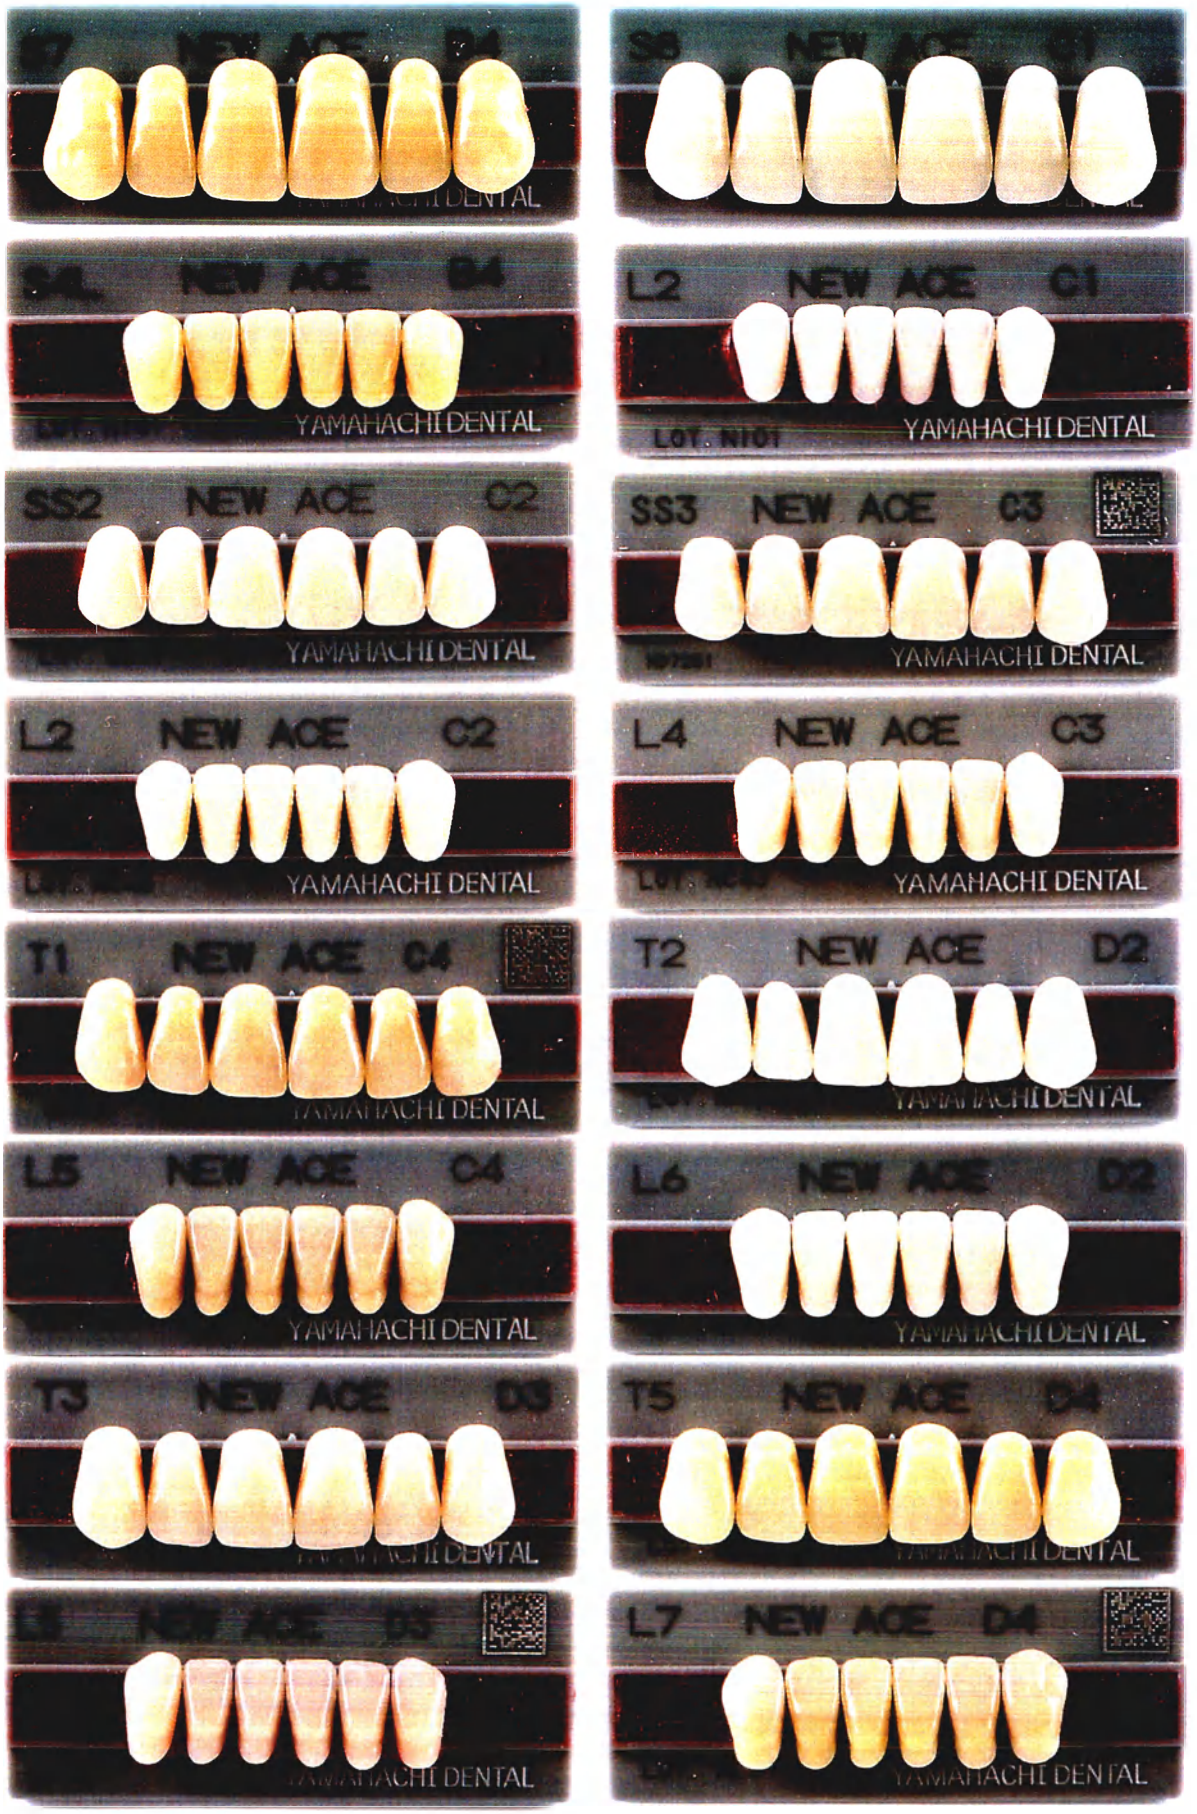

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:
•Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
•Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.


Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

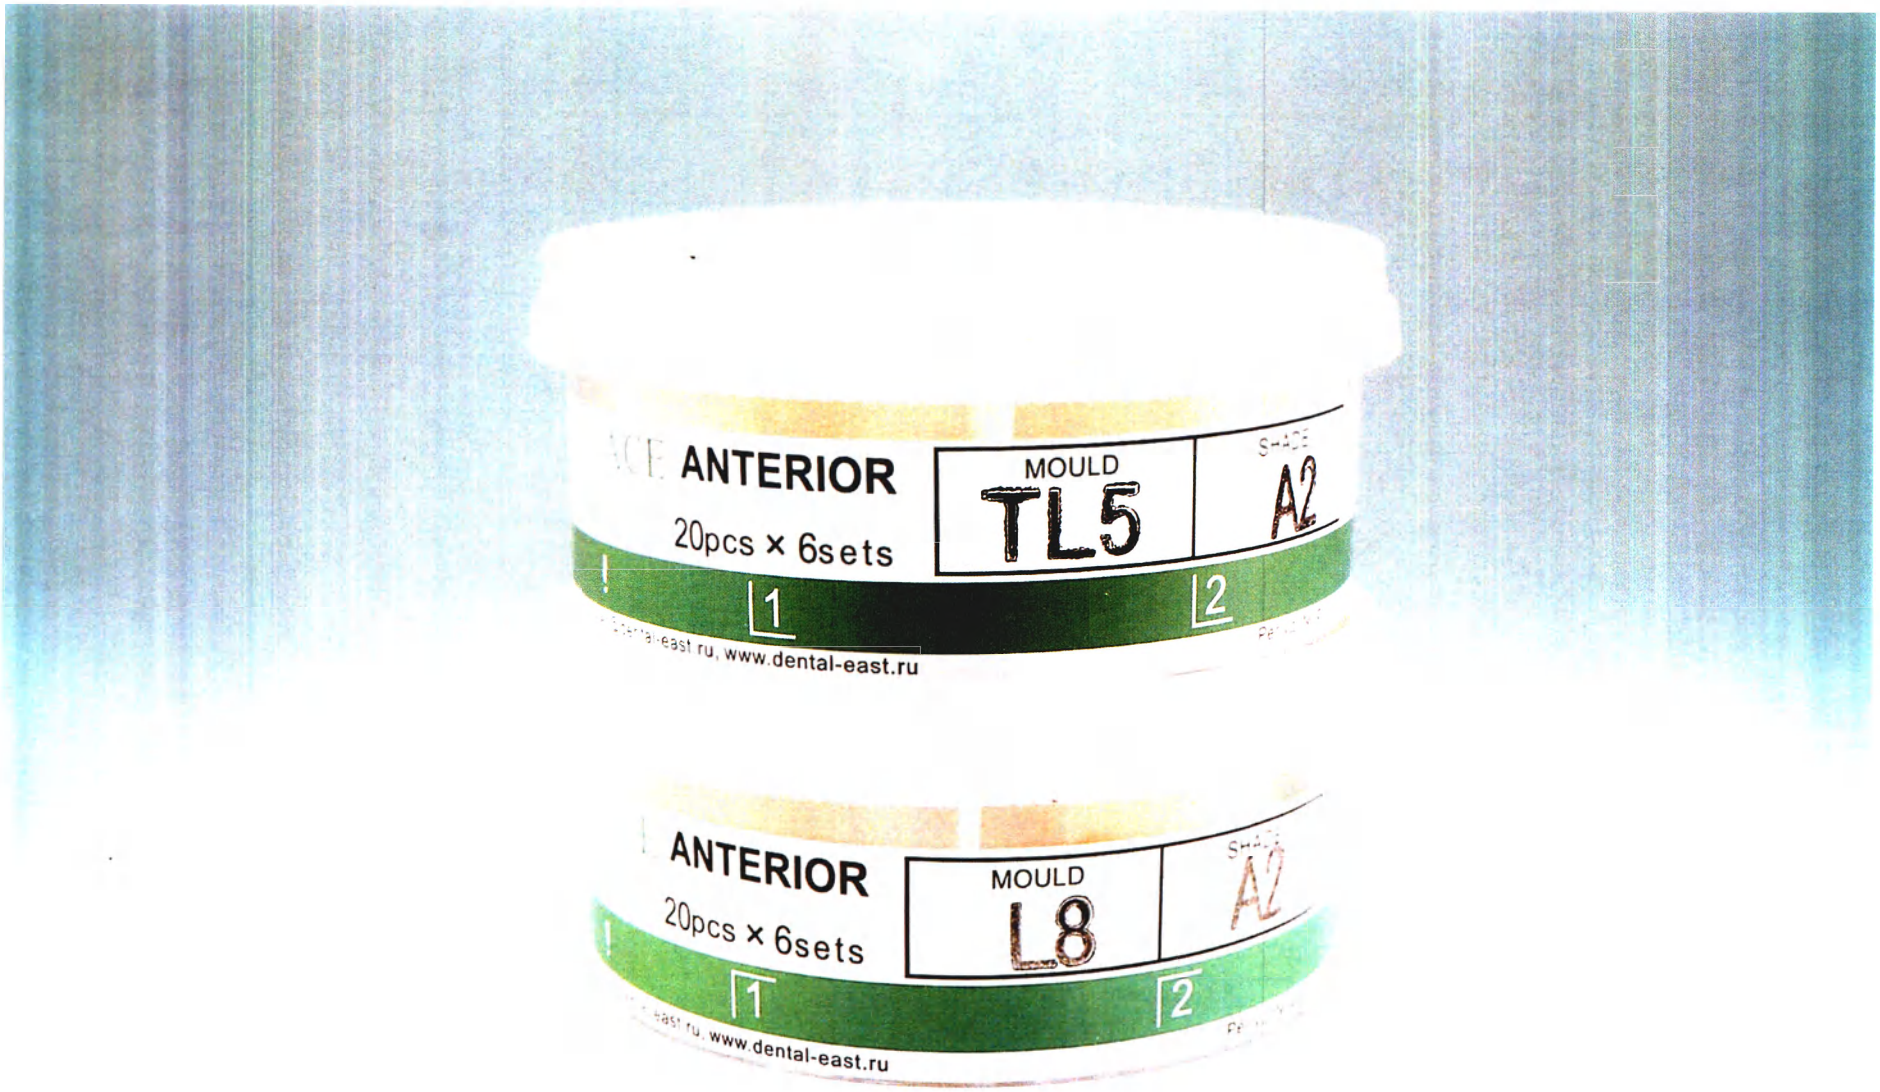

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Зубы акриловые, вариант исполнения Naperce



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

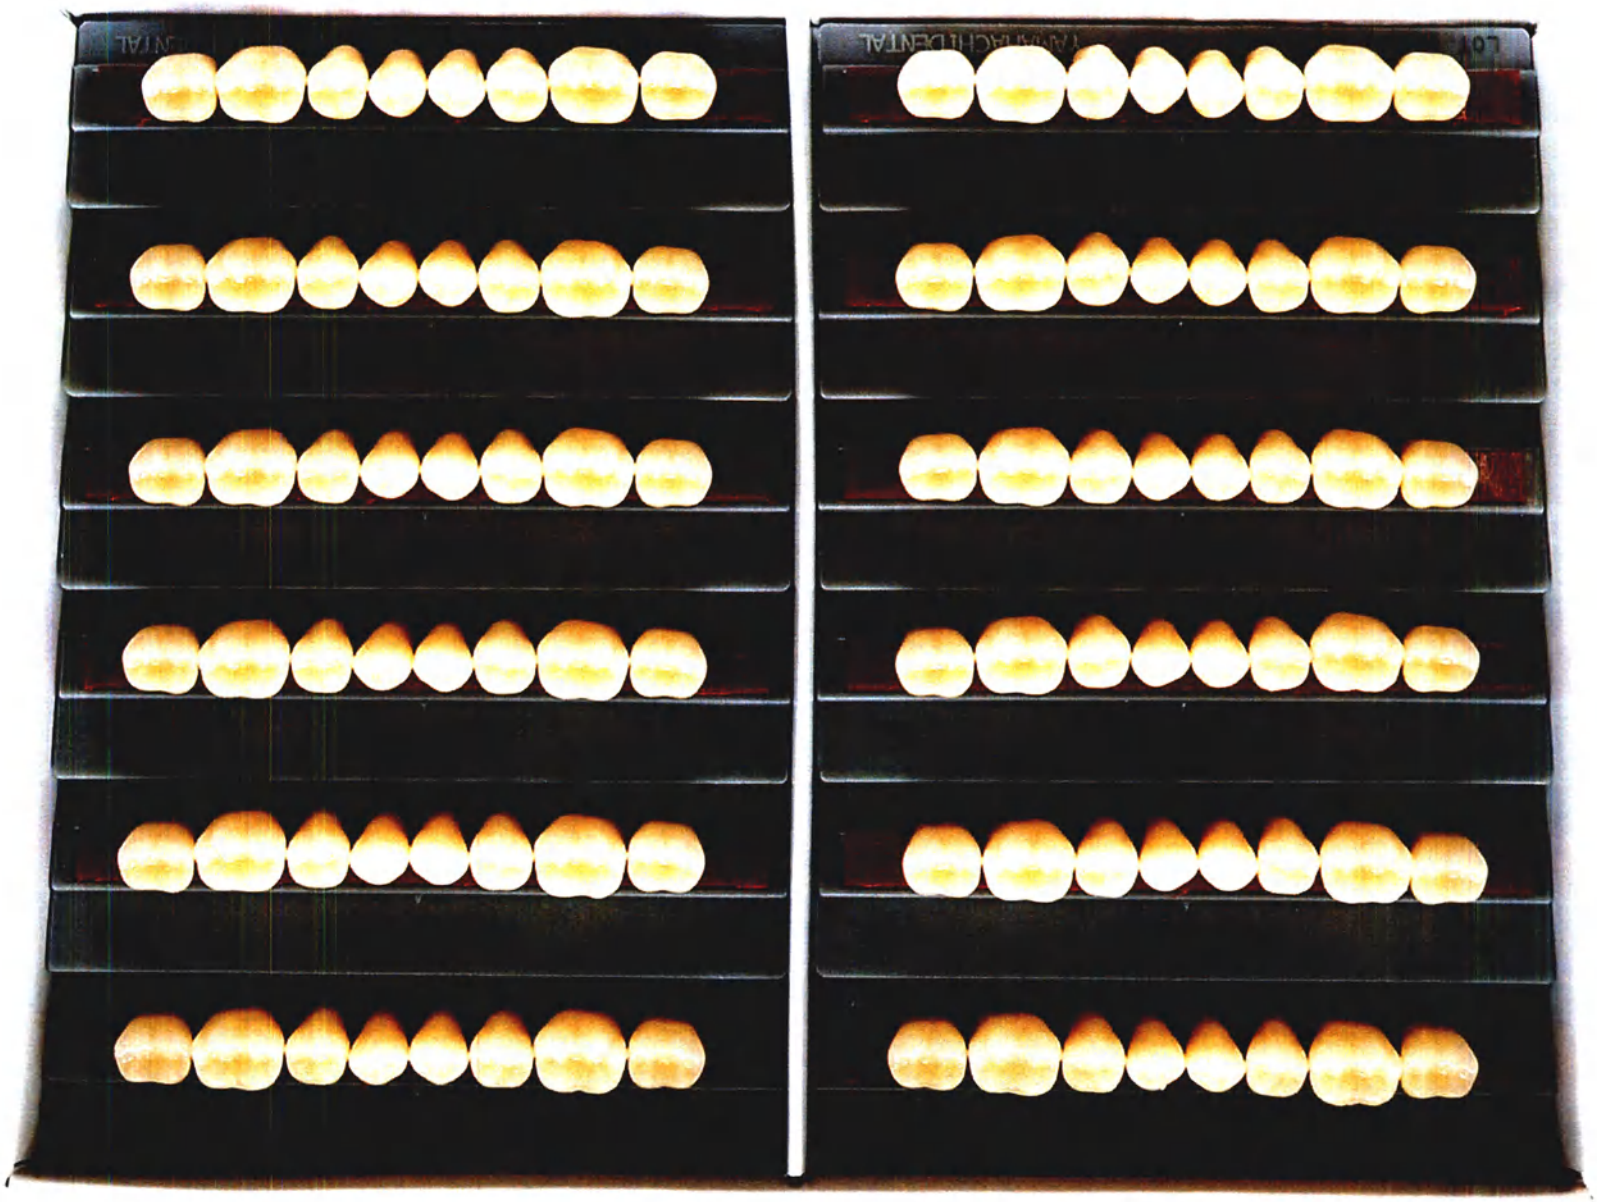

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C.
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


5. Зубы акриловые, вариант исполнения Million




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

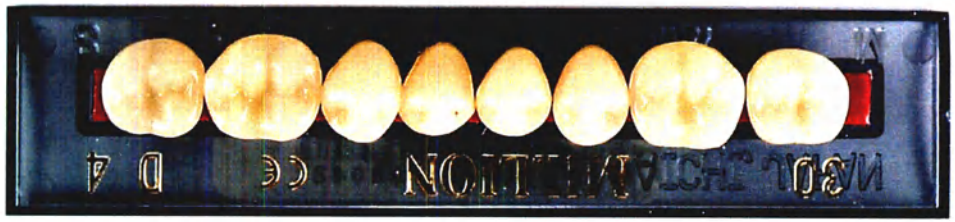

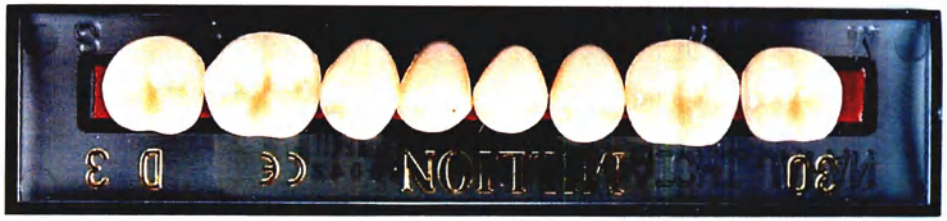

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

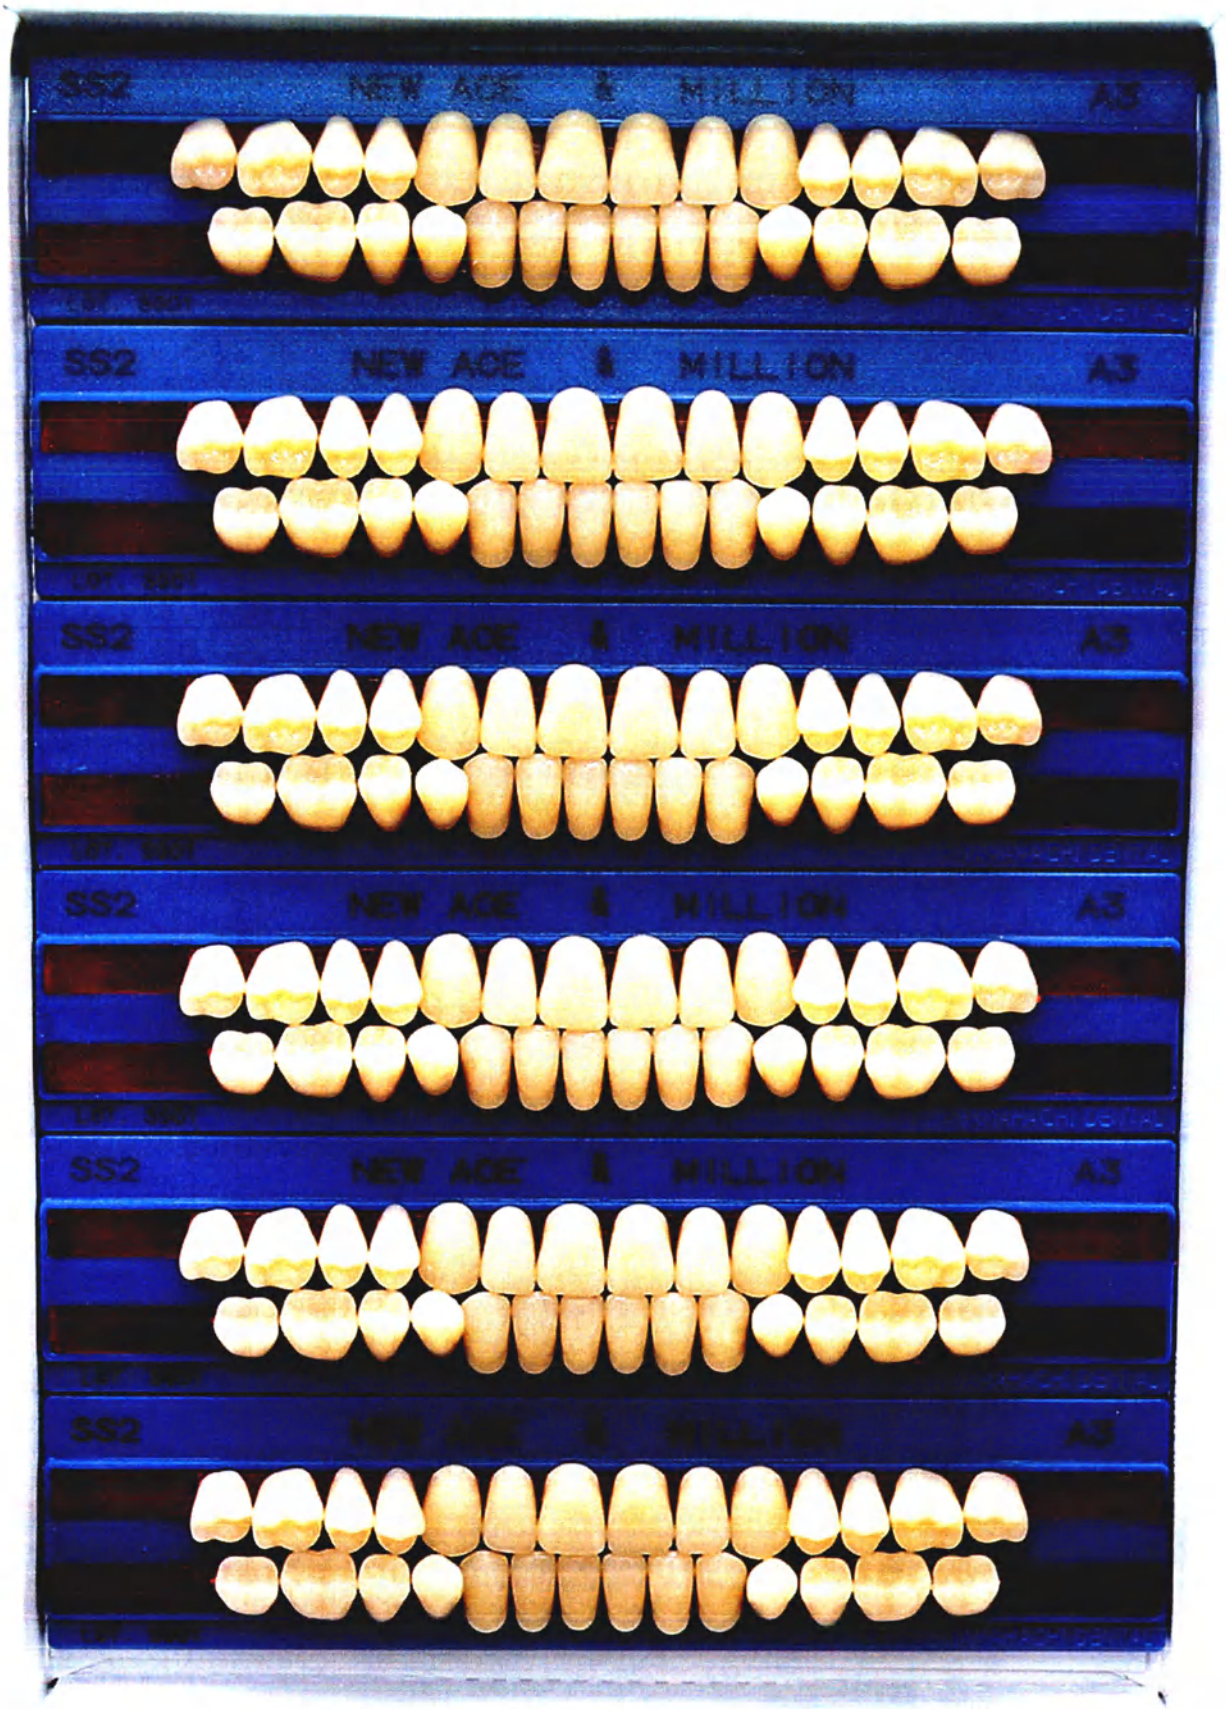

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

•Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
•Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.

Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

NON STERILE


YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.


«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

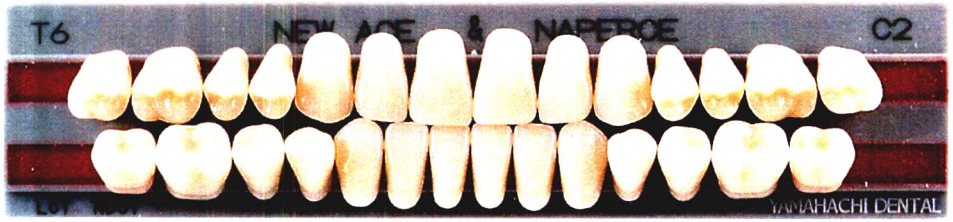


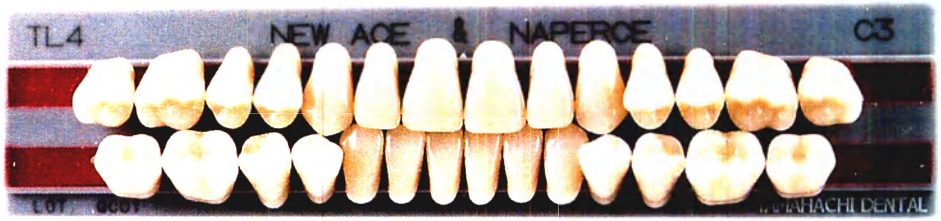

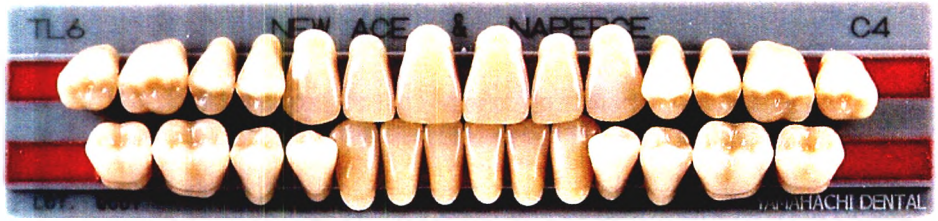

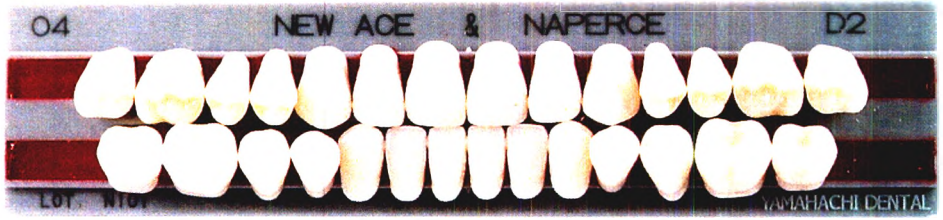

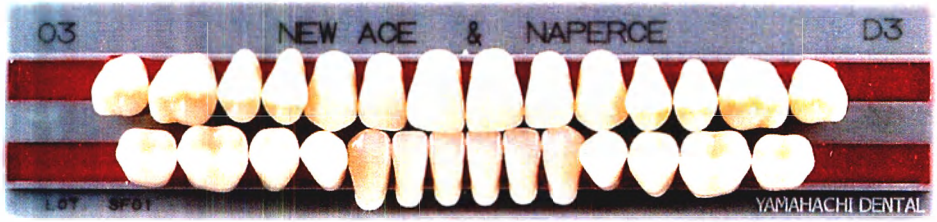

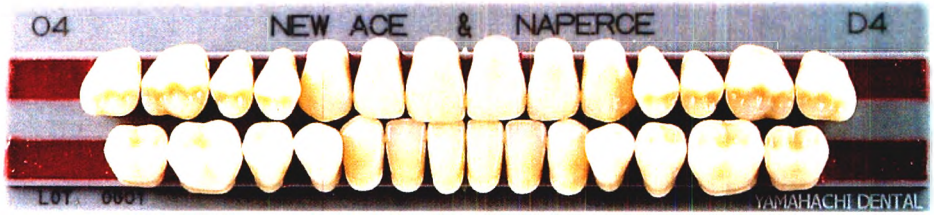

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зубы акриловые, варианты исполнения: PX, FX, New Ace, Naperce, Million.

Область применения:

Предназначены для изготовления зубных протезов.

Инструкция по применению:

1)Подберите наиболее подходящие цвет, форму и размер зубов.
2)На восковой заготовке базиса протеза выстройте зубной ряд и запакуйте восковую заготовку в кювету.
3)Согласно стандартной процедуре, вытопите воск из кюветы и заполните пластмассой, предназначенной для изготовления съёмных протезов.
4)После полимеризации пластмассы, распакуйте съёмный протез из кюветы и отполируйте стандартным способом.
5)Съёмный протез готов к применению.

"Ямахачи Дентал МФГ., Ко.",
Япония, Yamahachi Dental MFG., Co.,
54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

LOT

Bar-code

Уполномоченный представитель производителей на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Ист"
(ООО "Дентал-Ист"), Россия, 125195, Москва, Ленинградское шоссе, д. 96А, тел +7(499) 745-63-18, 745-63-16
сайт: www.dental-east.ru e-mail: sales@dental-east.ru
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06564 от 08.04.2010г.

Условия по применению медицинского изделия:

- Рекомендуемая температура окружающей среды при использовании 23°C ± 1°C
- Рекомендуемая влажность окружающей среды при использовании 50% ± 10%.


Утилизацию производить в соответствии с СанПин 2.1.7. 2790-10 от 09.12.2010г.

NON STERILE

YAMAHACHI DENTAL MFG., CO.

«Ямахачи Дентал МФГ., Ко.», Япония, Yamahachi Dental MFG., Co., 54-1 Ochigara, Nishiura-cho, Gamagori, Aichi-pref., Japan

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

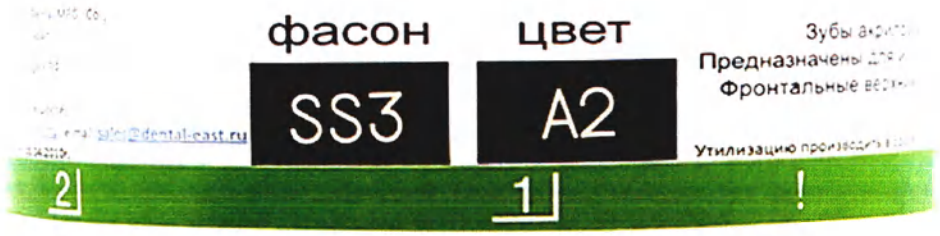







ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU