
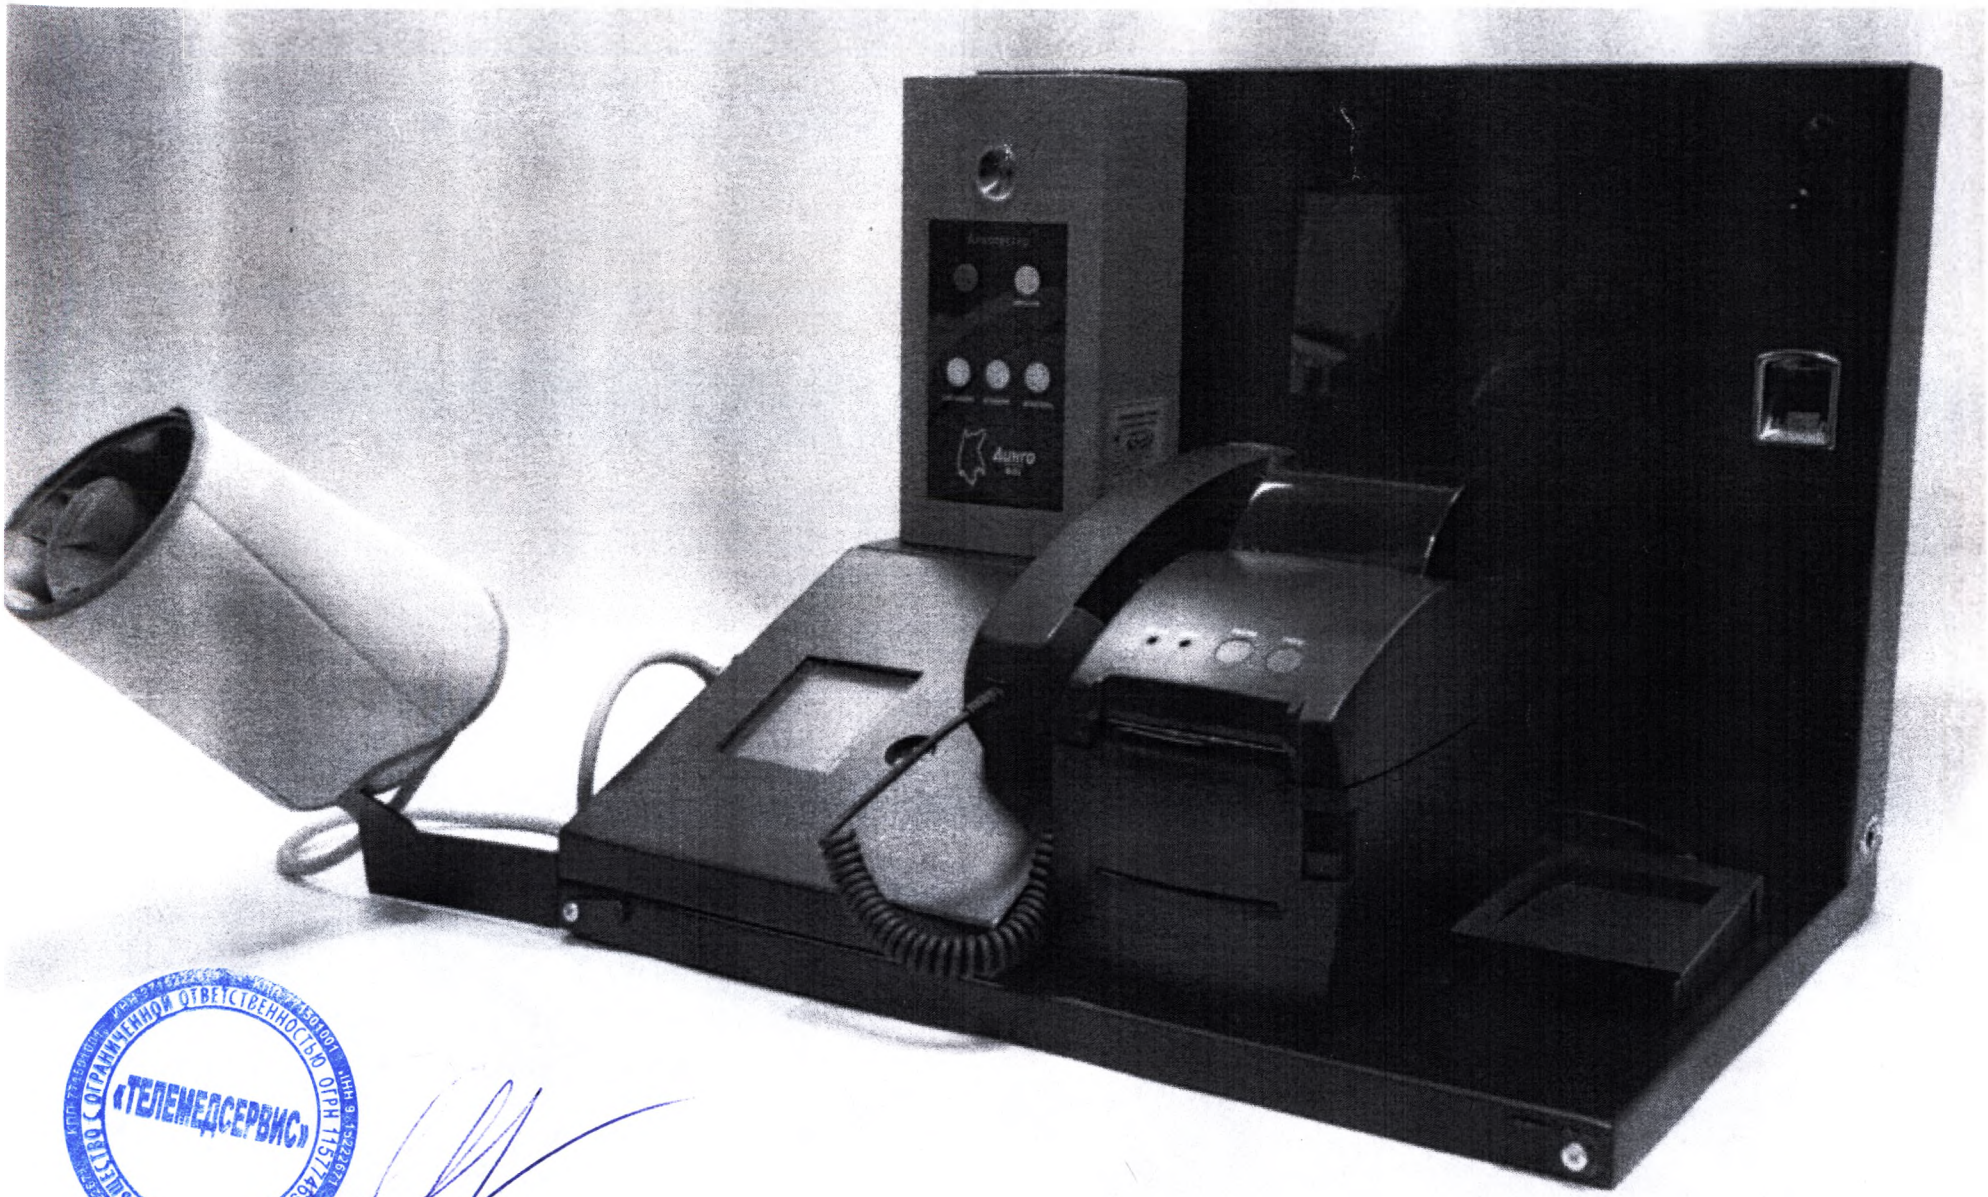



Фотографическое изображение 1. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

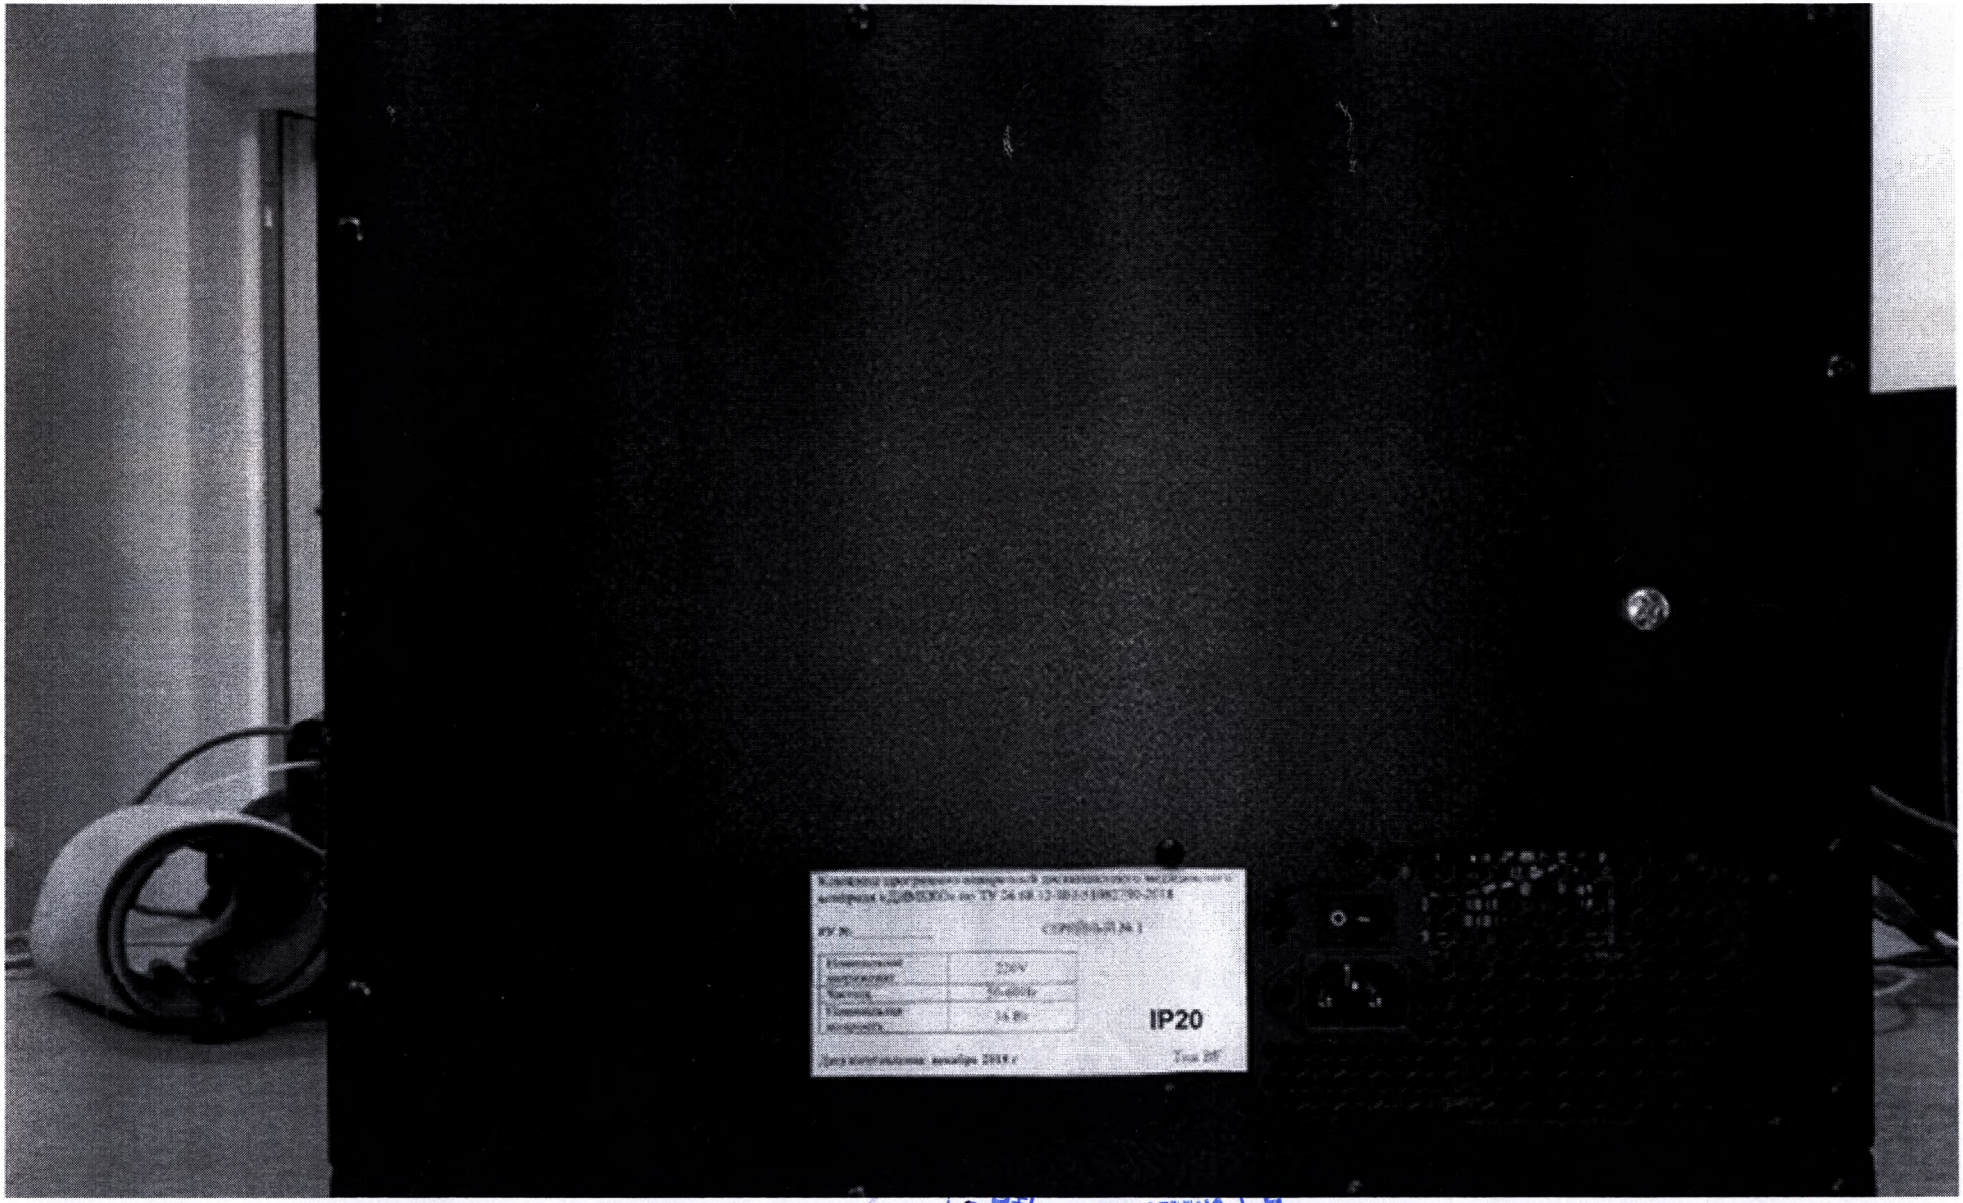



Фотографическое изображение 2. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018. Маркировочная табличка на задней панели.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

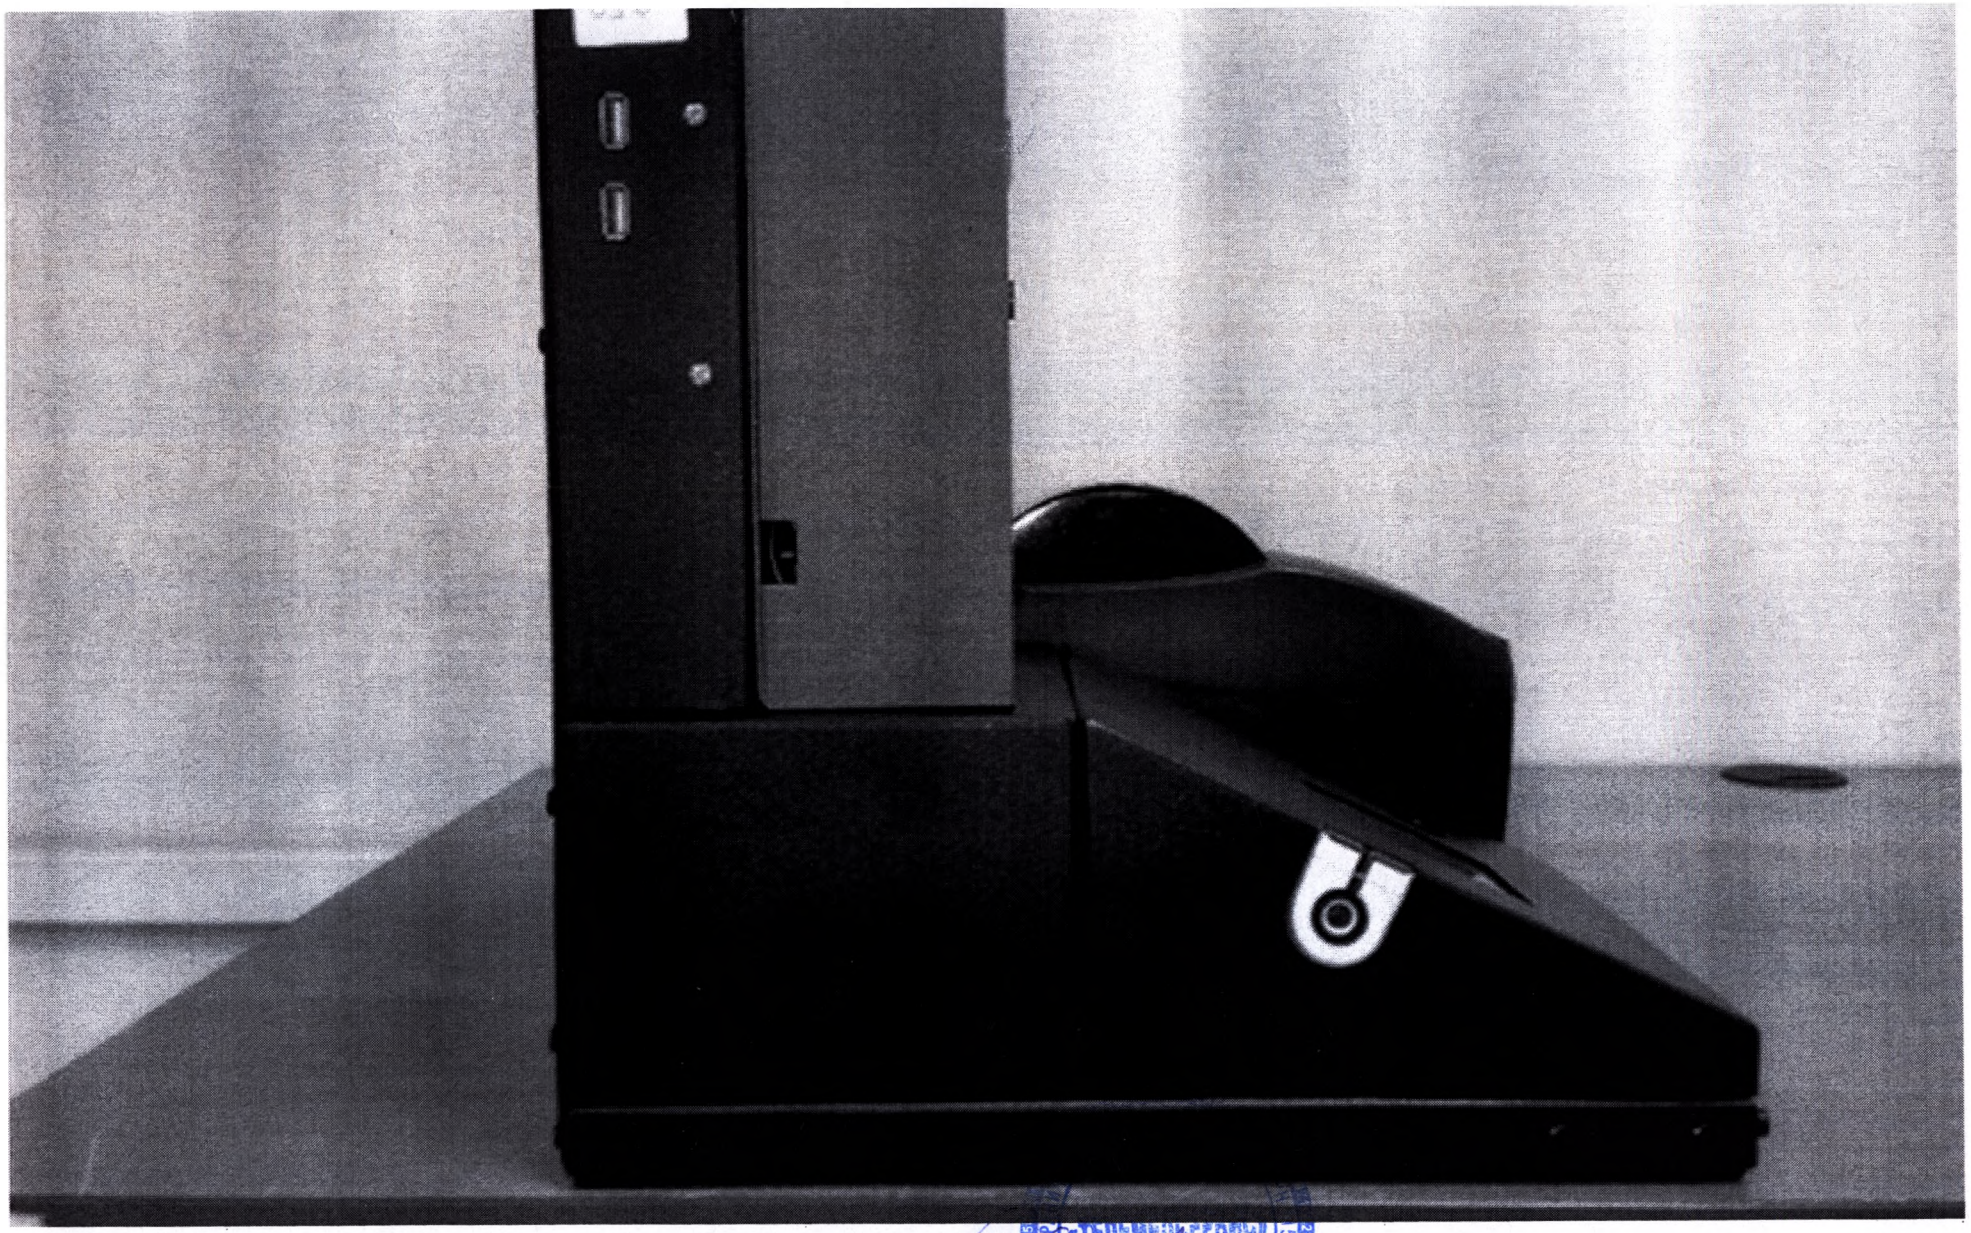


Фотографическое изображение 3. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018. Вид слева.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

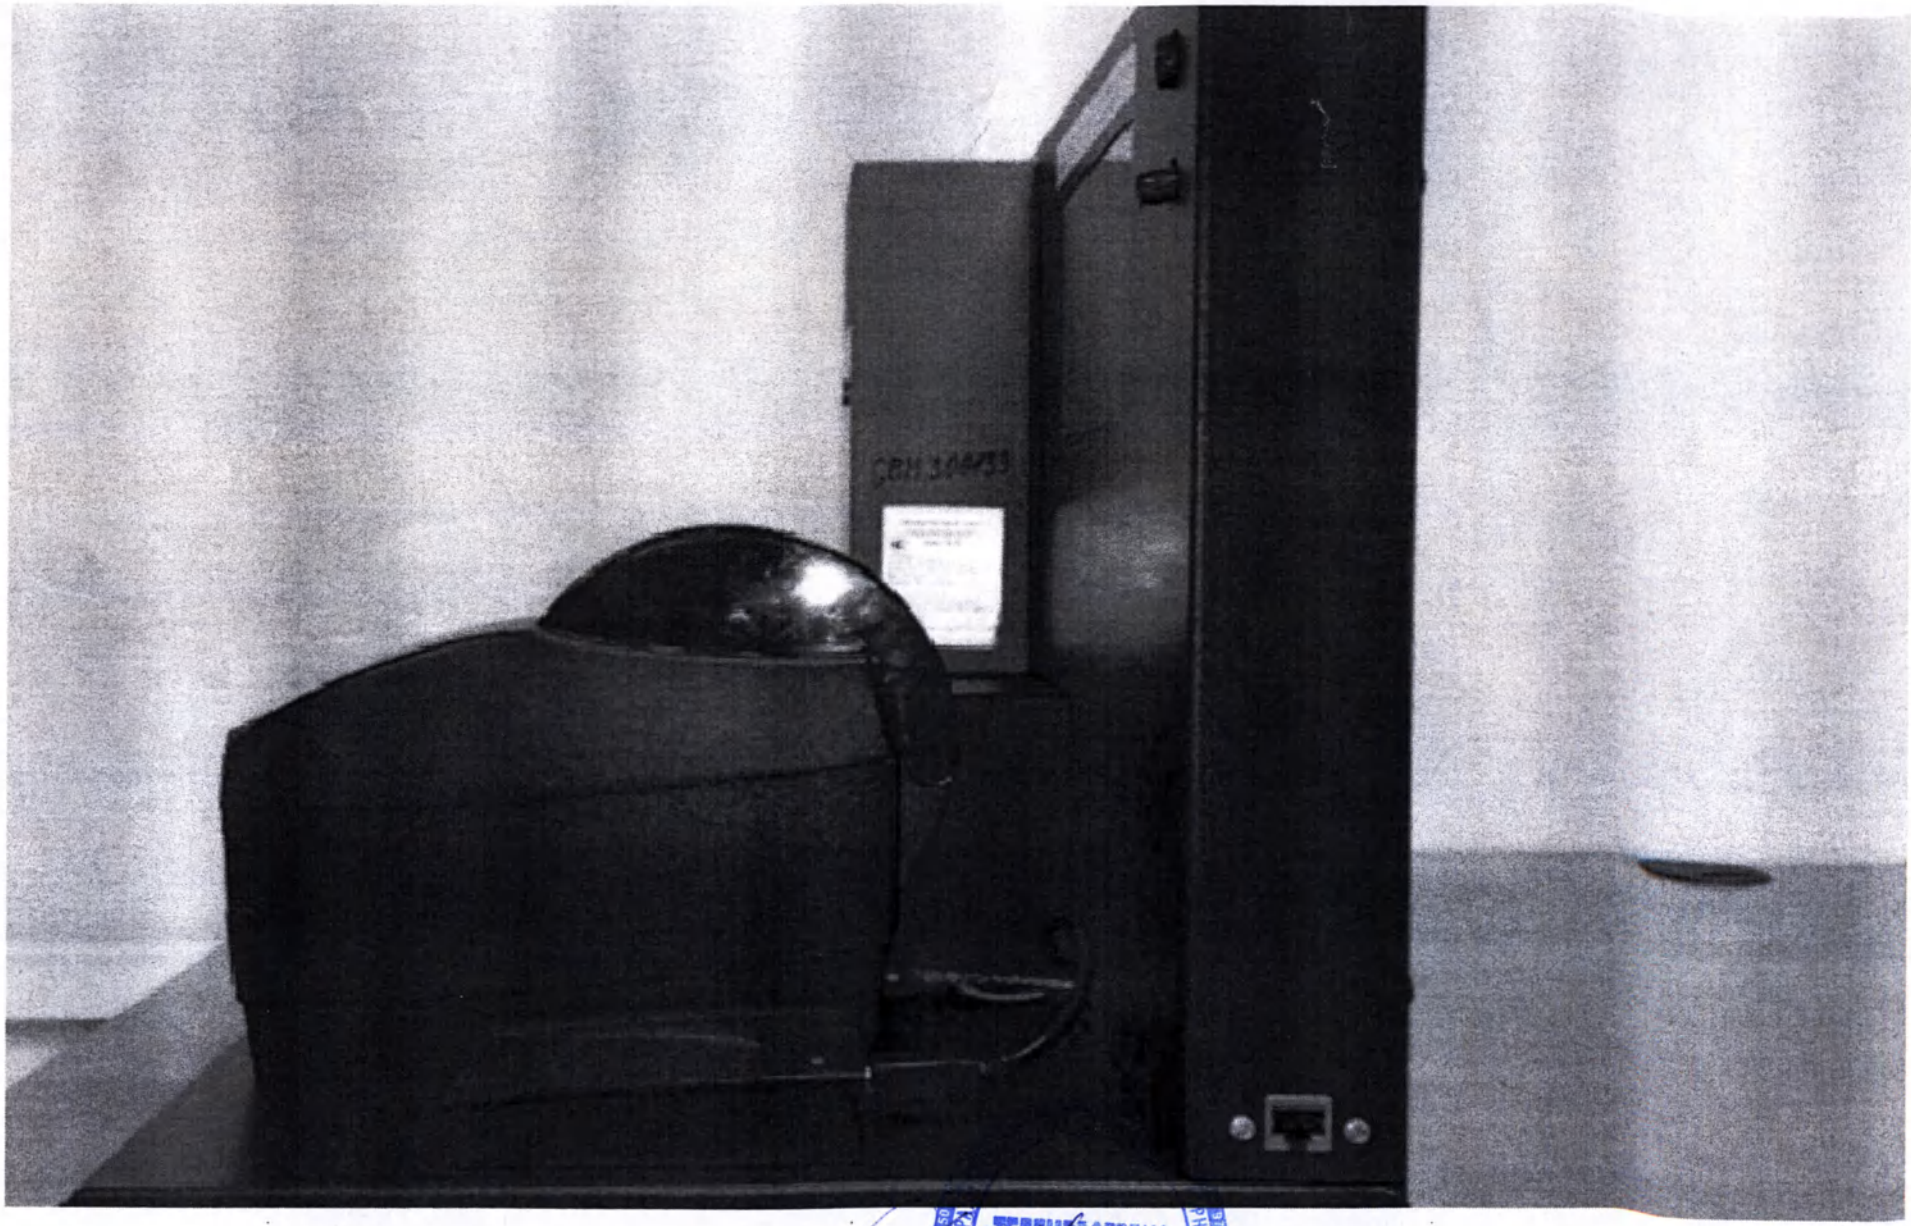


Фотографическое изображение 4. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018. Вид справа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

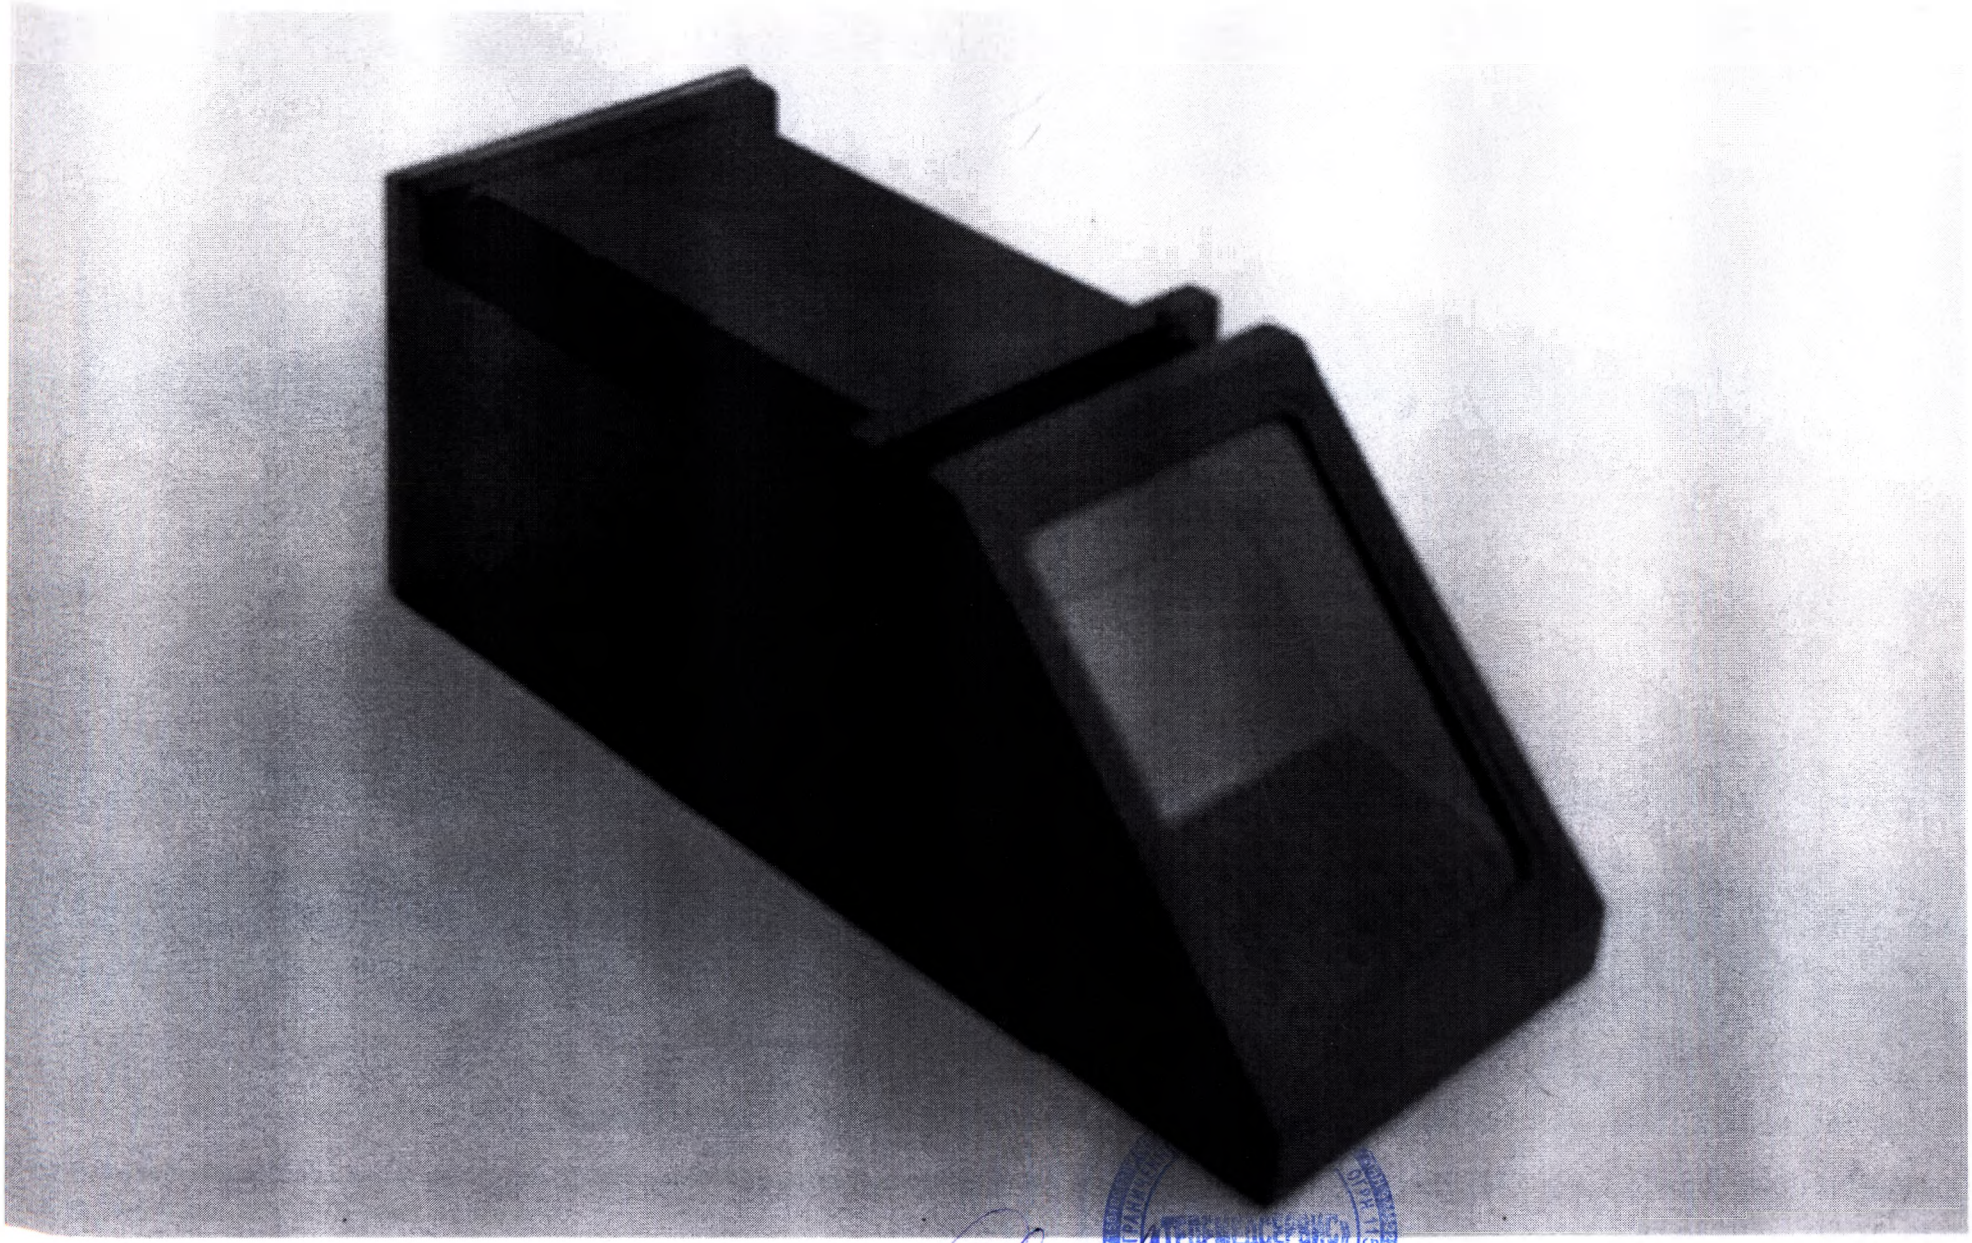

Фотографическое изображение 5. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018. Принадлежности: 1. Сканер отпечатков пальцев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

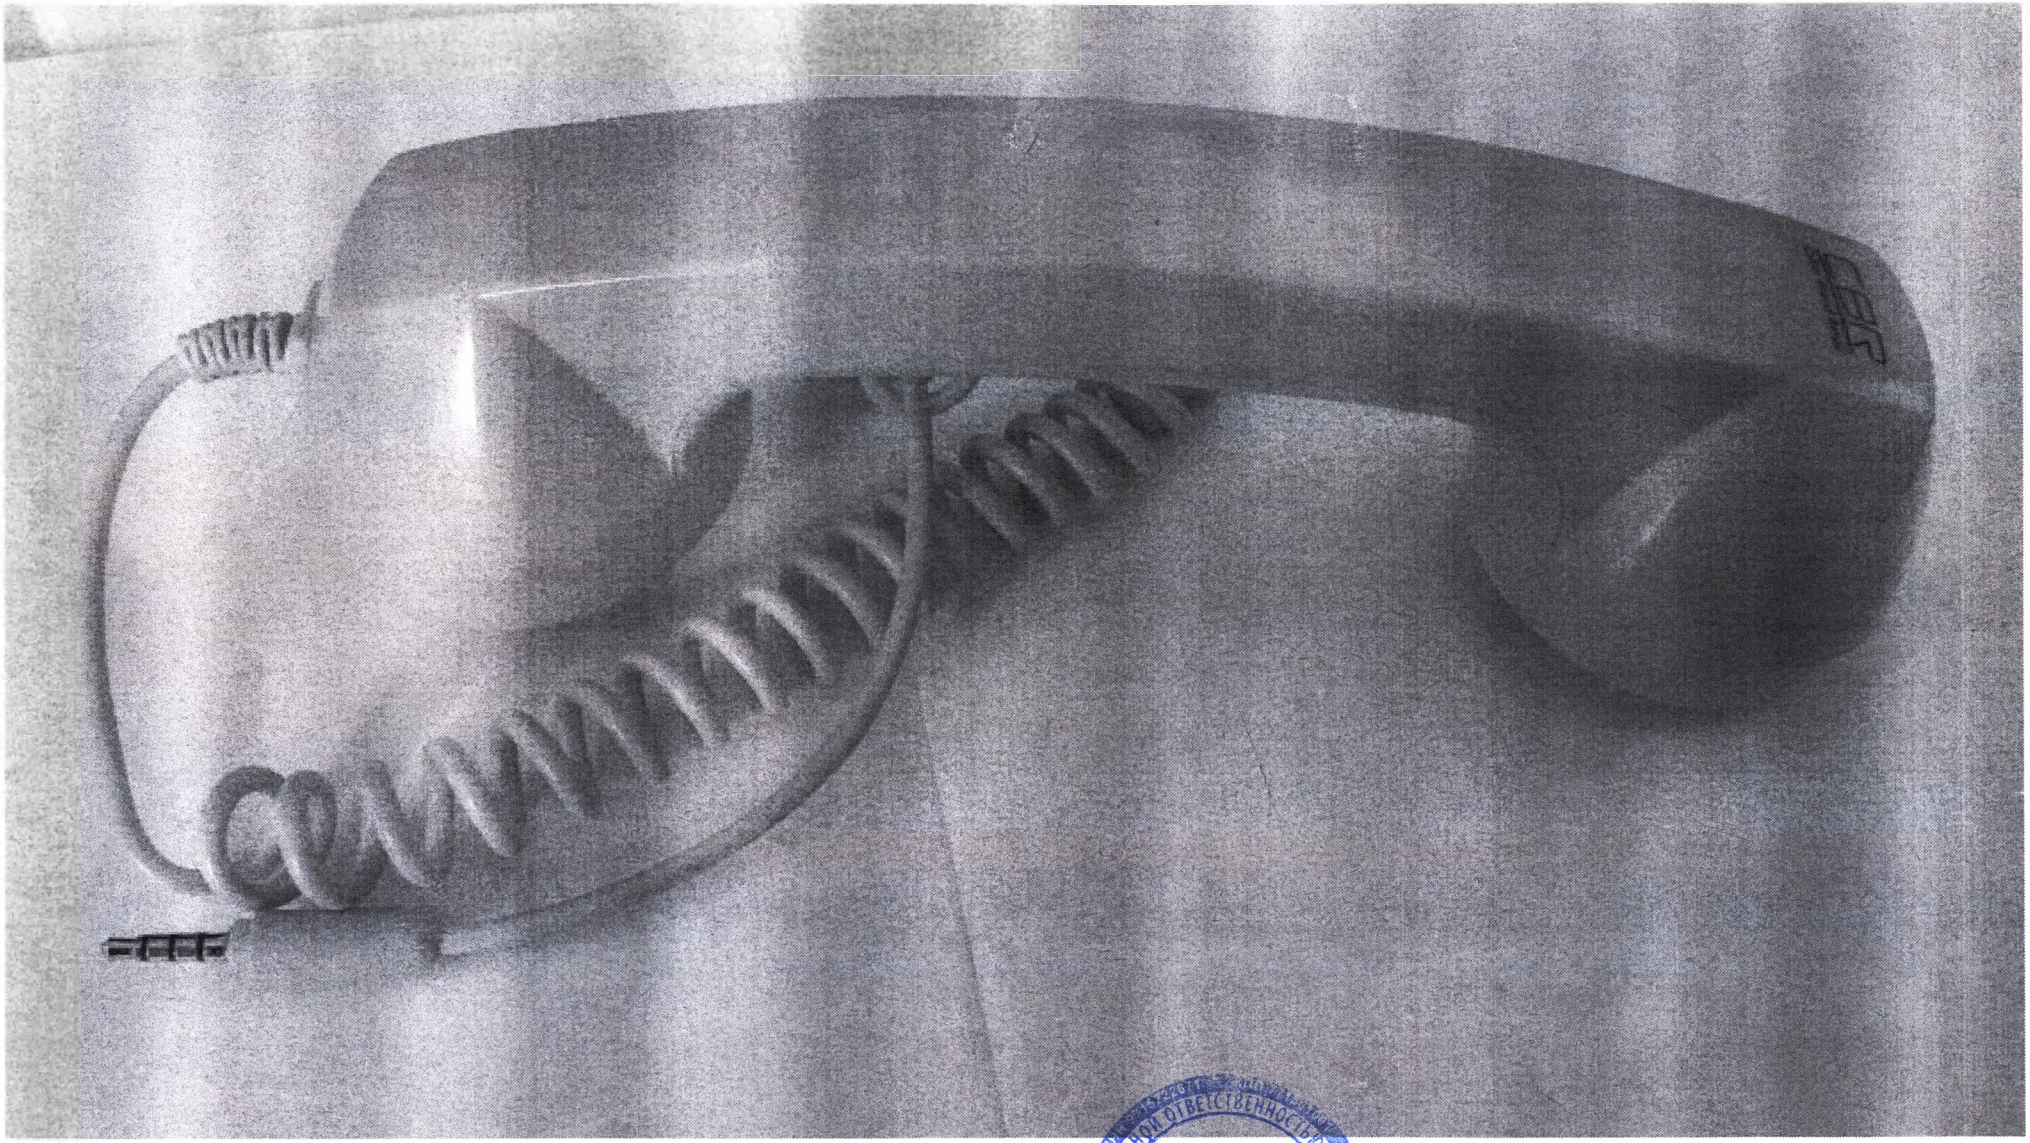

Фотографическое изображение 6. Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018. Принадлежности: 2. Трубка гарнитуры

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Телемедсервис»

_____ Е.А. Сукрышев
«___» _____ 2019 г.

**Маркировочная табличка на корпусе изделия**

Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018

РУ № _____ СЕРИЙНЫЙ № _____

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 220V |
| Частота | 50-60Hz |
| Номинальная мощность | 36 Вт |

**IP20**

Дата изготовления мес, год

Тип BF

**Маркировка коробки**

**Комплекс программно-аппаратный дистанционного медицинского контроля «ДИМЕКО» по ТУ 26.60.12-001-51082790-2018**
Производитель: ООО «Телемедсервис»,
Россия, 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1, стр. 3, эт.6, оф. 16,17
тел. 88001004370
Серийный № __, дата изготовления – _____
Рег.удост. № _____
Хранить при температуре +5 °С до +40 °С
Срок годности 5лет со дня изготовления
Сделано в России

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU