

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»




Е.В. Варлыгин

«18» ноября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


«Материал контрольный для определения эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии
KU, в вариантах исполнения»

Рисунок. Материал для контроля эритроцитов в моче, высокий уровень KU-UQC-01

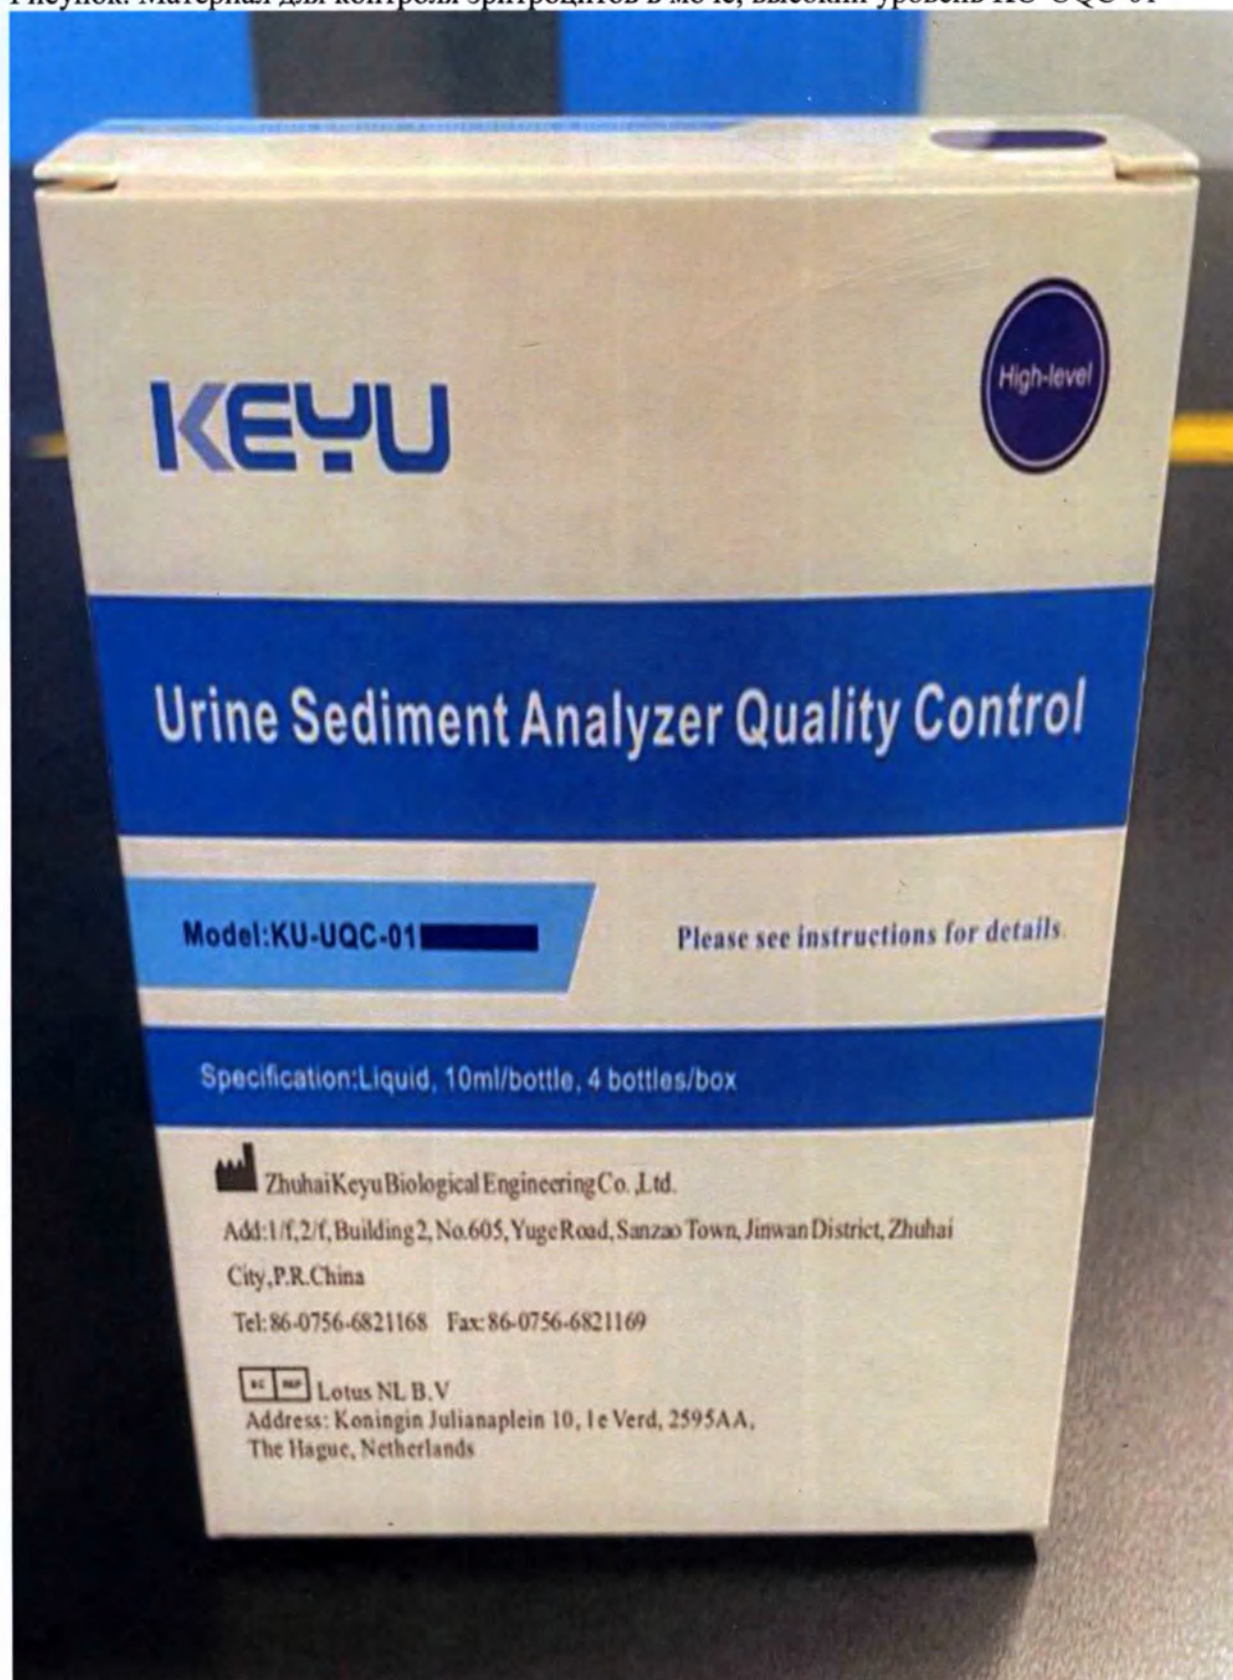





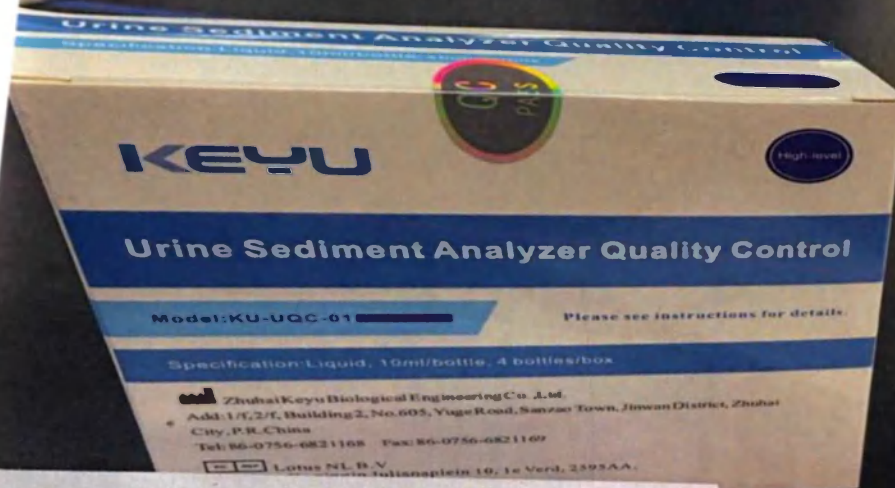

Reference Range of Urine Sediment Analyzer
LOT: B2407014101

Urine Sediment Analyzer	
Model	

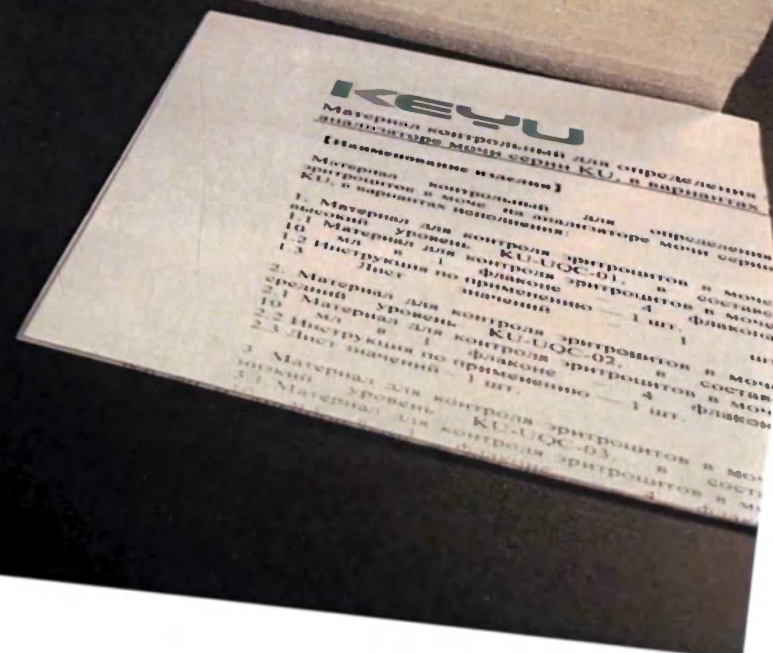


Рисунок. Макет маркировки для обращения на рынке РФ. Материал для контроля эритроцитов в моче, высокий уровень KU-UQC-01

Материал контрольный для определения эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии KU, в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Материал для контроля эритроцитов в моче, высокий уровень KU-UQC-01, в составе:

1. Материал для контроля эритроцитов в моче, 10 мл в 1 флаконе – 4 флакона;
2. Инструкция по применению — 1 шт.
3. Лист значений – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вил.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения указаны на оригинальной упаковке.



Caution:

1. The quality control with Lumpy or flocculent precipitate after mixing can not be used.
2. The used quality control cannot be recycled.
3. The product shall be used within the validity period, do not use the product beyond the validity period.




Рисунок. Материал для контроля эритроцитов в моче, средний уровень KU-UQC-02







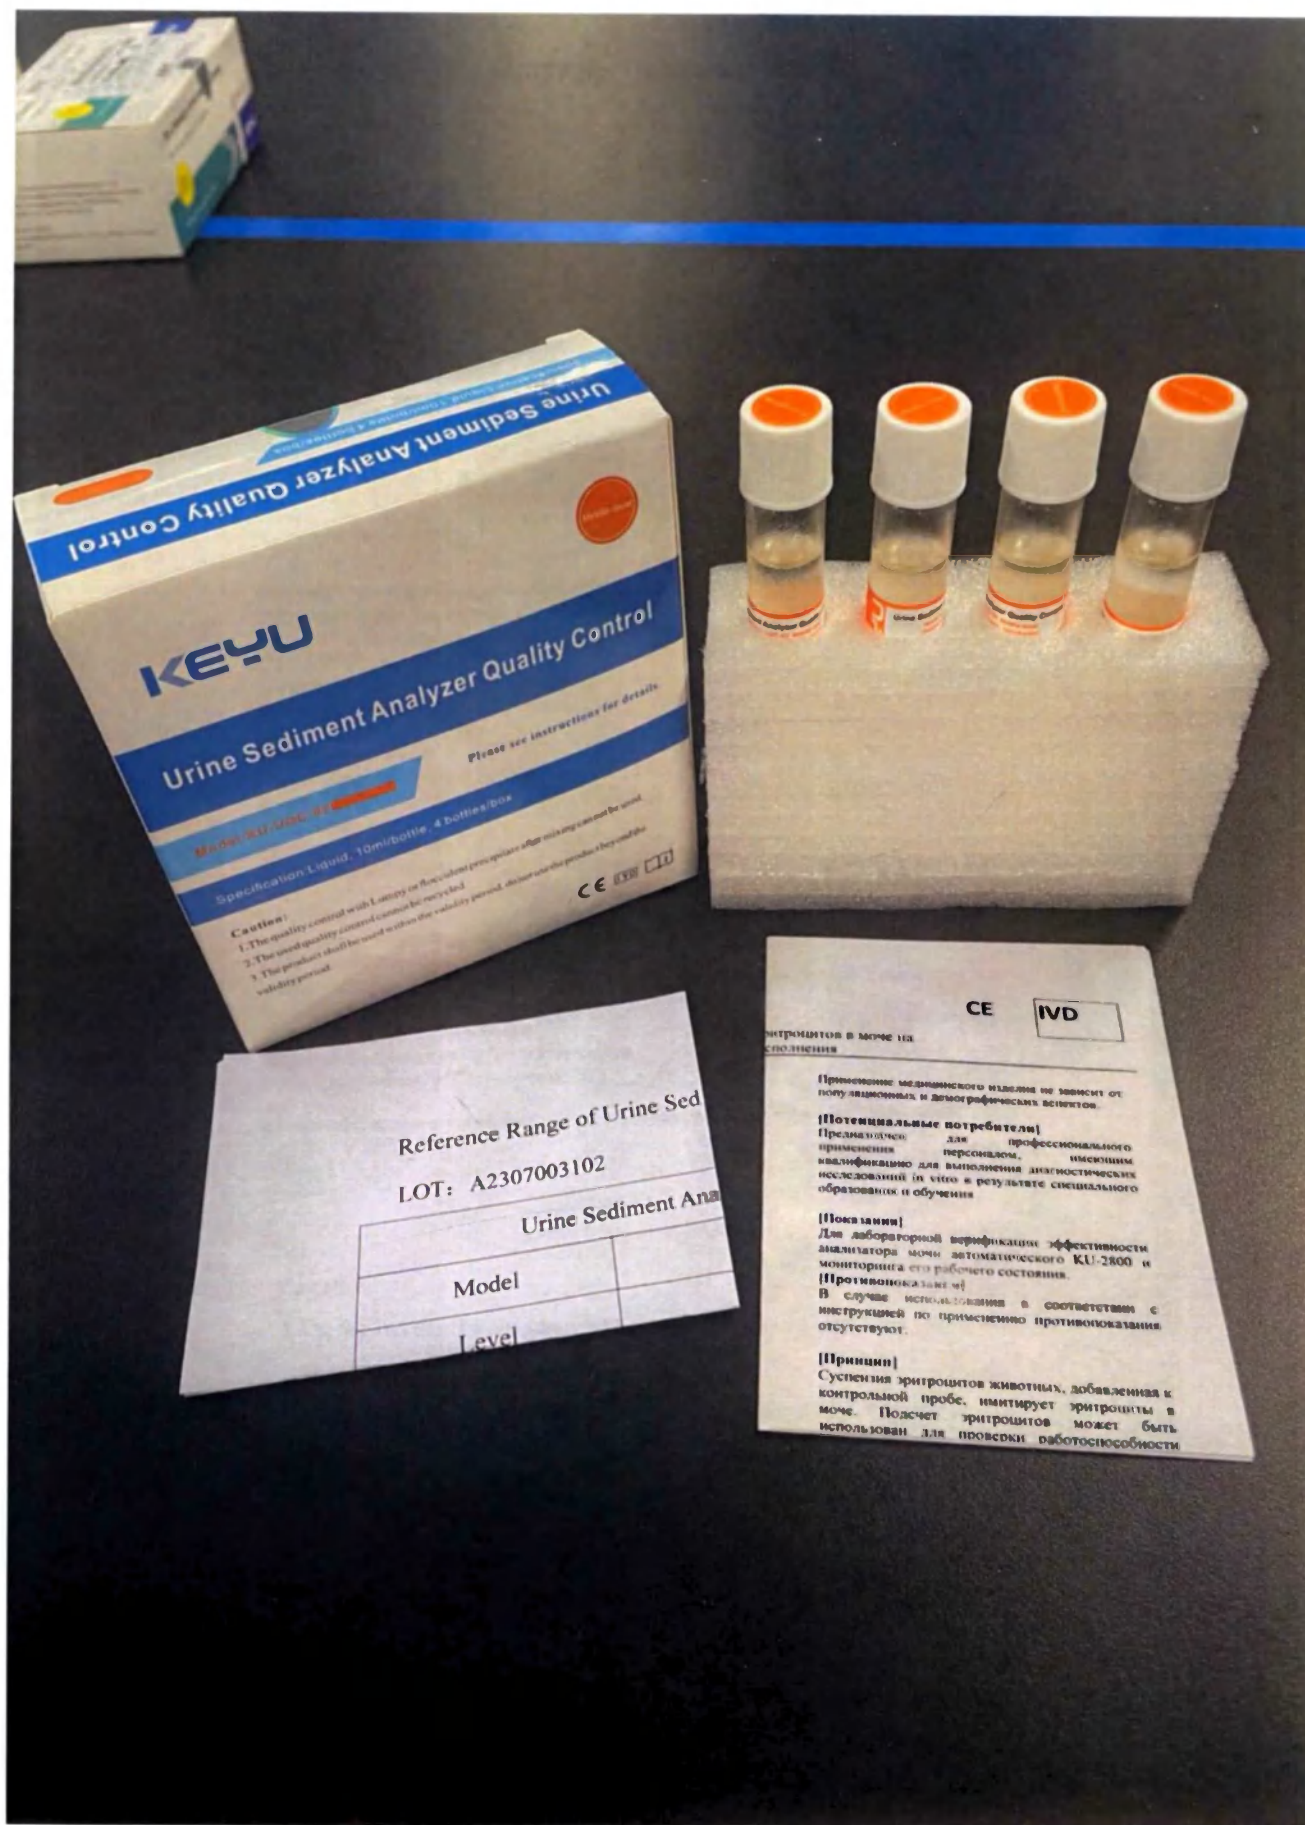


Рисунок. Макет маркировки для обращения на рынке РФ. Материал для контроля эритроцитов в моче, средний уровень KU-UQC-02

Материал контрольный для определения эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии KU, в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Материал для контроля эритроцитов в моче, средний уровень KU-UQC-02, в составе:

1. Материал для контроля эритроцитов в моче, 10 мл в 1 флаконе – 4 флакона;
2. Инструкция по применению — 1 шт.
3. Лист значений – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения указаны на оригинальной упаковке.



Caution:

1. The quality control with Lumpy or flocculent precipitate after mixing can not be used.
2. The used quality control cannot be recycled.
3. The product shall be used within the validity period, do not use the product beyond the validity period.





Рисунок. Материал для контроля эритроцитов в моче, низкий уровень KU-UQC-03



KEYU

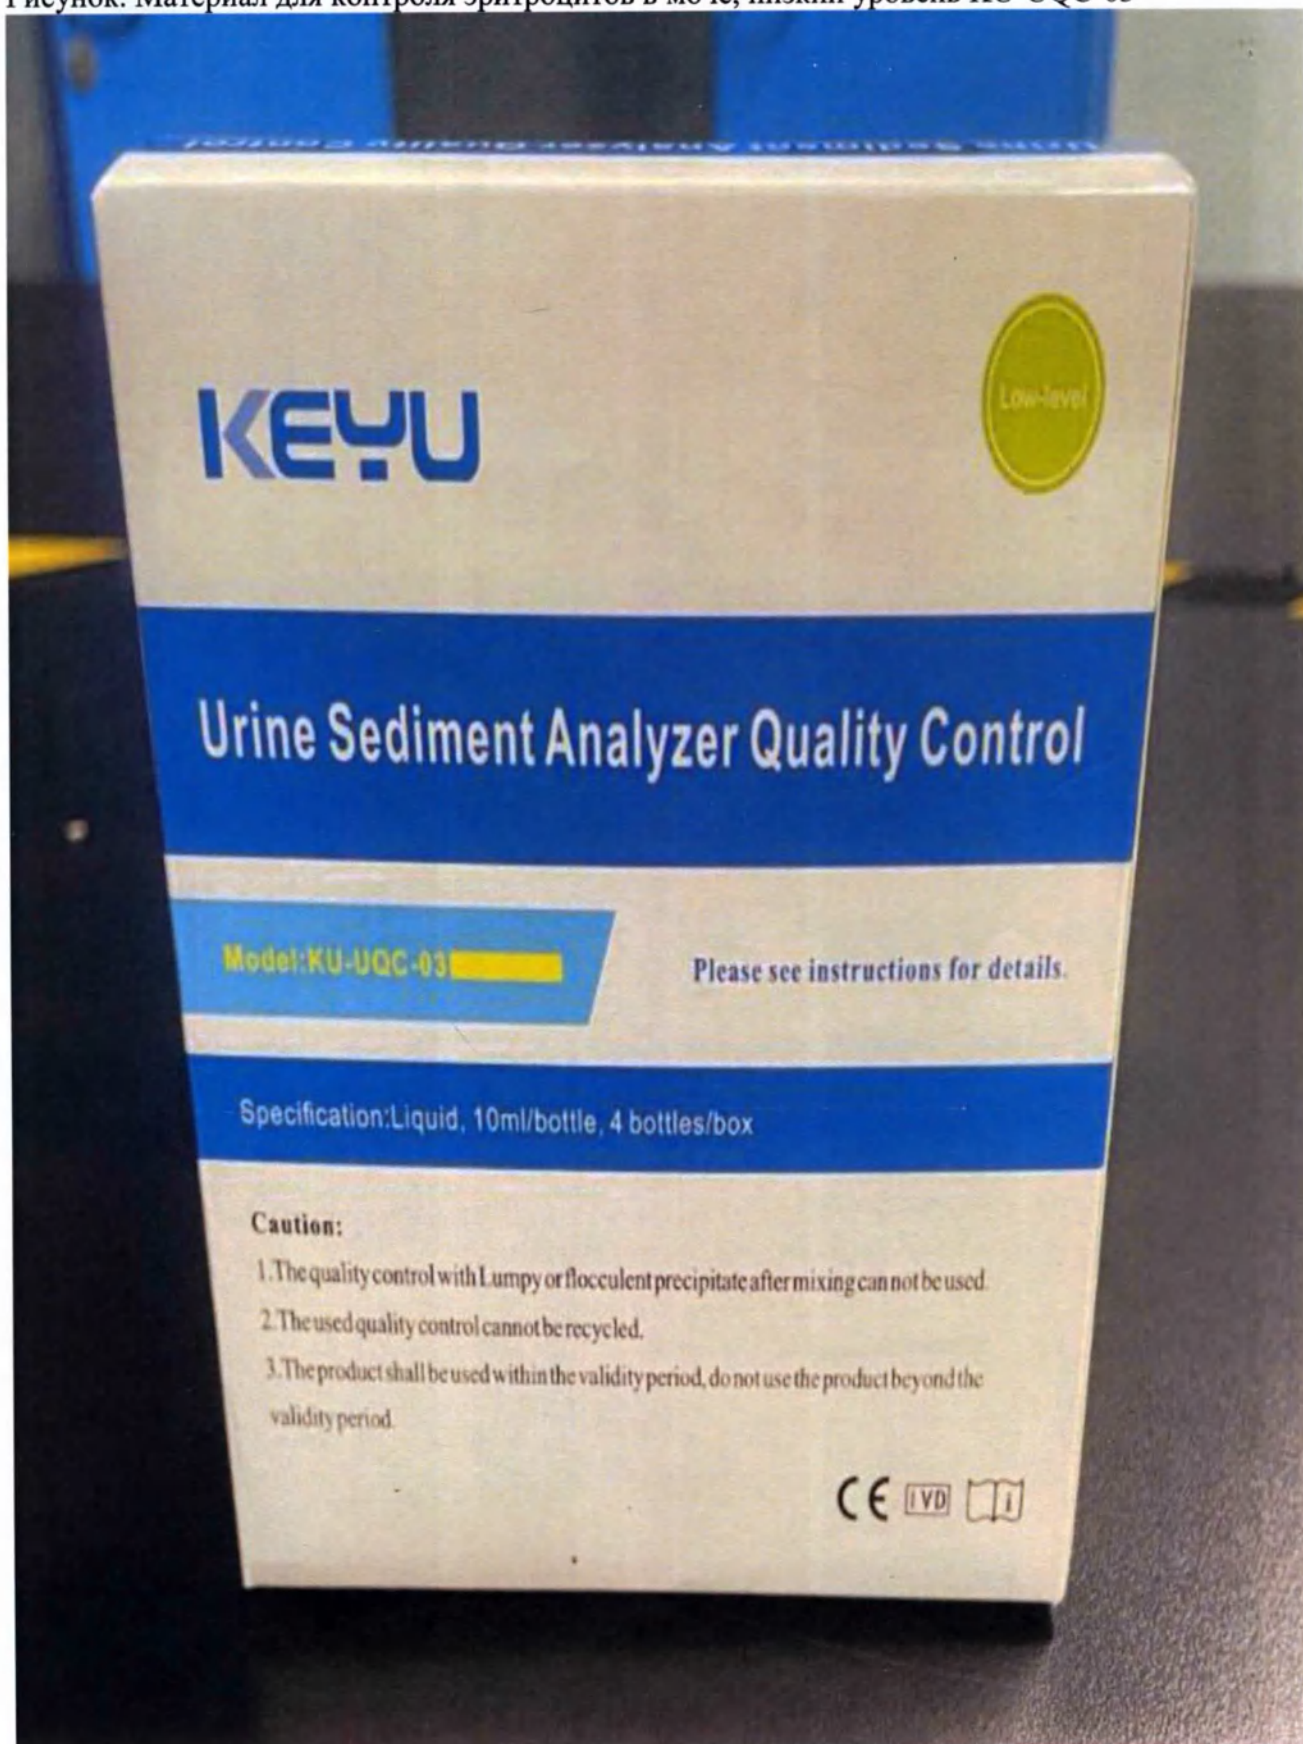

Urine Sediment Analyzer Quality Control


Model: KU-UQC-03

Please see instructions for details.

Specification: Liquid, 10ml/bottle, 4 bottles/box

Caution:

1. The quality control with Lumpy or flocculent precipitate after mixing can not be used.
2. The used quality control cannot be recycled.
3. The product shall be used within the validity period, do not use the product beyond the validity period.









Reference Range of Urine Sed

LOT: B2407015103

Urine Sediment An

Model

KEYU

Материал контрольный для определения
эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии
KU, в вариантах исполнения:

1. Материал для контроля эритроцитов в моче, высокий уровень KU-UQC-01, в составе: 10 мл в 1 флаконе — 4 флакона; Инструкция по применению — 1 шт.
2. Материал для контроля эритроцитов в моче, средний уровень KU-UQC-02, в составе: 10 мл в 1 флаконе — 4 флакона; Инструкция по применению — 1 шт.
3. Материал для контроля эритроцитов в моче, низкий уровень KU-UQC-03, в составе: 10 мл в 1 флаконе — 4 флакона; Инструкция по применению — 1 шт.

Рисунок. Макет маркировки для обращения на рынке РФ. Материал для контроля эритроцитов в моче, низкий уровень KU-UQC-03

Материал контрольный для определения эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии KU, в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Материал для контроля эритроцитов в моче, низкий уровень KU-UQC-03, в составе:

1. Материал для контроля эритроцитов в моче, 10 мл в 1 флаконе – 4 флакона;
2. Инструкция по применению — 1 шт.
3. Лист значений – 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения указаны на оригинальной упаковке.



Caution:

1. The quality control with Lumpy or flocculent precipitate after mixing can not be used.
2. The used quality control cannot be recycled.
3. The product shall be used within the validity period, do not use the product beyond the validity period.


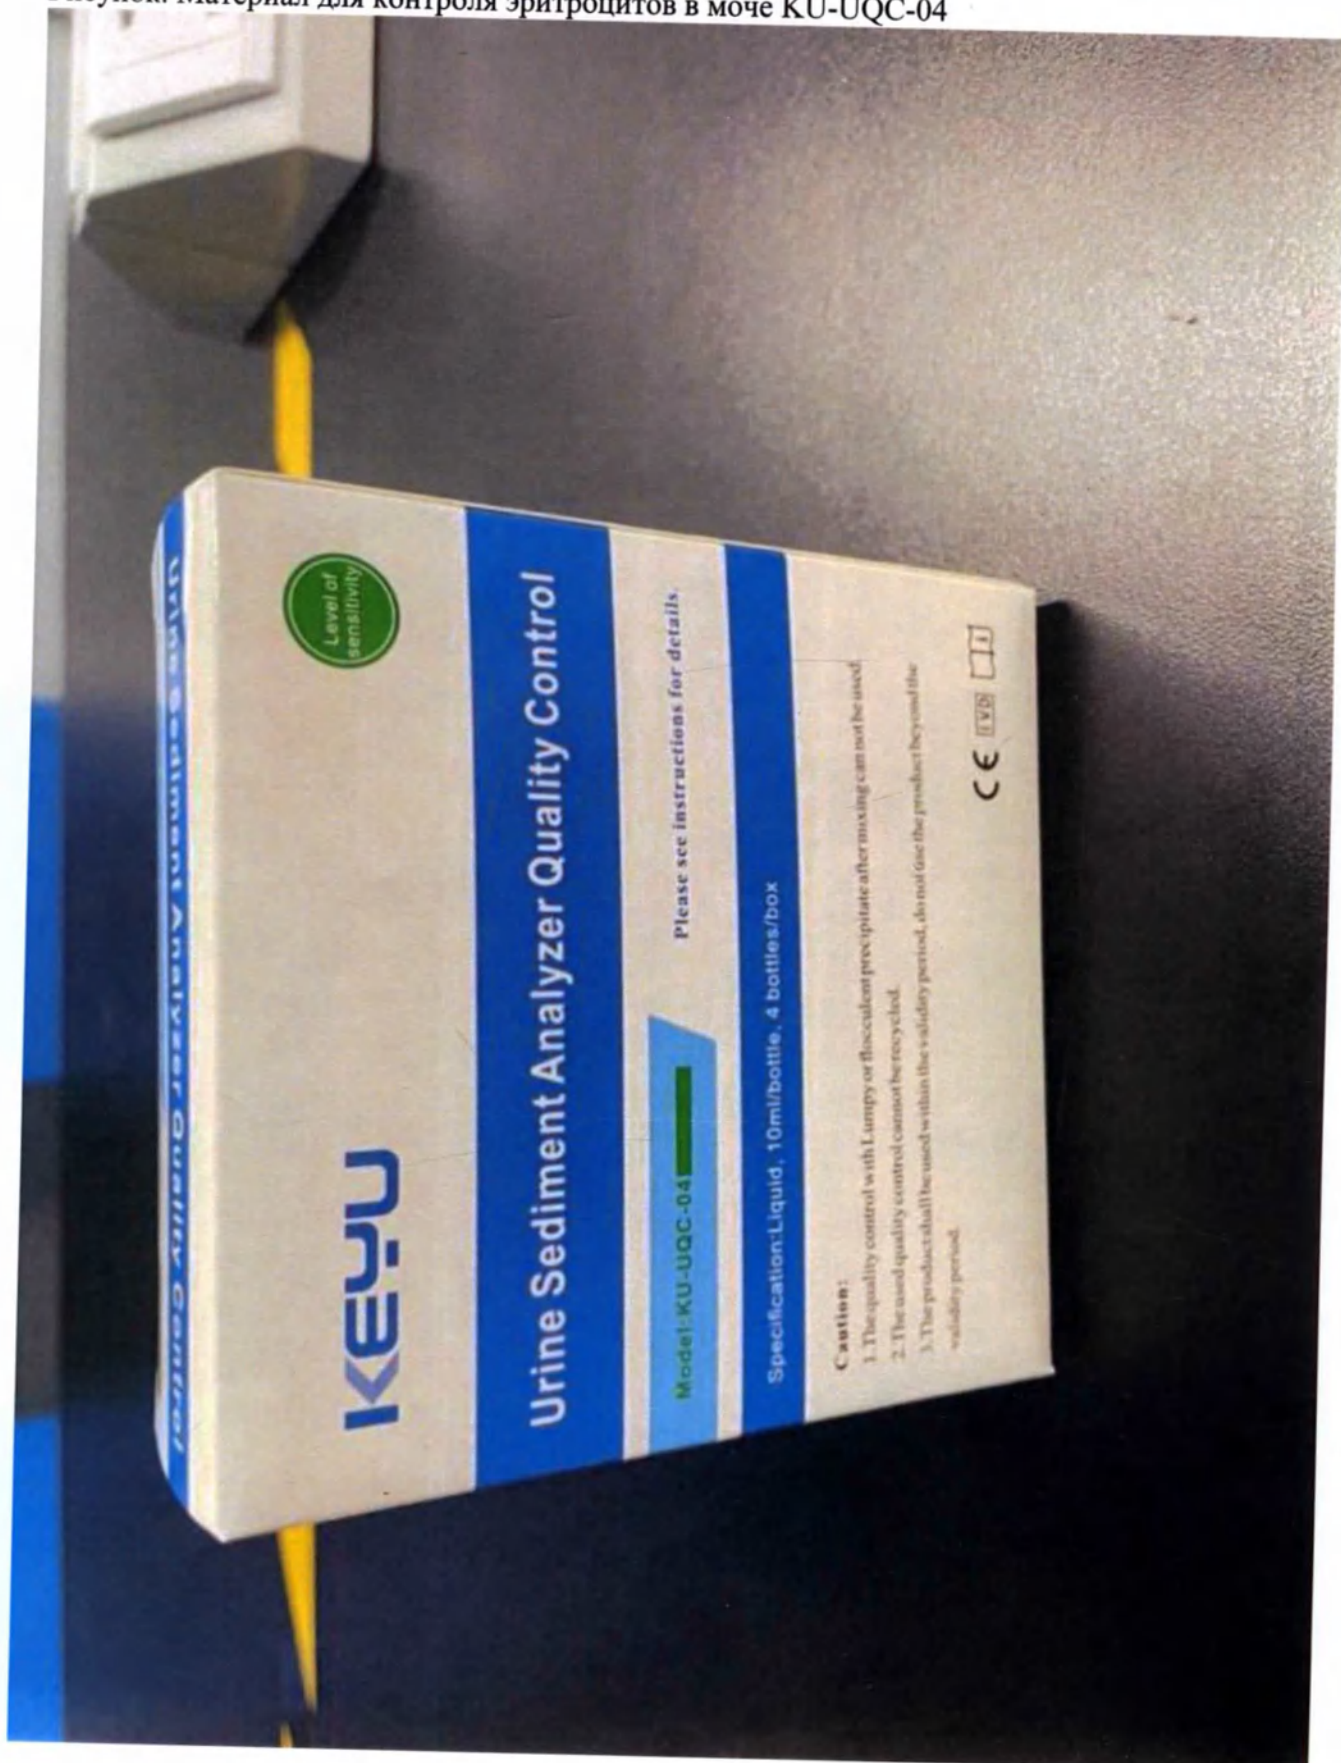


Рисунок. Материал для контроля эритроцитов в моче KU-UQC-04







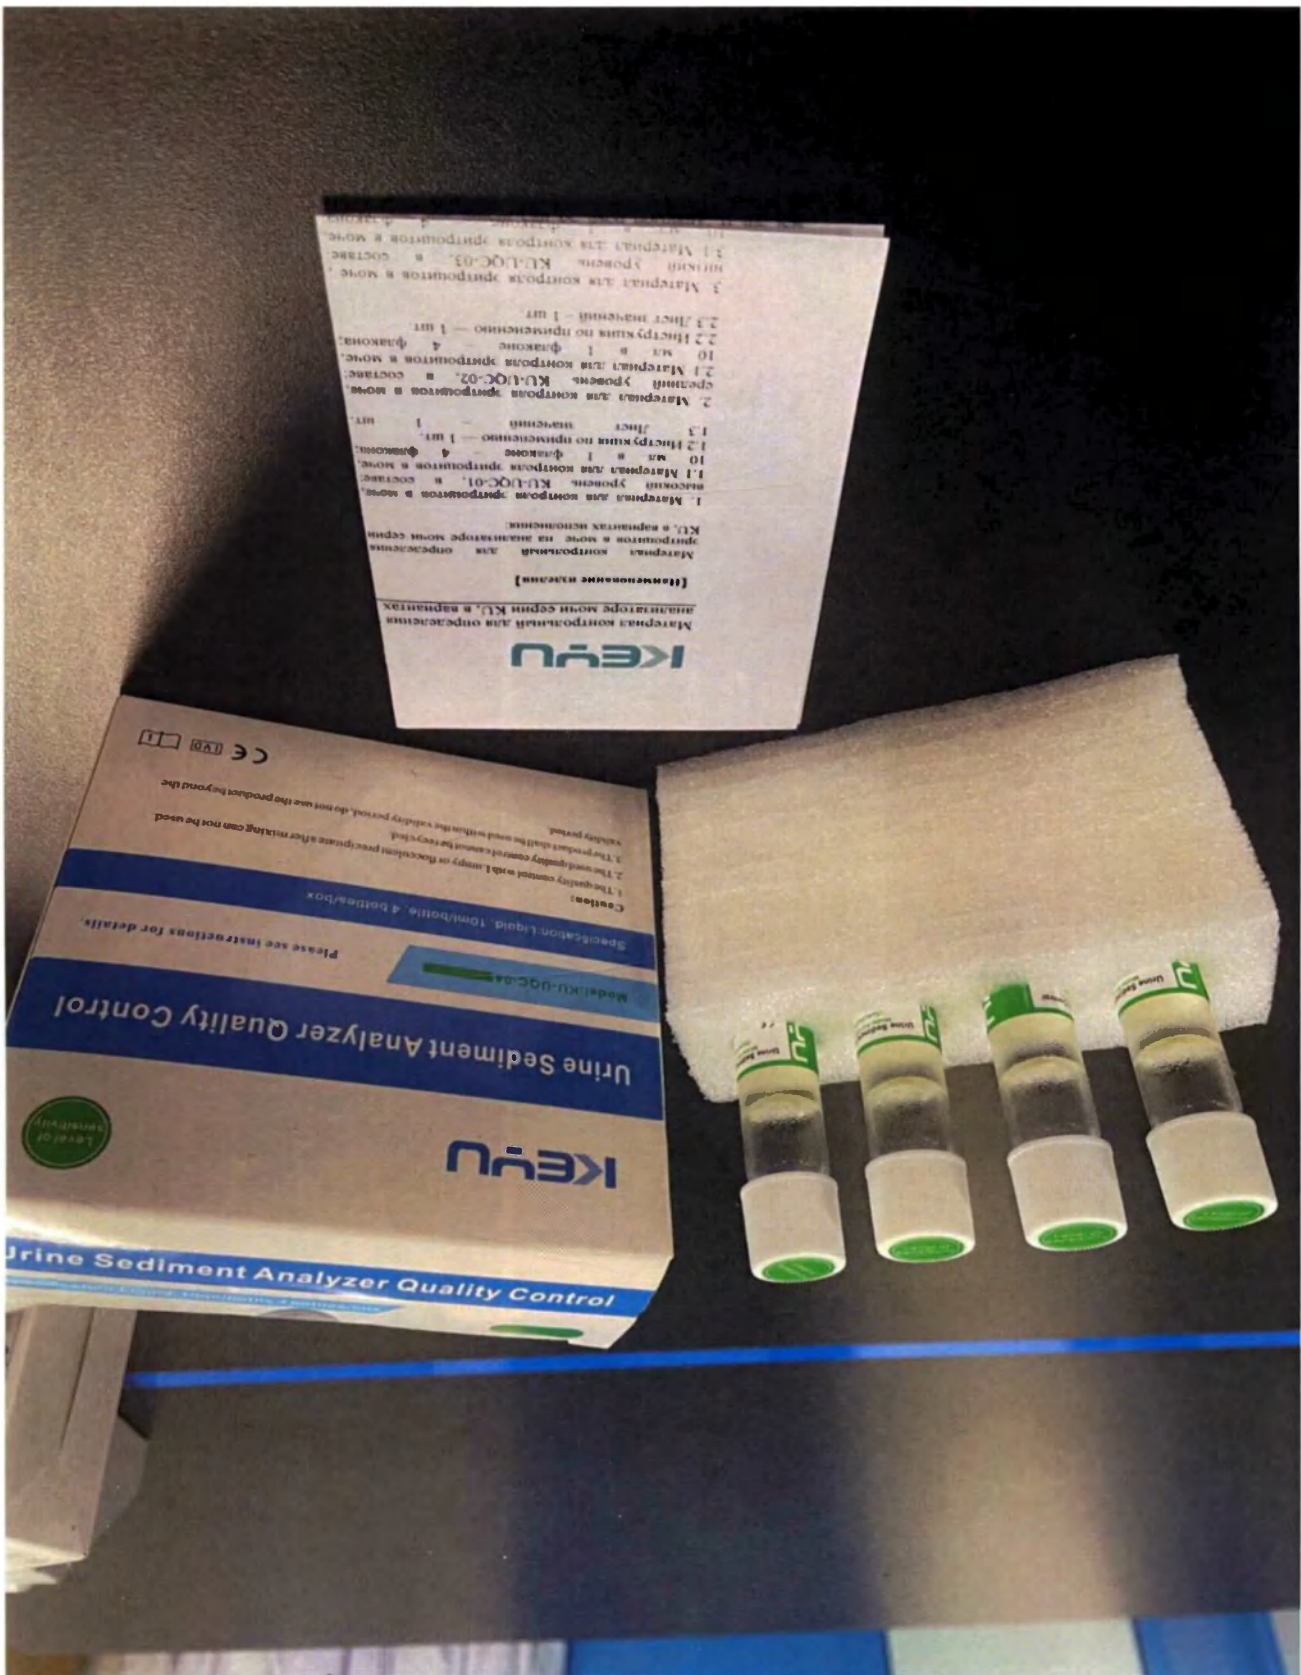


Рисунок. Макет маркировки для обращения на рынке РФ. Материал для контроля эритроцитов в моче KU-UQC-04

Материал контрольный для определения эритроцитов в моче на анализаторе мочи серии KU, в вариантах исполнения

Вариант исполнения: Материал для контроля эритроцитов в моче KU-UQC-04, в составе:

1. Материал для контроля эритроцитов в моче, 10 мл в 1 флаконе – 4 флакона;
2. Инструкция по применению — 1 шт.

Производитель

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Место производства

Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.

1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China

Уполномоченный представитель производителя в РФ

ООО «КИФА»;

Адрес: 109316, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3

Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Состав изделия, номер серии, срок годности, условия хранения указаны на оригинальной упаковке.



Caution:

- 1.The quality control with Lumpy or flocculent precipitate after mixing can not be used.
- 2.The used quality control cannot be recycled.
- 3.The product shall be used within the validity period, do not use the product beyond the validity period.



и скреплено печатью

21/Двадцать один)

лист(-ов)

Генеральный директор ООО «КИФА»



Е.В.Варль