



Общество с ограниченной ответственностью «РК Групп»

364047, Чеченская республика, г. Грозный, ул. Кемеровская, 12

тел. (8712) 29-26-73, e-mail: info@rkgroupgrozny.ru

ОКПО 28604018, ОГРН 1182036003060

ИНН/КПП 2016004205/201601001

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

БИК 040702615, к/с 30101810907020000615, р/с 40702810260360002614

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «РК Групп»



Кумар Раджив

сентября 2021 г.

Фотографические изображения

маркировки и медицинского изделия

Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным
покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019

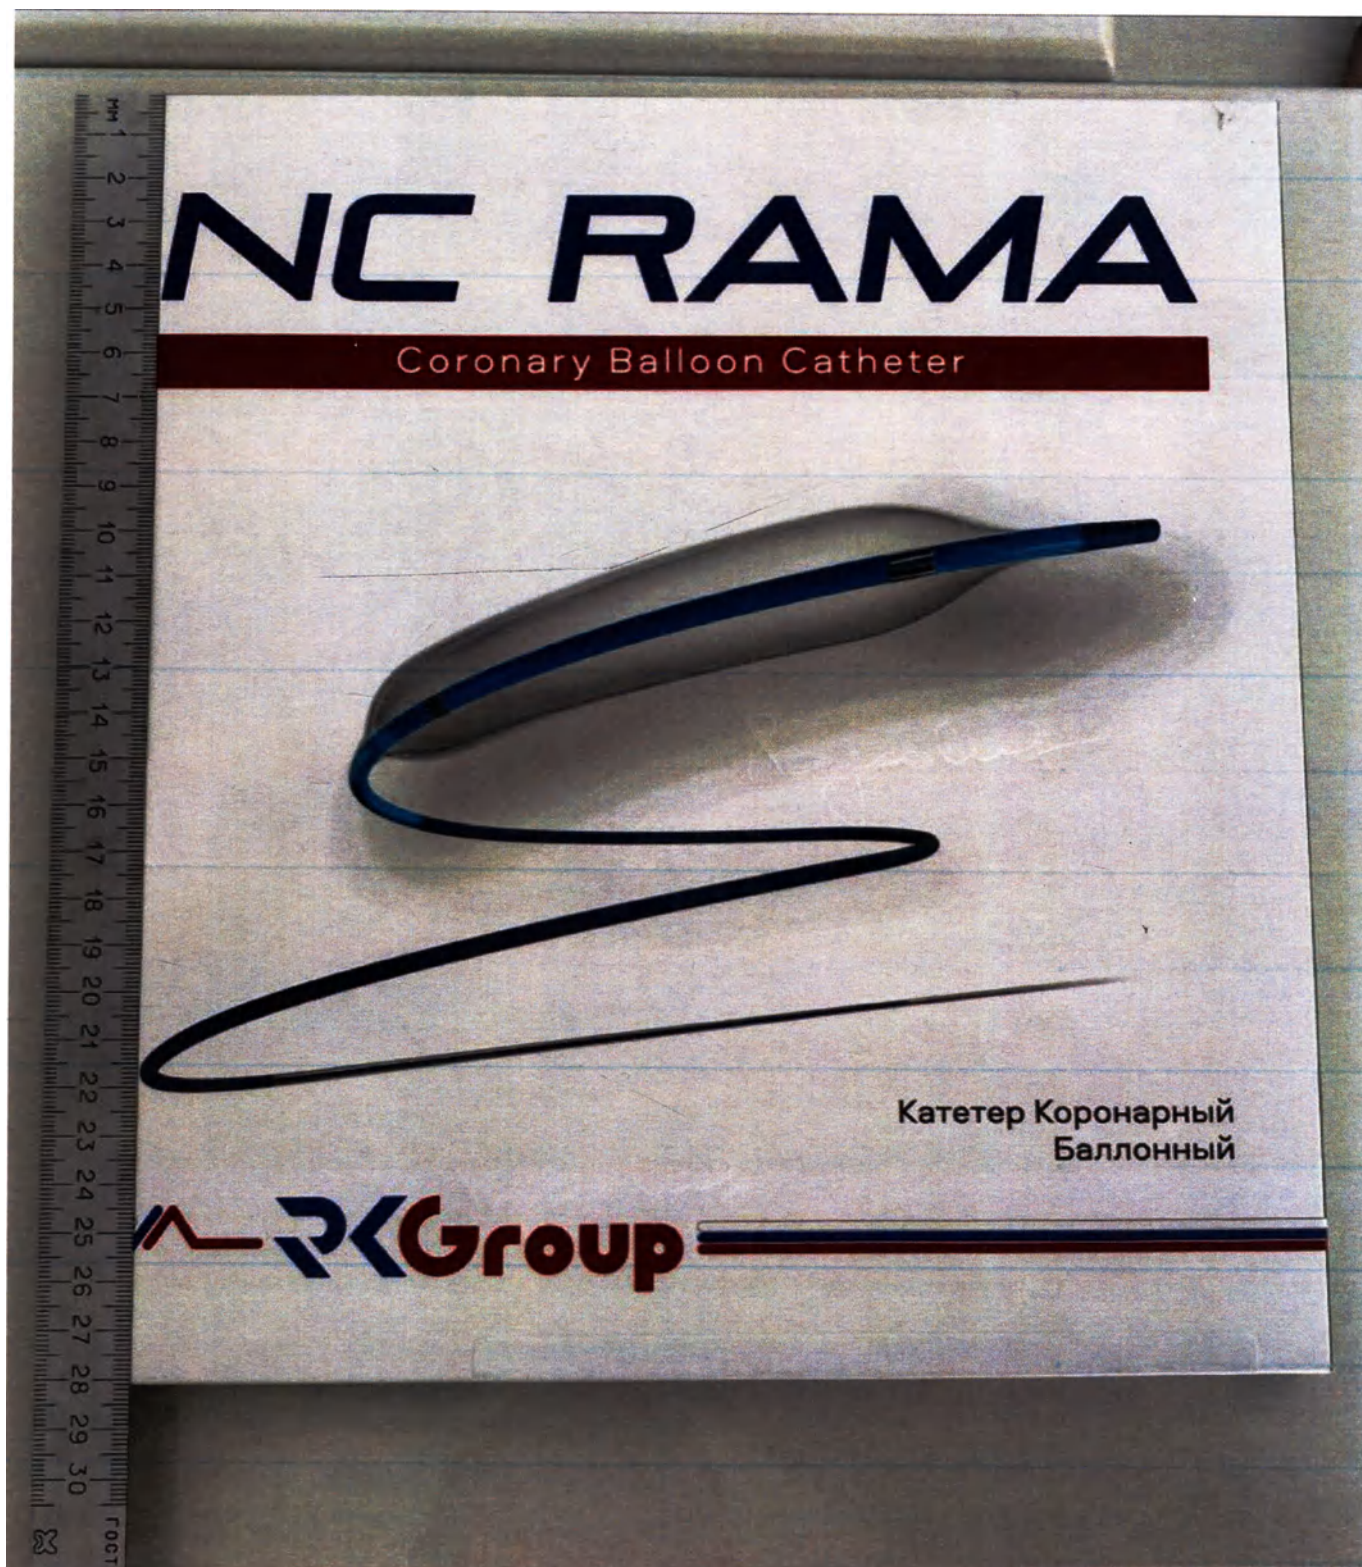


Рисунок 1. Общий вид вторичной упаковки (с указанием размера) медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные высокого давления NC RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13- 002-28604018-2019.

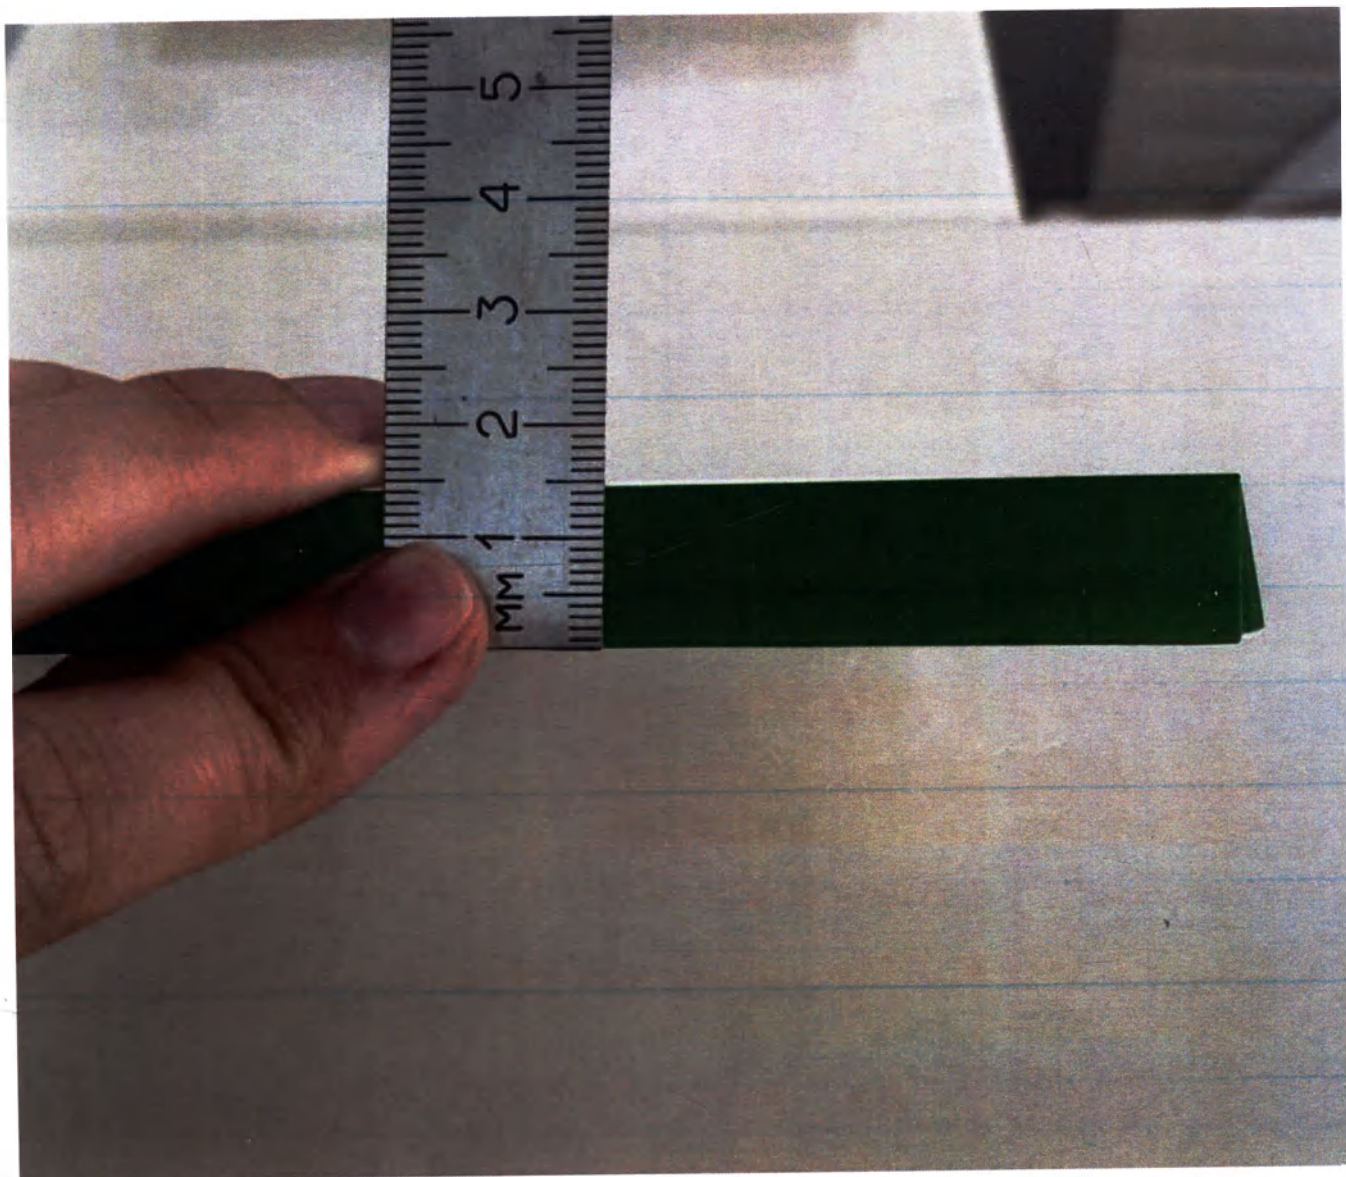


Рисунок 2. Общий вид вторичной упаковки (с указанием размера) медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные высокого давления NC RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.

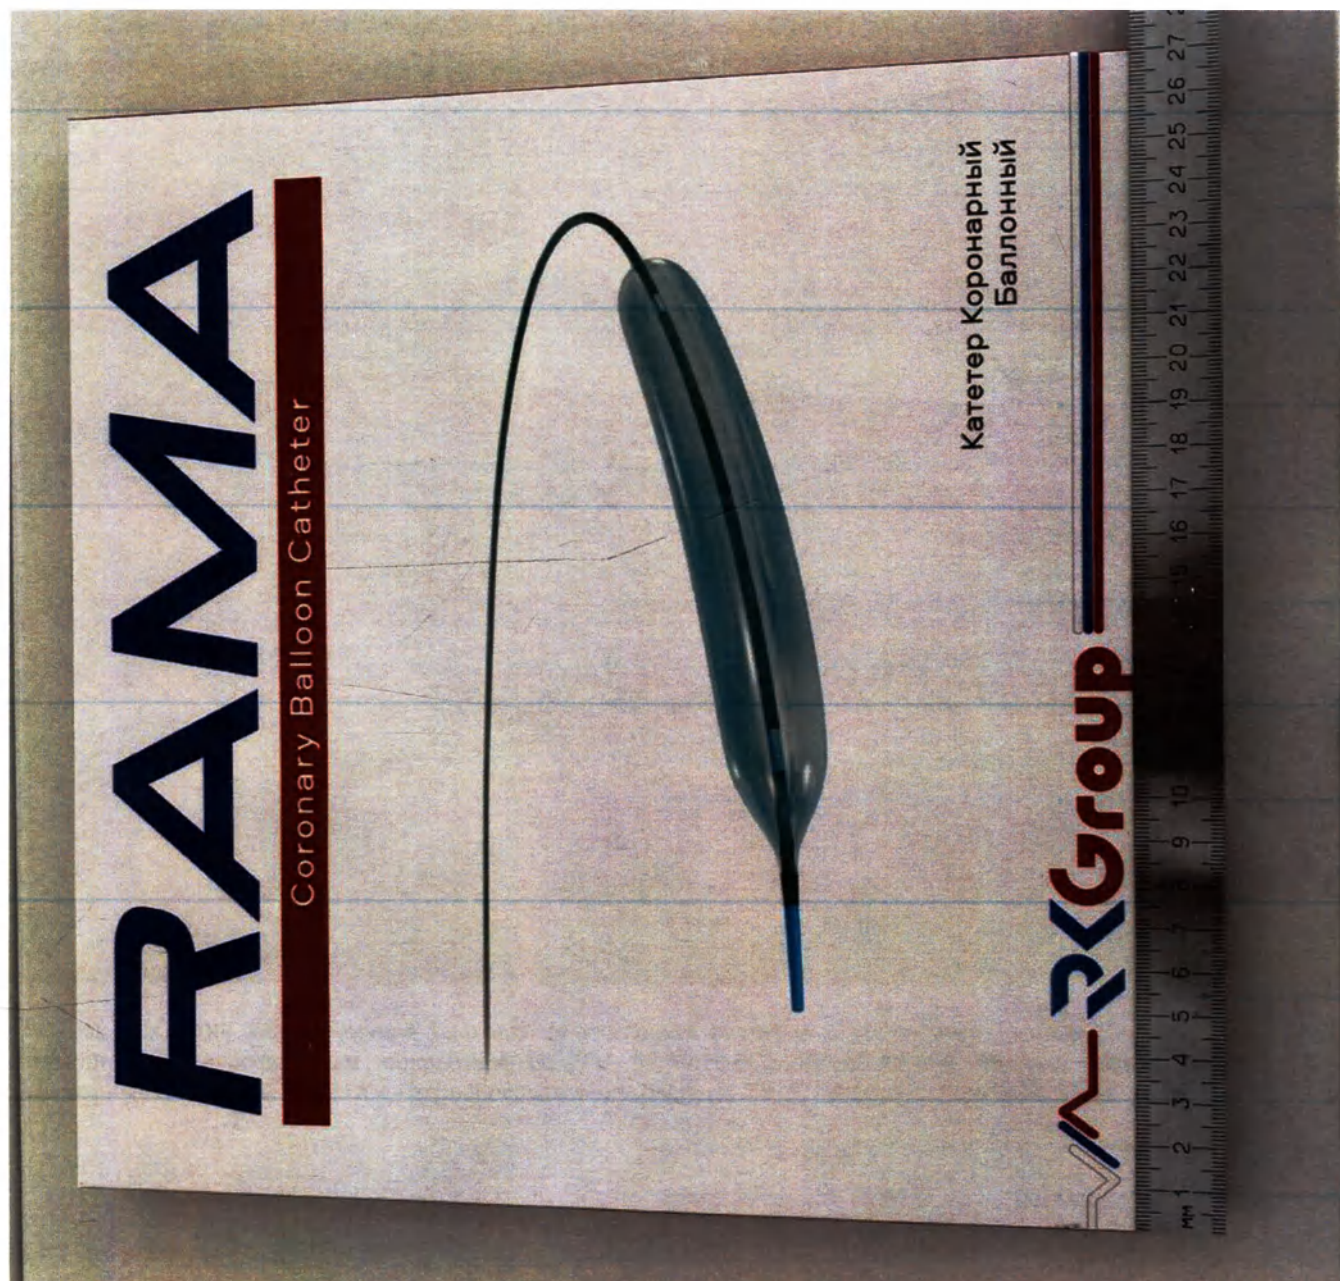


Рисунок 3. Общий вид вторичной упаковки (с указанием размера) медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.


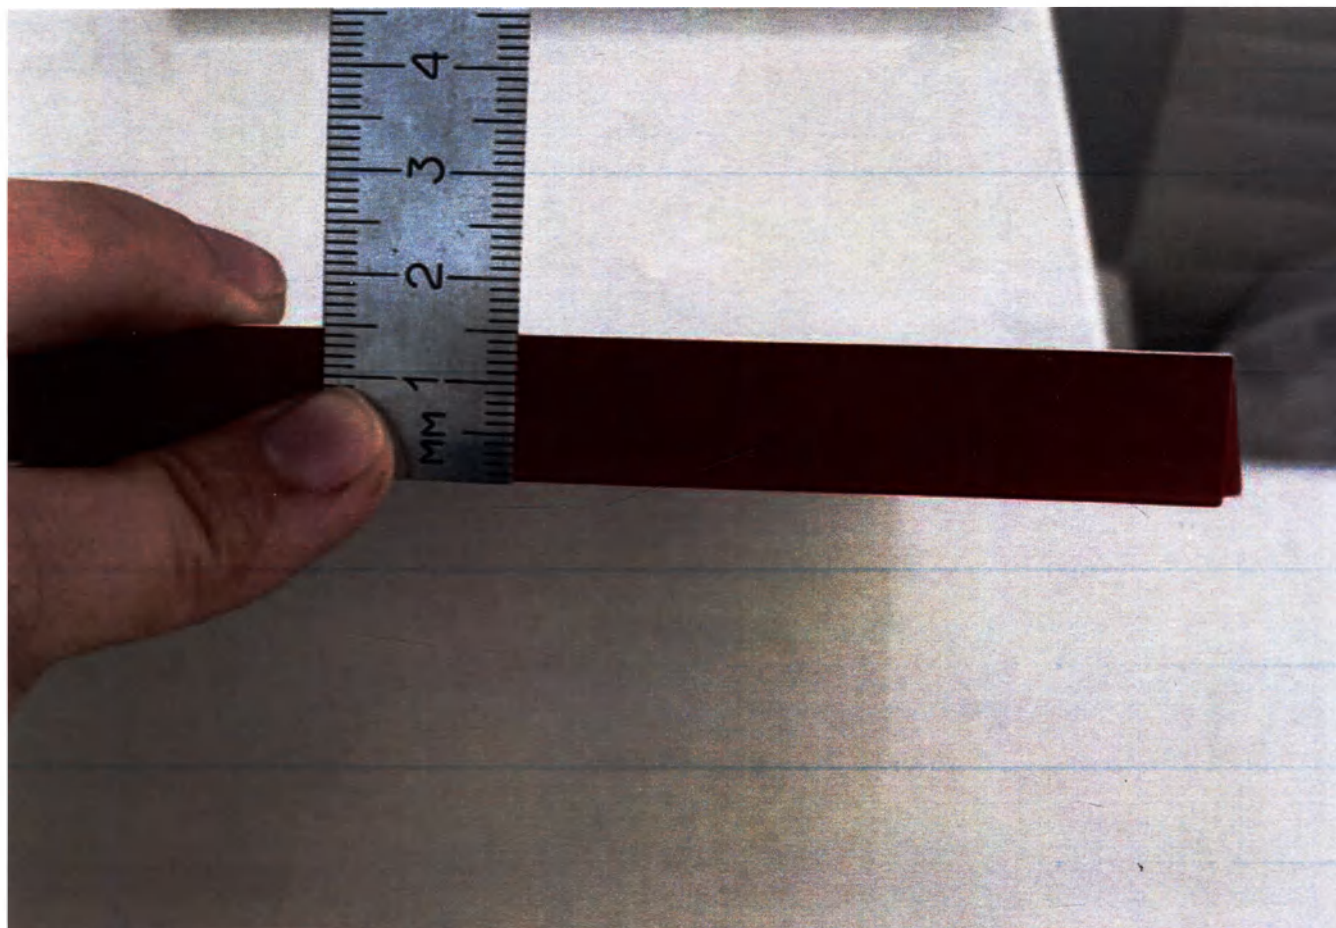


Рисунок 4. Общий вид вторичной упаковки (с указанием размера) медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.

ООО «РК ГРУП» РФ, 364047, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Кемеровская, 12
RK GROUP LLC, Russia, 364047, Chechen Republic, Grozny, 12 Kemerovskaya st.

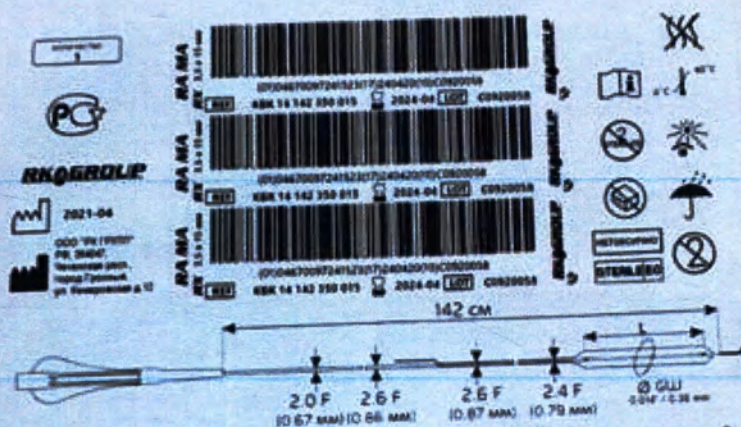

Катетер коронарный баллонный RA MA
с гидрофильным покрытием

ТУ 32.50.13-002-28604018-2019
ПУ Н РЗН 2021/13781 от 24.03.21

тип проводящего катетера
5F

проводник
0.014" - 0.36 mm

гидрофильный

ДАВЛЕНИЕ			mmHg
mmHg	mm	mm	
100	5	10	1.52
150	7	15	1.58
200	8	20	1.61
250	9	25	1.64
300	10	30	1.66
350	11	35	1.70
400	12	40	1.73
450	13	45	1.76
500	14	50	1.79
550	15	55	1.81
600	16	60	1.84
650	17	65	1.86
700	18	70	1.88
750	19	75	1.90
800	20	80	1.94

RA MA™

RK GROUP

www.rkgroup.ru
info@rkgroup.ru
8 800 222 13 13
Произведено в России

КАРД КАТЕТЕРЫ СЕРИИ RA MA / KATETER KORONARNYI BALLONNYI VYSTROYI
RA MA **3,5 mm** **15 mm** **LOT C0920058** **2024-04**
КЕК 14 142 350 015

Рисунок 5. Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, общий вид макета этикетки на картонной коробке (вторичной упаковке).

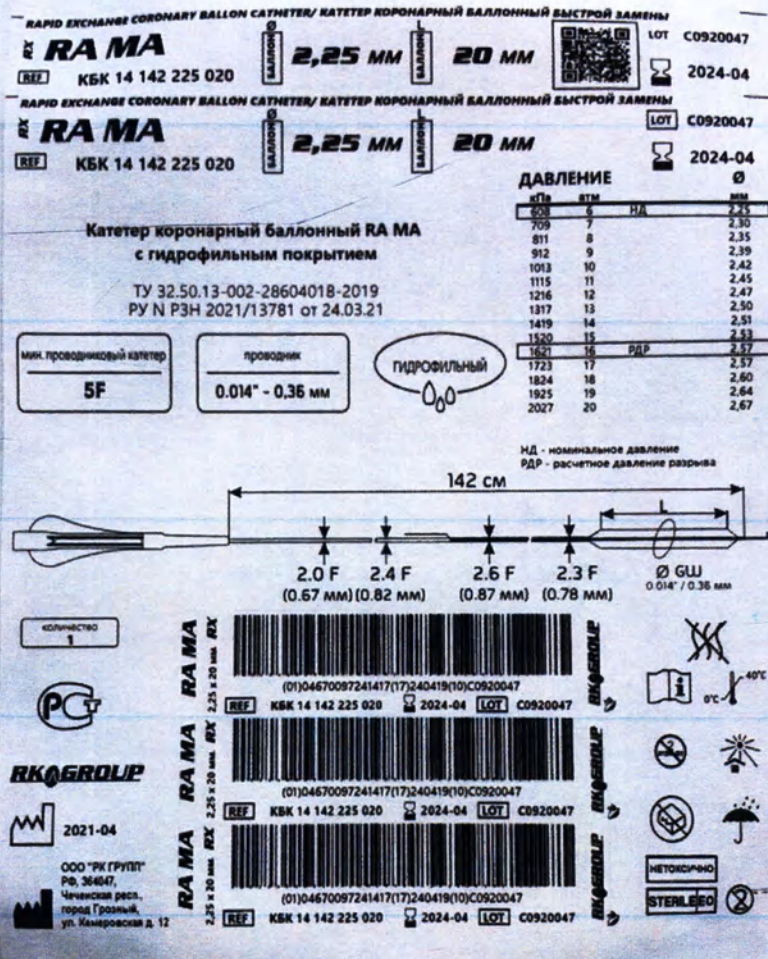


Рисунок 6. Общий вид первичной упаковки медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.

NC RA MA

КБК НК 14 142 325 015

3,25 mm 15 mm

Катетер коронарный баллонный
высокого давления NC RA MA с
гидрофильным покрытием

ТУ 32.50.13-002-28604018-2019
ПУ № РЭН 2021/13781 от 24.03.21

мин. проводников катетер

5F

проводник

0.014" - 0.36 mm


ГИДРОФИЛЬНЫЙ



ДАВЛЕНИЕ

мм рт.ст.	мм ВТМ	мм
508	6	2,96
709	7	3,00
811	8	3,05
912	9	3,10
1013	10	3,15
1115	11	3,20
1216	12	3,24
1317	13	3,27
1419	14	3,30
1520	15	3,33
1621	16	3,35
1723	17	3,38
1824	18	3,40
1925	19	3,42
2027	20	3,44
2128	21	3,46
2229	22	3,48

НД - номинальное давление
РДР - расчетное давление разрыва

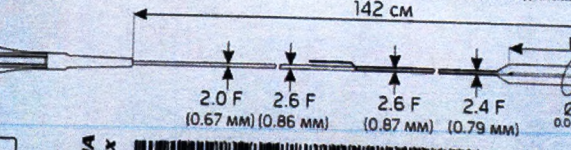

NC RA MA

КБК НК 14 142 325 015

3,25 x 15 mm

Катетер коронарный баллонный
высокого давления NC RA MA с
гидрофильным покрытием

ТУ 32.50.13-002-28604018-2019
ПУ № РЭН 2021/13781 от 24.03.21

мин. проводников катетер

5F

проводник

0.014" - 0.36 mm


ГИДРОФИЛЬНЫЙ



ДАВЛЕНИЕ

мм рт.ст.	мм ВТМ	мм
508	6	2,96
709	7	3,00
811	8	3,05
912	9	3,10
1013	10	3,15
1115	11	3,20
1216	12	3,24
1317	13	3,27
1419	14	3,30
1520	15	3,33
1621	16	3,35
1723	17	3,38
1824	18	3,40
1925	19	3,42
2027	20	3,44
2128	21	3,46
2229	22	3,48

НД - номинальное давление
РДР - расчетное давление разрыва

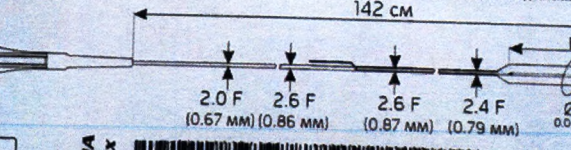

NC RA MA

КБК НК 14 142 325 015

3,25 x 15 mm

Катетер коронарный баллонный
высокого давления NC RA MA с
гидрофильным покрытием

ТУ 32.50.13-002-28604018-2019
ПУ № РЭН 2021/13781 от 24.03.21

мин. проводников катетер

5F

проводник

0.014" - 0.36 mm

ГИДРОФИЛЬНЫЙ



ДАВЛЕНИЕ

мм рт.ст.	мм ВТМ	мм
508	6	2,96
709	7	3,00
811	8	3,05
912	9	3,10
1013	10	3,15
1115	11	3,20
1216	12	3,24
1317	13	3,27
1419	14	3,30
1520	15	3,33
1621	16	3,35
1723	17	3,38
1824	18	3,40
1925	19	3,42
2027	20	3,44
2128	21	3,46
2229	22	3,48

НД - номинальное давление
РДР - расчетное давление разрыва

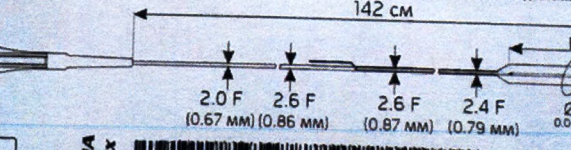


Рисунок 8. Общий вид первичной упаковки медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные высокого давления NC RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.

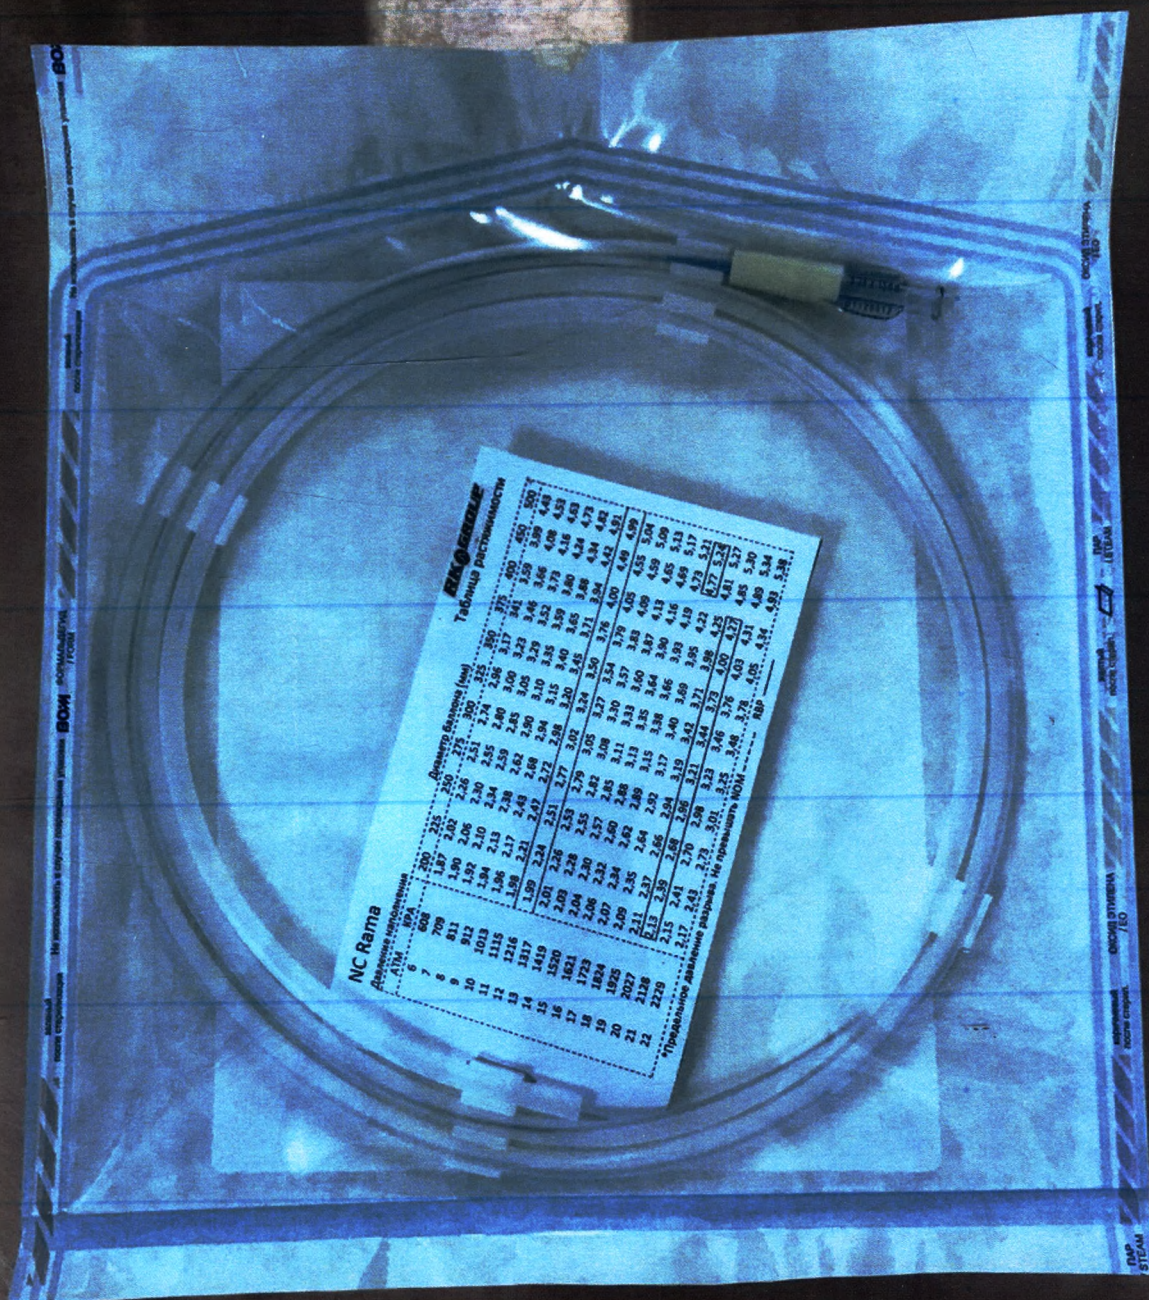


Рисунок 9. Общий вид первичной упаковки с обратной стороны медицинского изделия Катетеры коронарные баллонные с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019, вариант исполнения Катетеры коронарные баллонные высокого давления NC RA MA с гидрофильным покрытием по ТУ 32.50.13-002-28604018-2019.

Верно

Прошито, пронумеровано и

Скреплено печатью на 10 лист ах

Генеральный директор ООО «РК Групп»

Кумар Раджив / [Signature]

