
Фото набора реагентов

«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр»


«ИФА-Эпштейн-Барр-IgG» с принадлежностями

серия 03 от 11.2015 г.

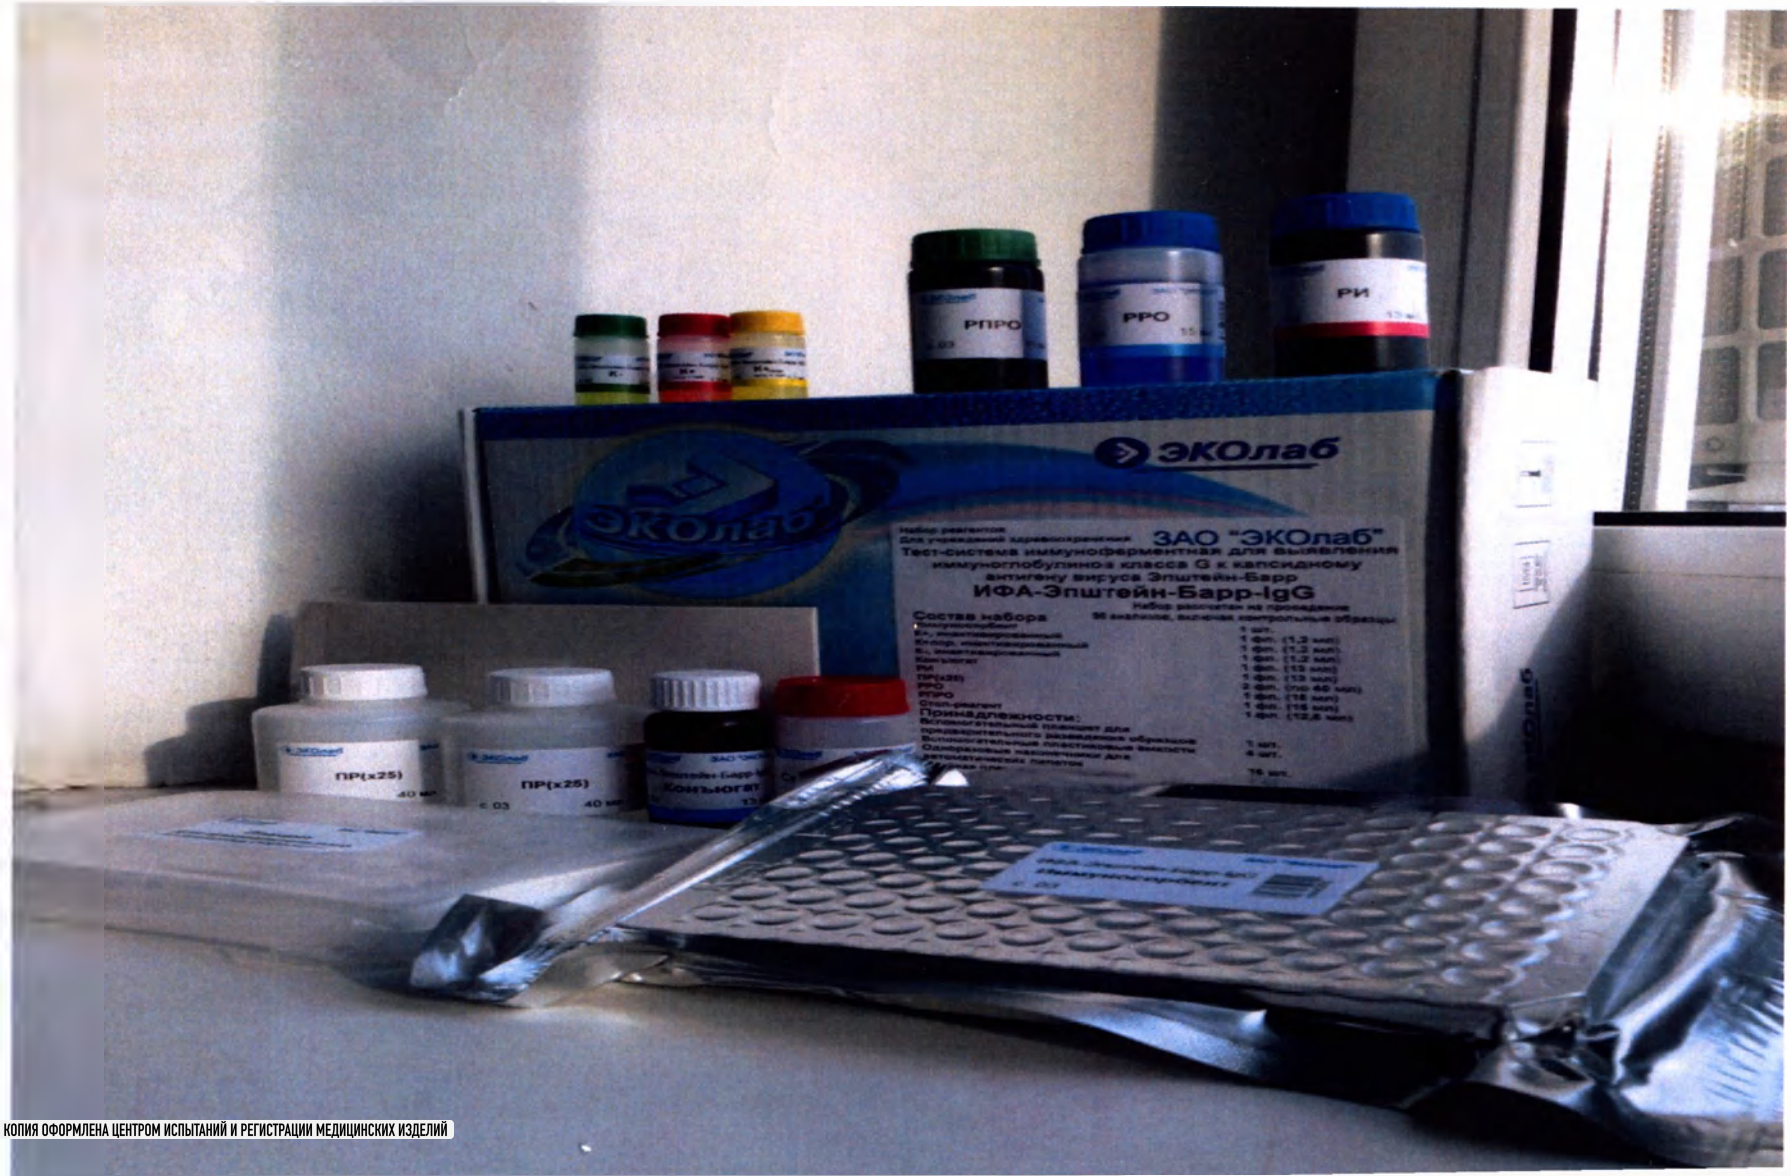

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

серия 04 от 11.2015 г.

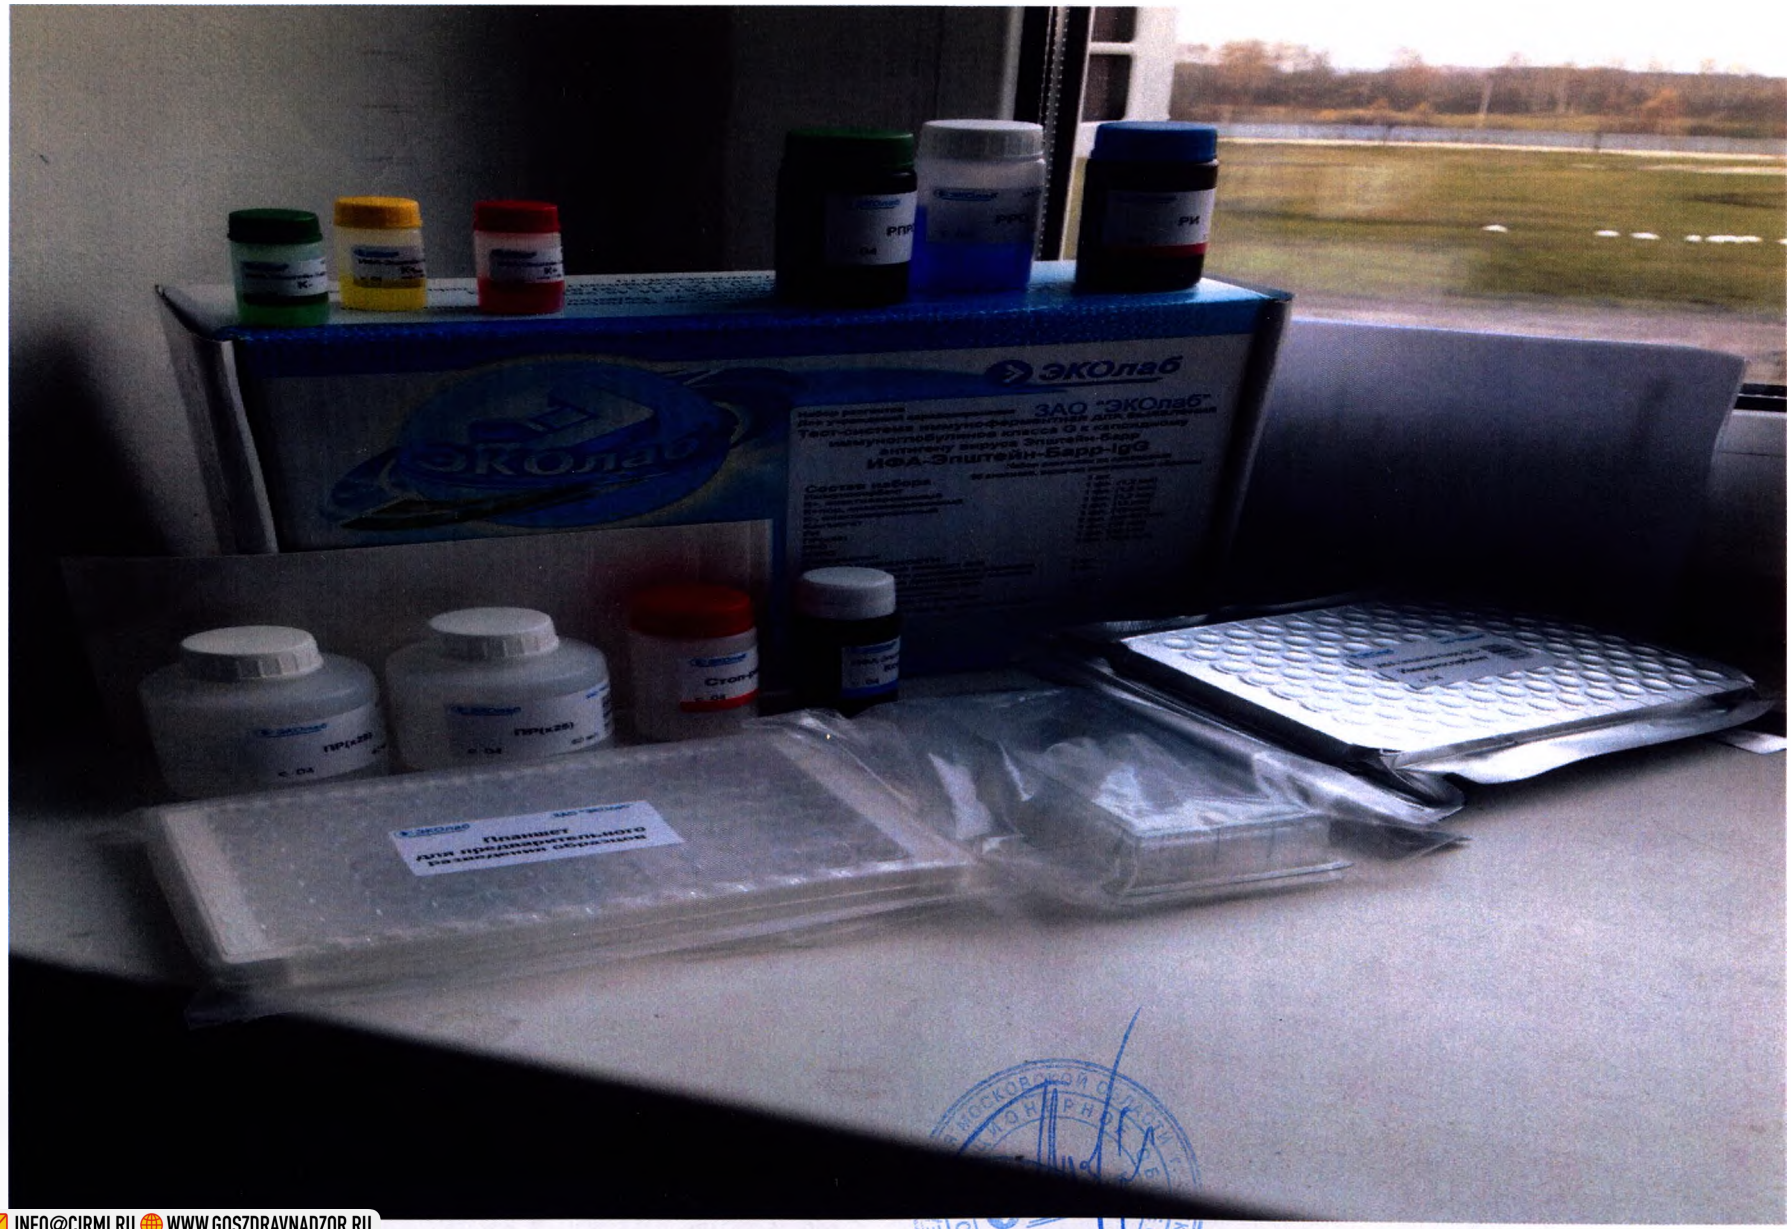

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб" В.Ю. Борисов

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист а
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"31" 10 2016 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU