
Фото набора реагентов

«Диагностикум для выявления антител класса М

к цитомегаловирусу в реакции иммунофлюоресценции» «ЦМВ-Флюороген-IgM»


Комплект 1«Диагностикум для выявления антител класса М к цитомегаловирусу в реакции иммунофлюоресценции» «ЦМВ-Флюороген-IgM»

Серия 09 от 07.2016 г.

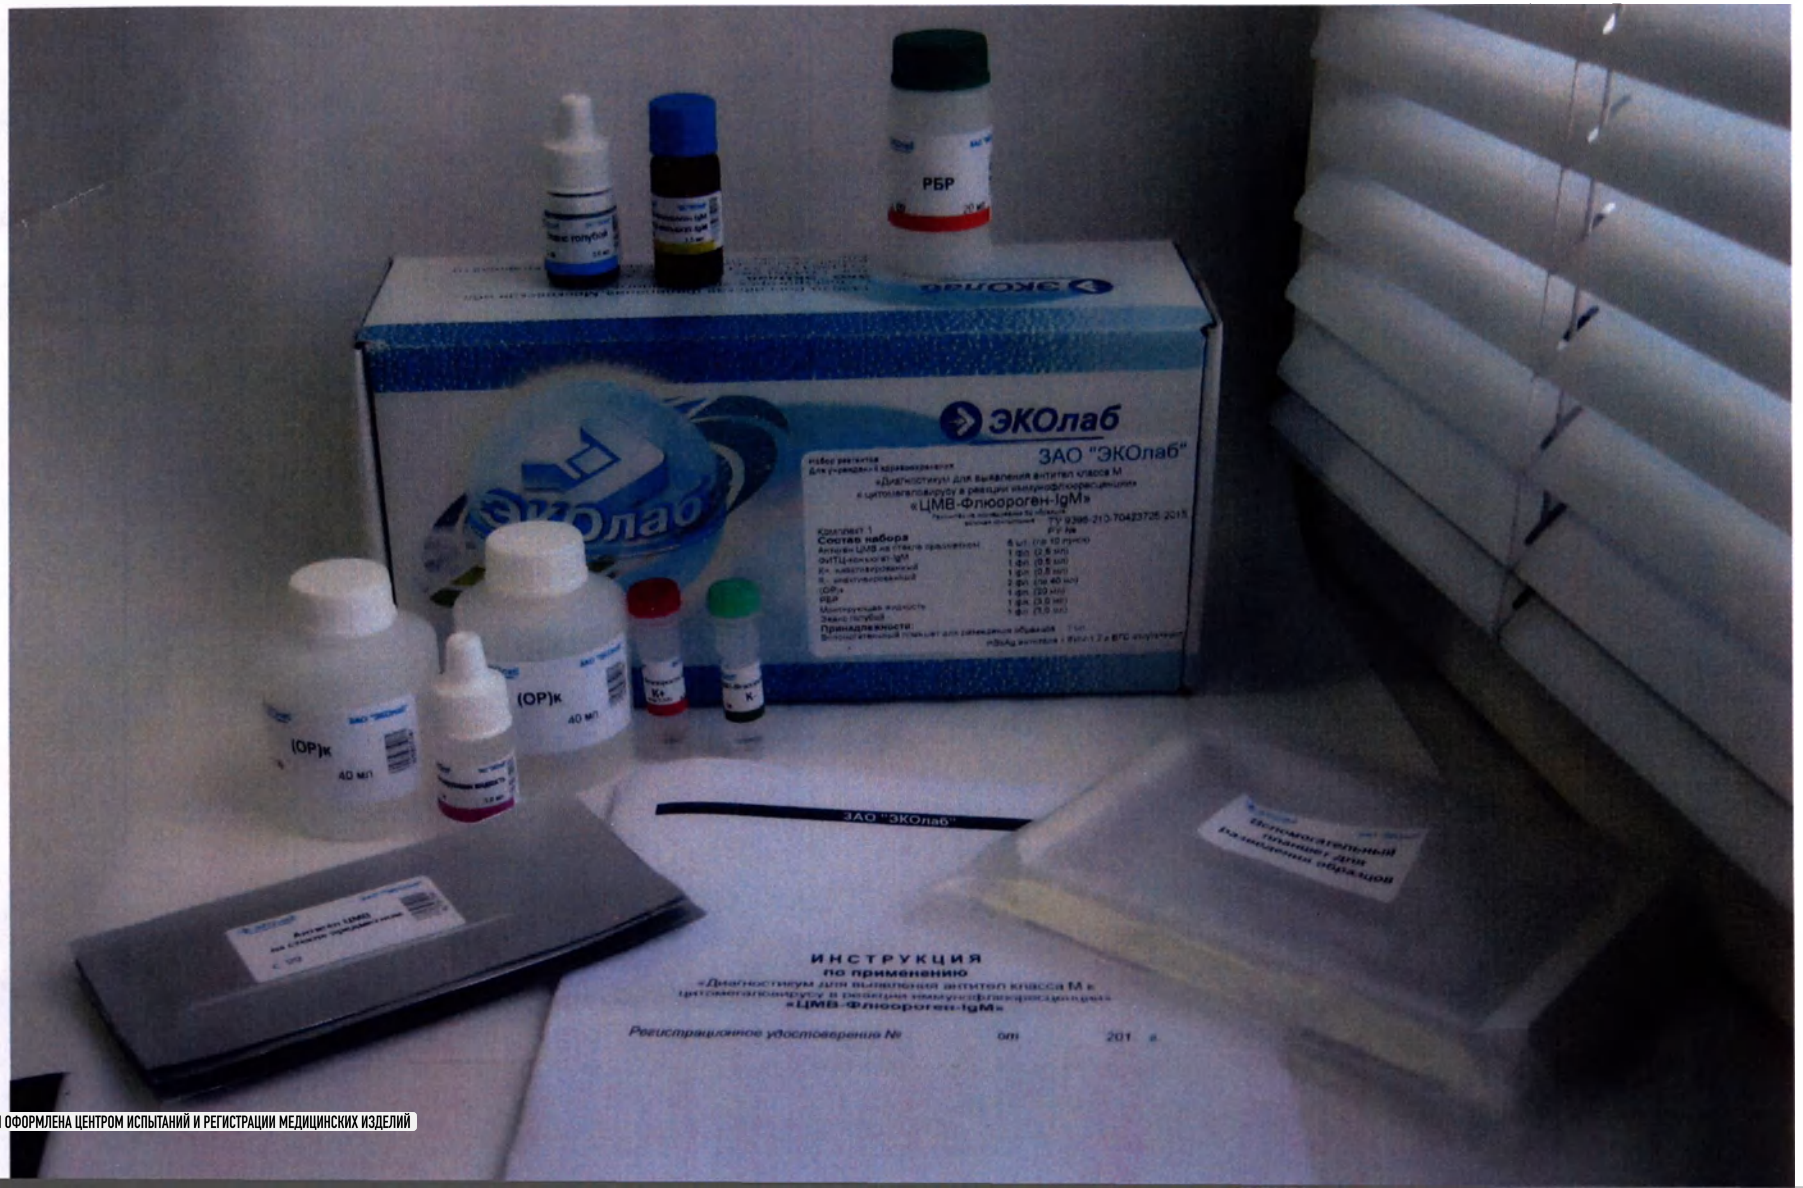


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Серия 13 от 08.2016 г.

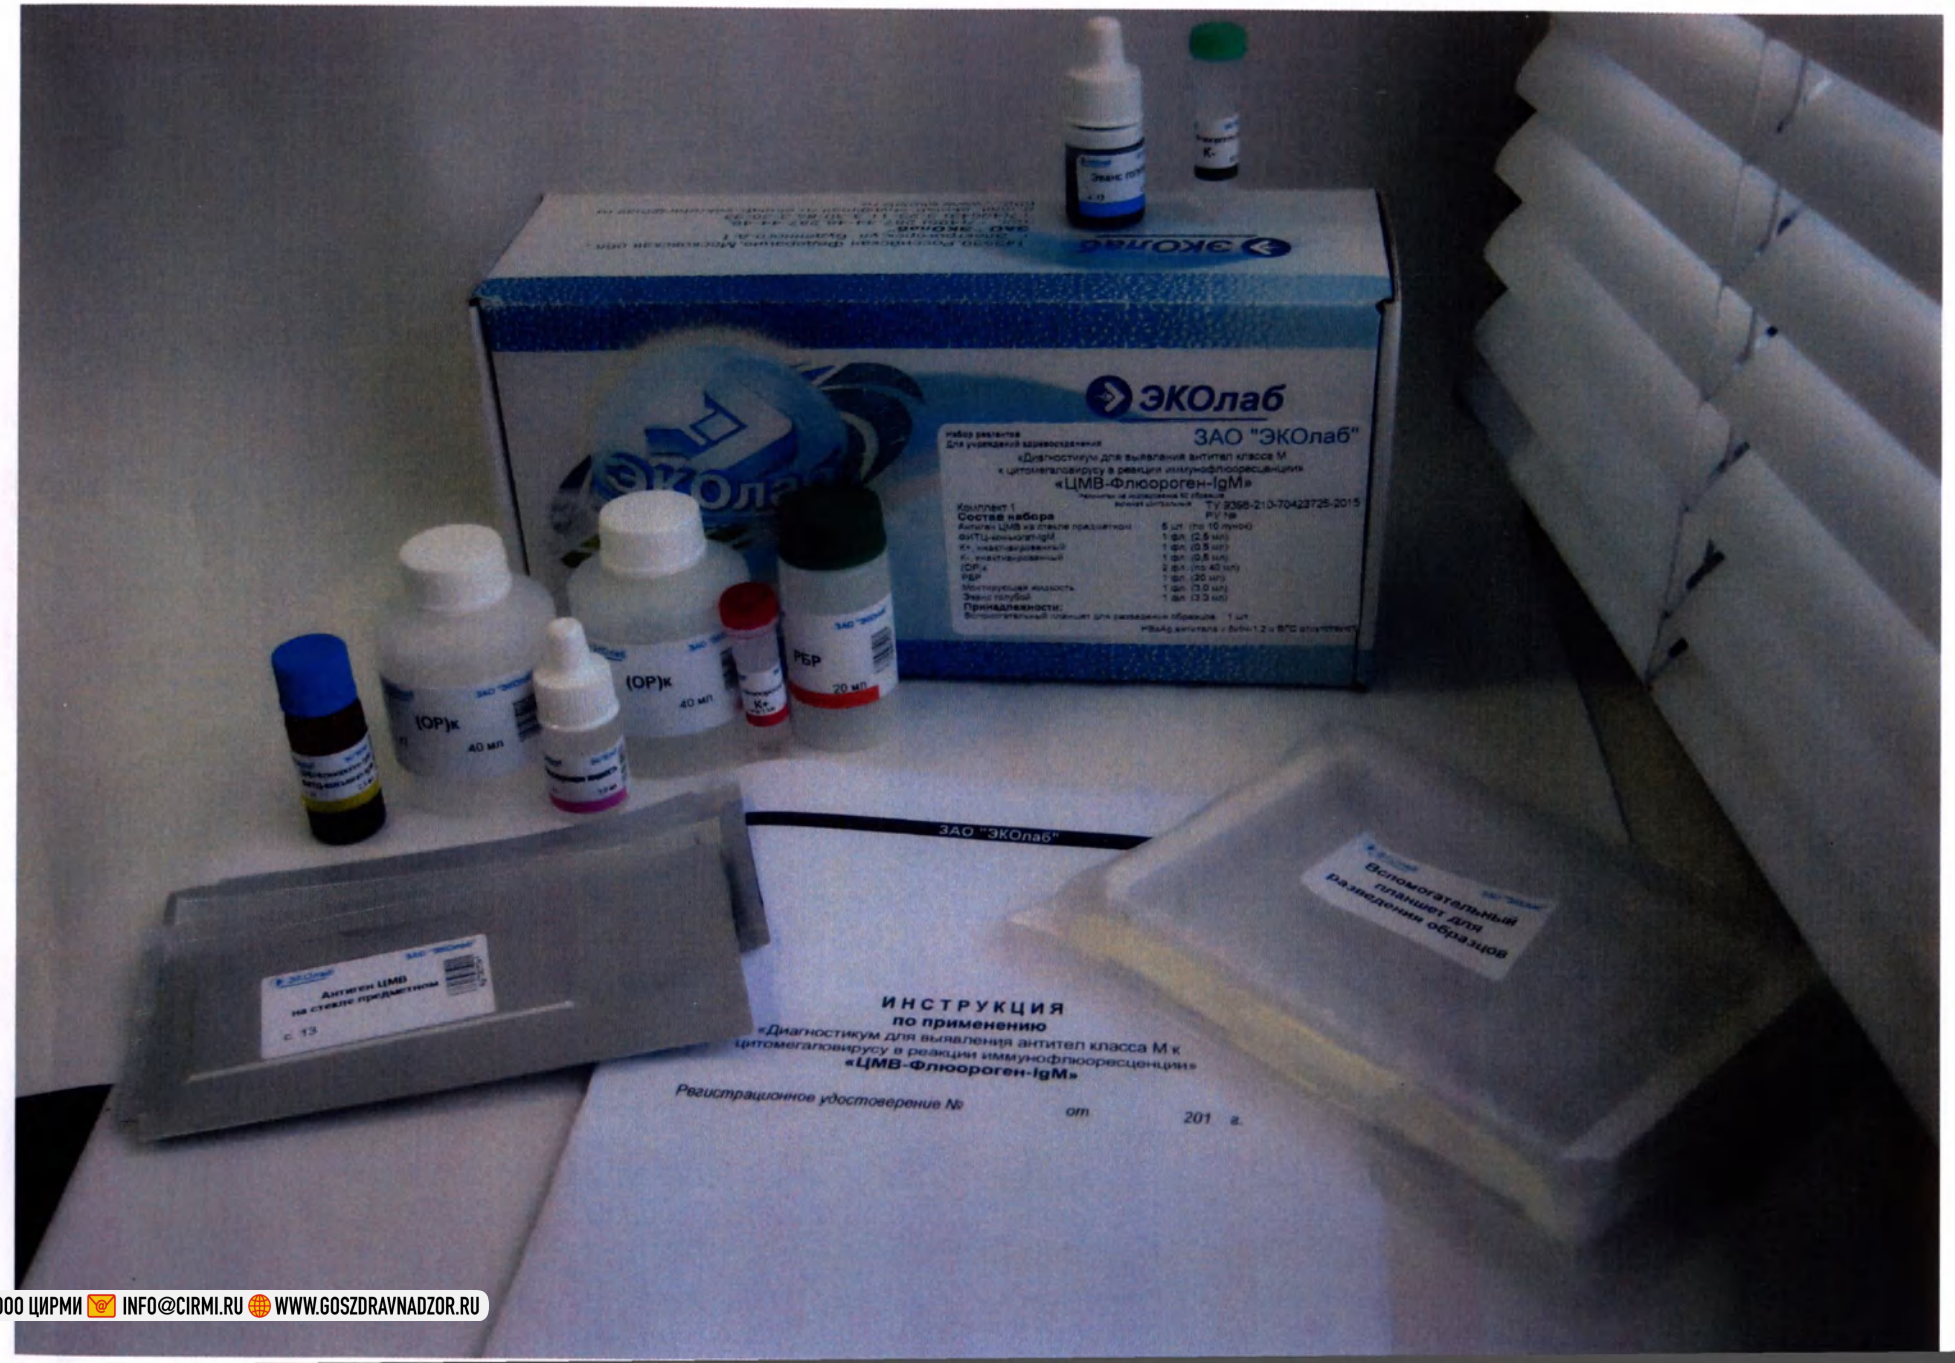


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия 11 от 07.2016 г.

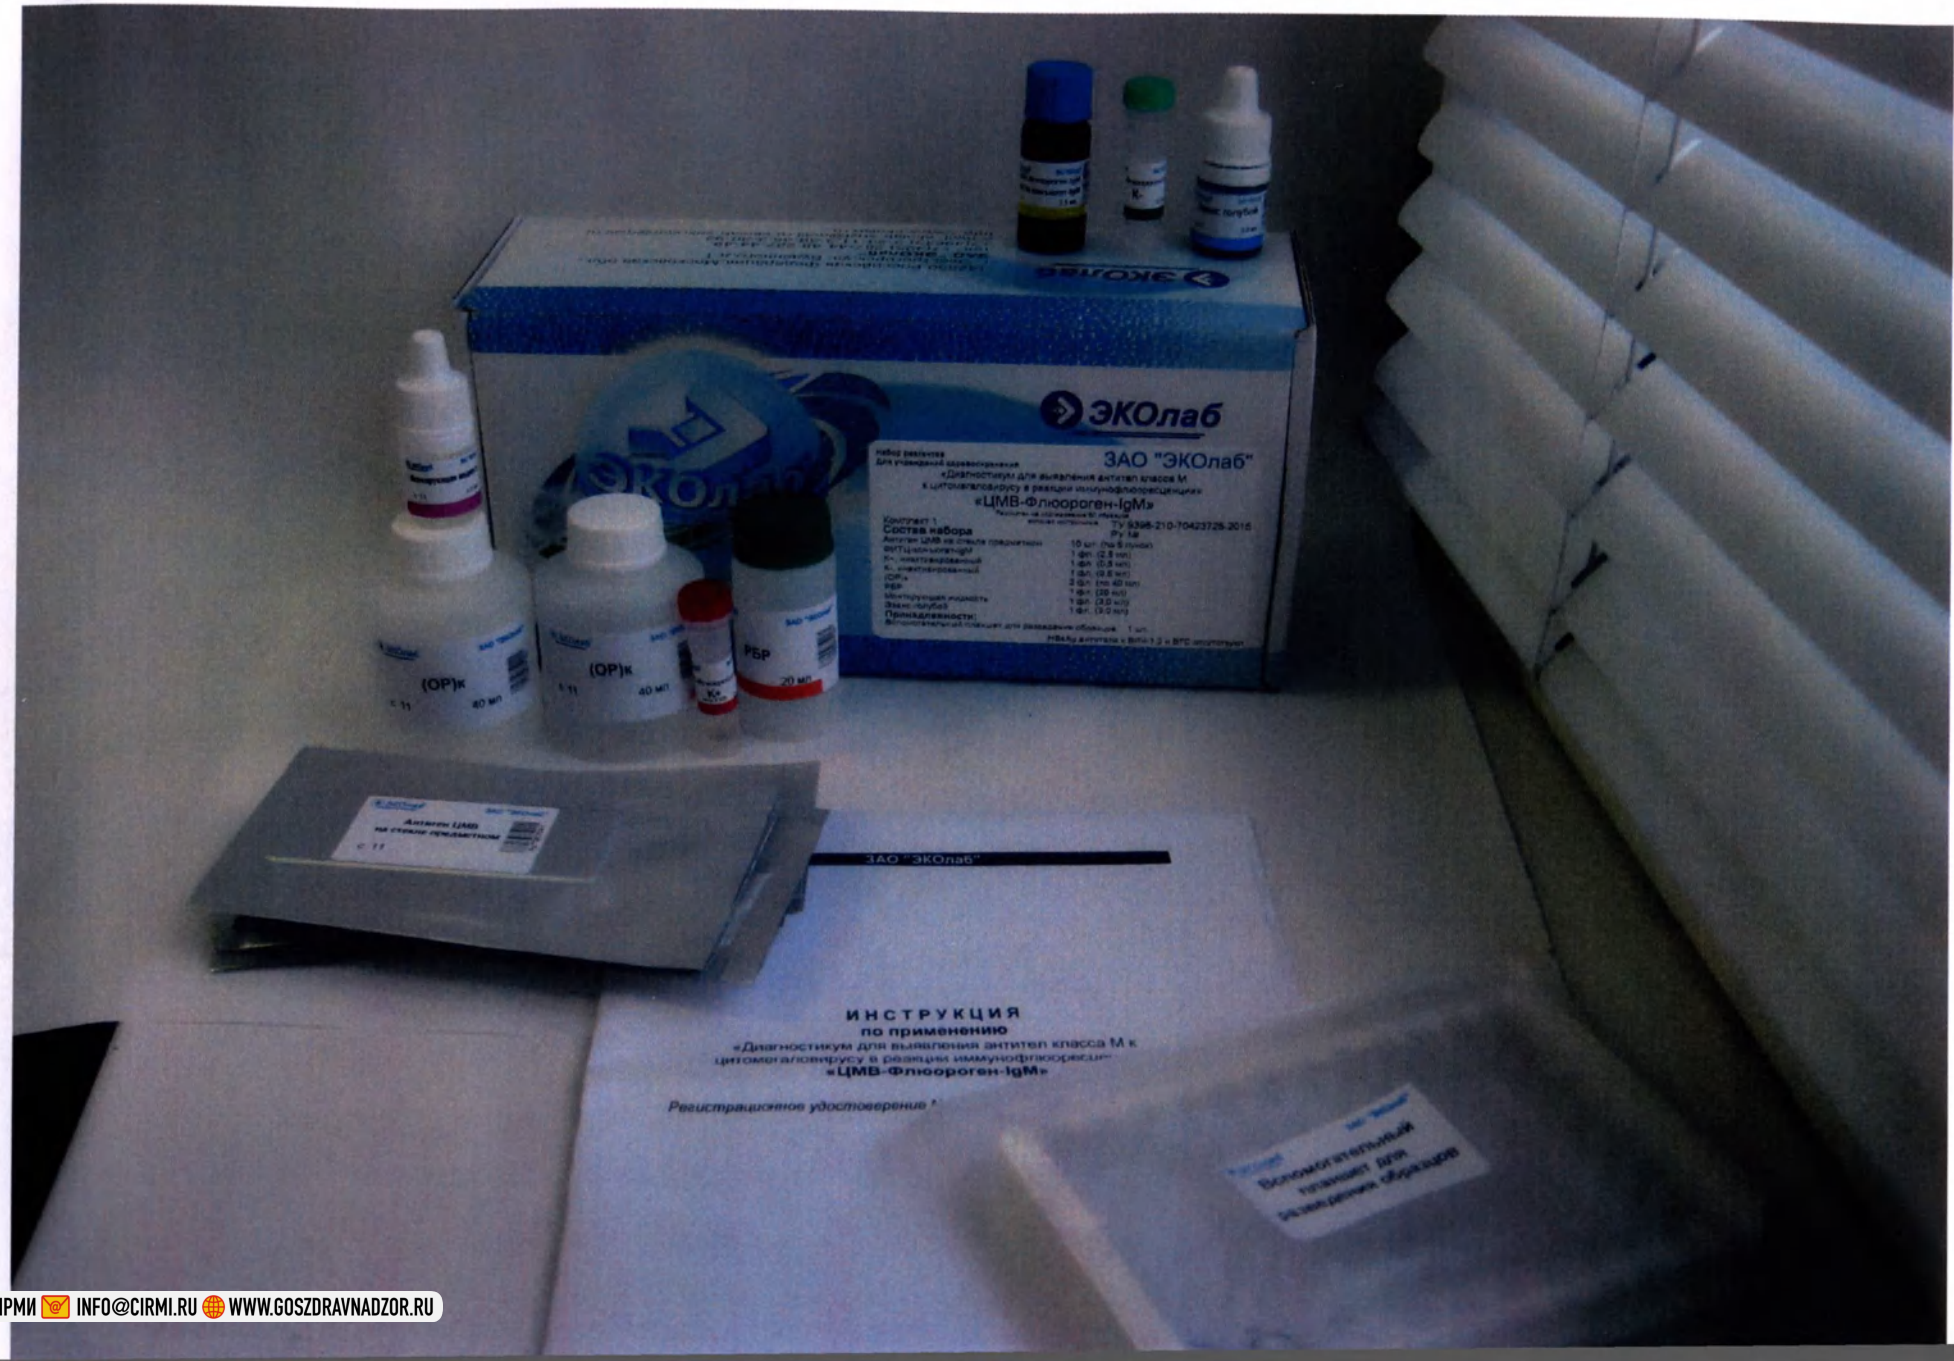

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия 15 от 08.2016 г.

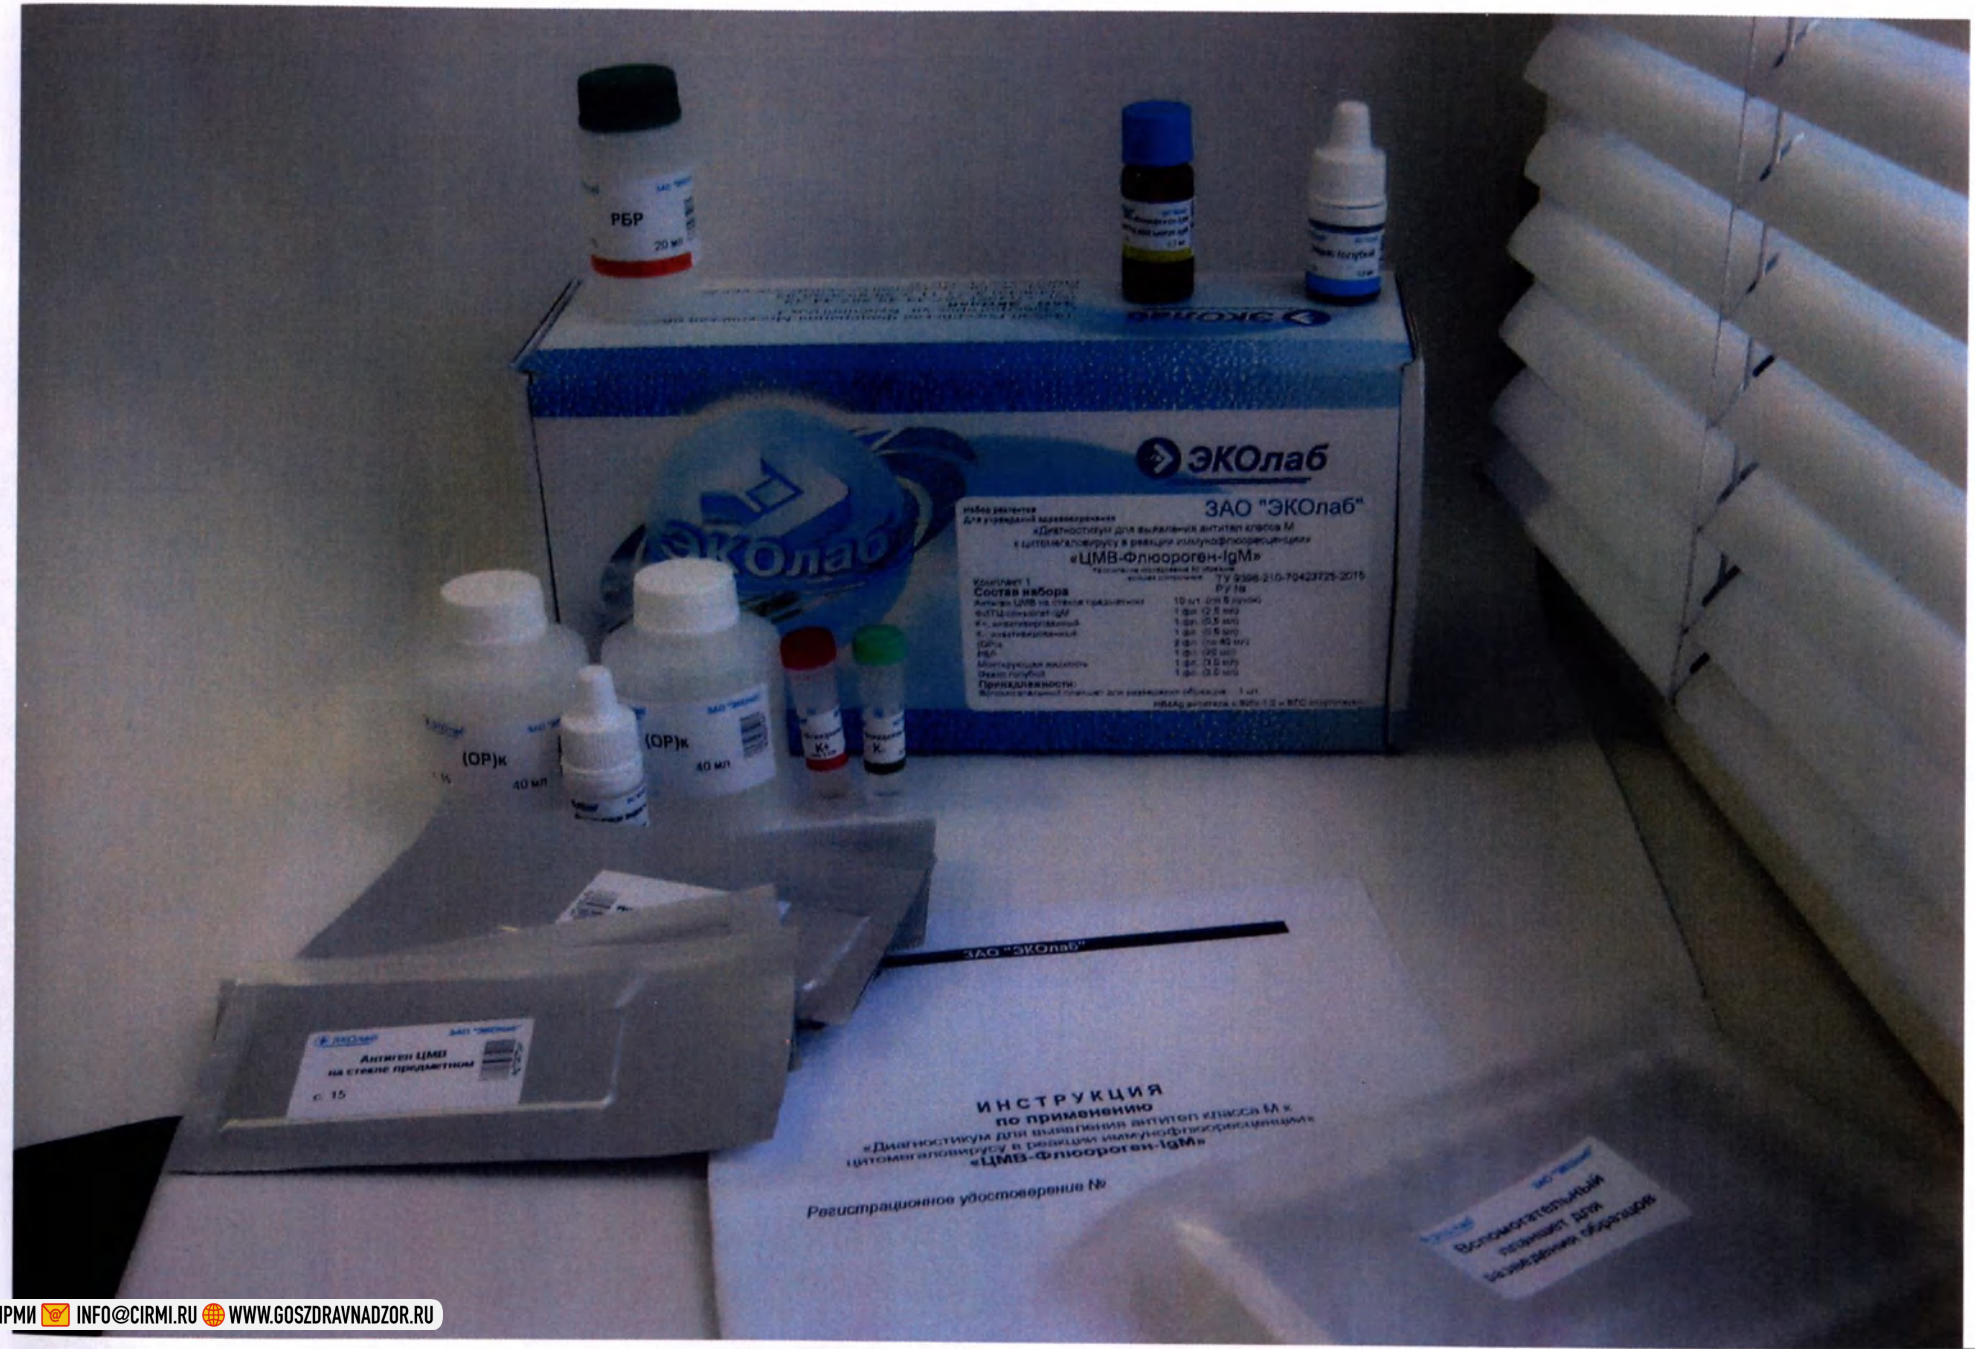


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект 2 «Диагностикум для выявления антител класса М к цитомегаловирусу в реакции иммунофлюоресценции» «ЦМВ-Флюороген-IgM»
Серия 10 от 07.2016 г.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия 14 от 08.2016 г.

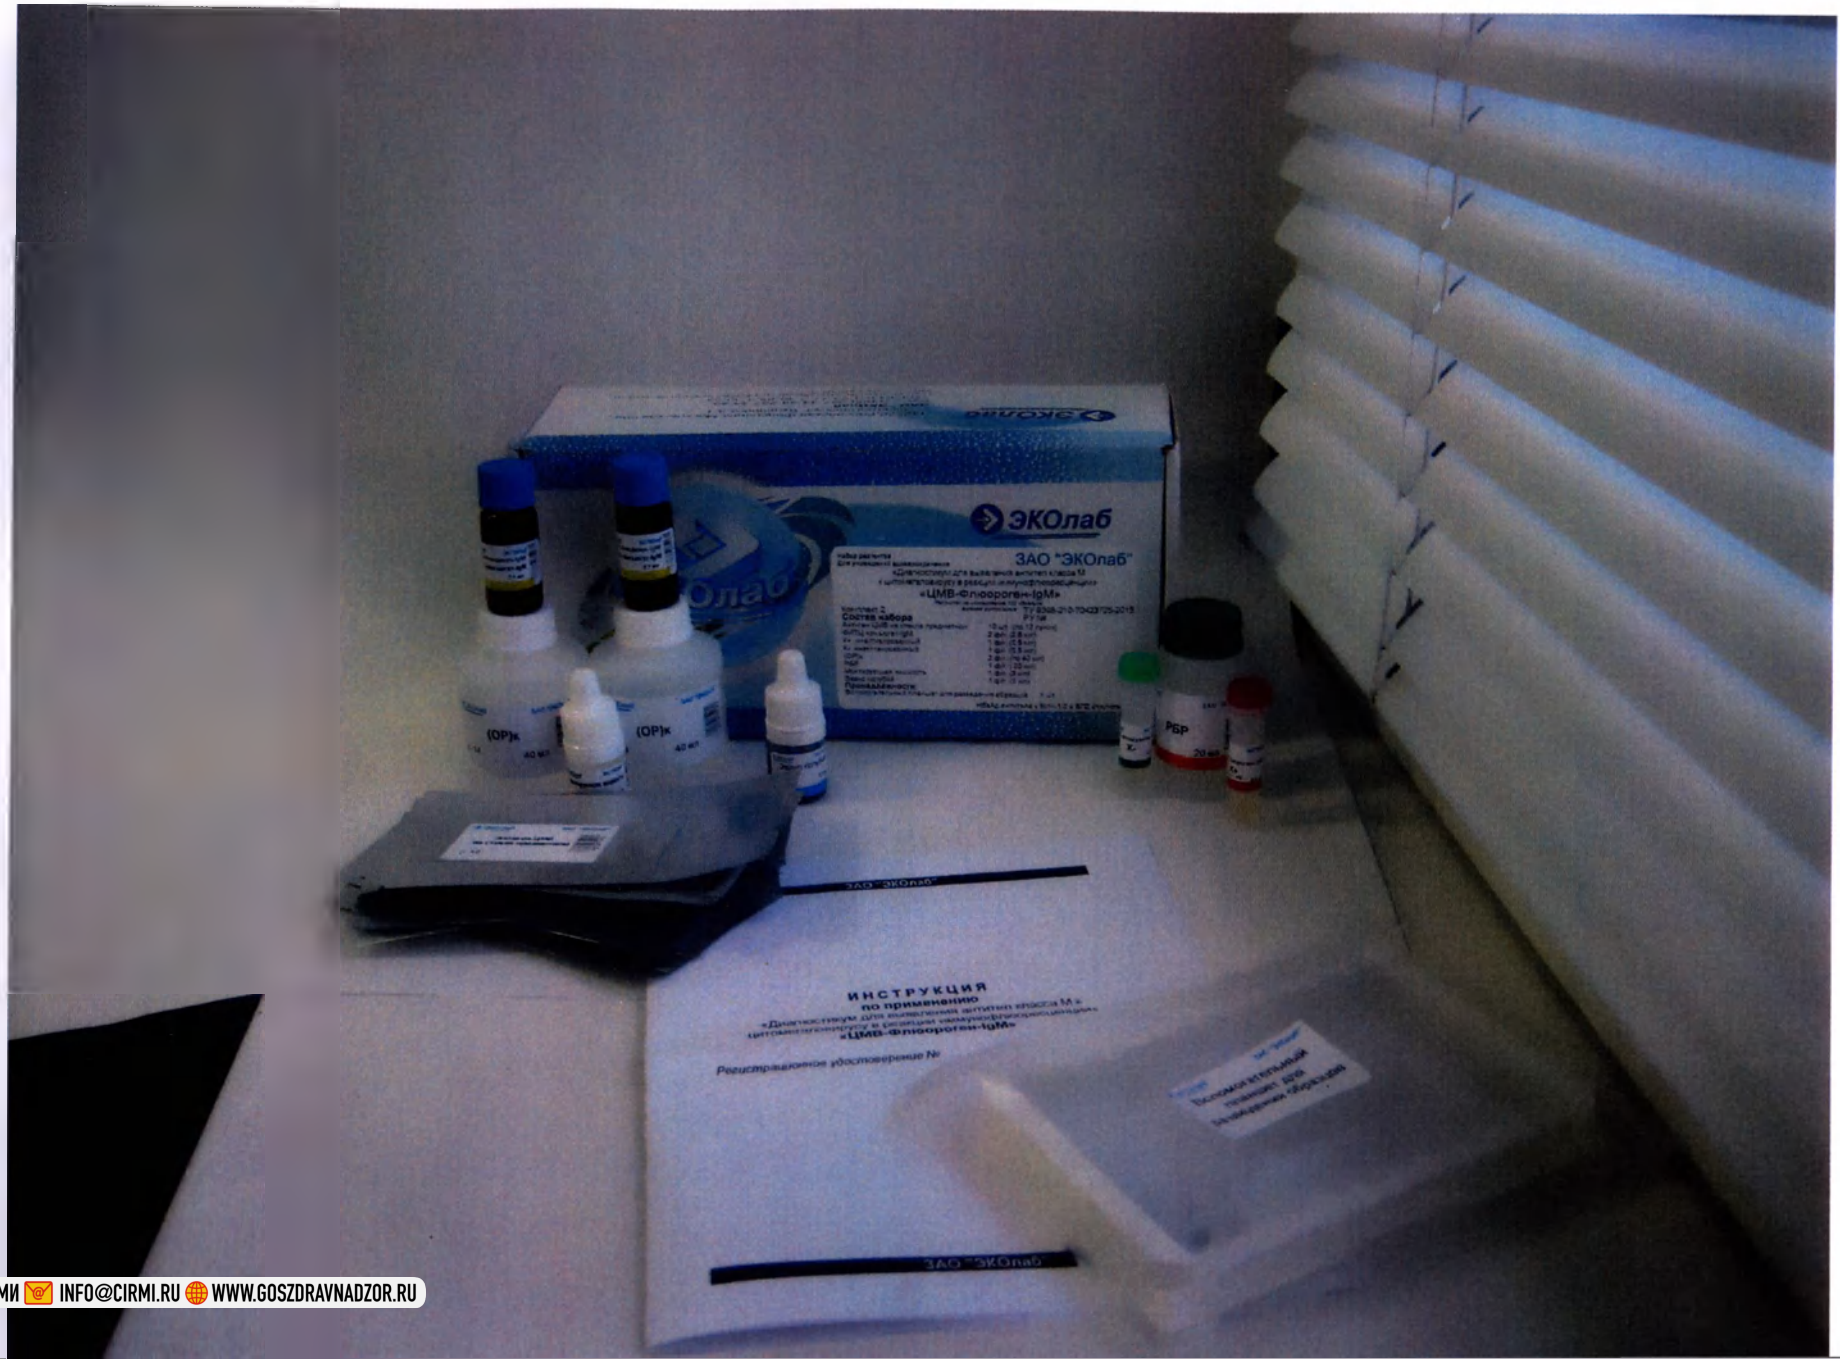


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия 12 от 07.2016 г.

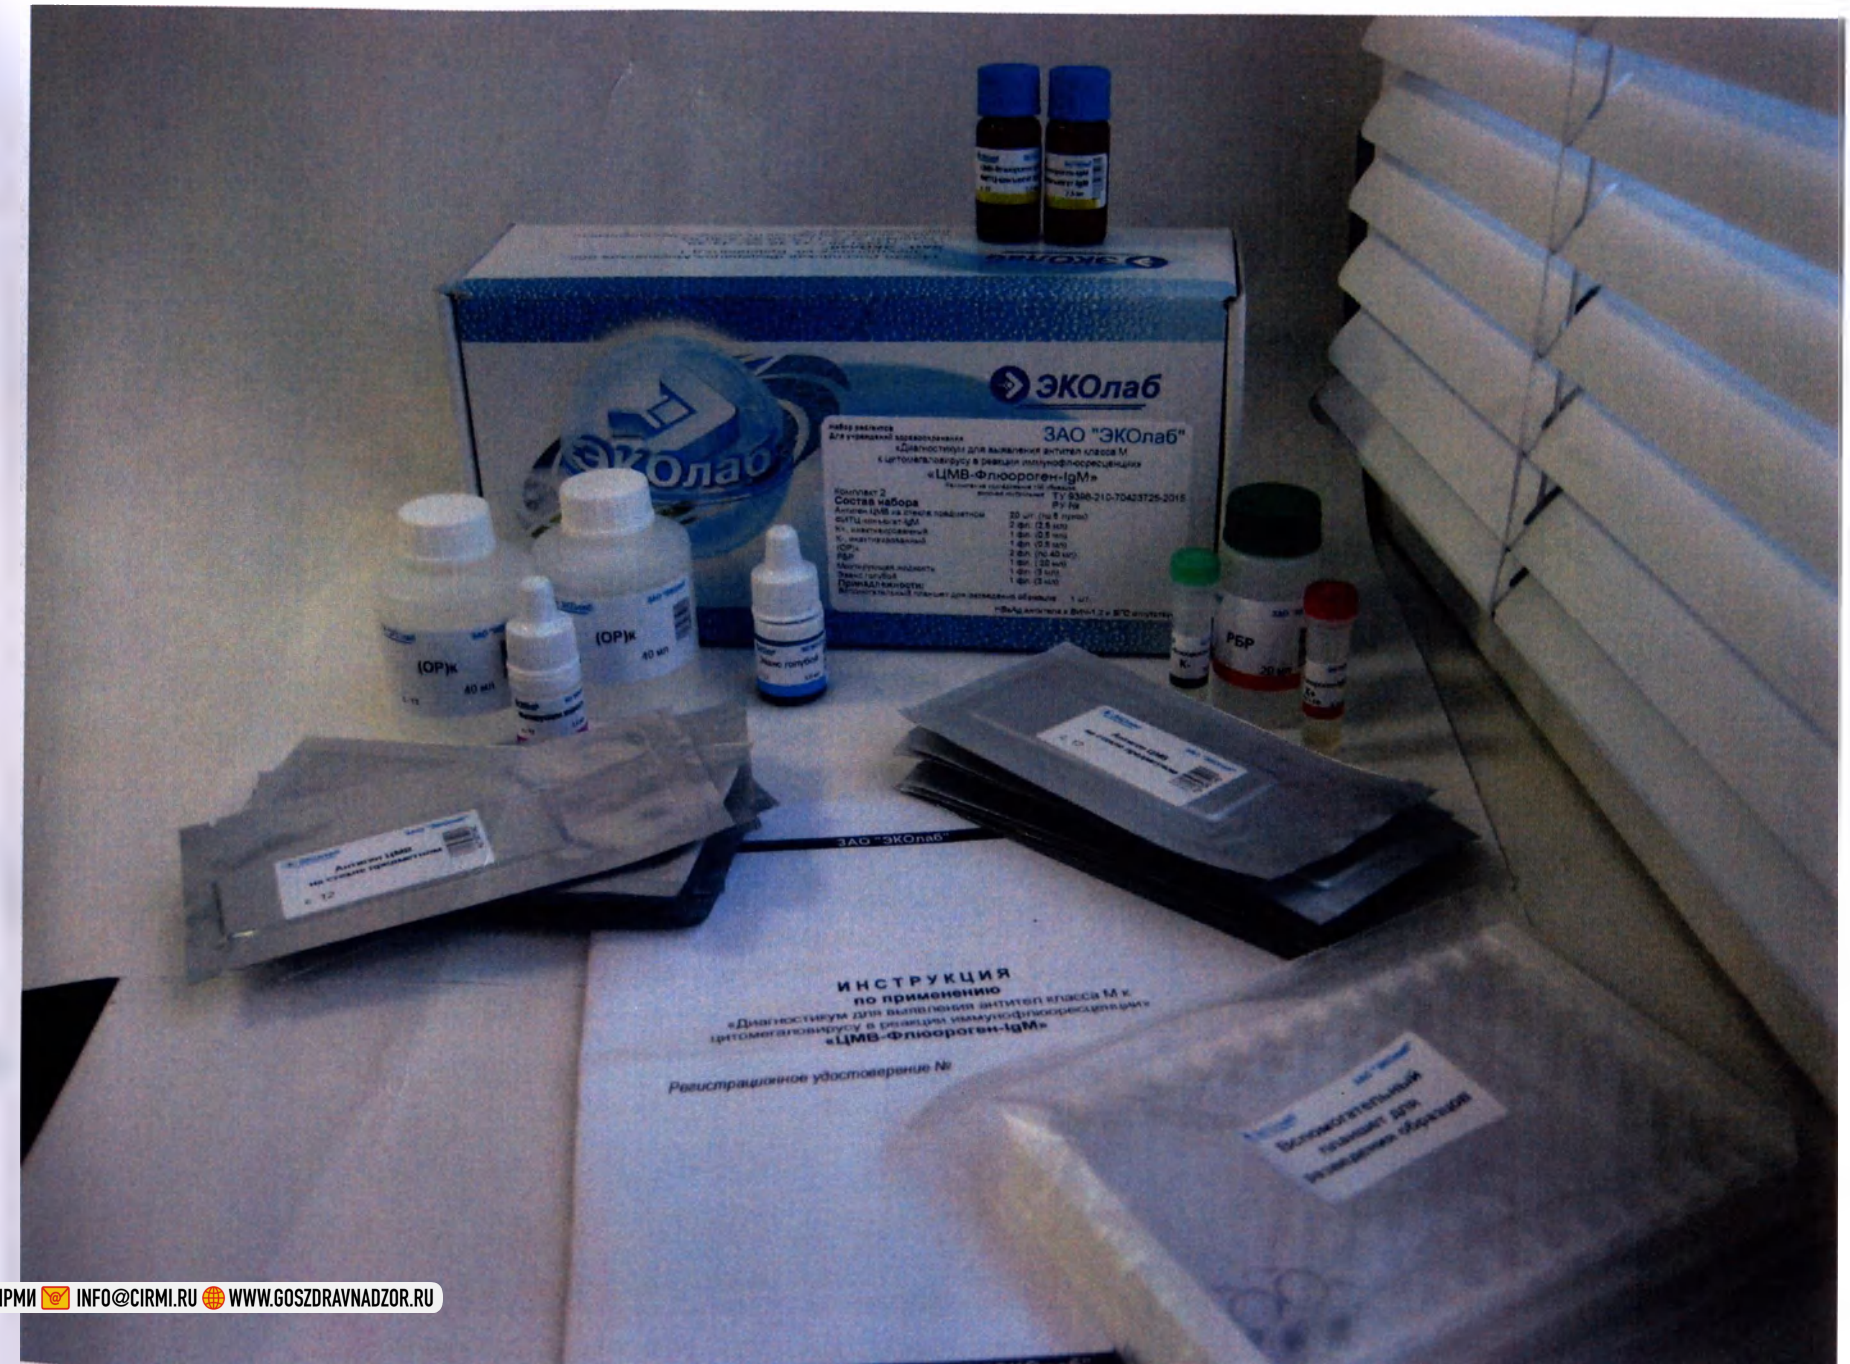


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Серия 16 от 08.2016 г.

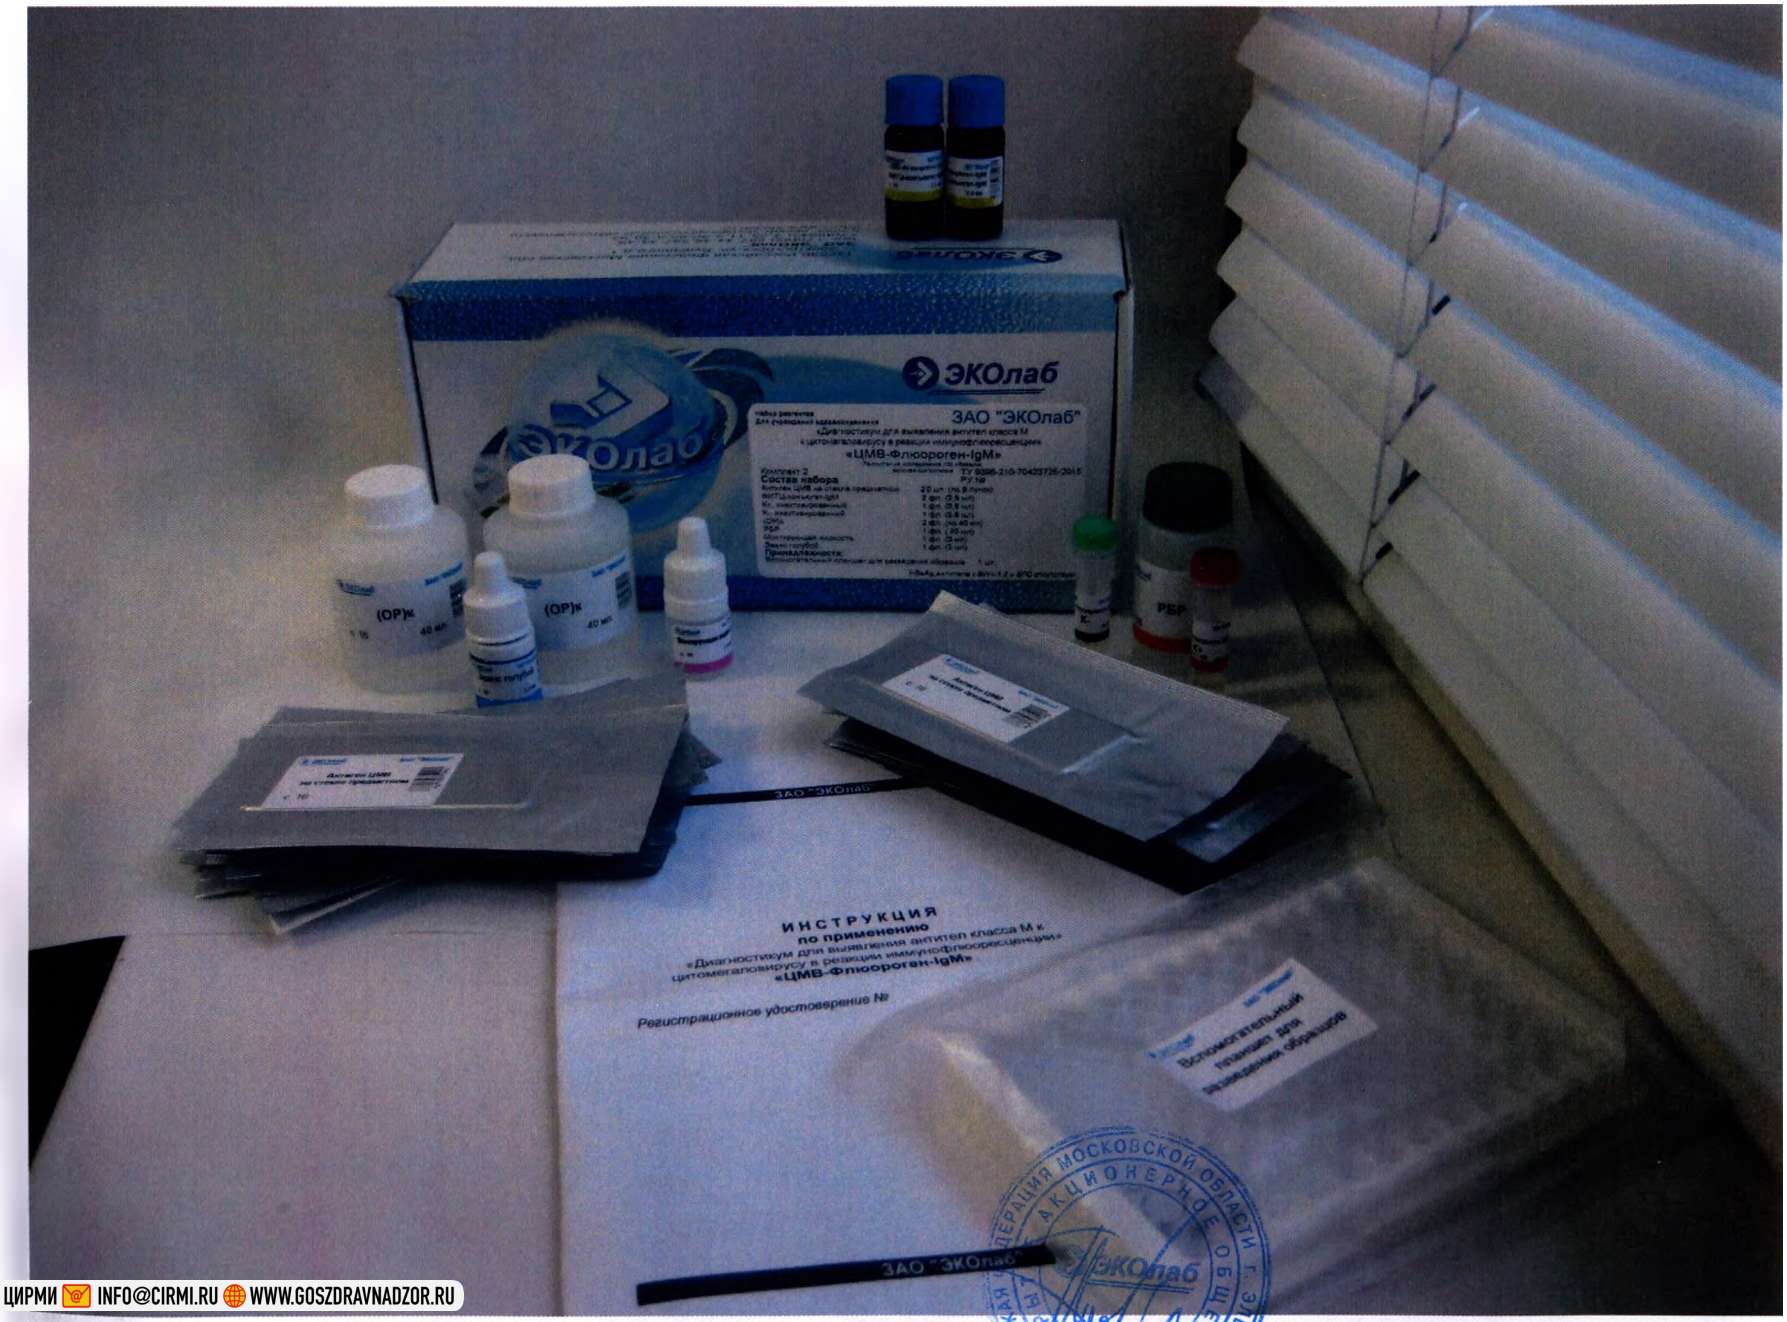

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Генеральный директор ЗАО “ЭКОлаб» В.Ю. Борисов

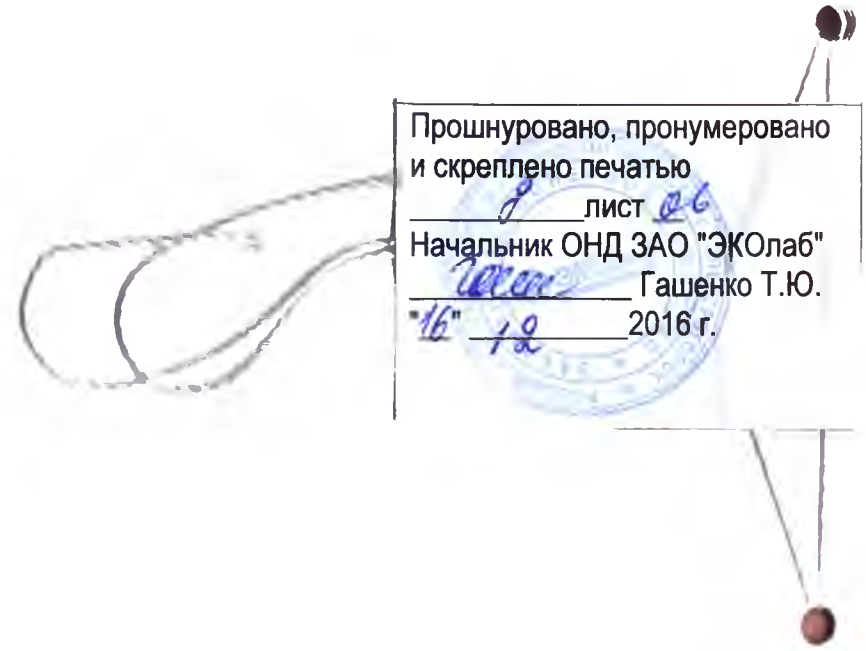

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU