«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «Эндомедиум+»
_____ Гусев О. А.
М.П.
«22» ноября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024 в вариантах исполнения, с принадлежностями

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

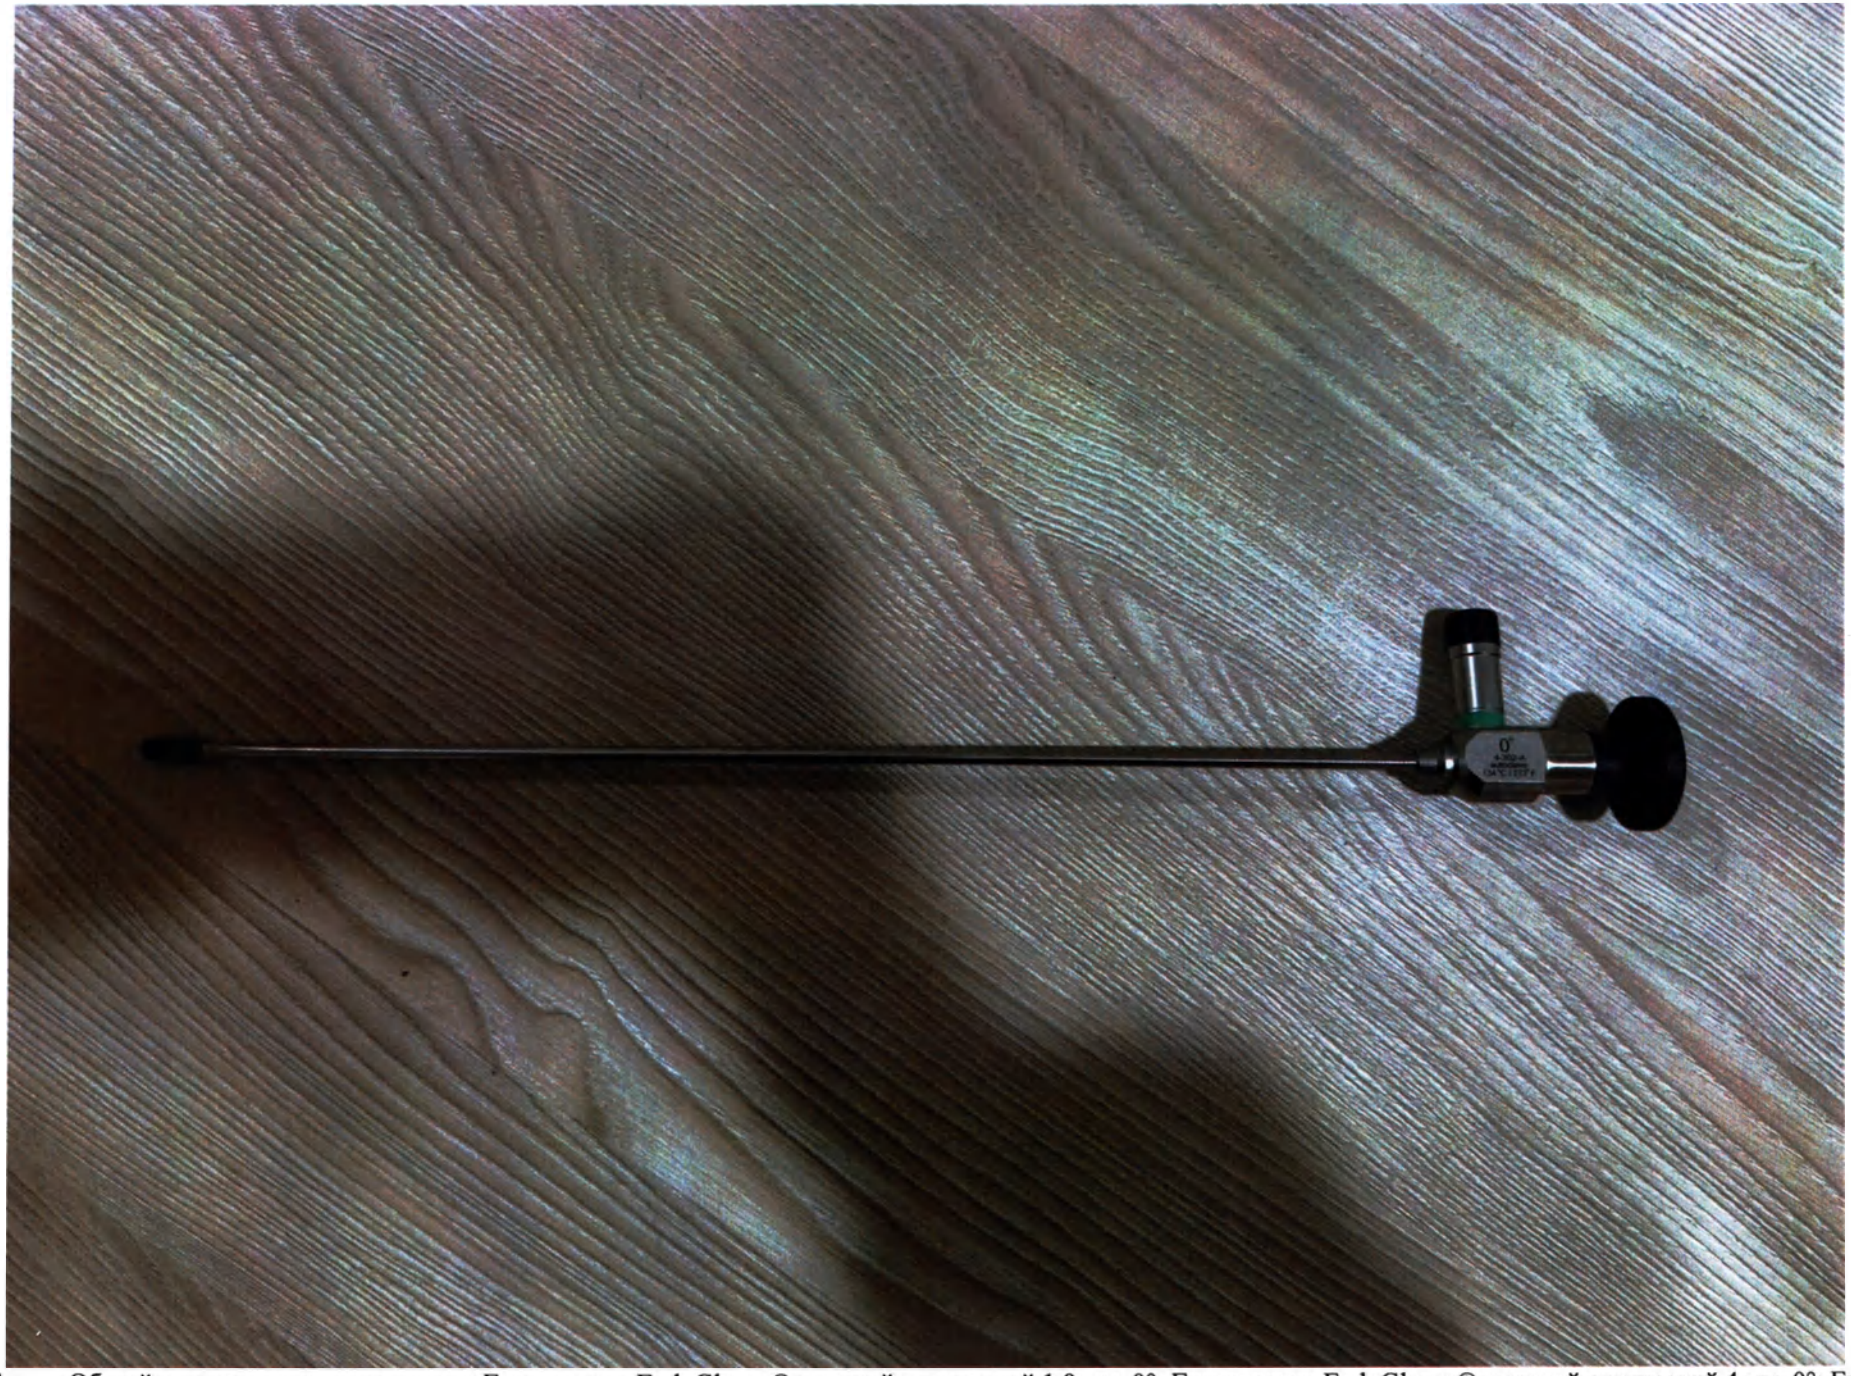


Фото 1. Общий вид вариантов исполнения: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 2. Пример маркировки на изделии вариантов исполнений: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 3. Пример маркировки на изделии вариантов исполнений: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 4. Пример маркировки на изделии вариантов исполнений: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

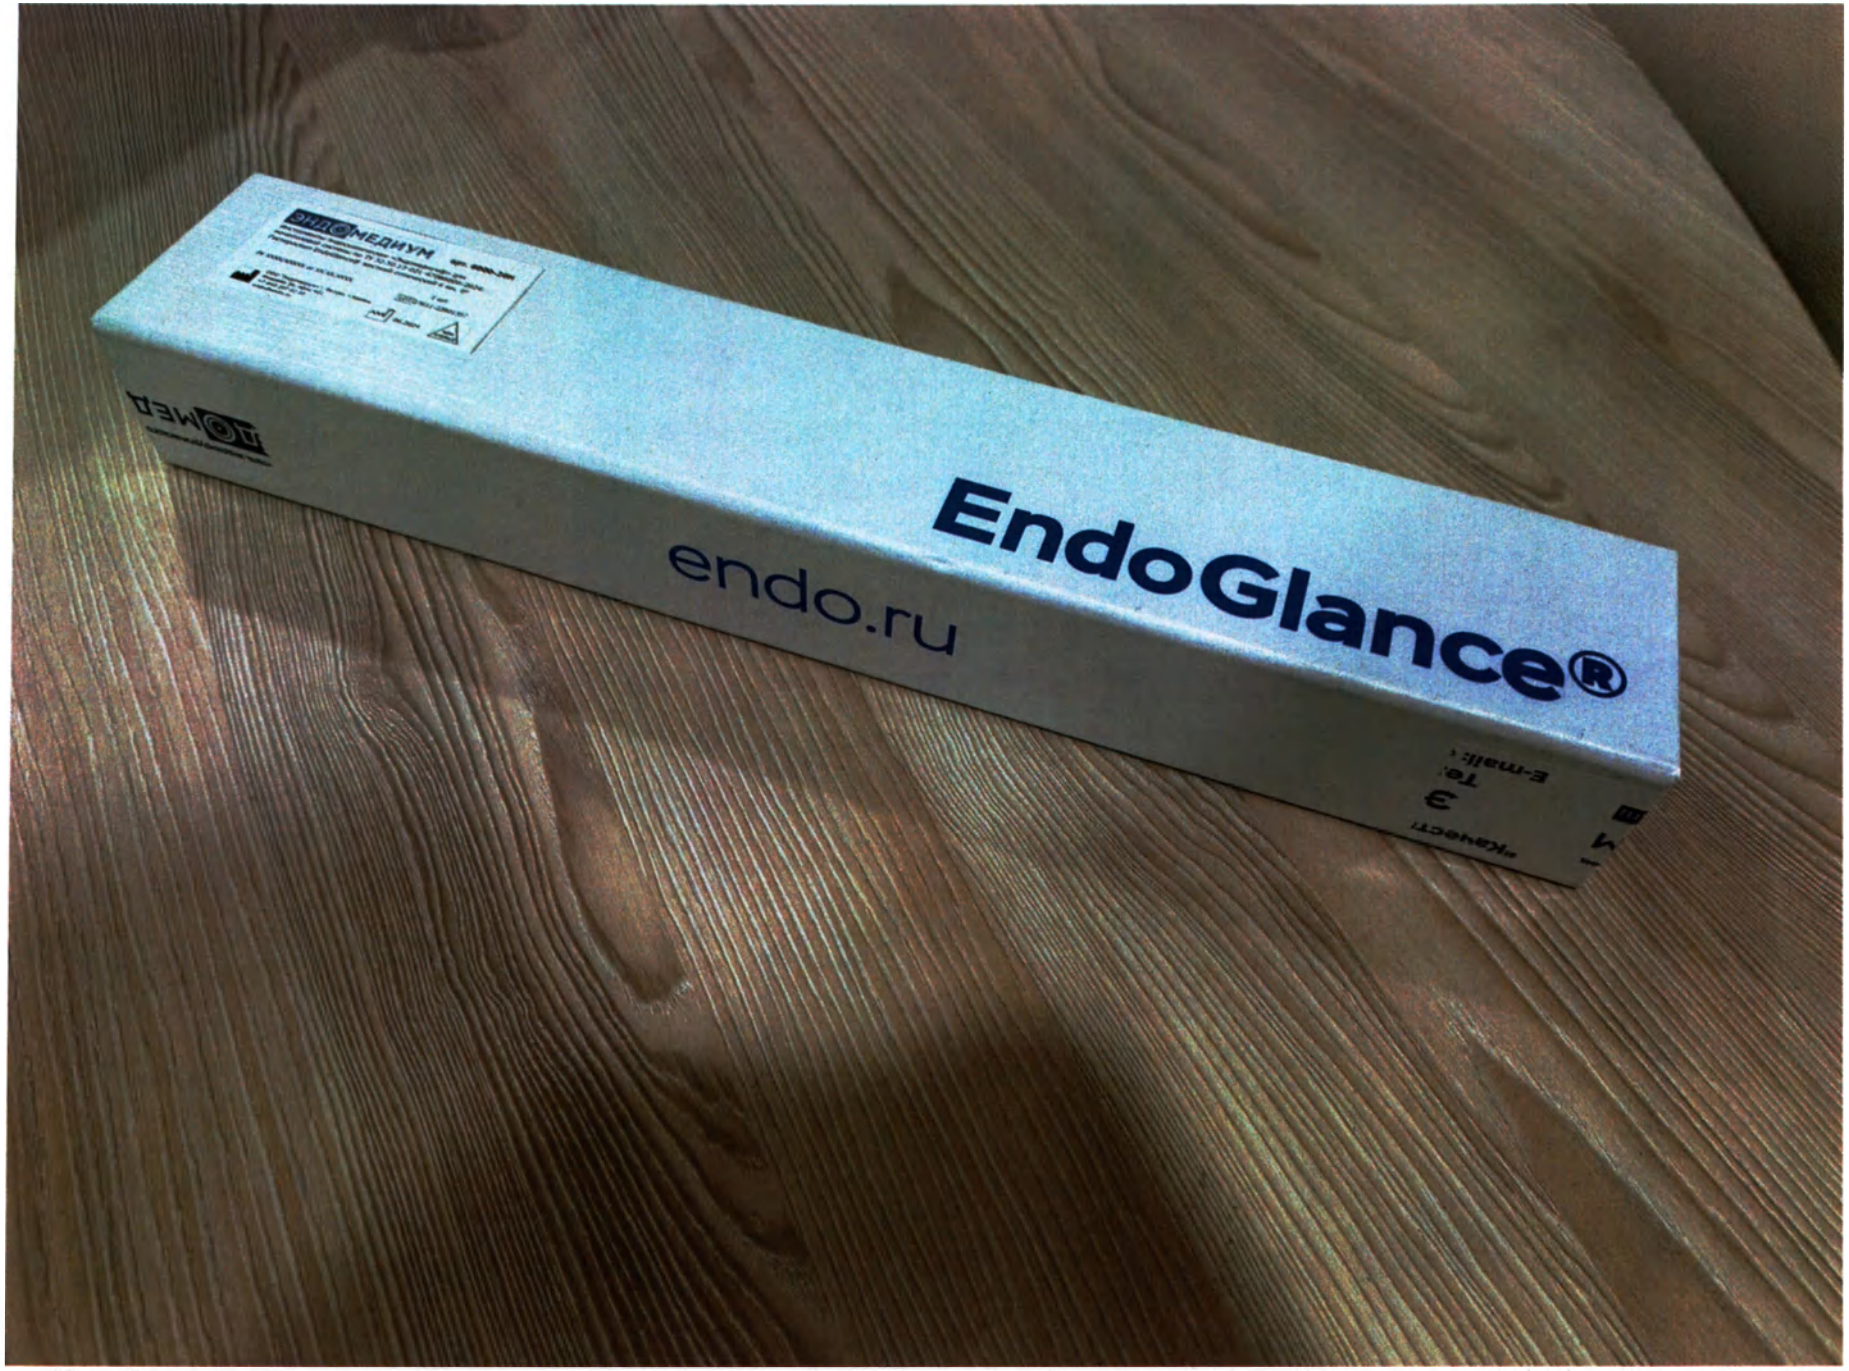


Фото 5. Потребительская упаковка вариантов исполнений: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

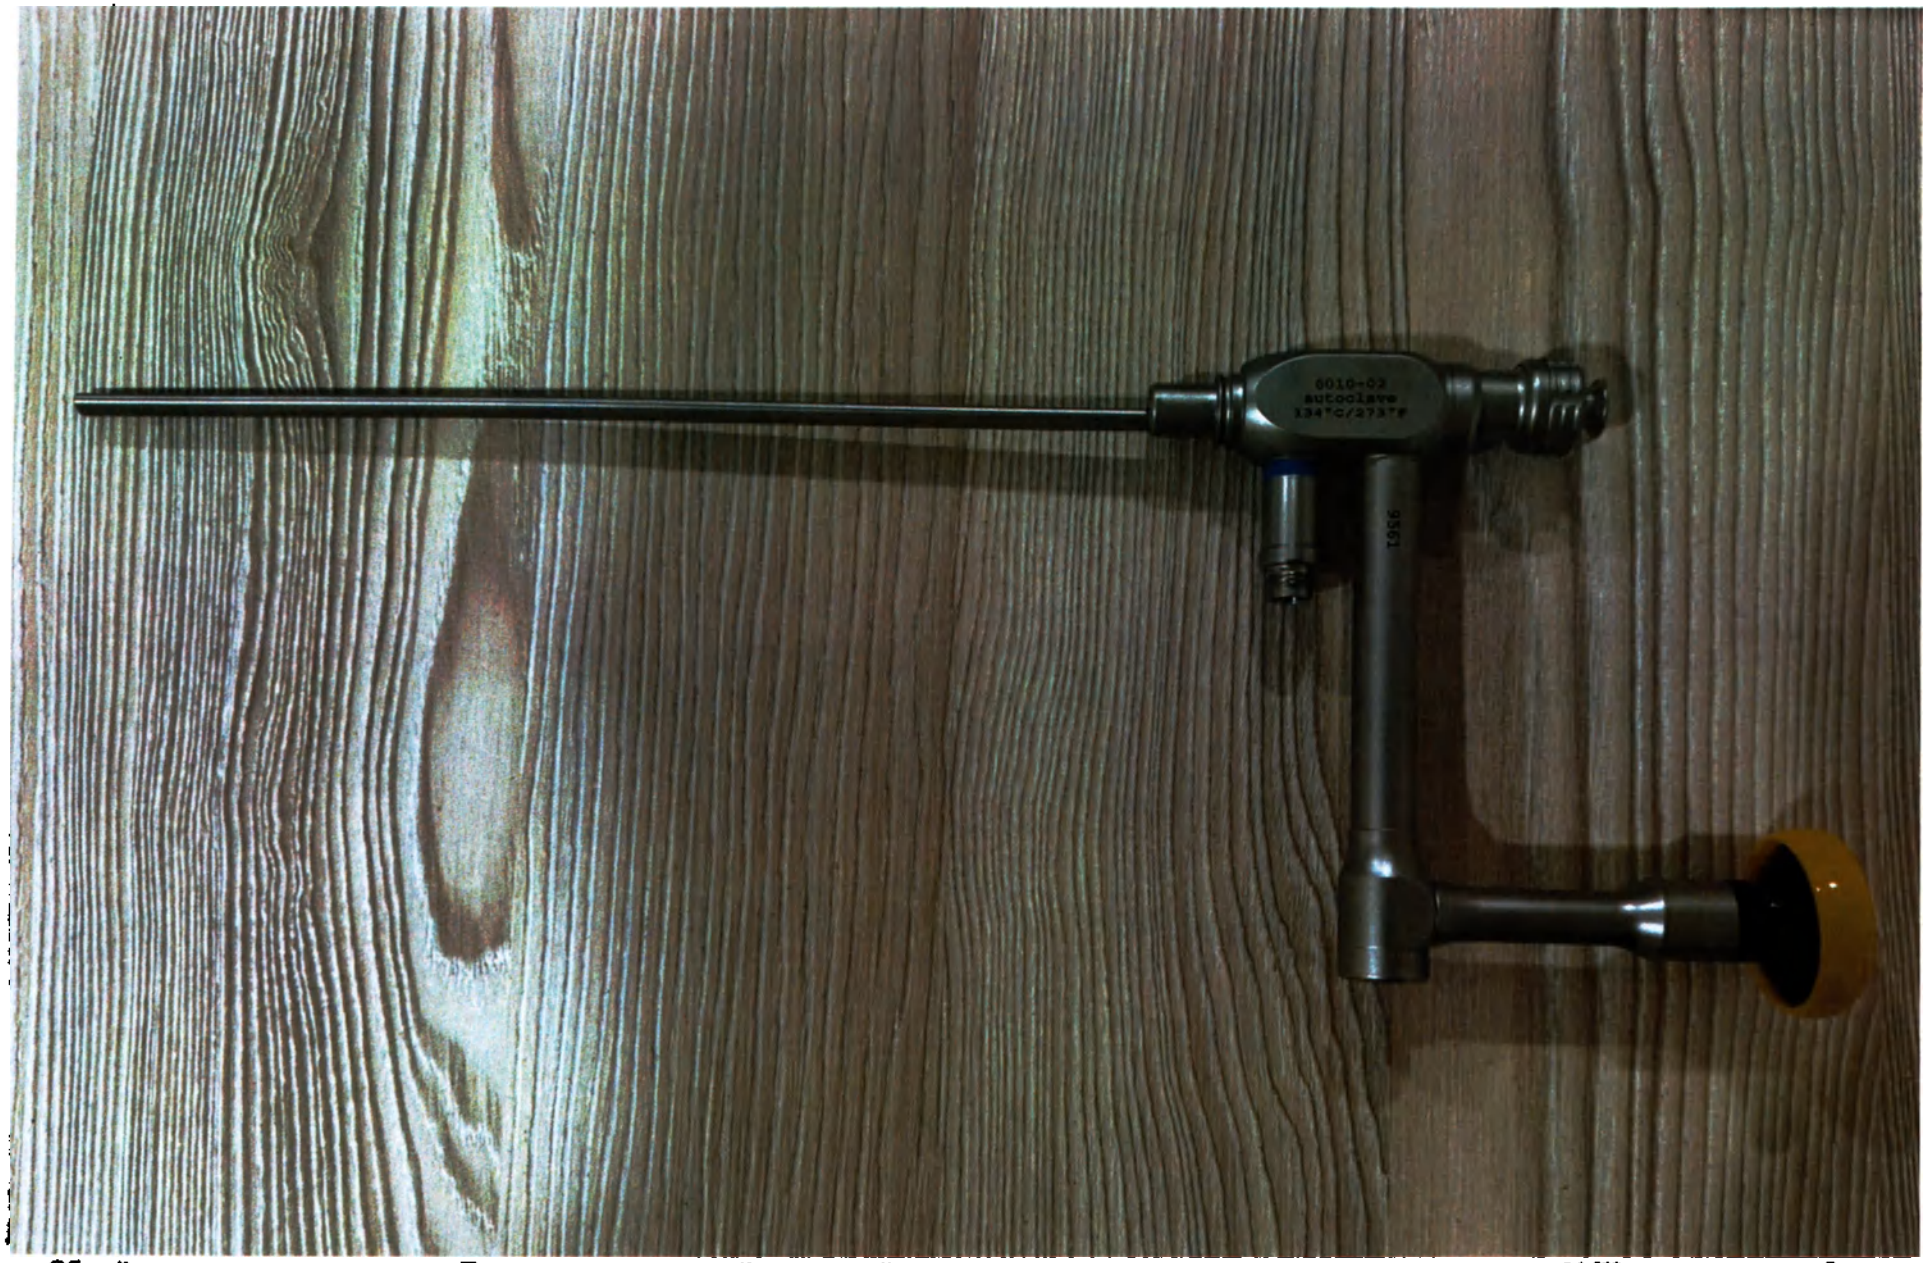


Фото 6. **Общий вид вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 0°; Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 30°**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

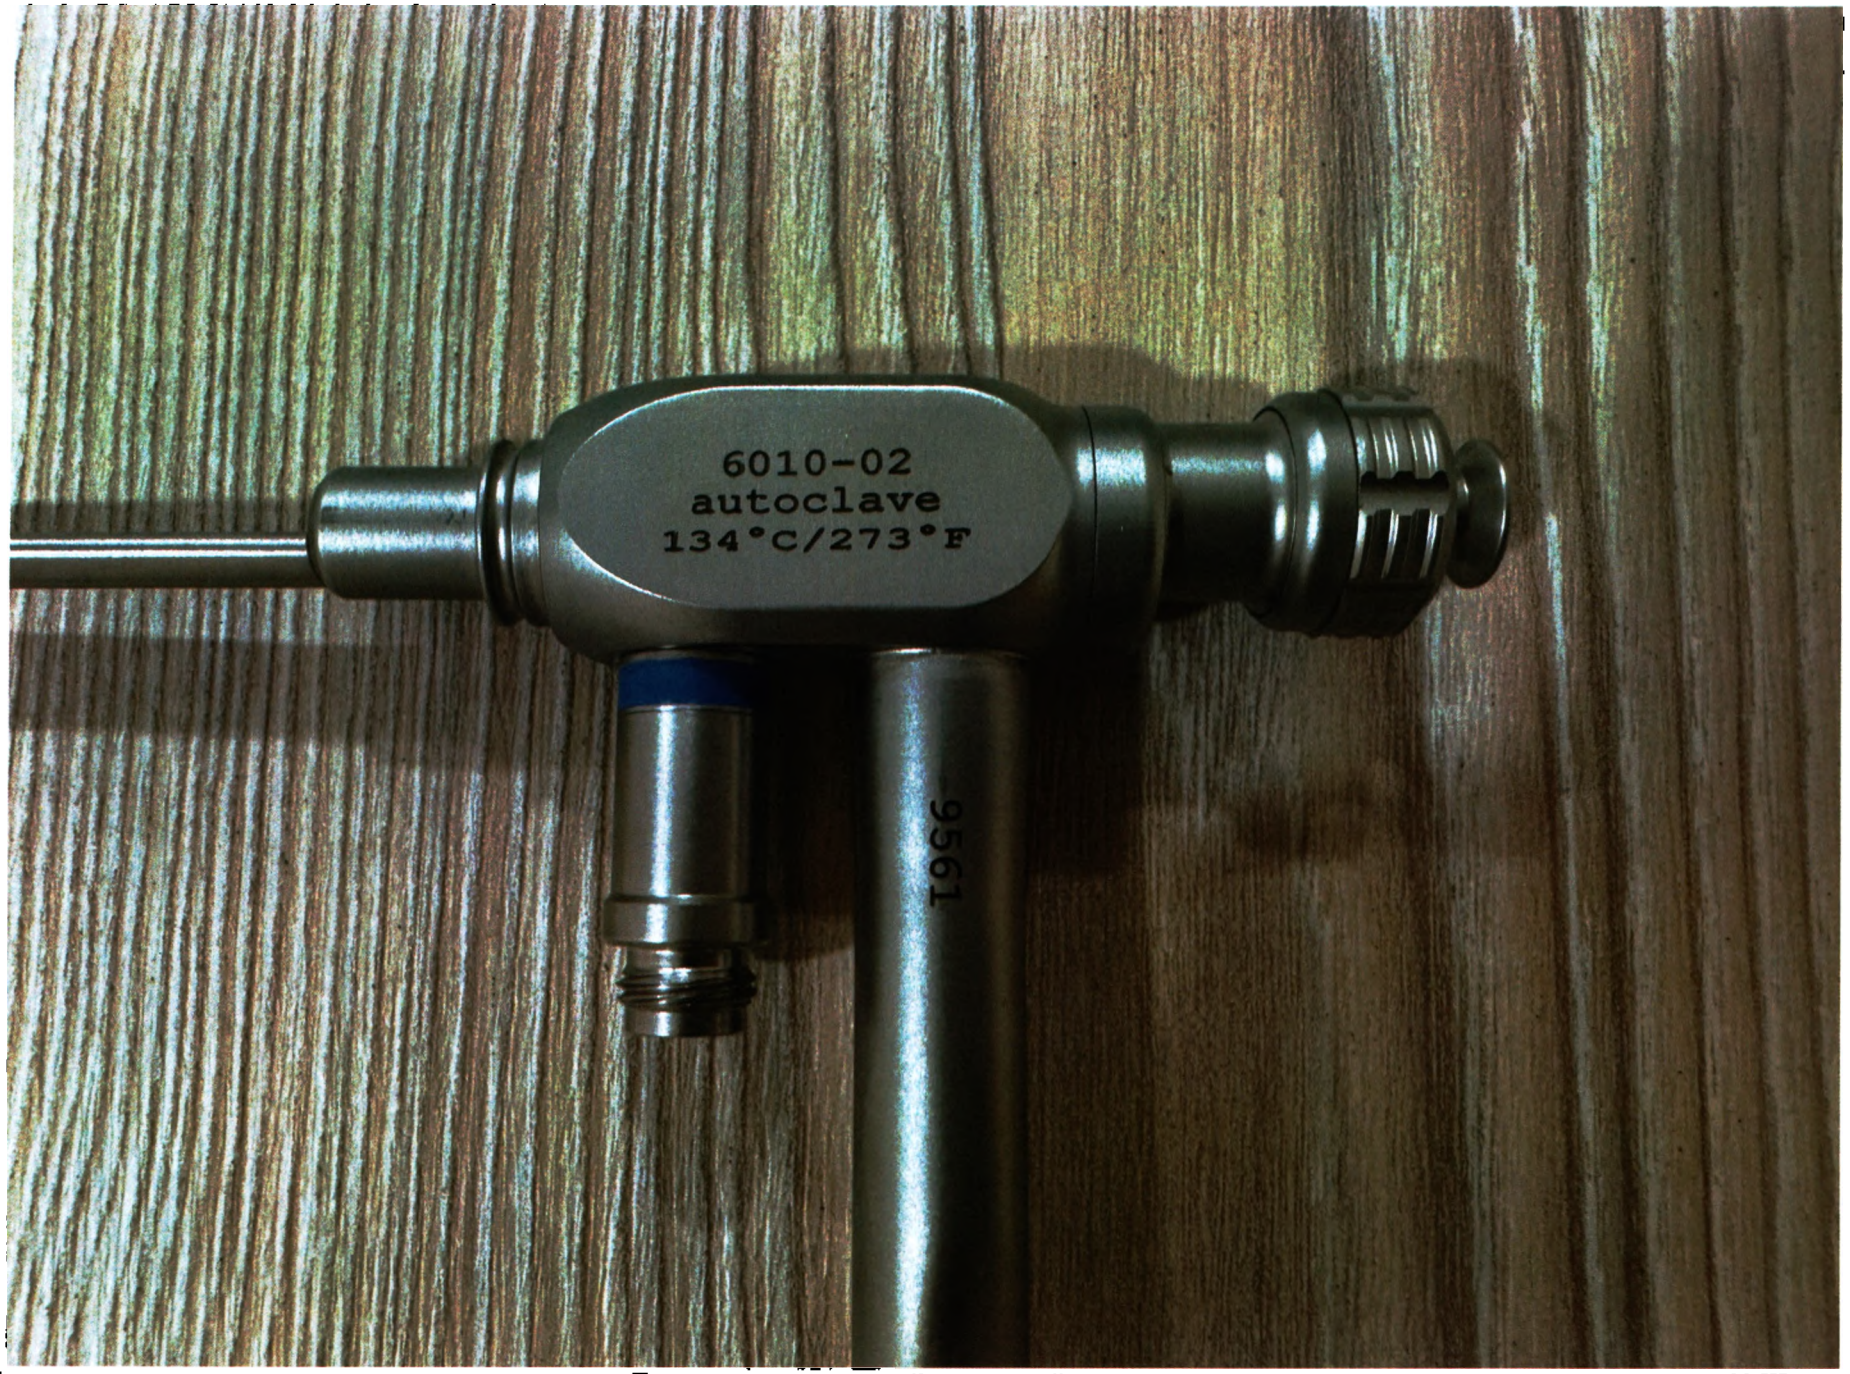


Фото 7. **Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 0°; Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 30°**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 8. **Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 0°; Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 30°**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 9. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 0°; Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с параллельным окуляром 11 Шр, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

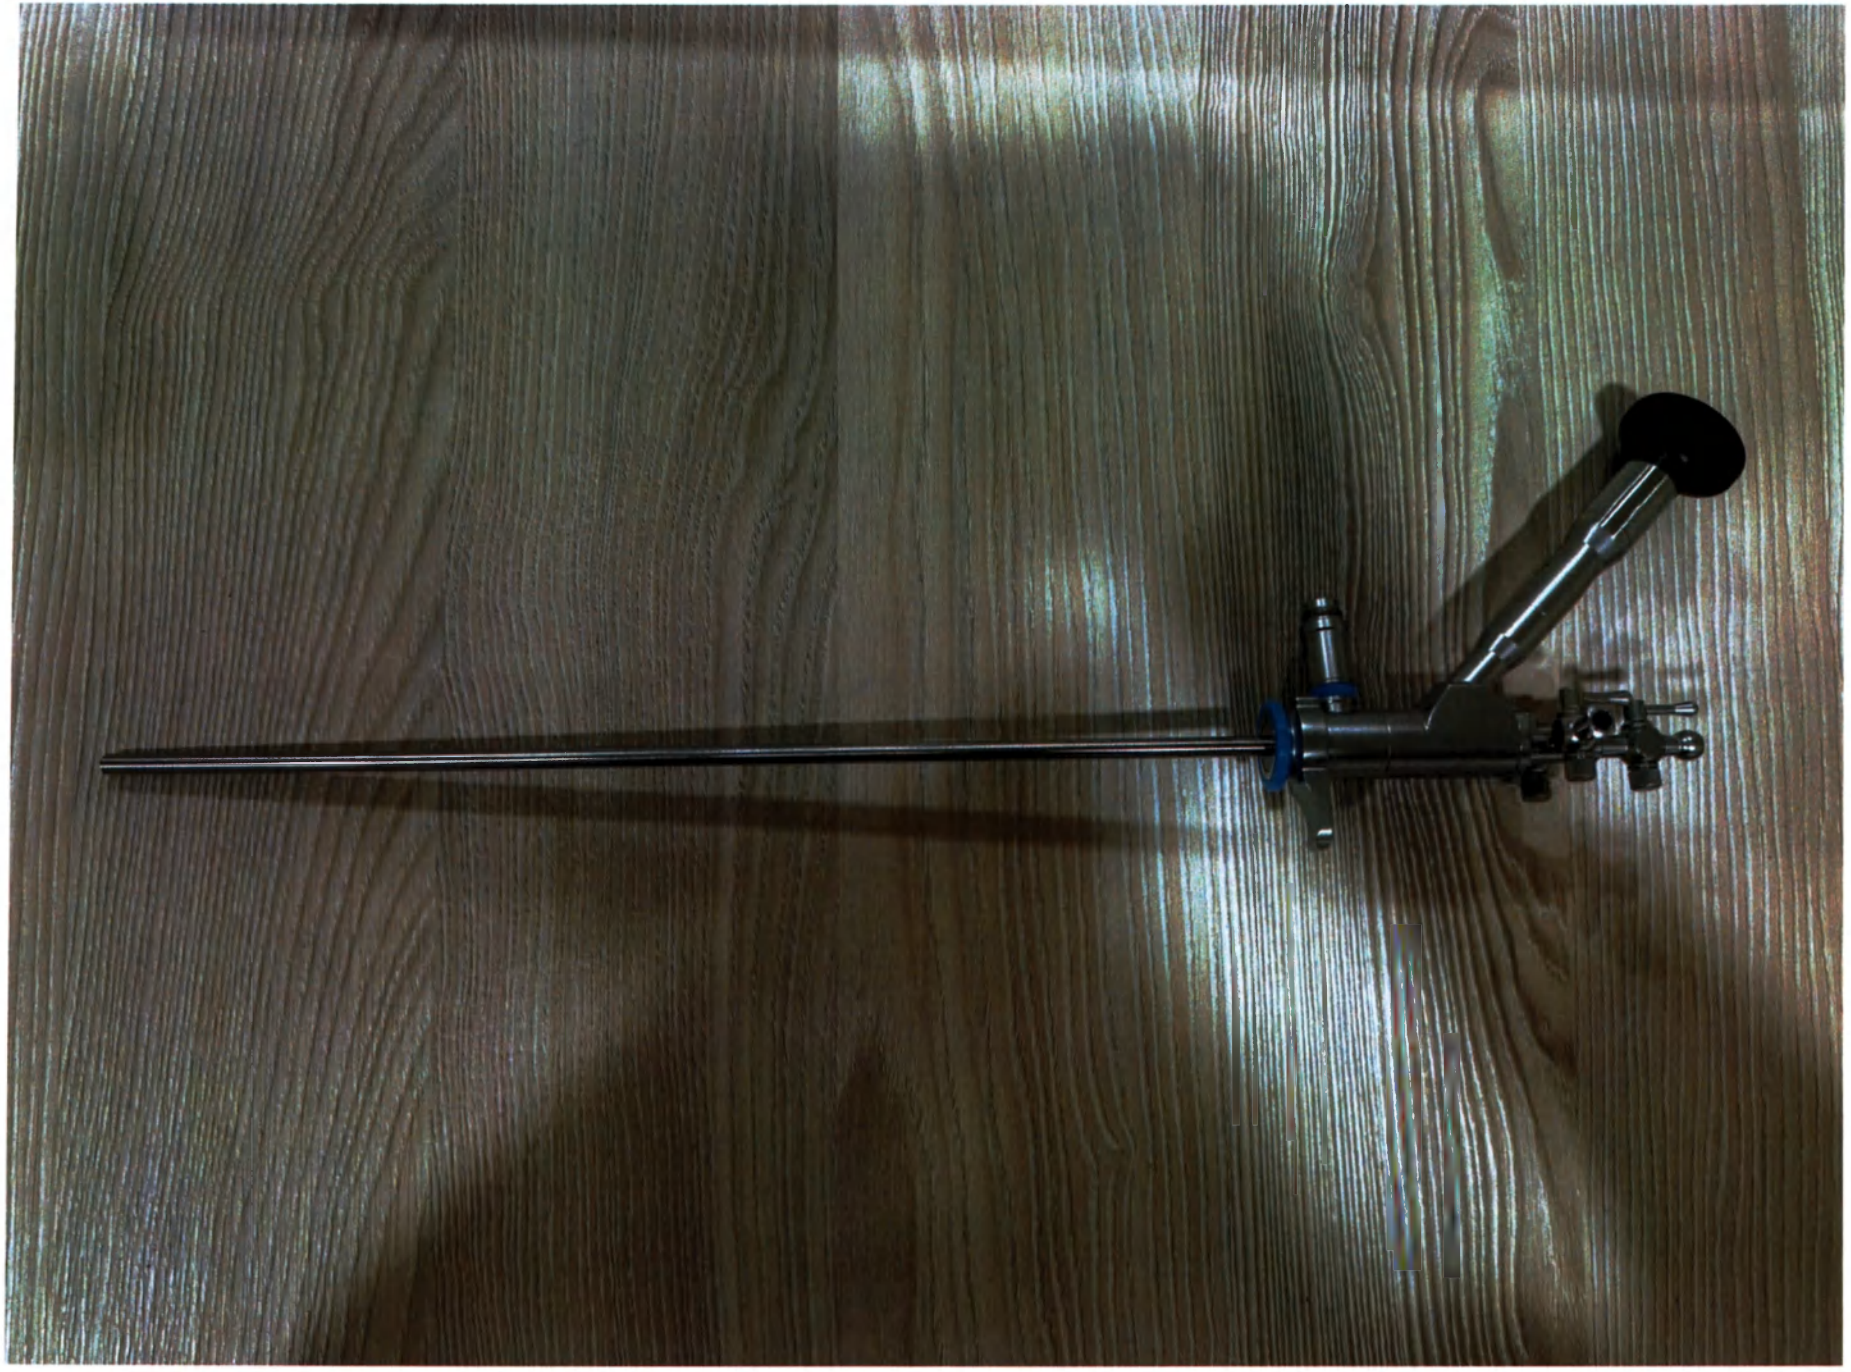


Фото 10. Общий вид вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 15 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

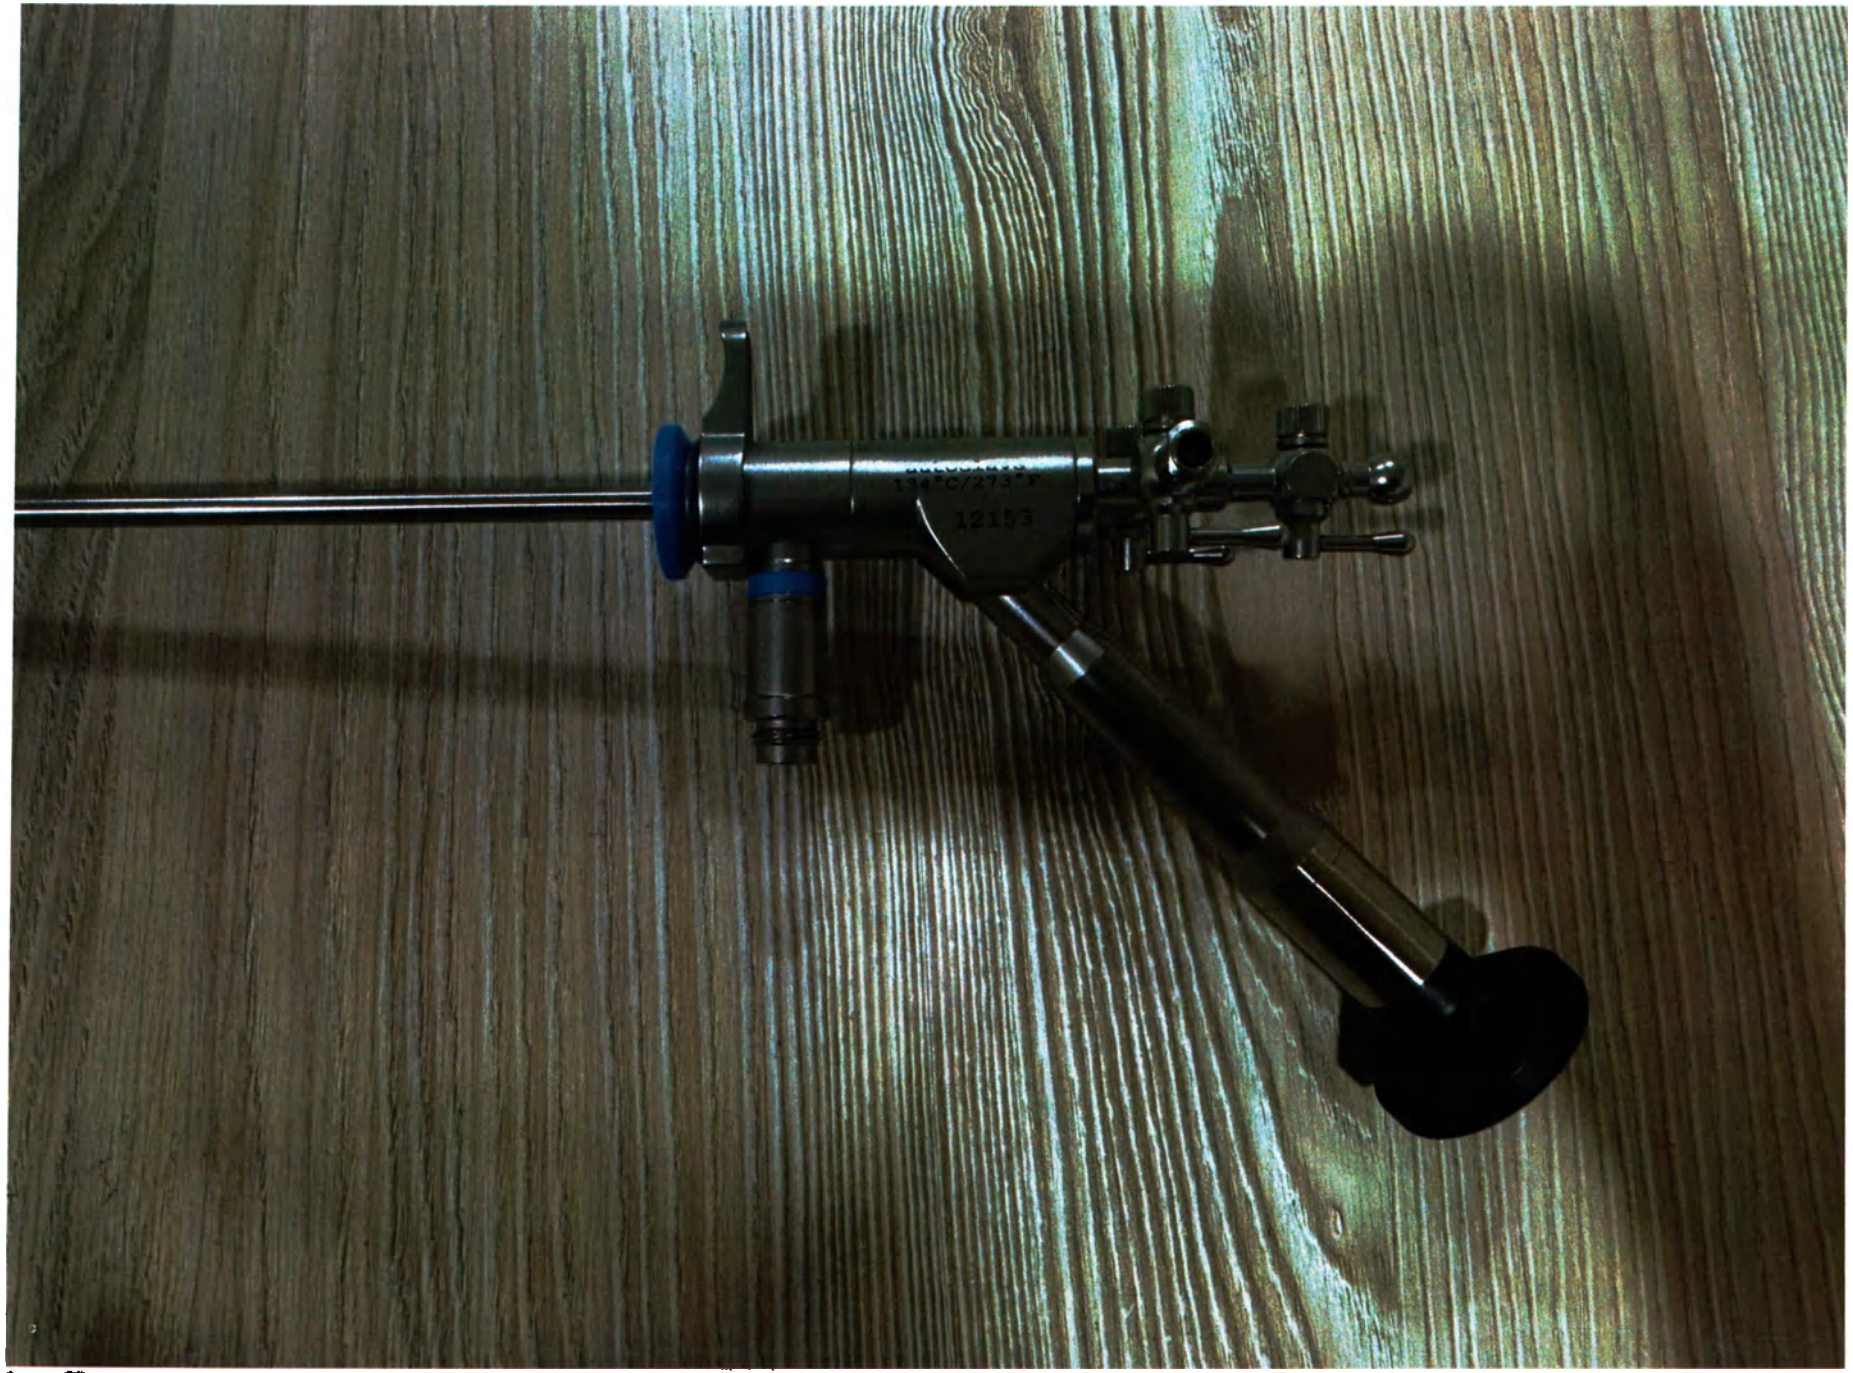


Фото 11. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 15 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

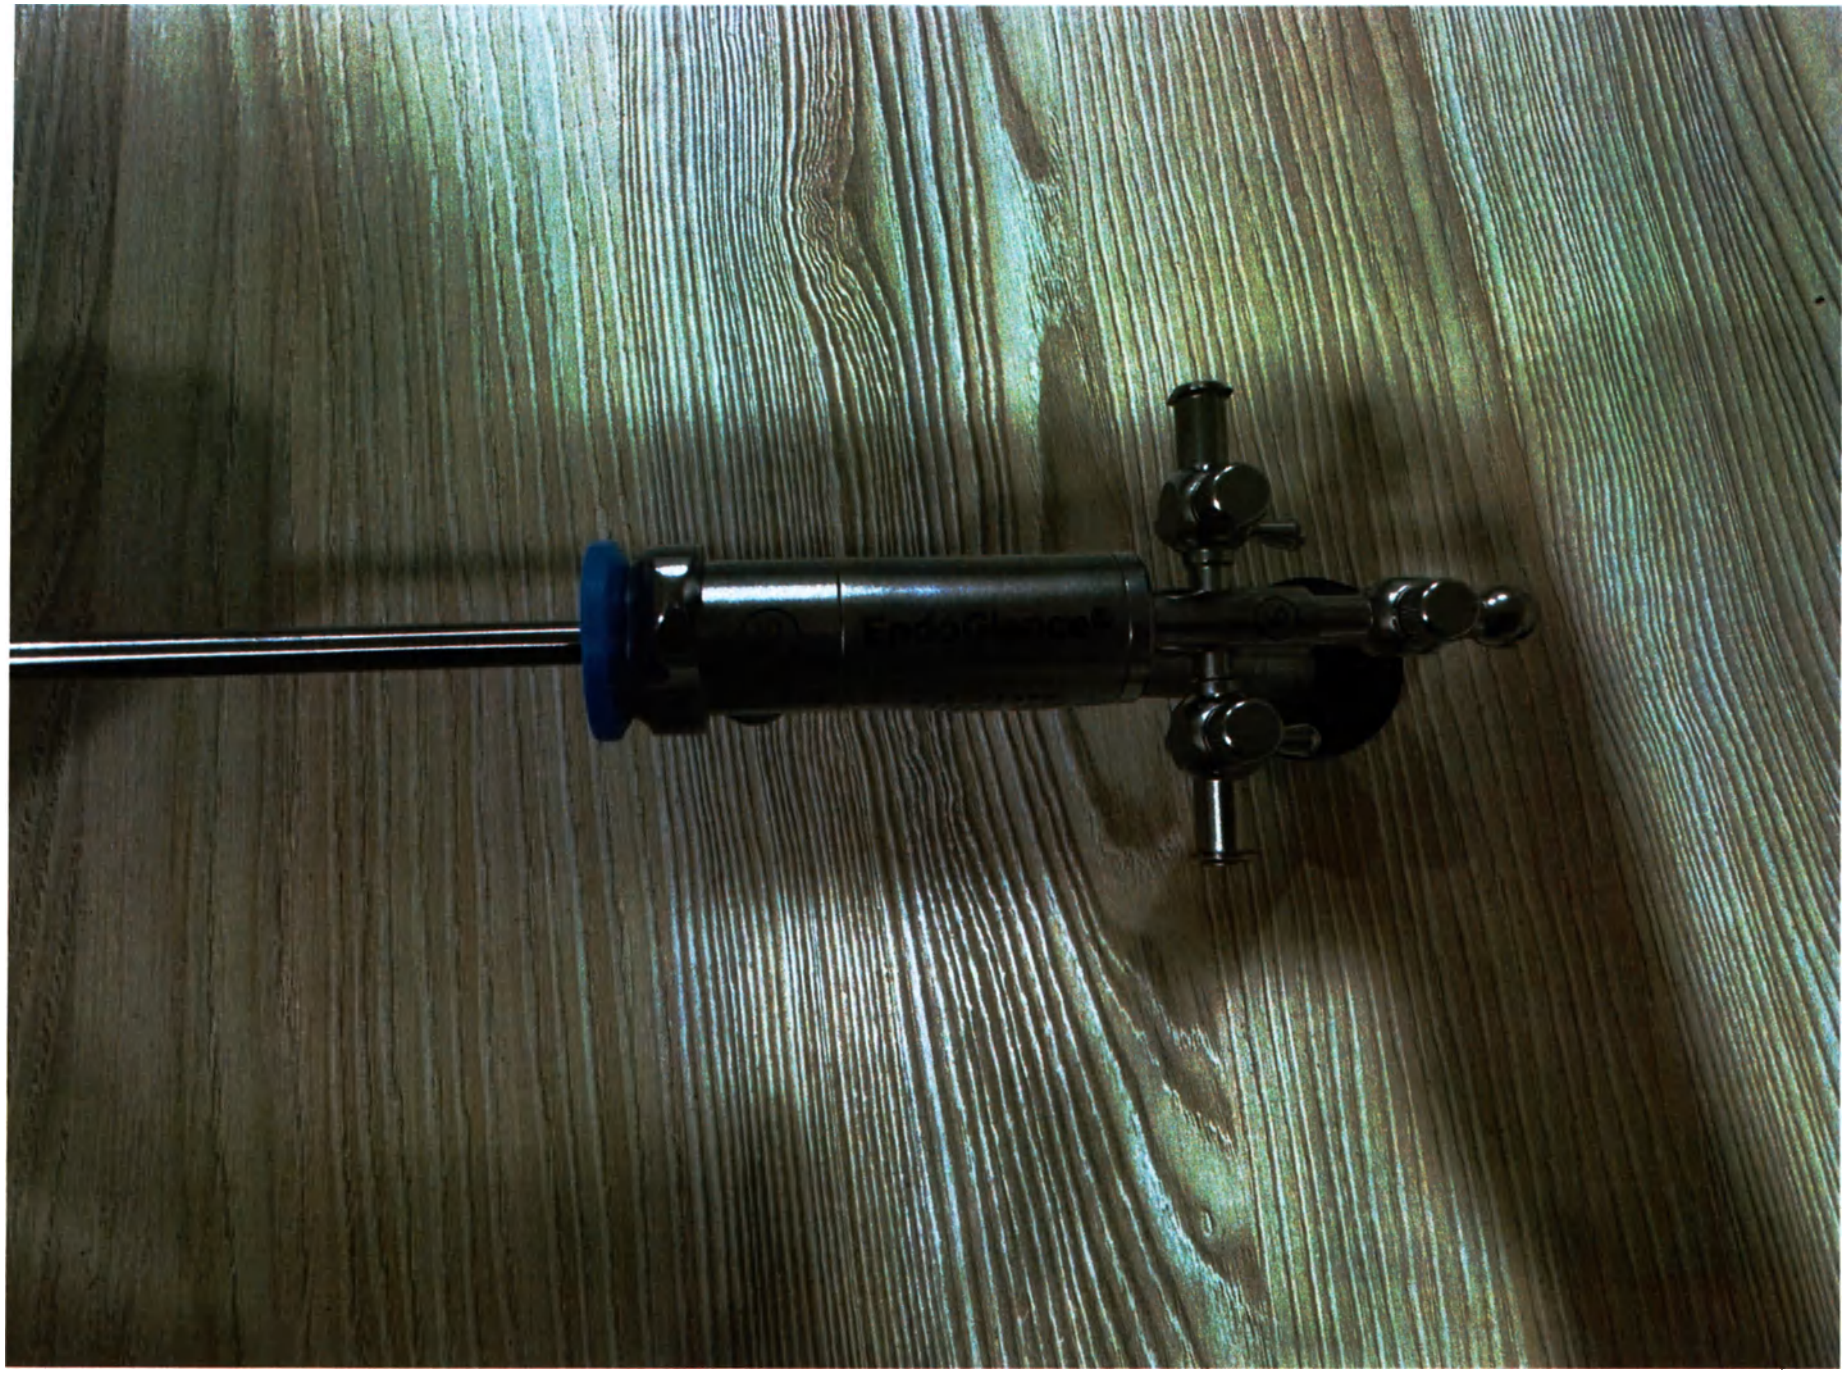


Фото 12. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 15 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 13. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 15 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

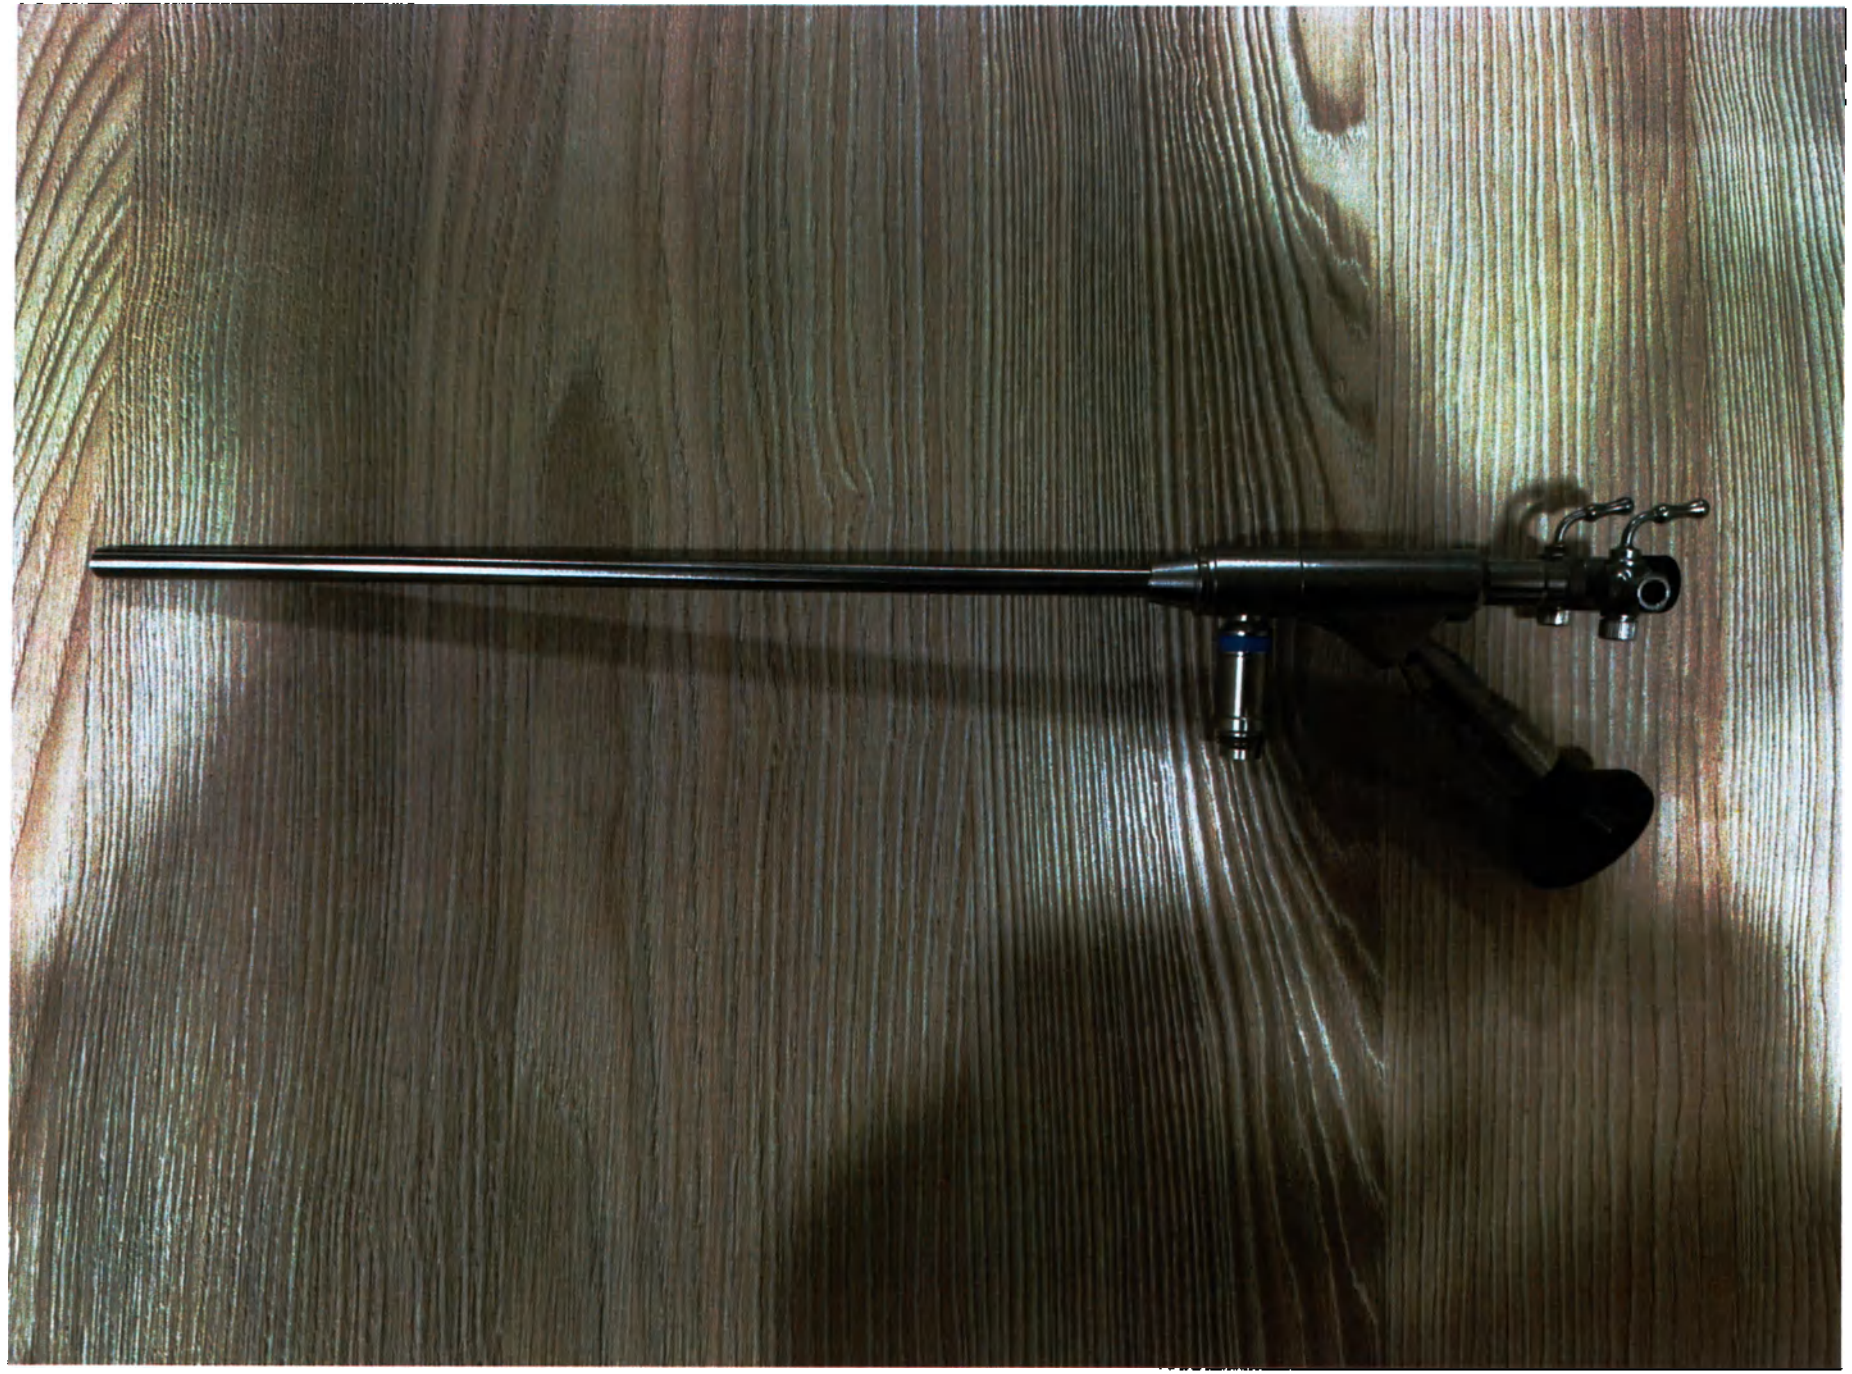


Фото 14. Общий вид вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19.5 Шр, направление наблюдения 5°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

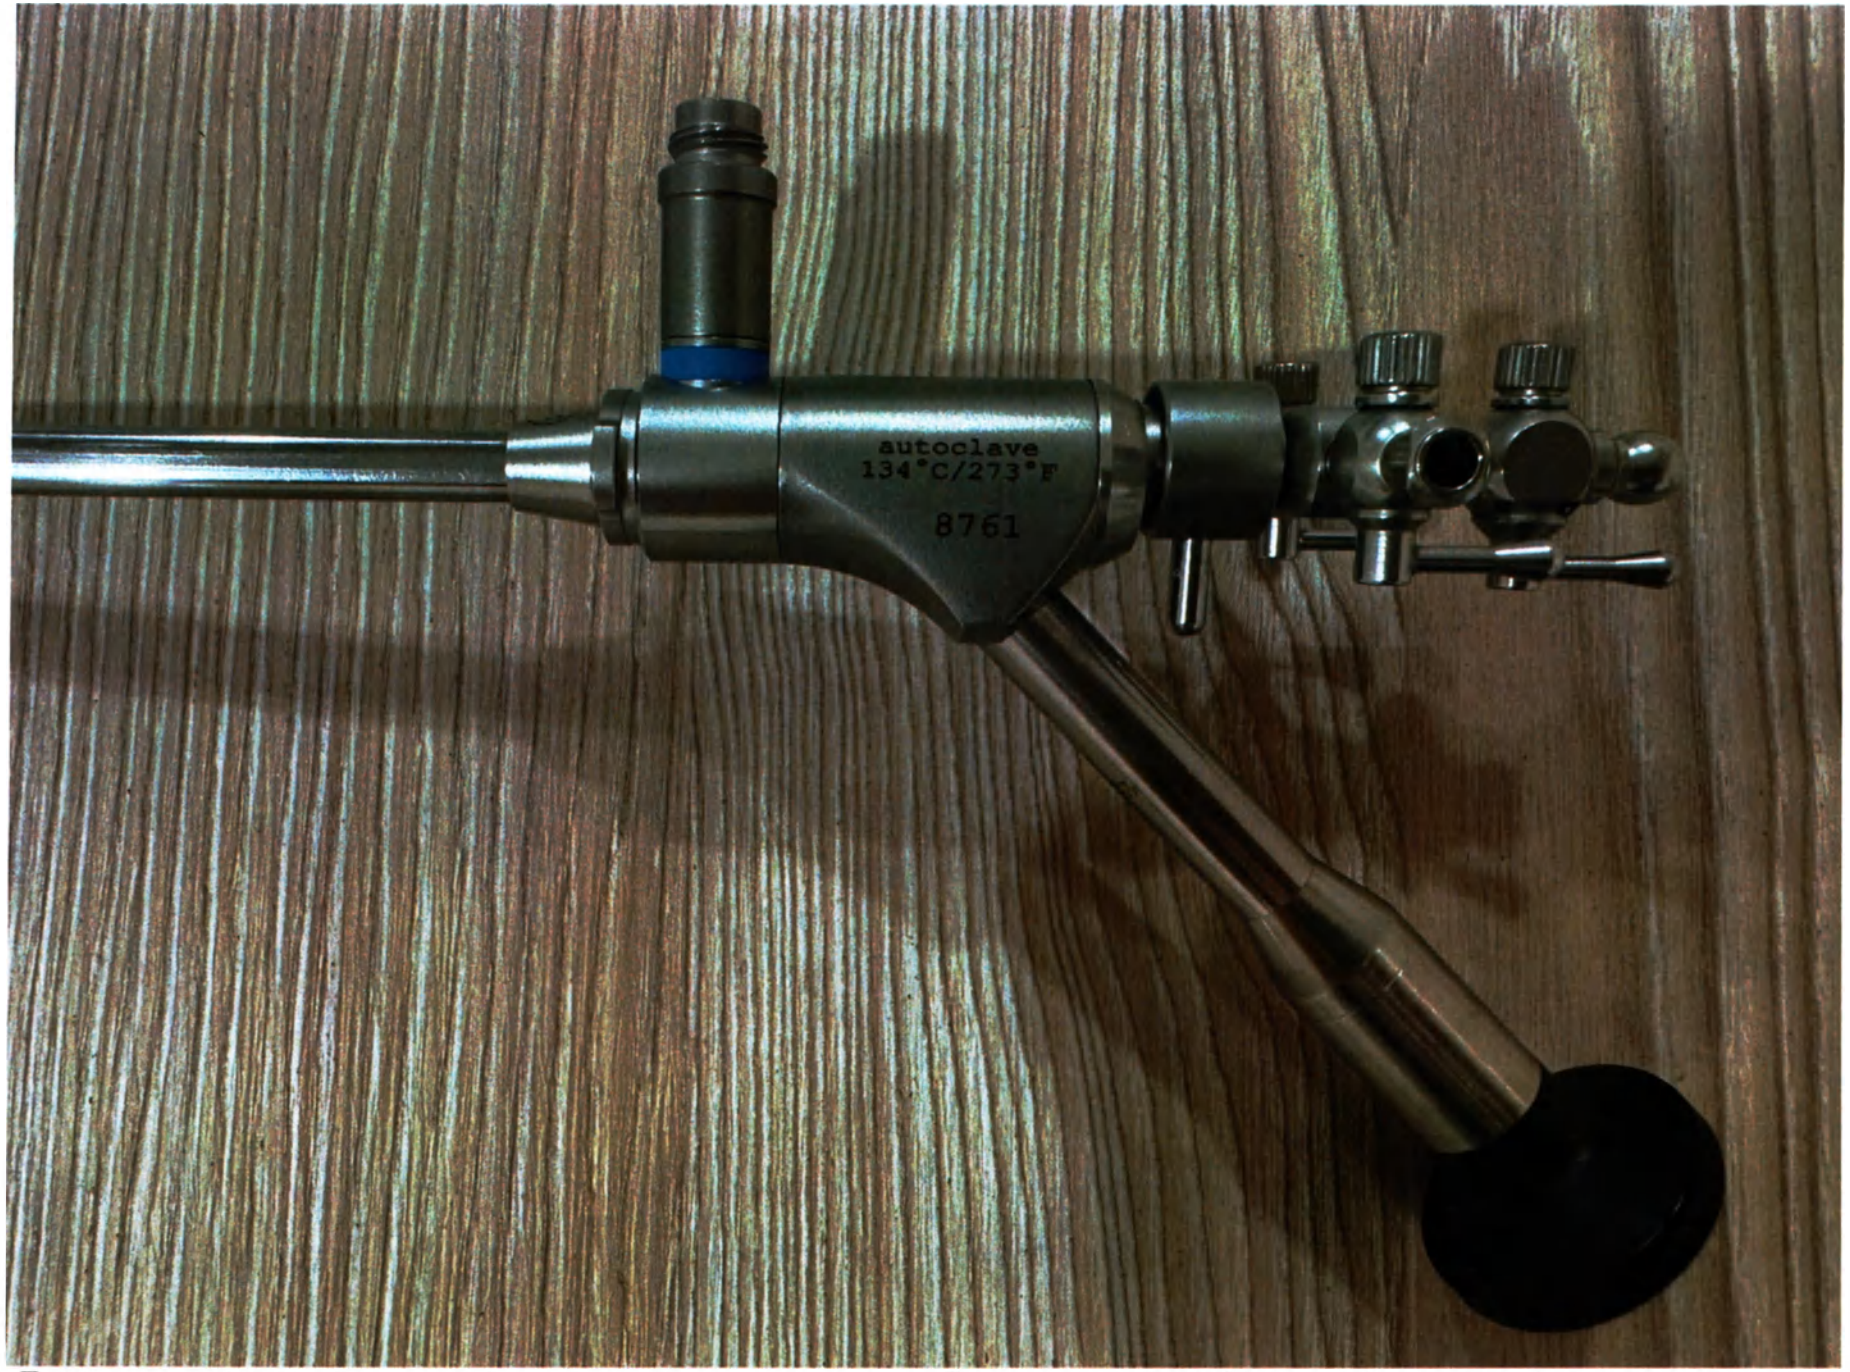


Фото 15. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19.5 Шр, направление наблюдения 5°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

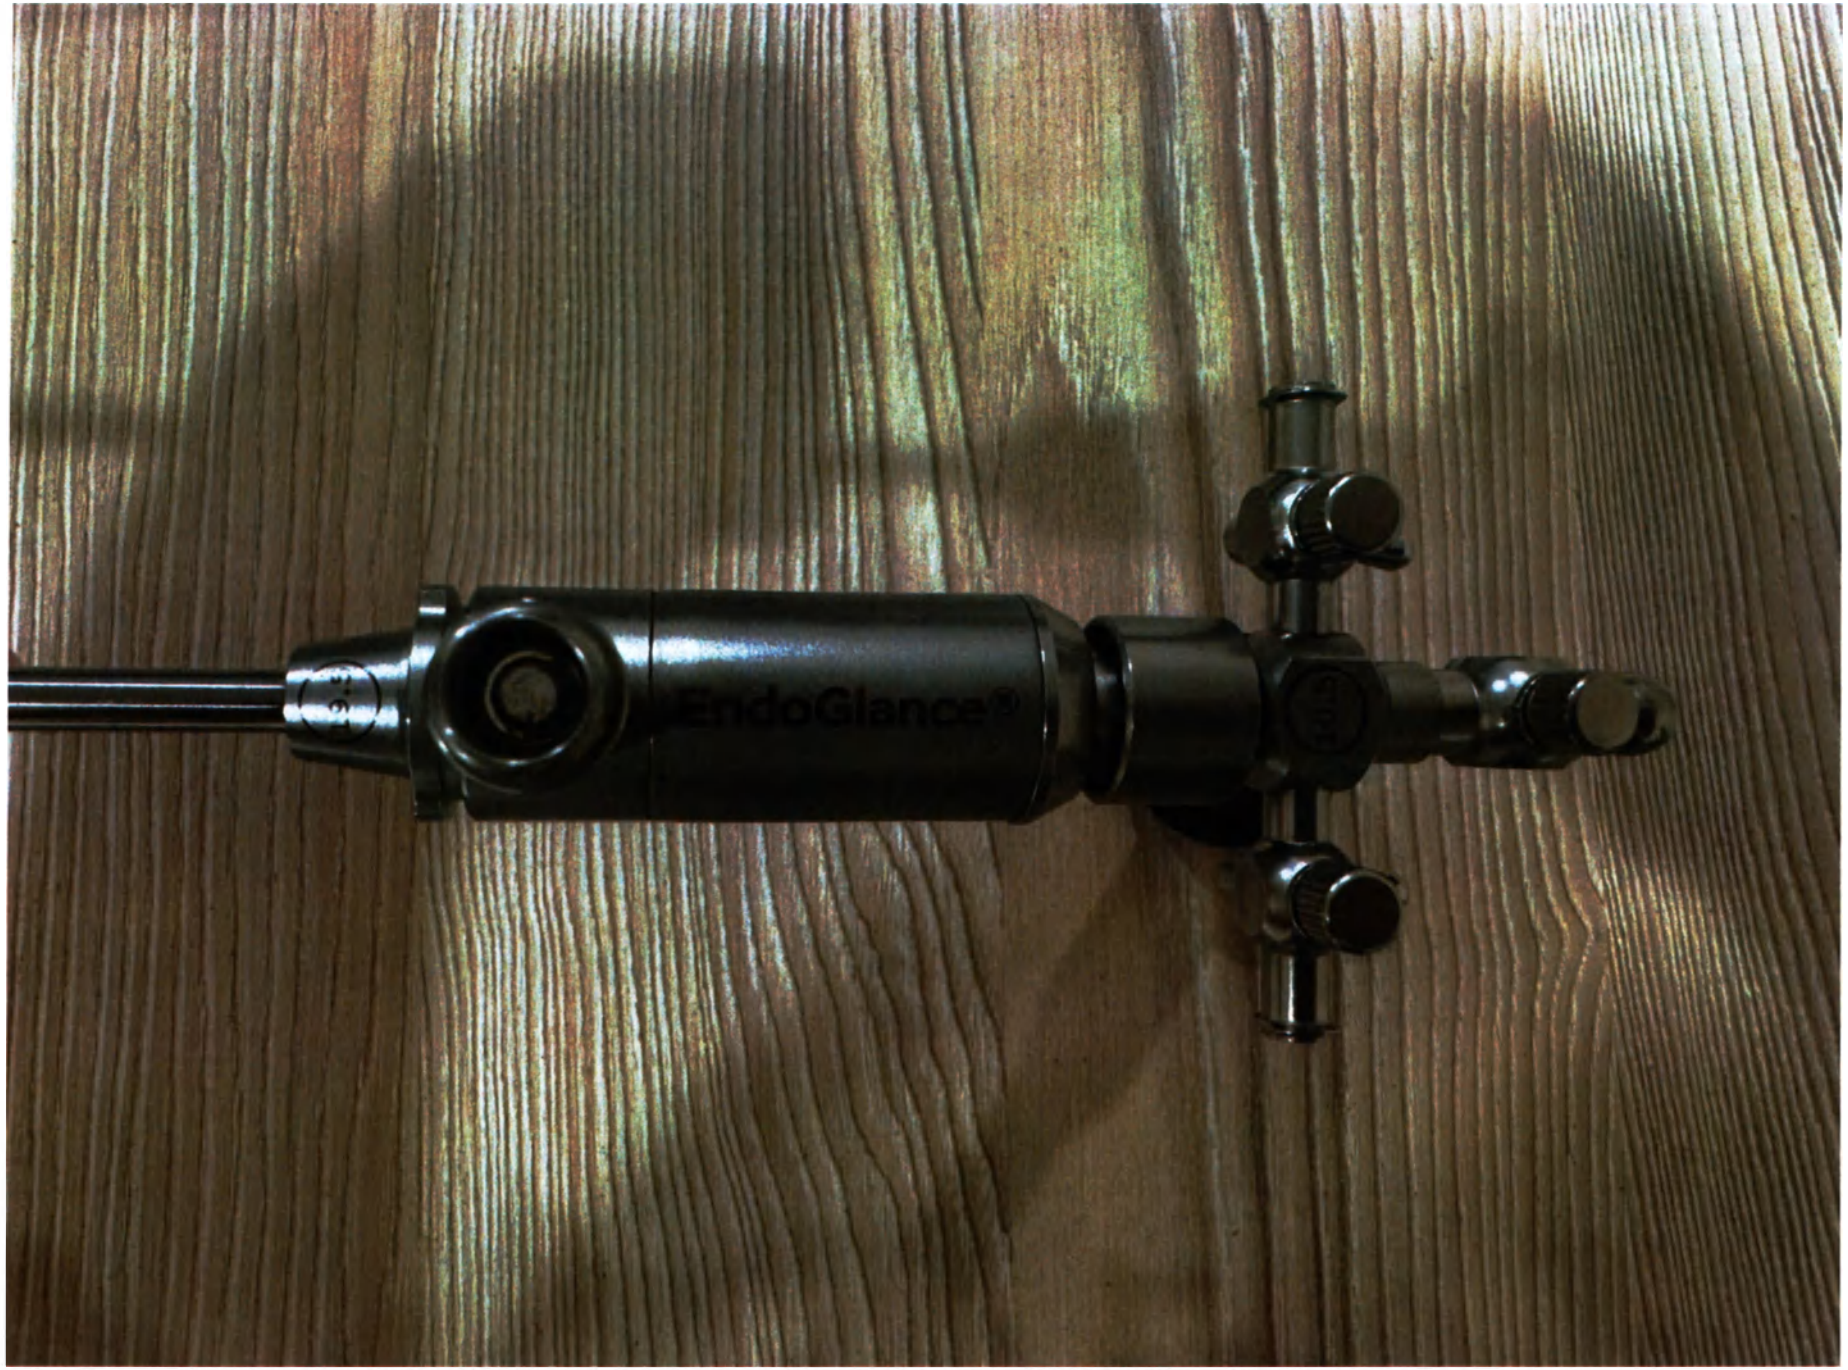


Фото 16. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19.5 Шр, направление наблюдения 5°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

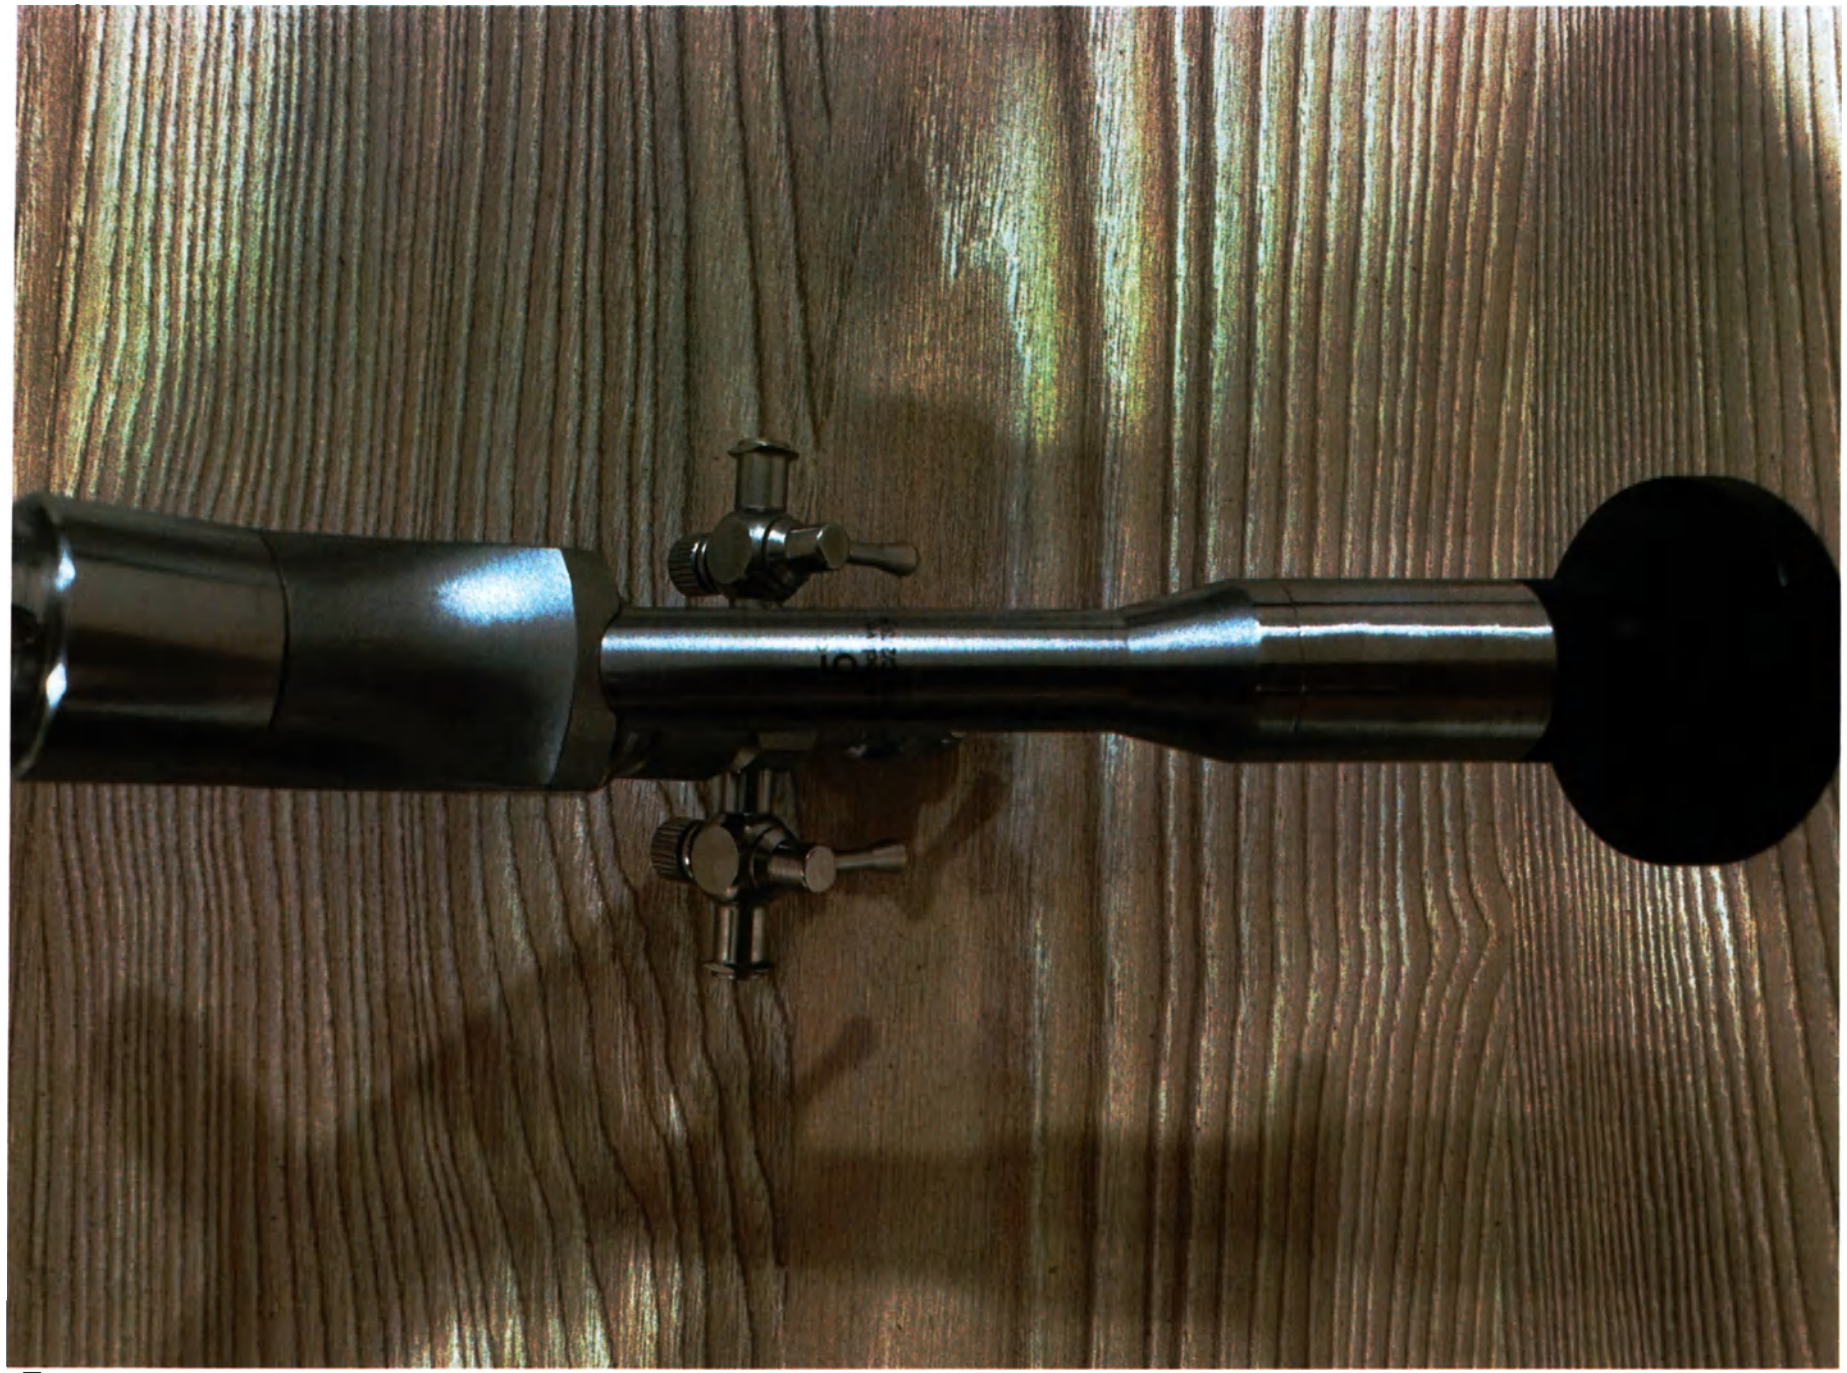


Фото 17. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19.5 Шр, направление наблюдения 5°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 18. Общий вид вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 19. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 20. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 21. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 19 Шр, направление наблюдения 12°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 22. Общий вид вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 6.3 мм, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 23. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 6.3 мм, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 24. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 6.3 мм, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 25. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 6.3 мм, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

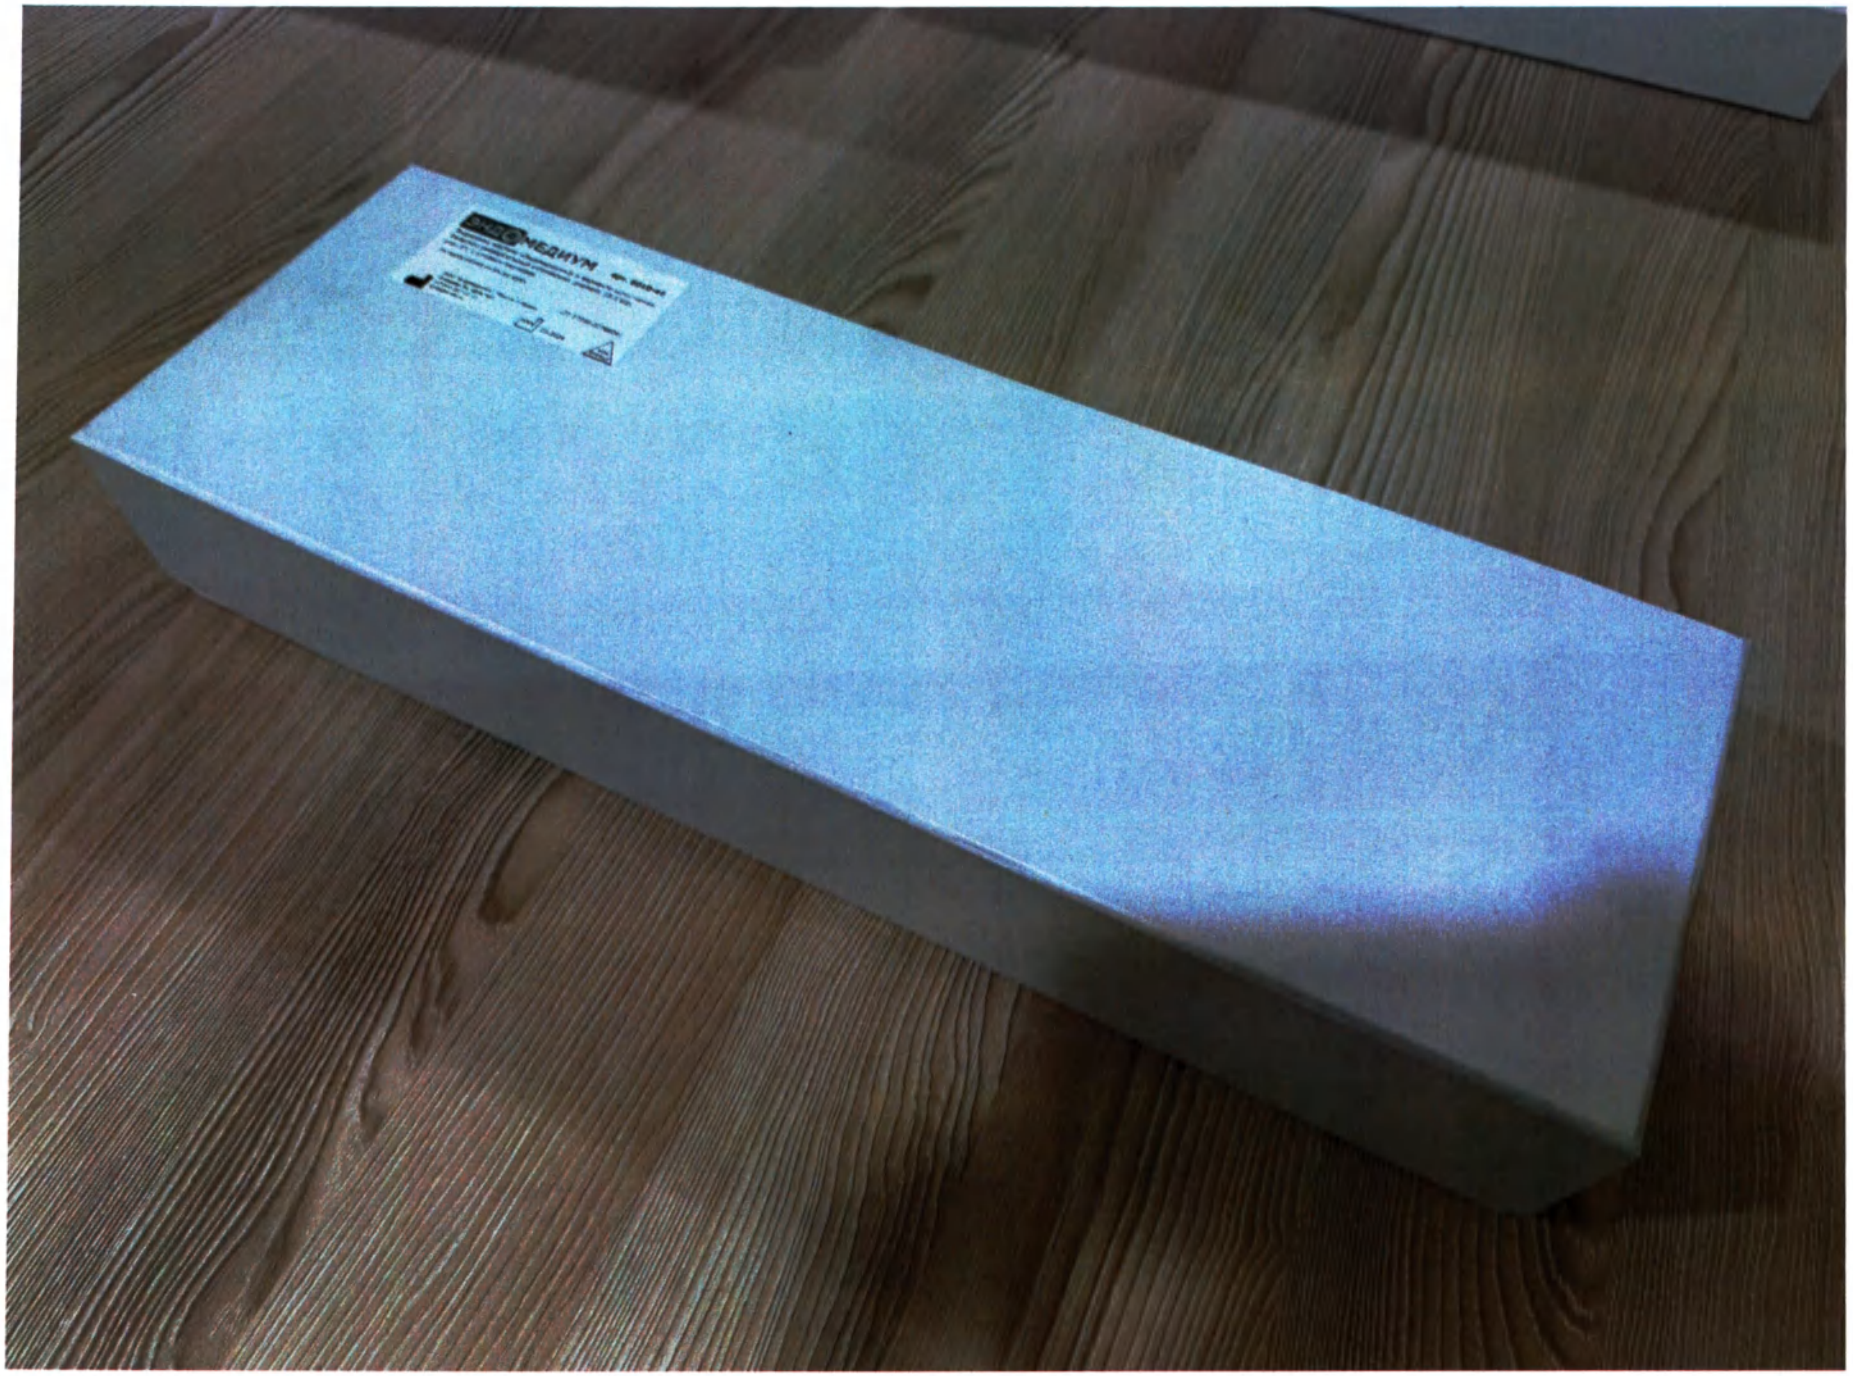


Фото 26. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Телескоп универсальный оптический с инструментальным каналом с угловым окуляром 6.3 мм, направление наблюдения 30°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

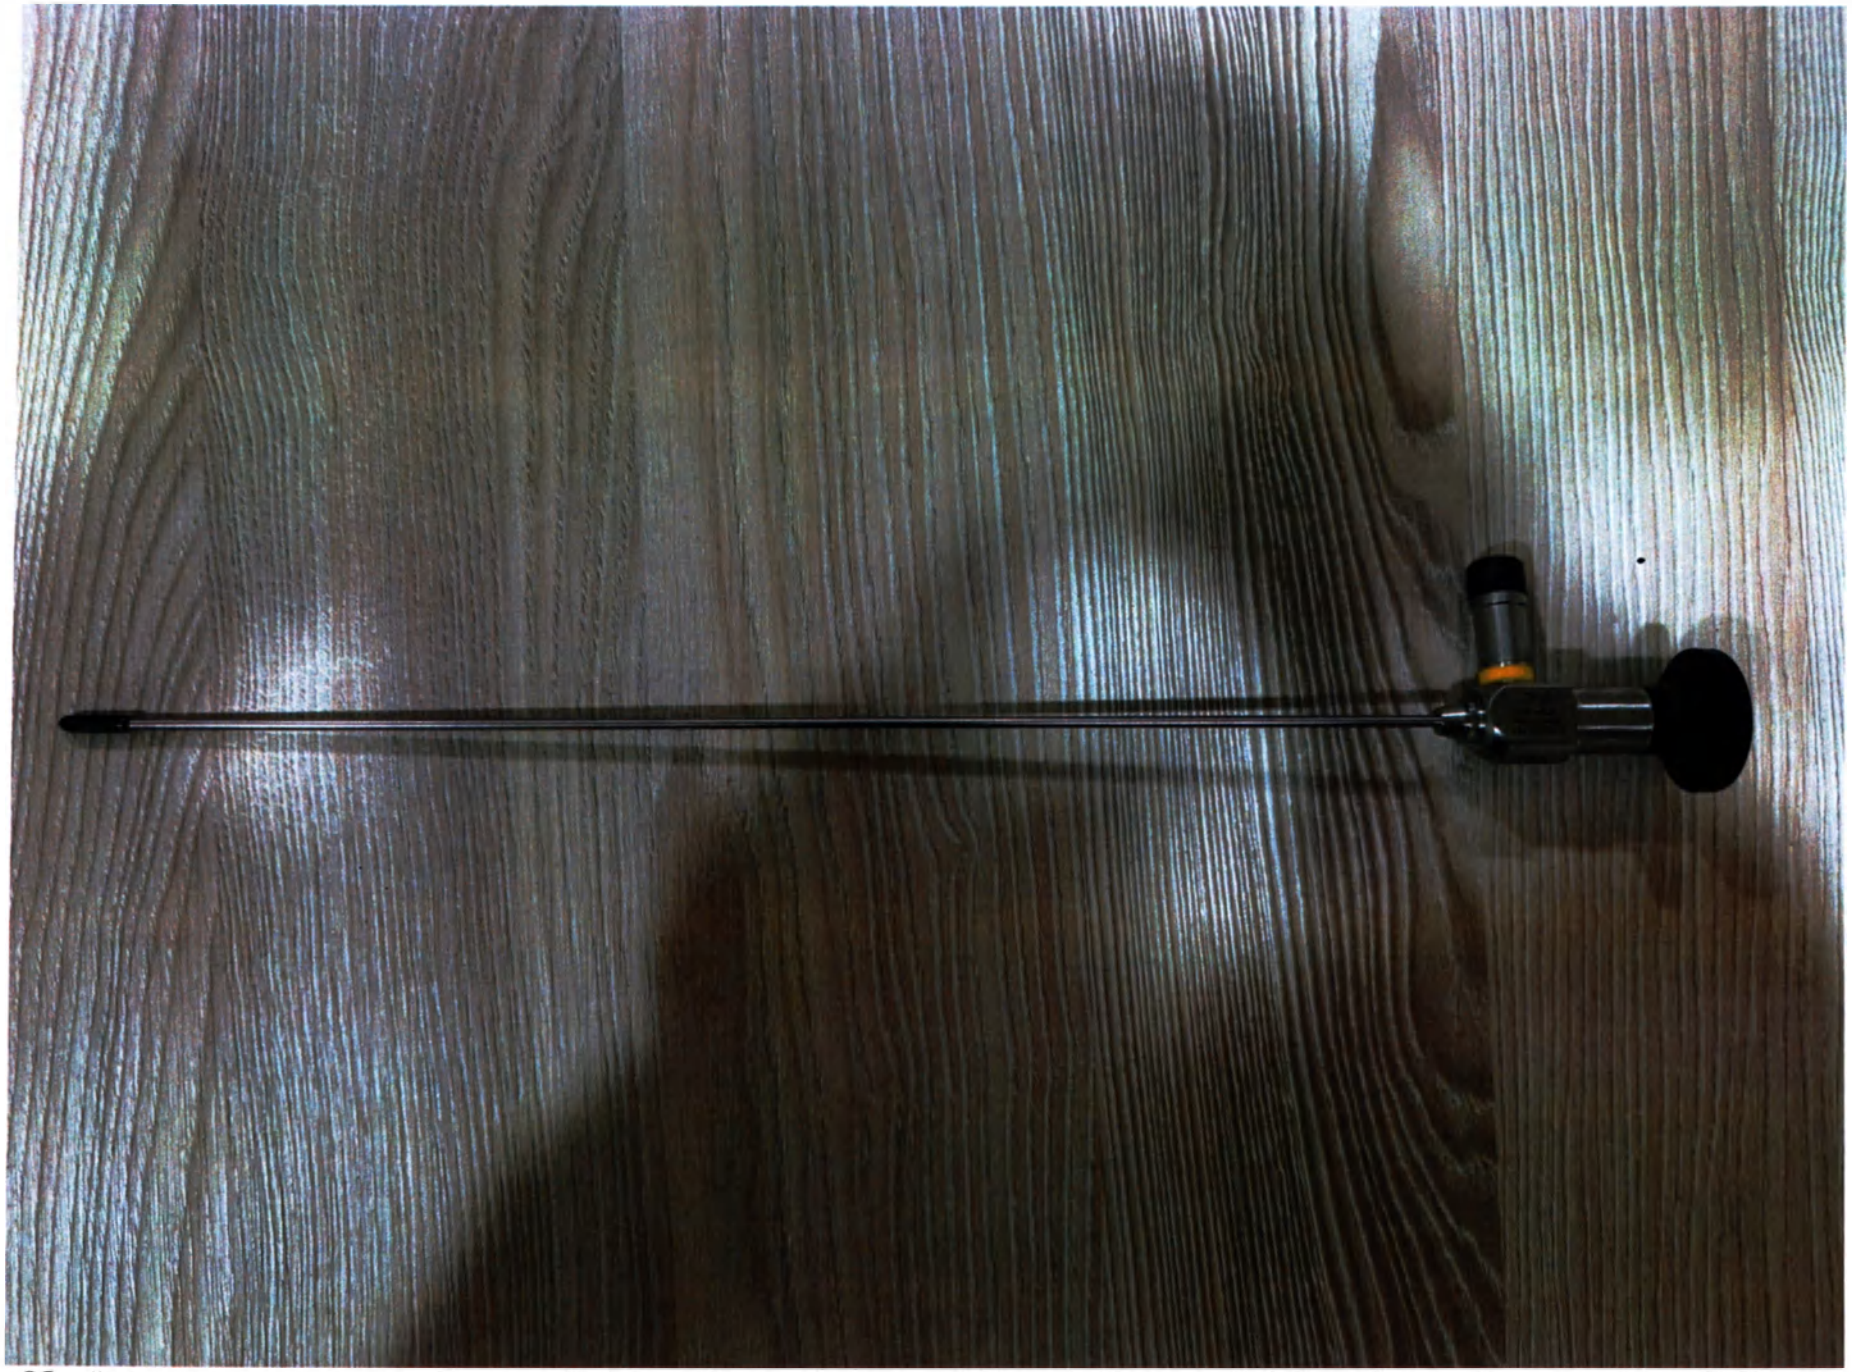


Фото 27. Общий вид вариантов исполнения: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

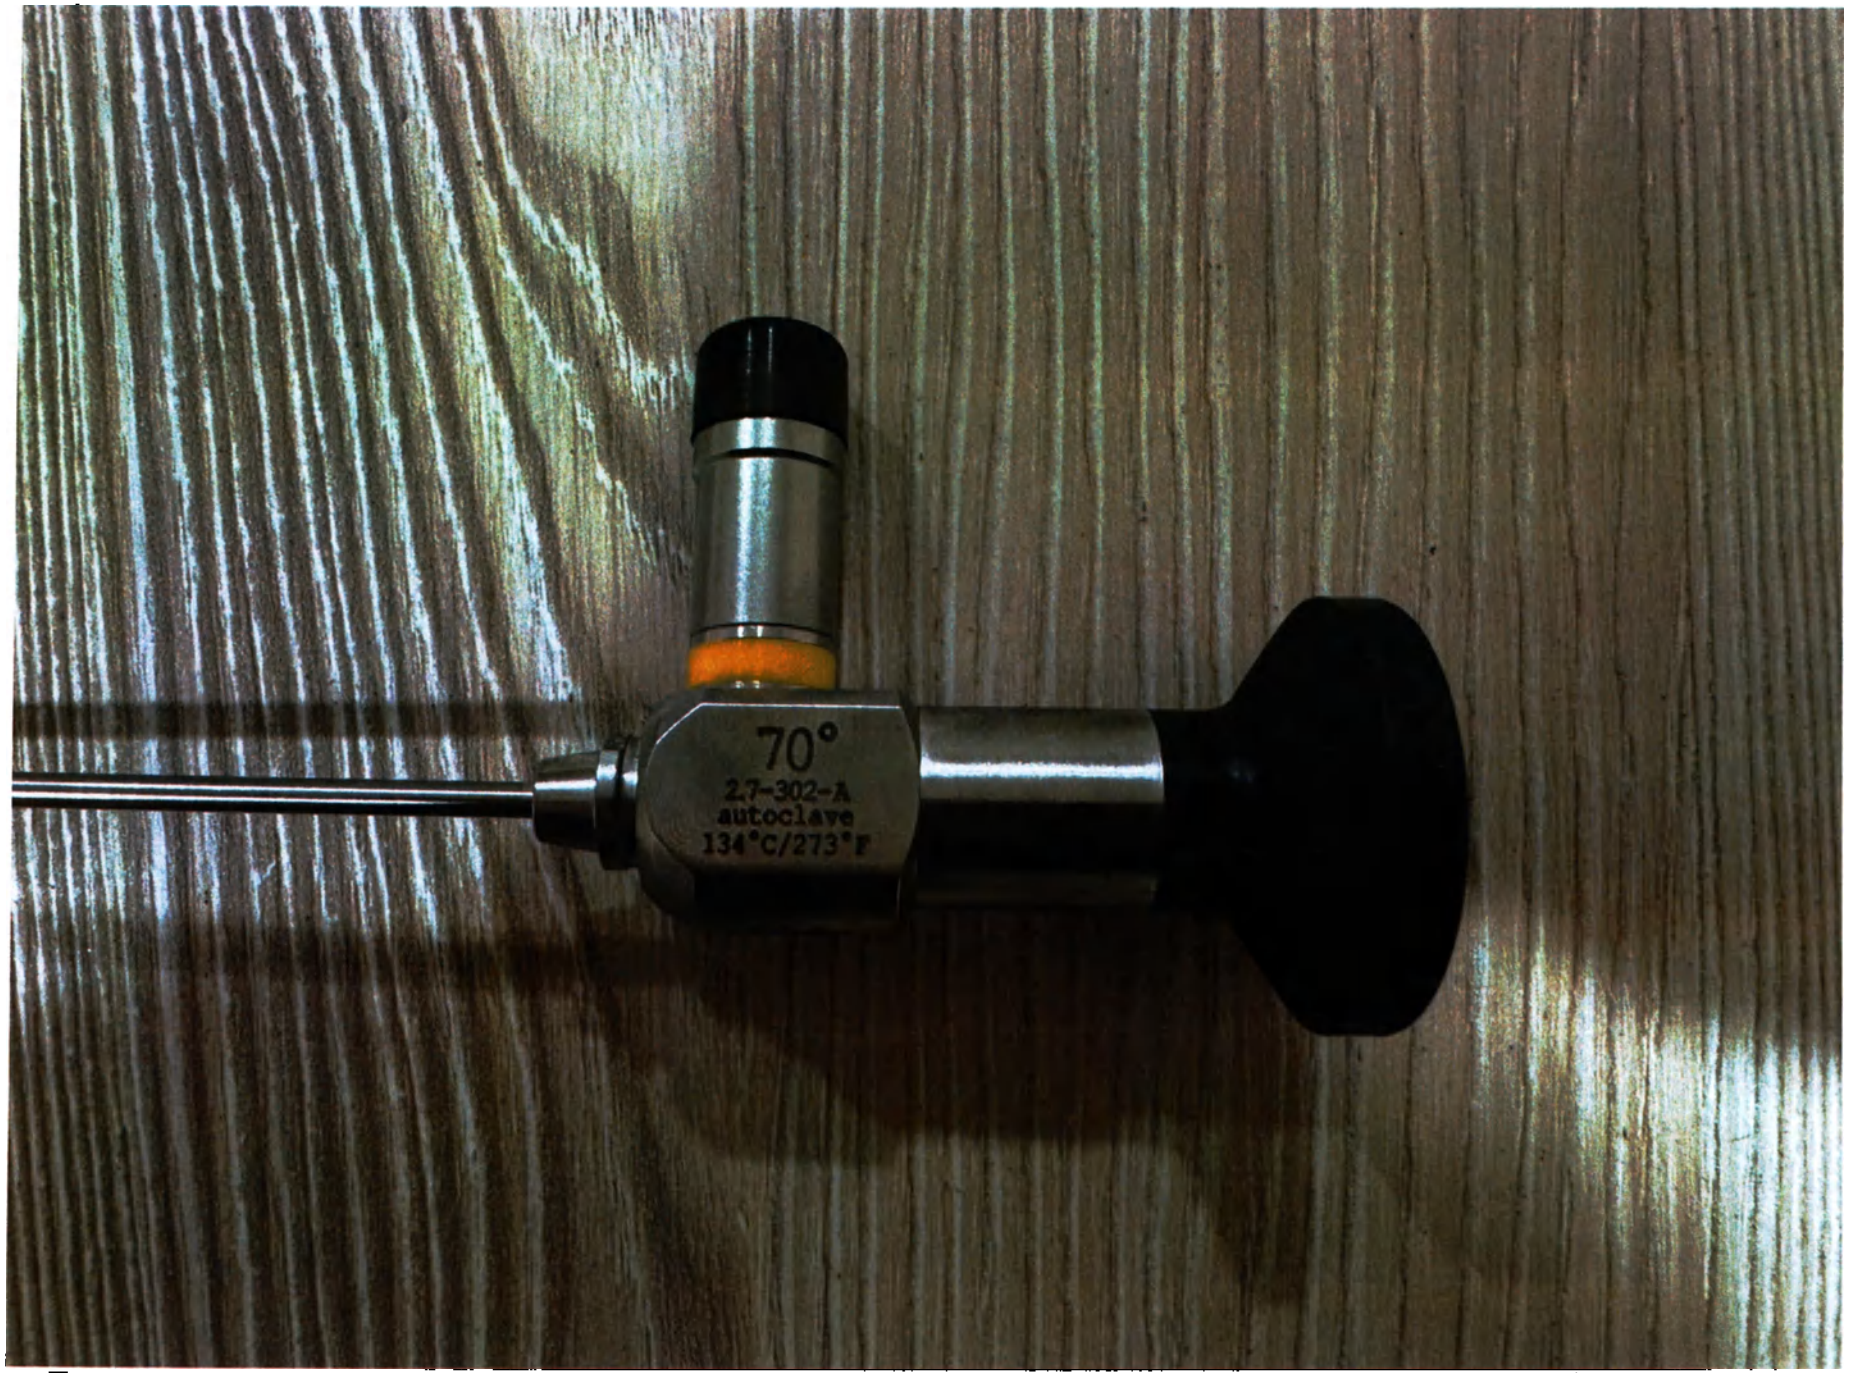


Фото 28. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

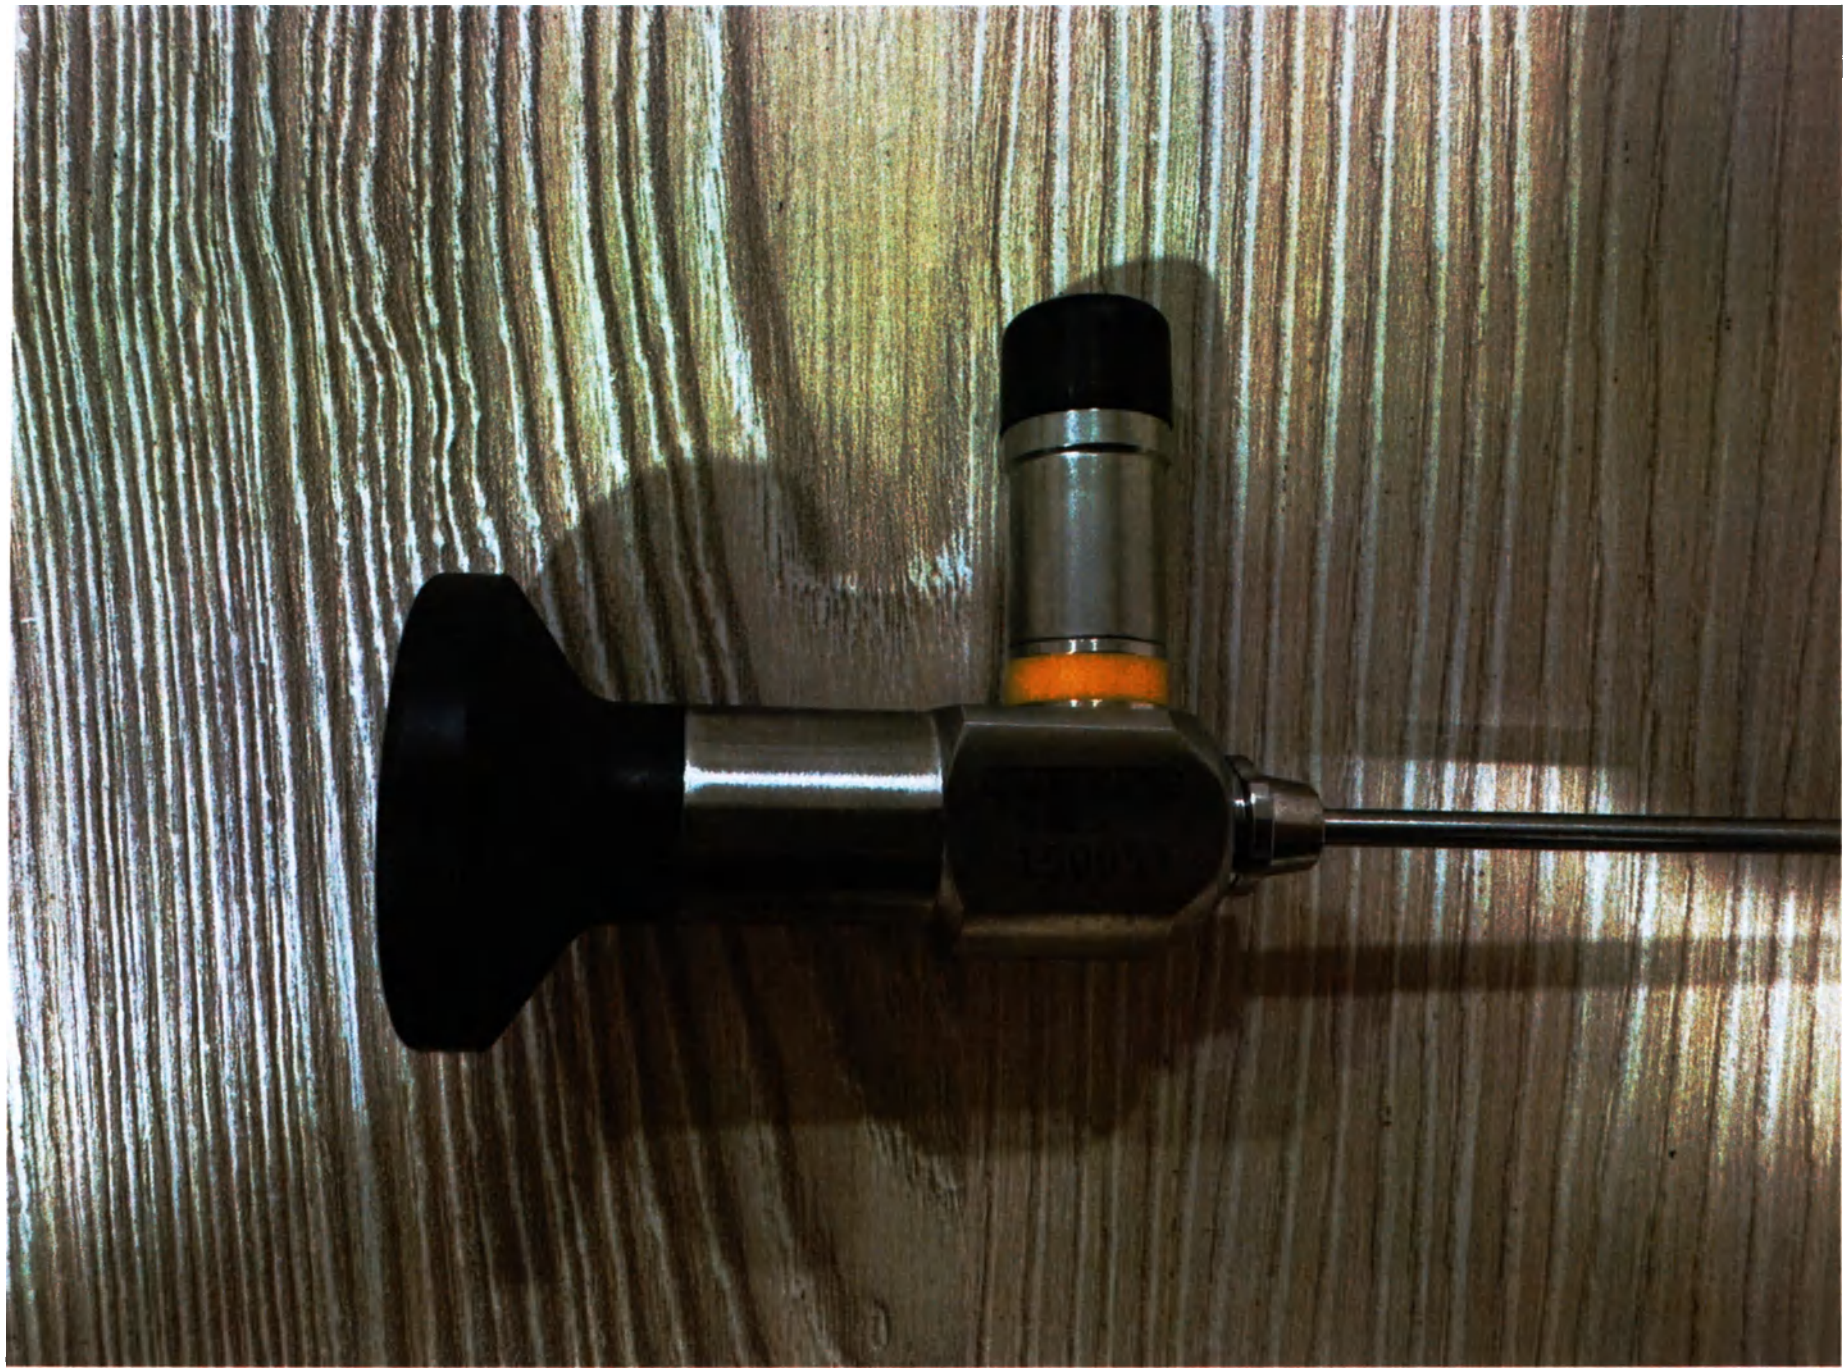


Фото 29. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

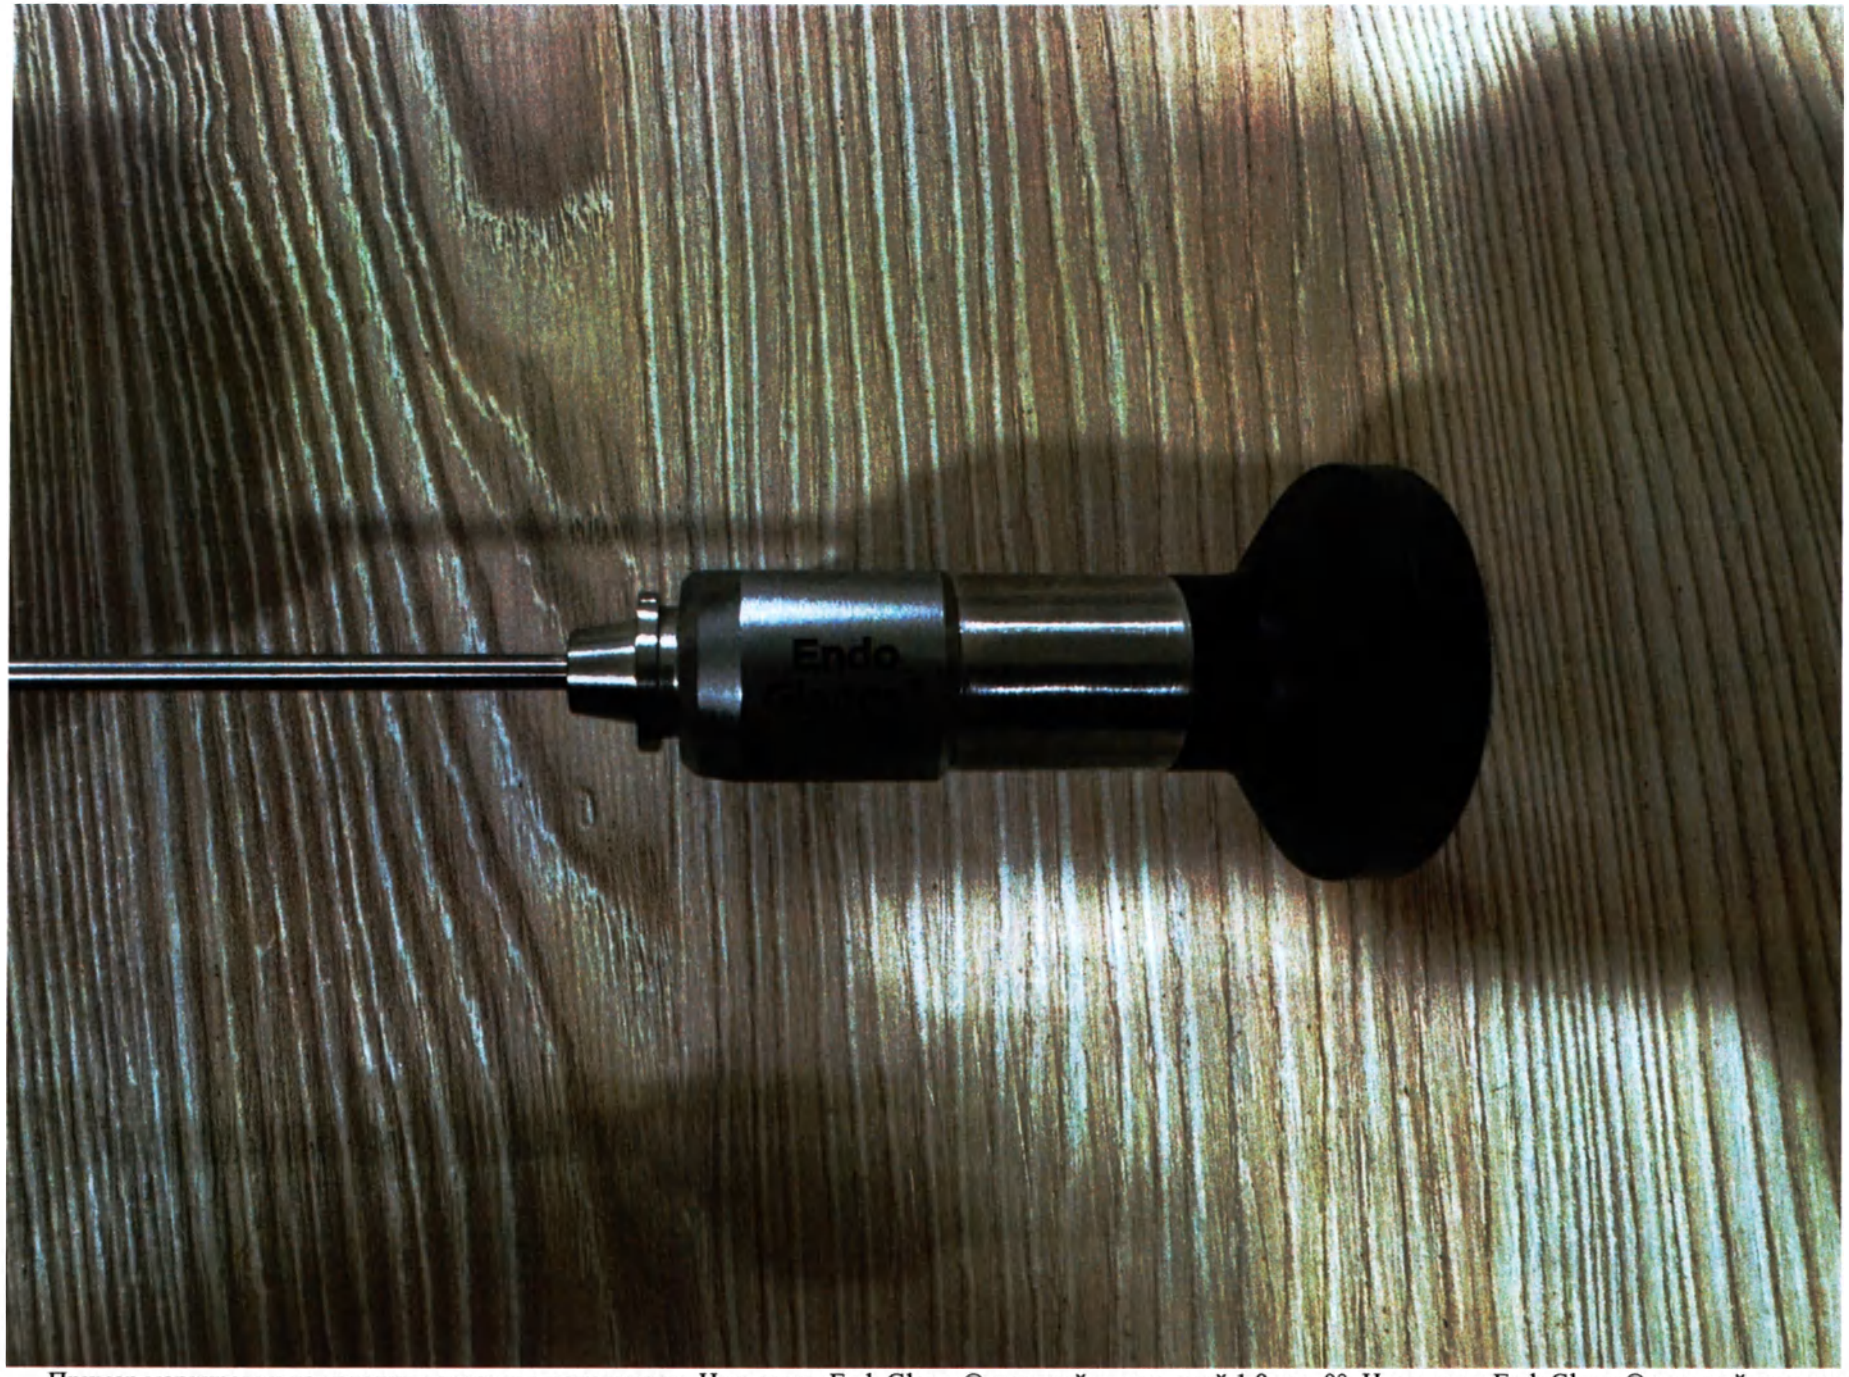


Фото 30. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

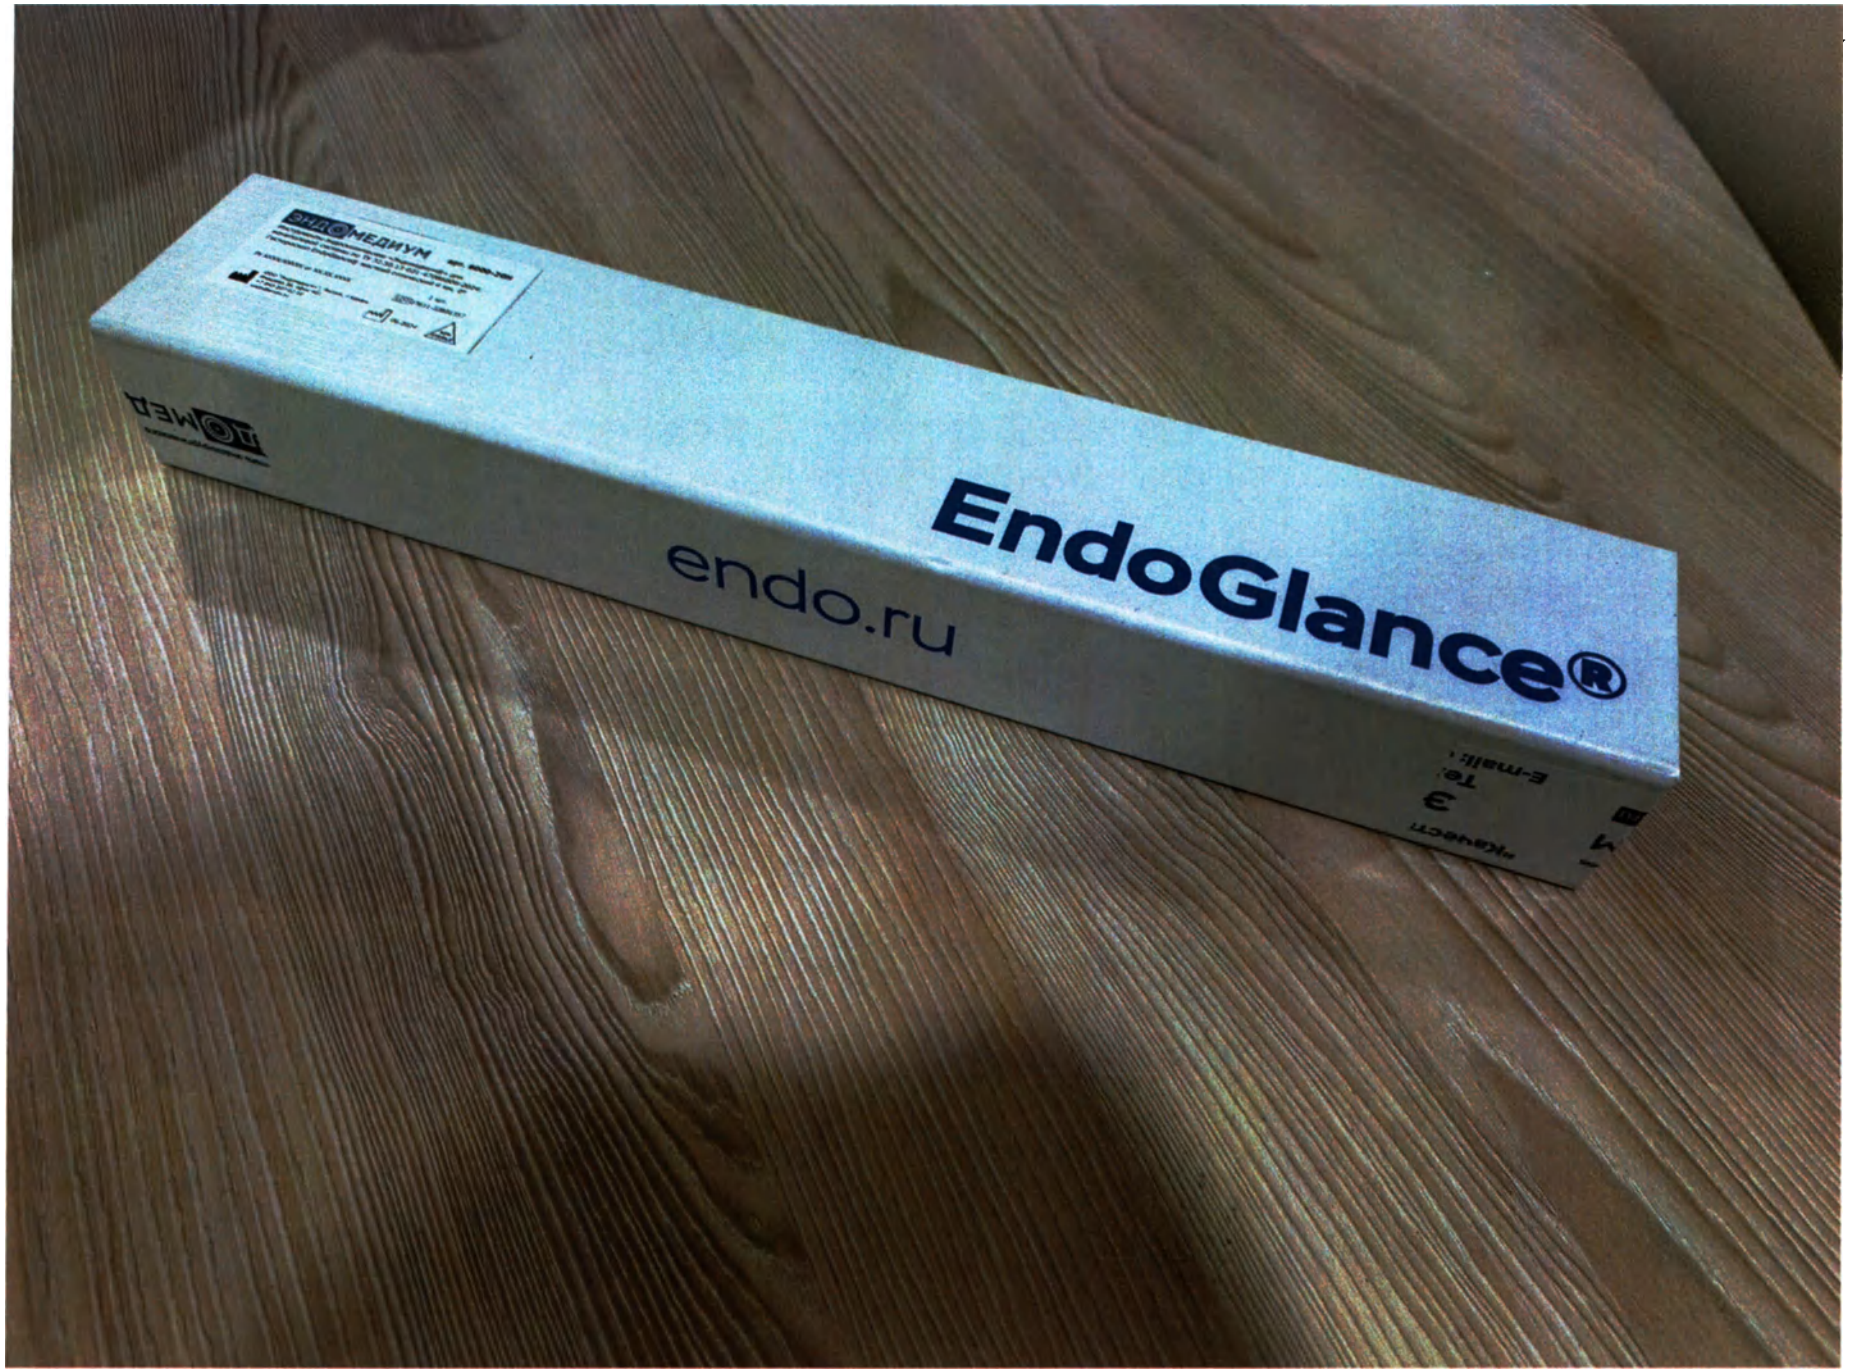


Фото 31. Потребительская упаковка.вариантов исполнения: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 1.9 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 45°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 4 мм, 70°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 0°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 12°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 30°; Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический 2.7 мм, 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

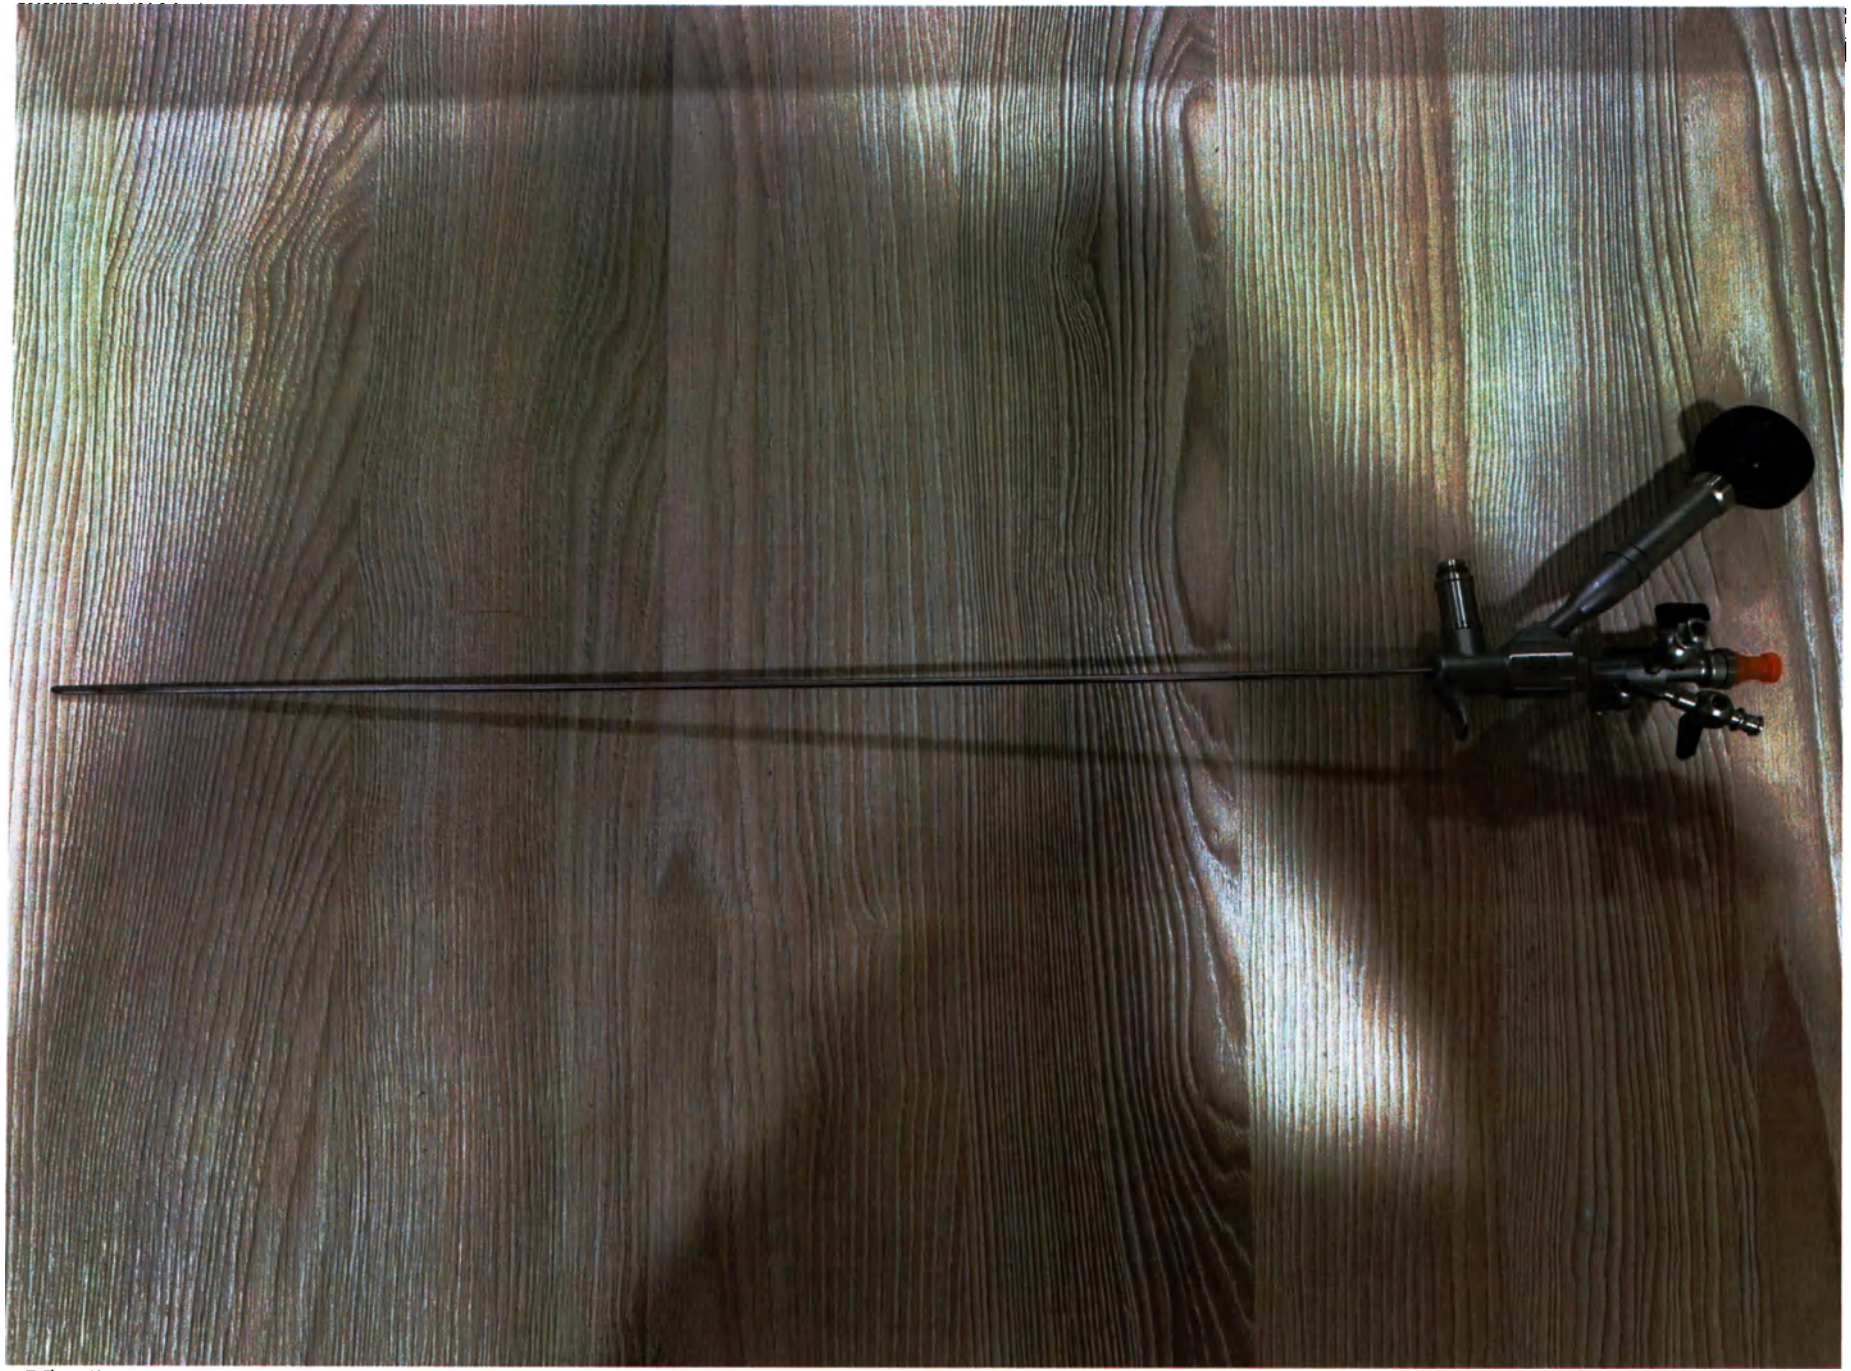


Фото 32. Общий вид вариантов исполнения: Уретерореноскоп жесткий оптический 8-9.8 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 6-7.5 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 4.8-5.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

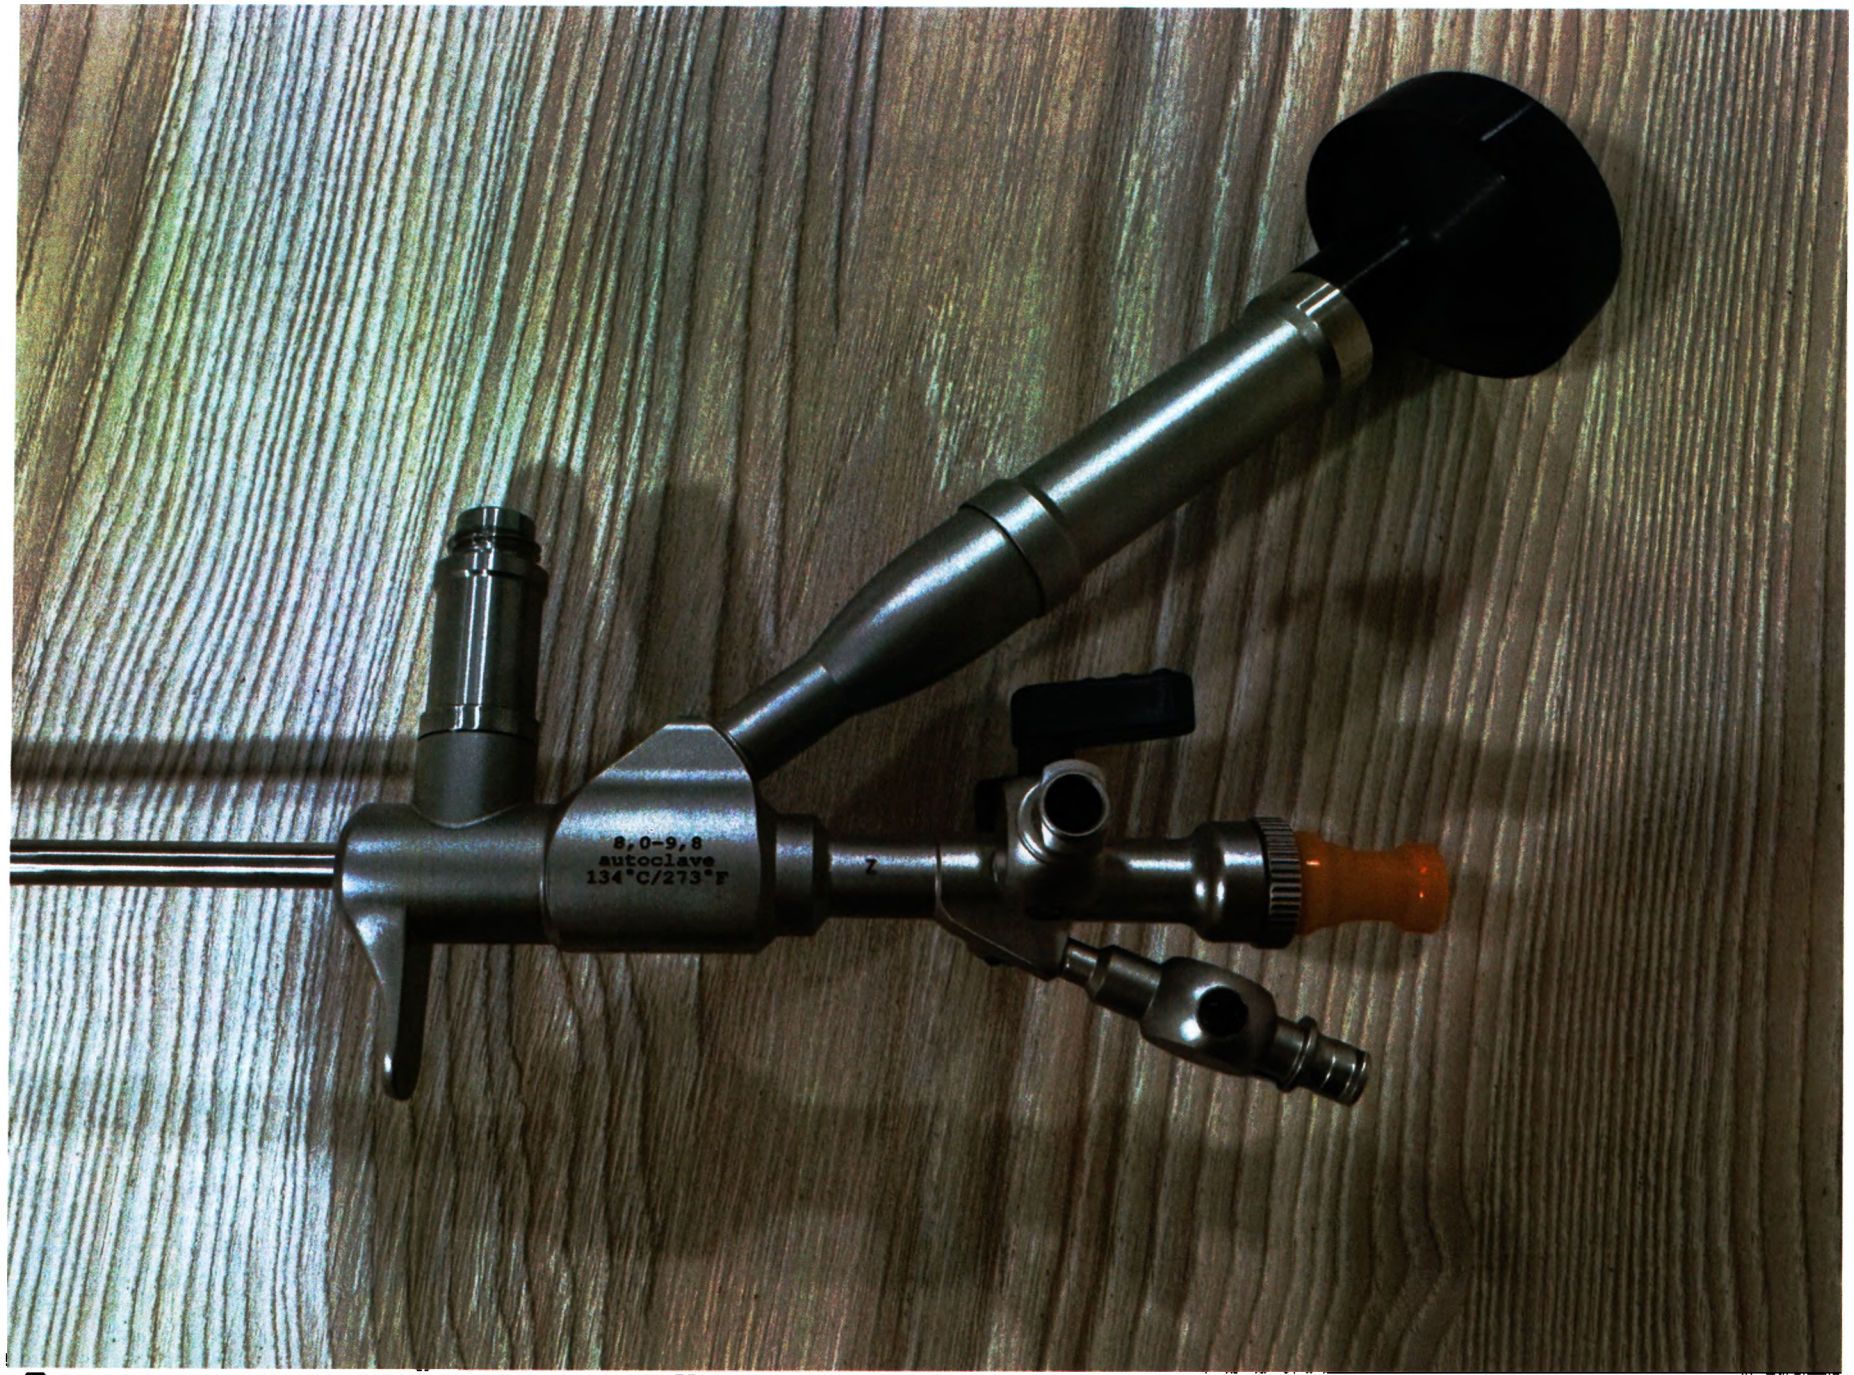


Фото 33. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Уретерореноскоп жесткий оптический 8-9.8 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 6-7.5 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 4.8-5.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

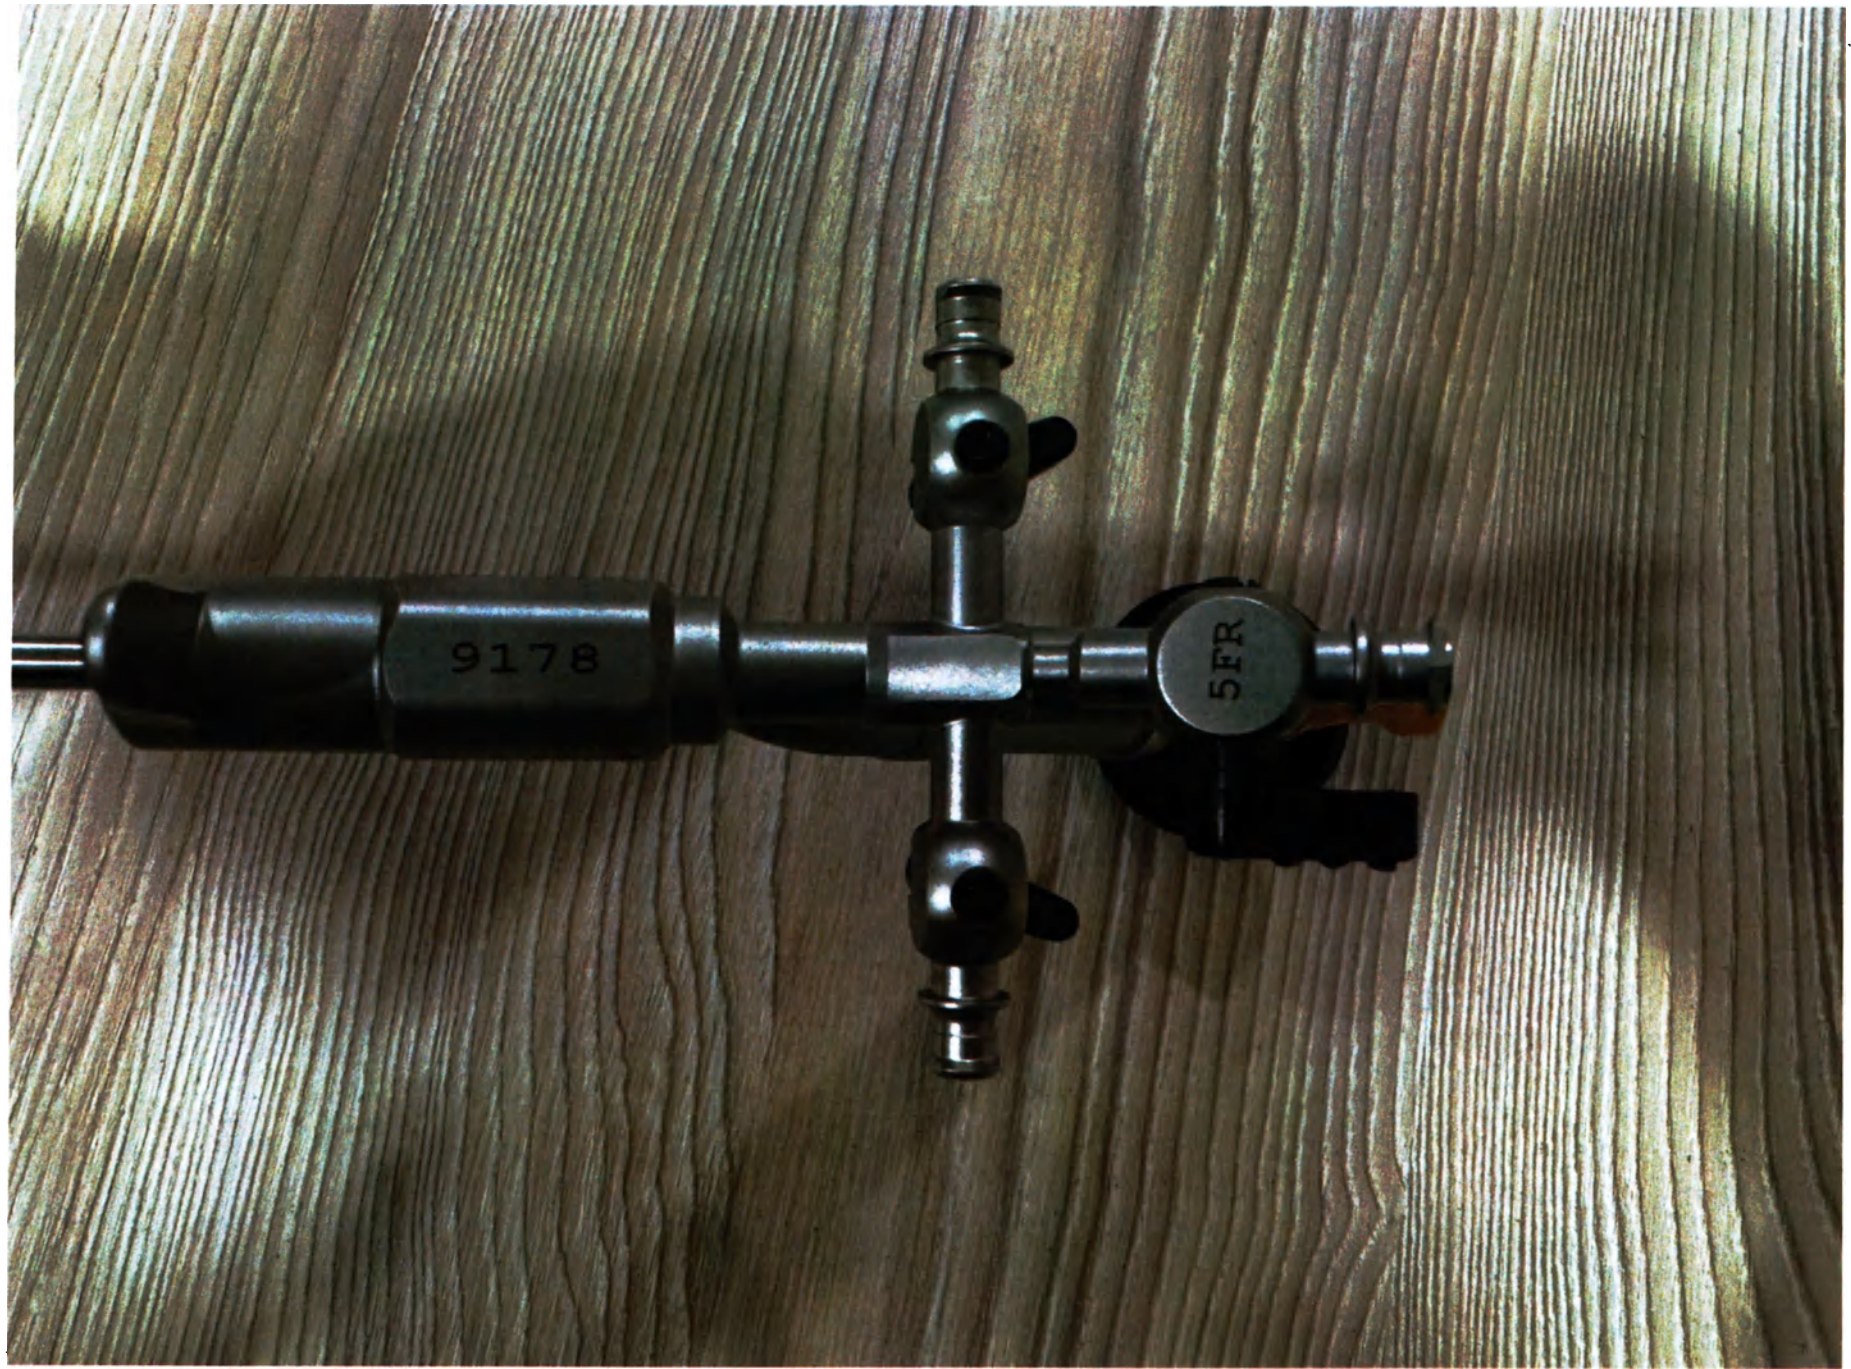


Фото 34. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Уретероренноскоп жесткий оптический 8-9.8 Шр; Уретероренноскоп жесткий оптический 6-7.5 Шр; Уретероренноскоп жесткий оптический 4.8-5.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

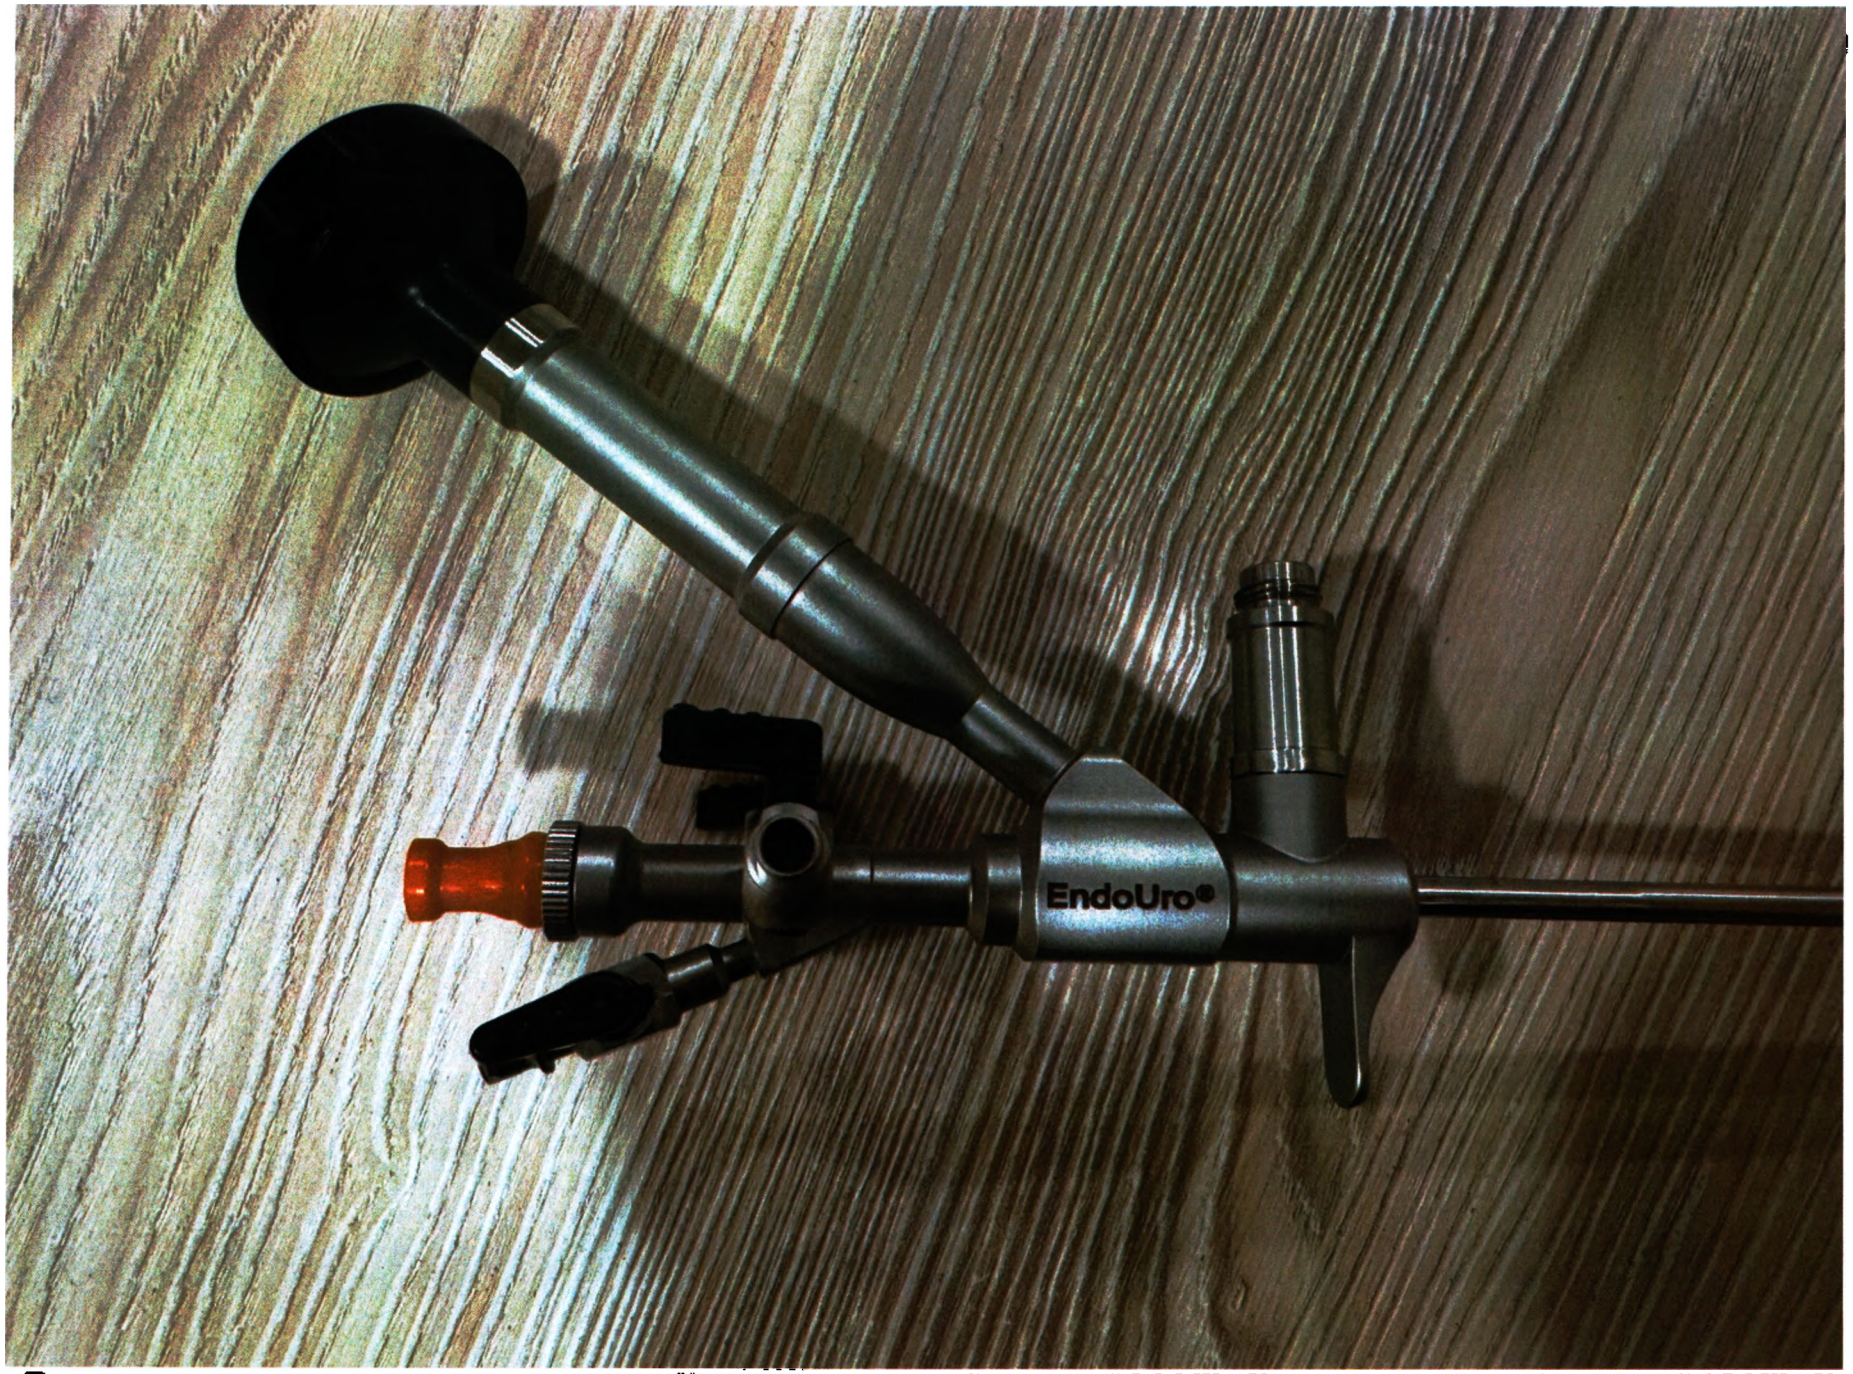


Фото 35. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Уретерореноскоп жесткий оптический 8-9.8 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 6-7.5 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 4.8-5.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

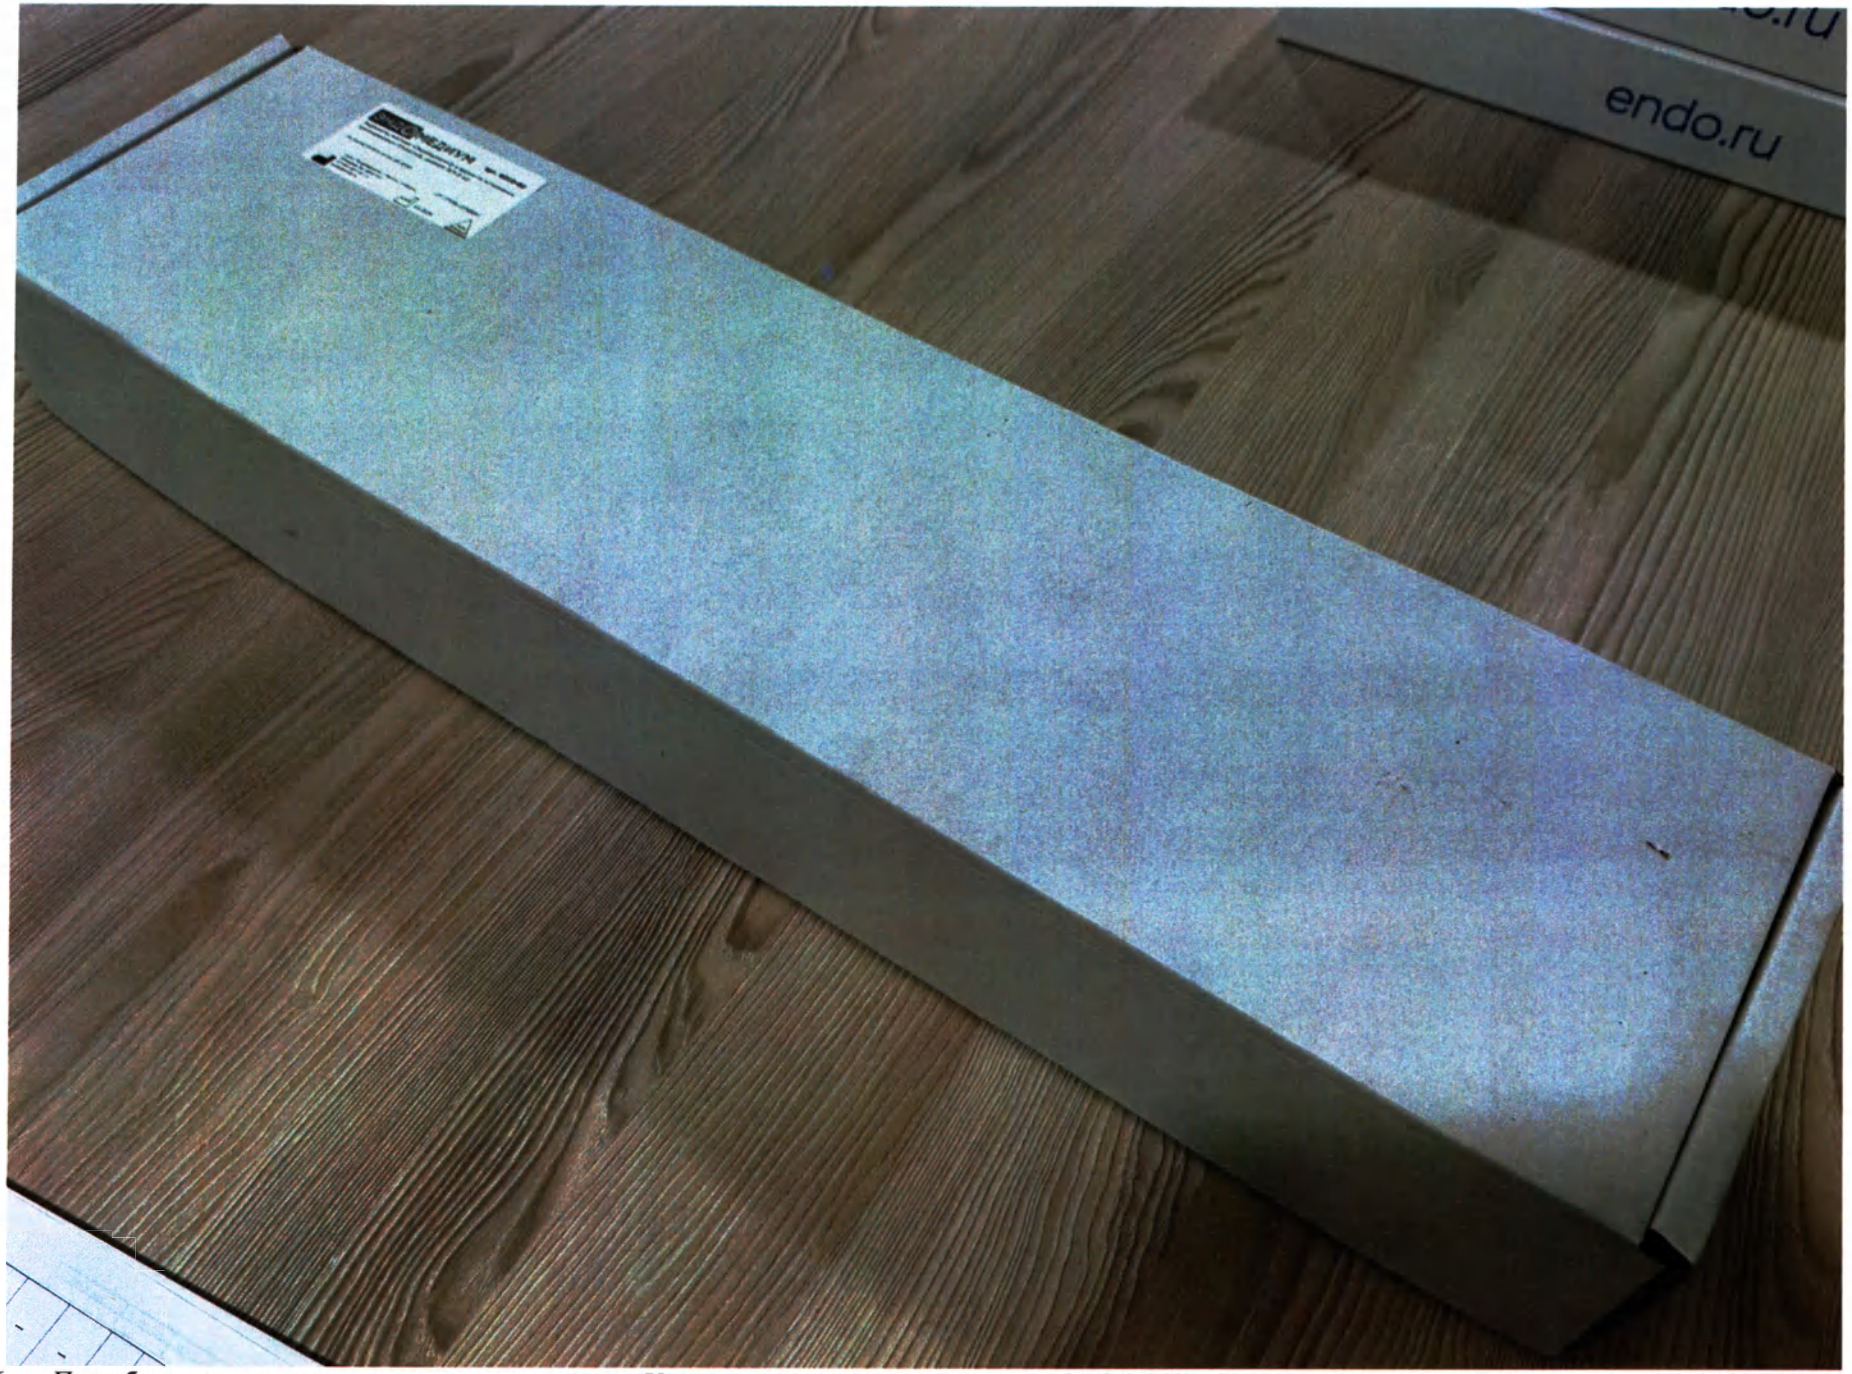


Фото 36. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Уретерореноскоп жесткий оптический 8-9.8 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 6-7.5 Шр; Уретерореноскоп жесткий оптический 4.8-5.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 37. Общий вид вариантов исполнения: Тубус без инструментального канала 9 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 38. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус без инструментального канала 9 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 15

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

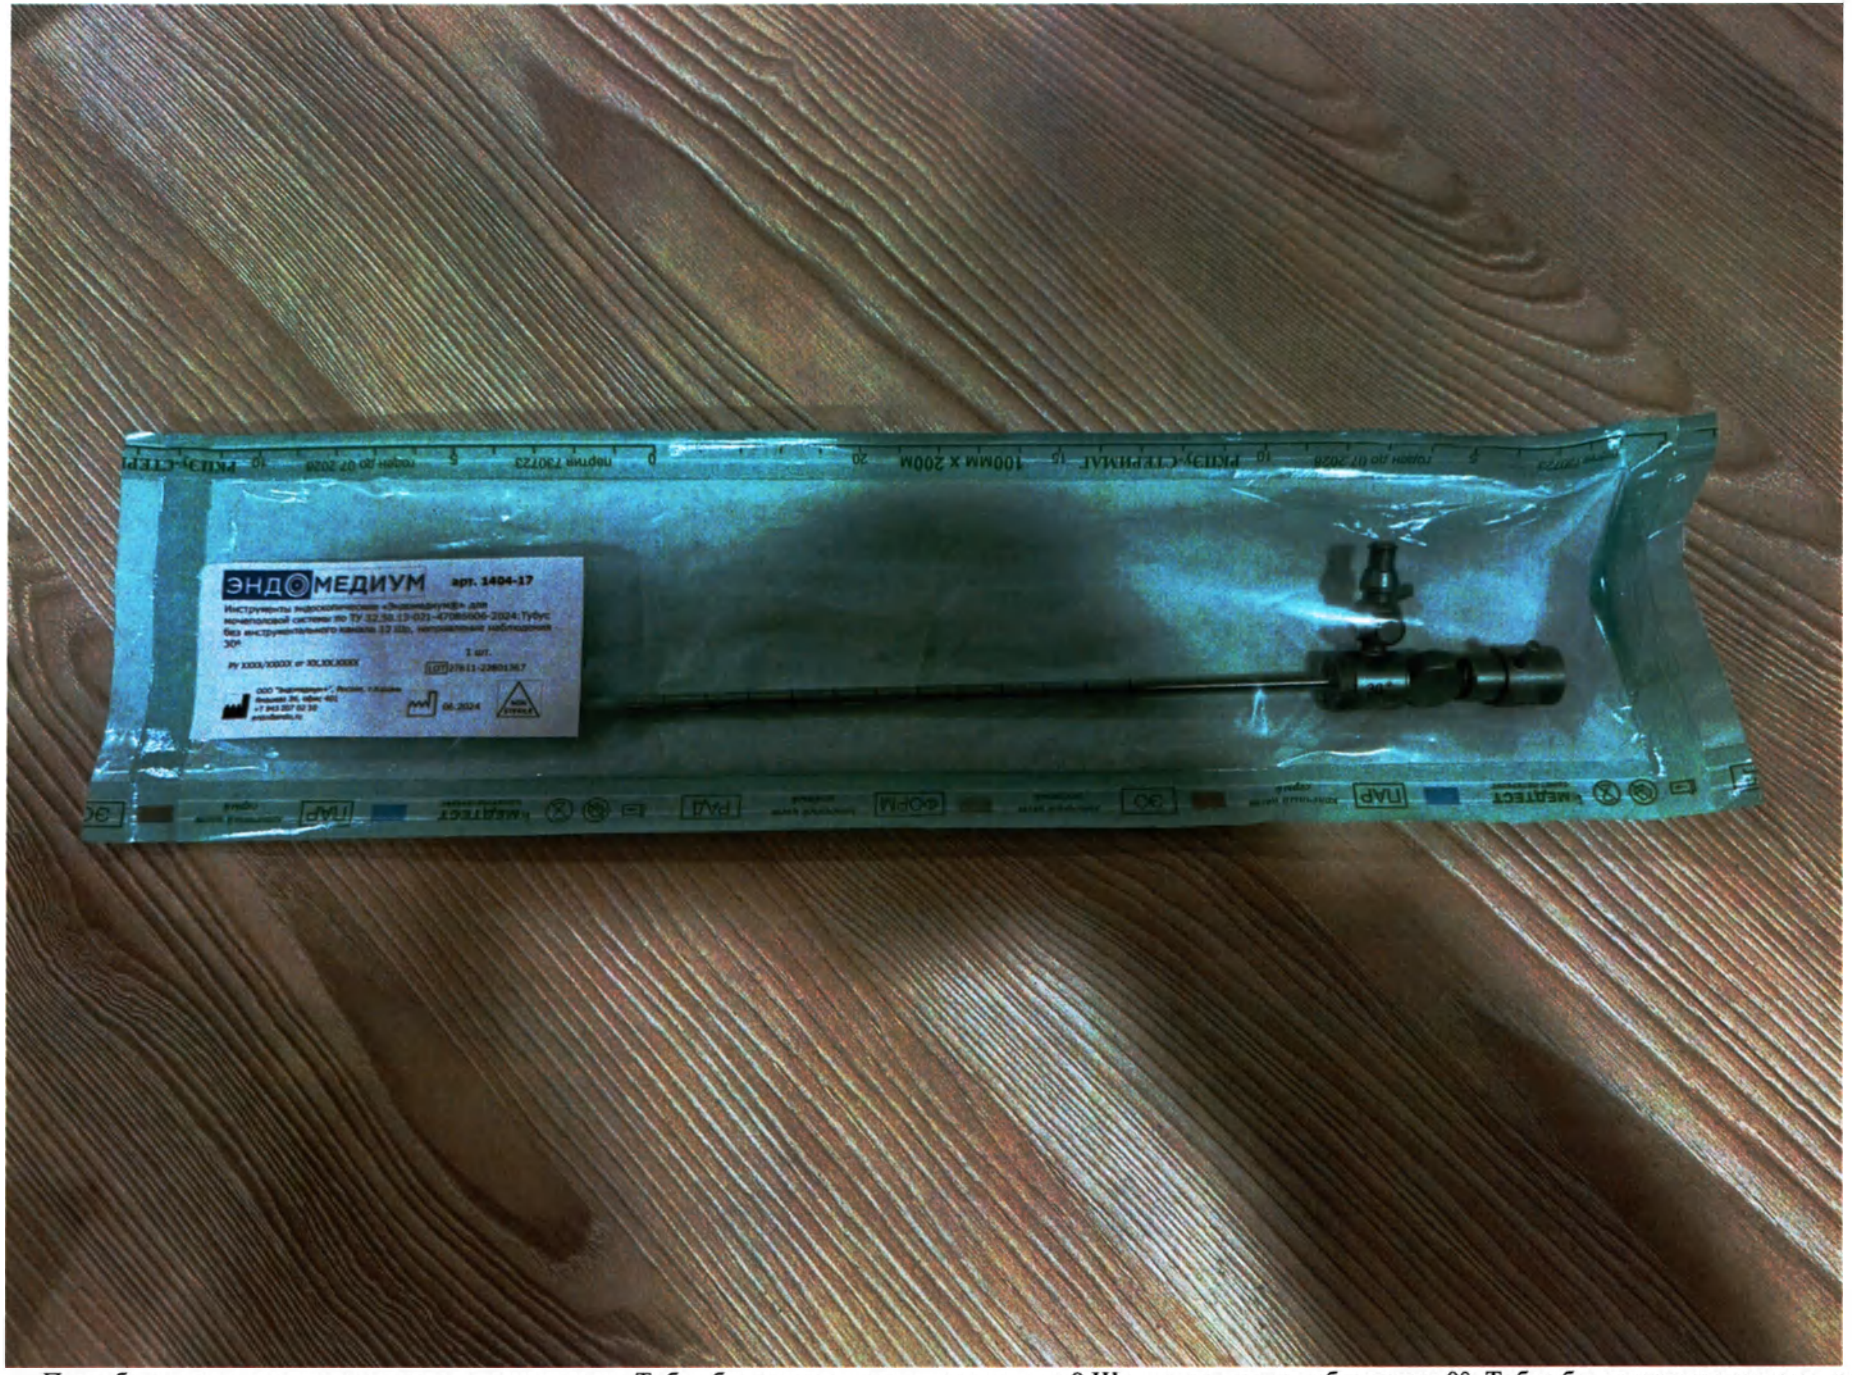


Фото 39. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Тубус без инструментального канала 9 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 12 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 15 Шр, направление наблюдения 70°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 0°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 12°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 30°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 45°; Тубус без инструментального канала 18 Шр, направление наблюдения 70°

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 40. Общий вид вариантов исполнения: Тубус 16 Fr с инструментальным каналом 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 41. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус 16 Fr с инструментальным каналом 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

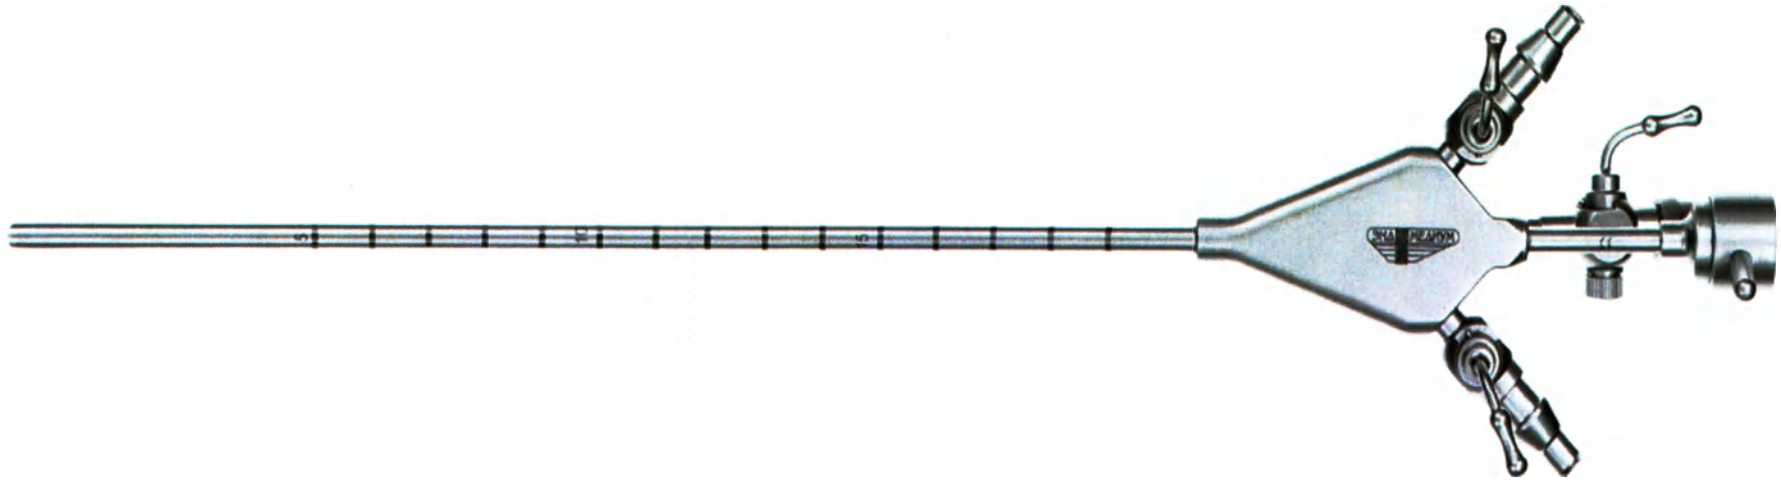


Фото 42. Общий вид вариантов исполнения: Тубус 16 Fr с инструментальным каналом 6 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 43. Общий вид вариантов исполнения: Тубус 22 Fr с инструментальным каналом 7 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

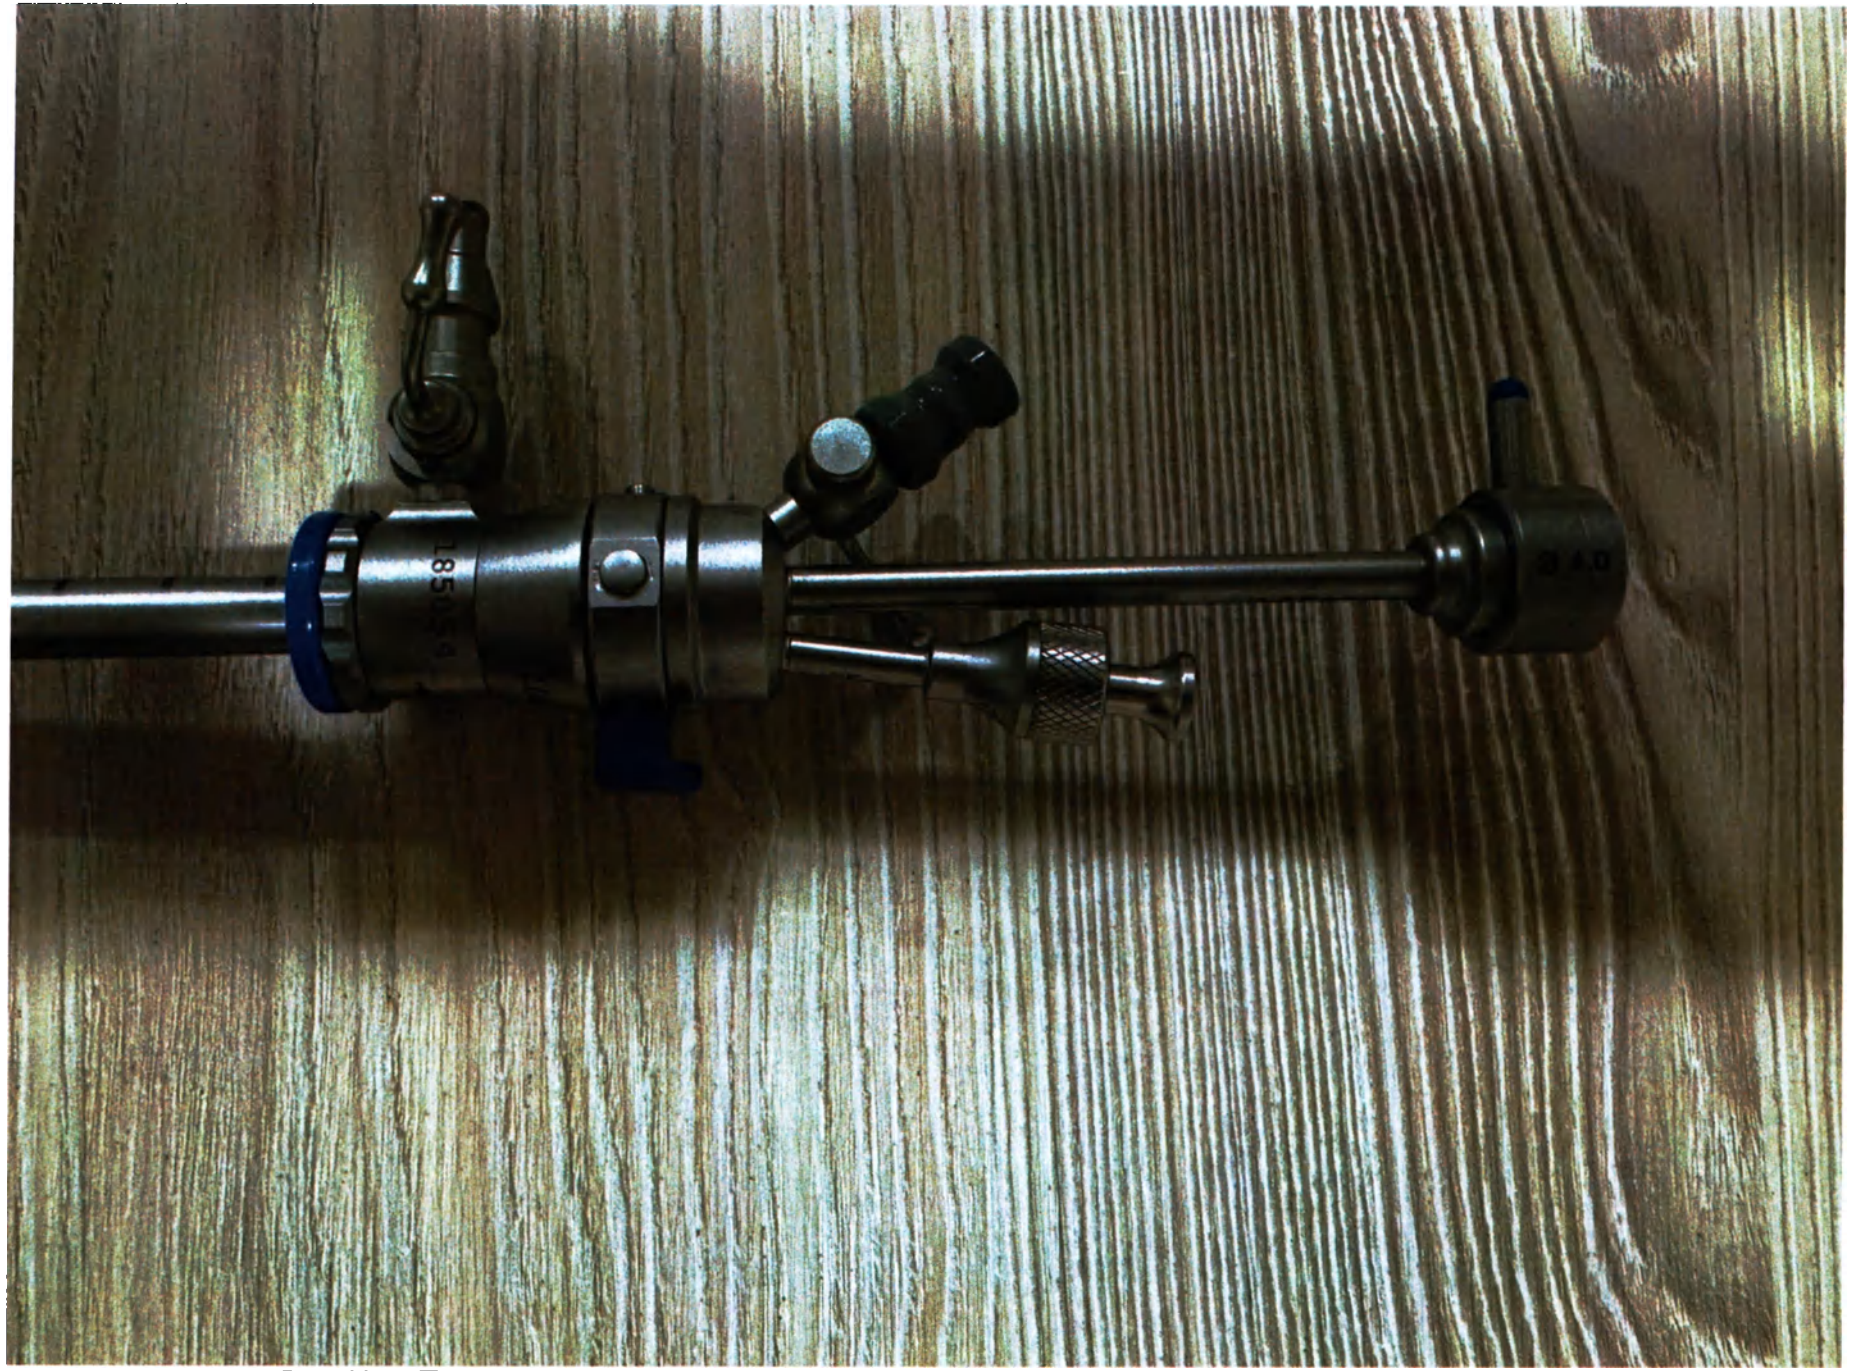


Фото 44. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус 22 Fr с инструментальным каналом 7 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 45. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Тубус 16 Fr с инструментальным каналом 5 Шр; Тубус 16 Fr с инструментальным каналом 6 Шр; Тубус 22 Fr с инструментальным каналом 7 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 47. Общий вид вариантов исполнения: Тубус универсальный 17 Шр; Тубус универсальный 19.8 Шр; Тубус универсальный 21 Шр; Тубус универсальный 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

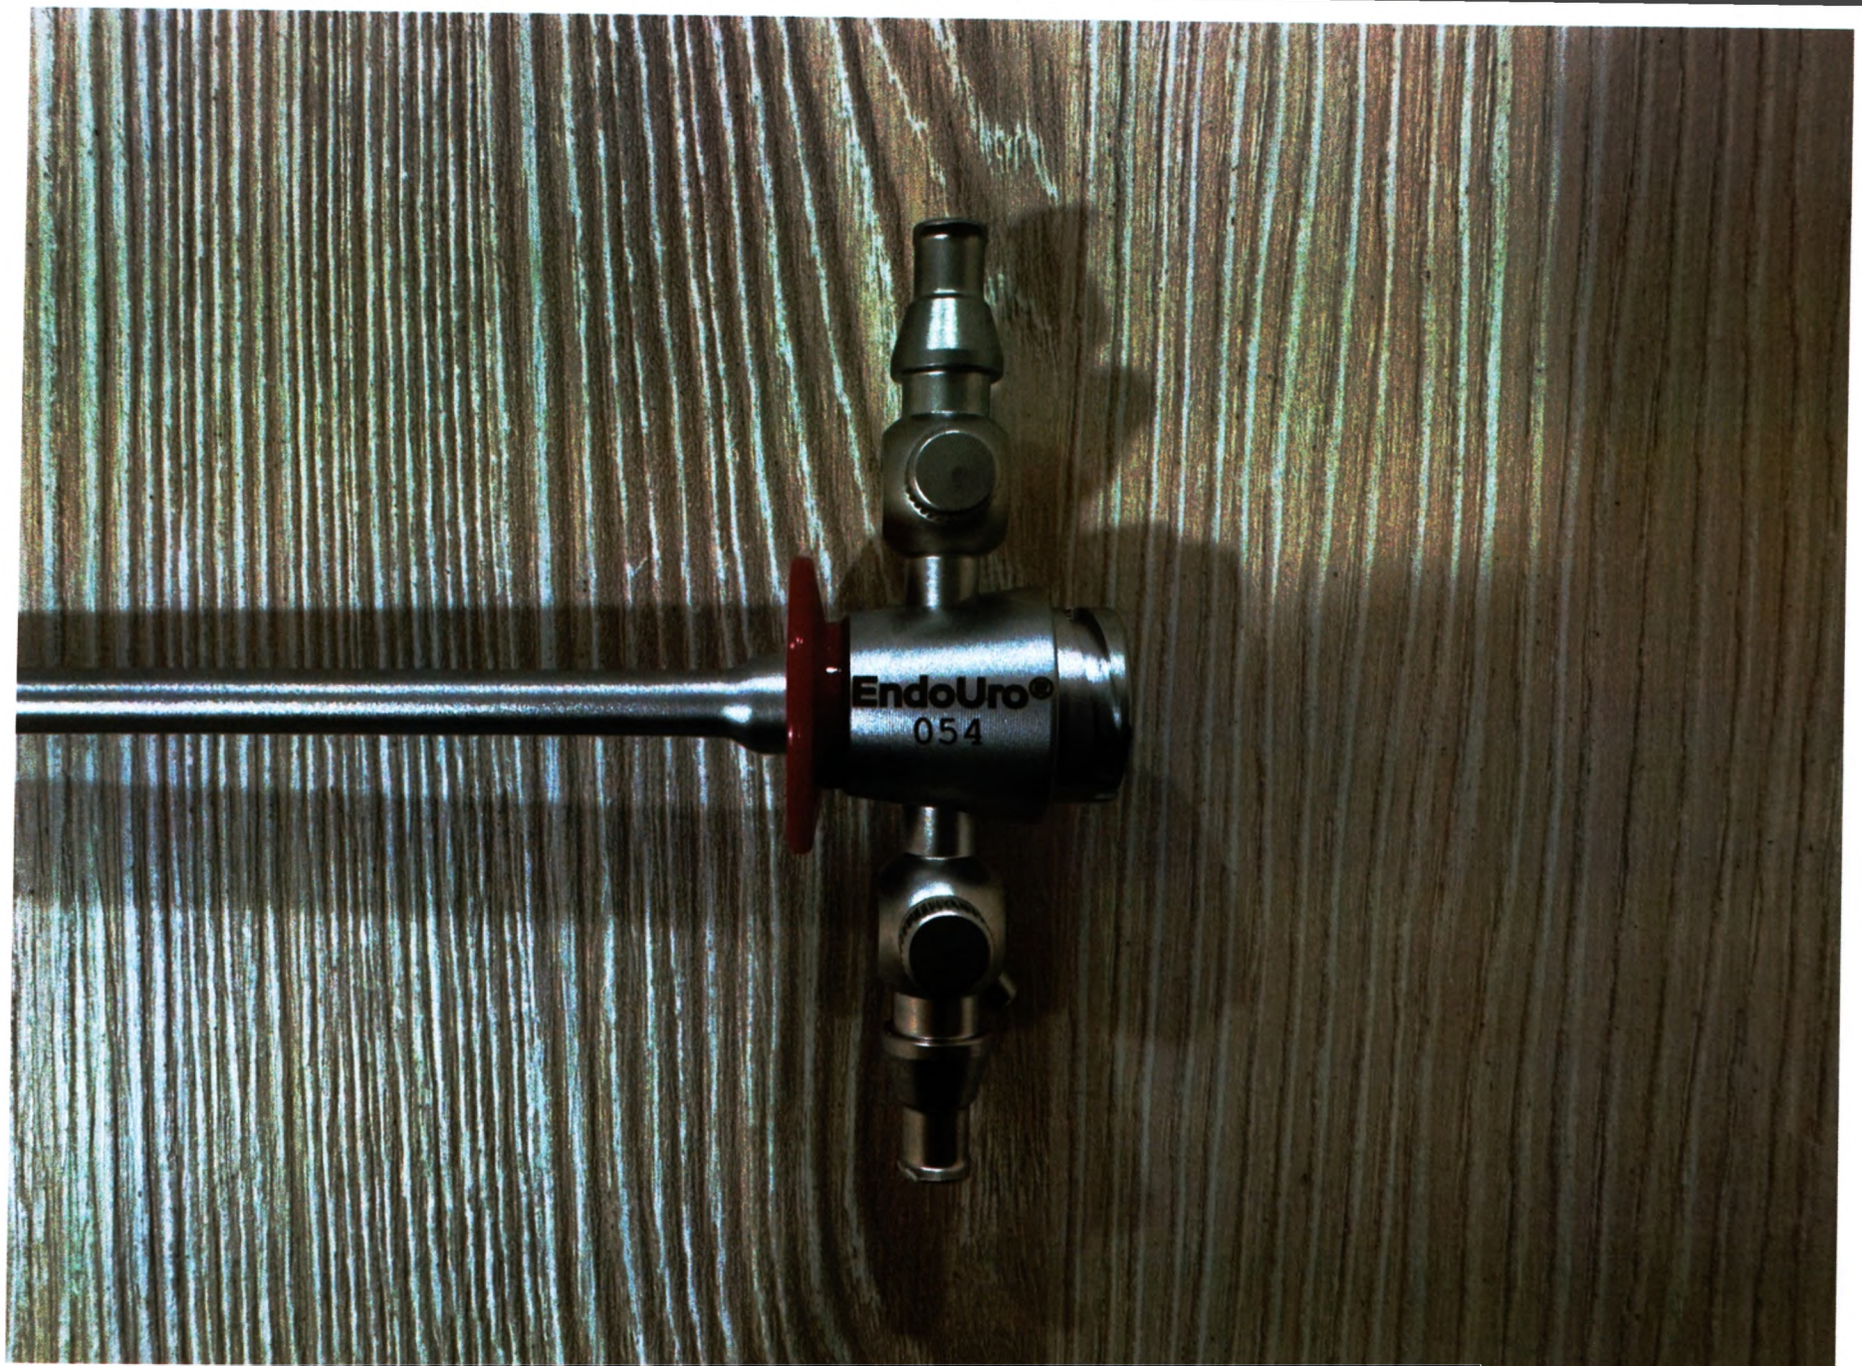


Фото 48. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус универсальный 17 Шр; Тубус универсальный 19.8 Шр; Тубус универсальный 21 Шр; Тубус универсальный 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

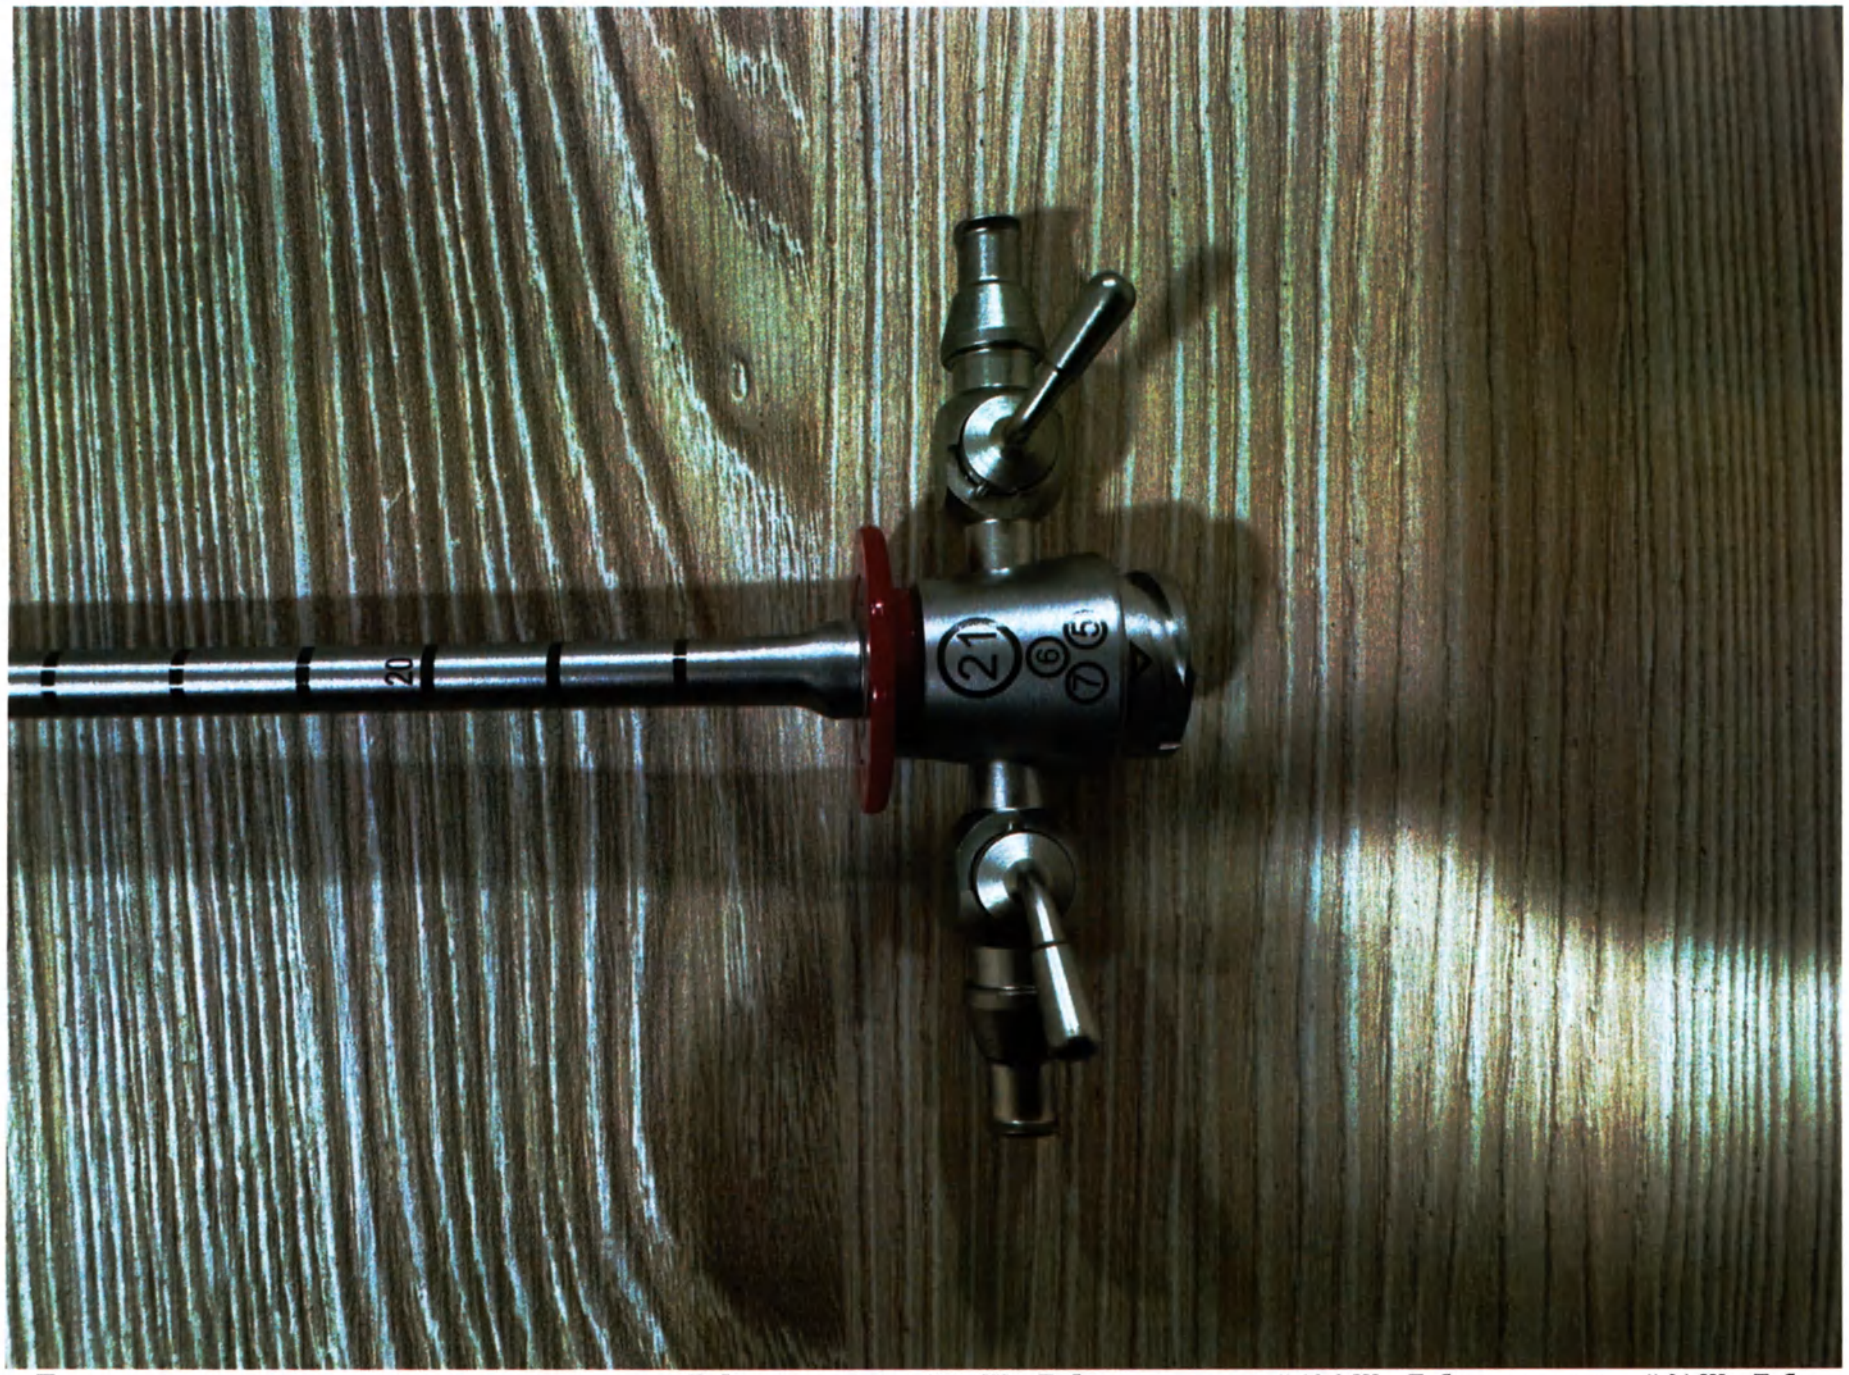


Фото 49. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус универсальный 17 Шр; Тубус универсальный 19.8 Шр; Тубус универсальный 21 Шр; Тубус универсальный 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

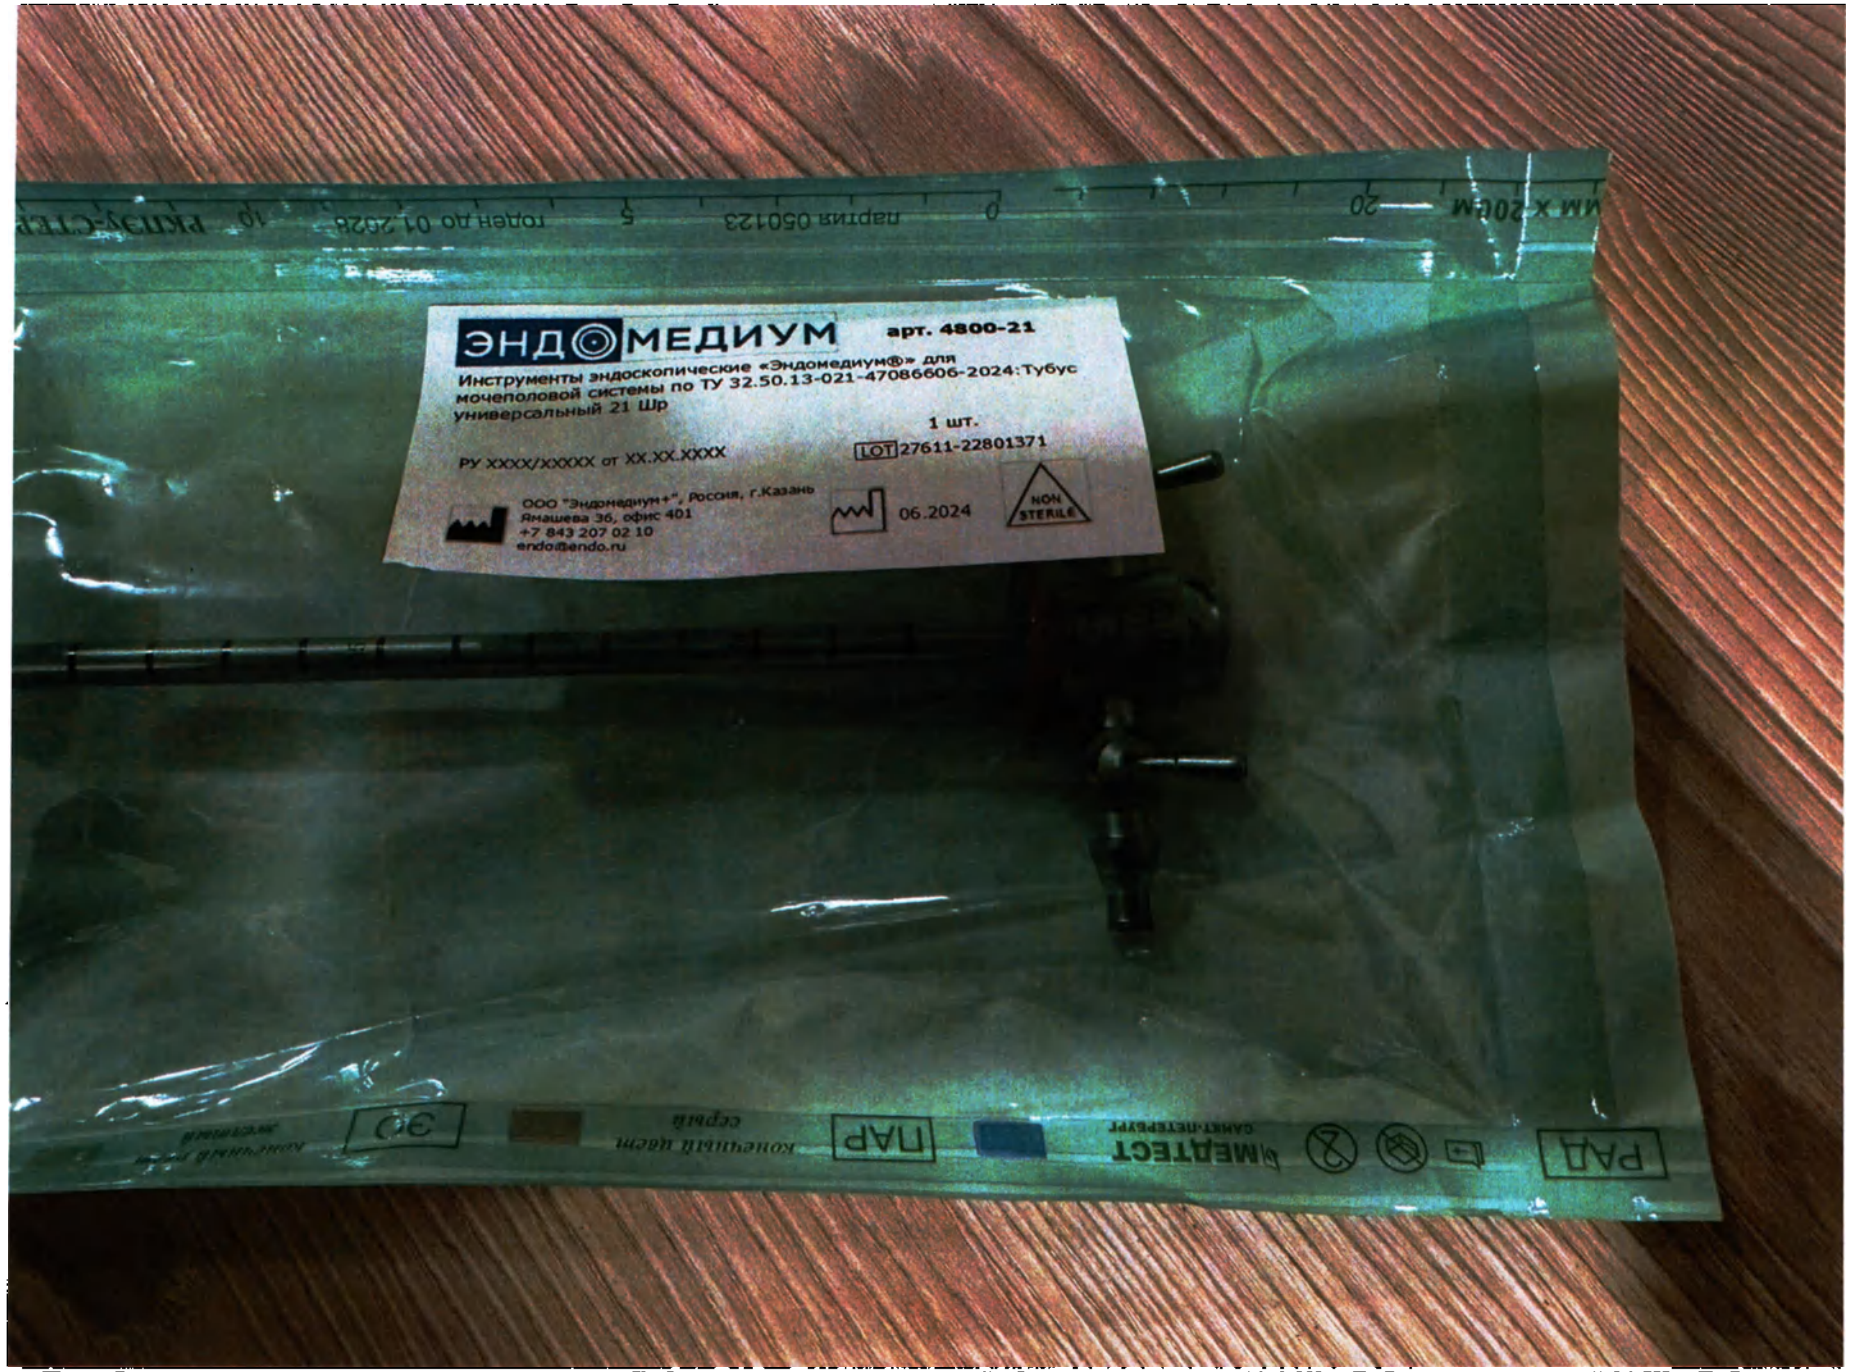


Фото 50. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Тубус универсальный 17 Шр; Тубус универсальный 19.8 Шр; Тубус универсальный 21 Шр; Тубус универсальный 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

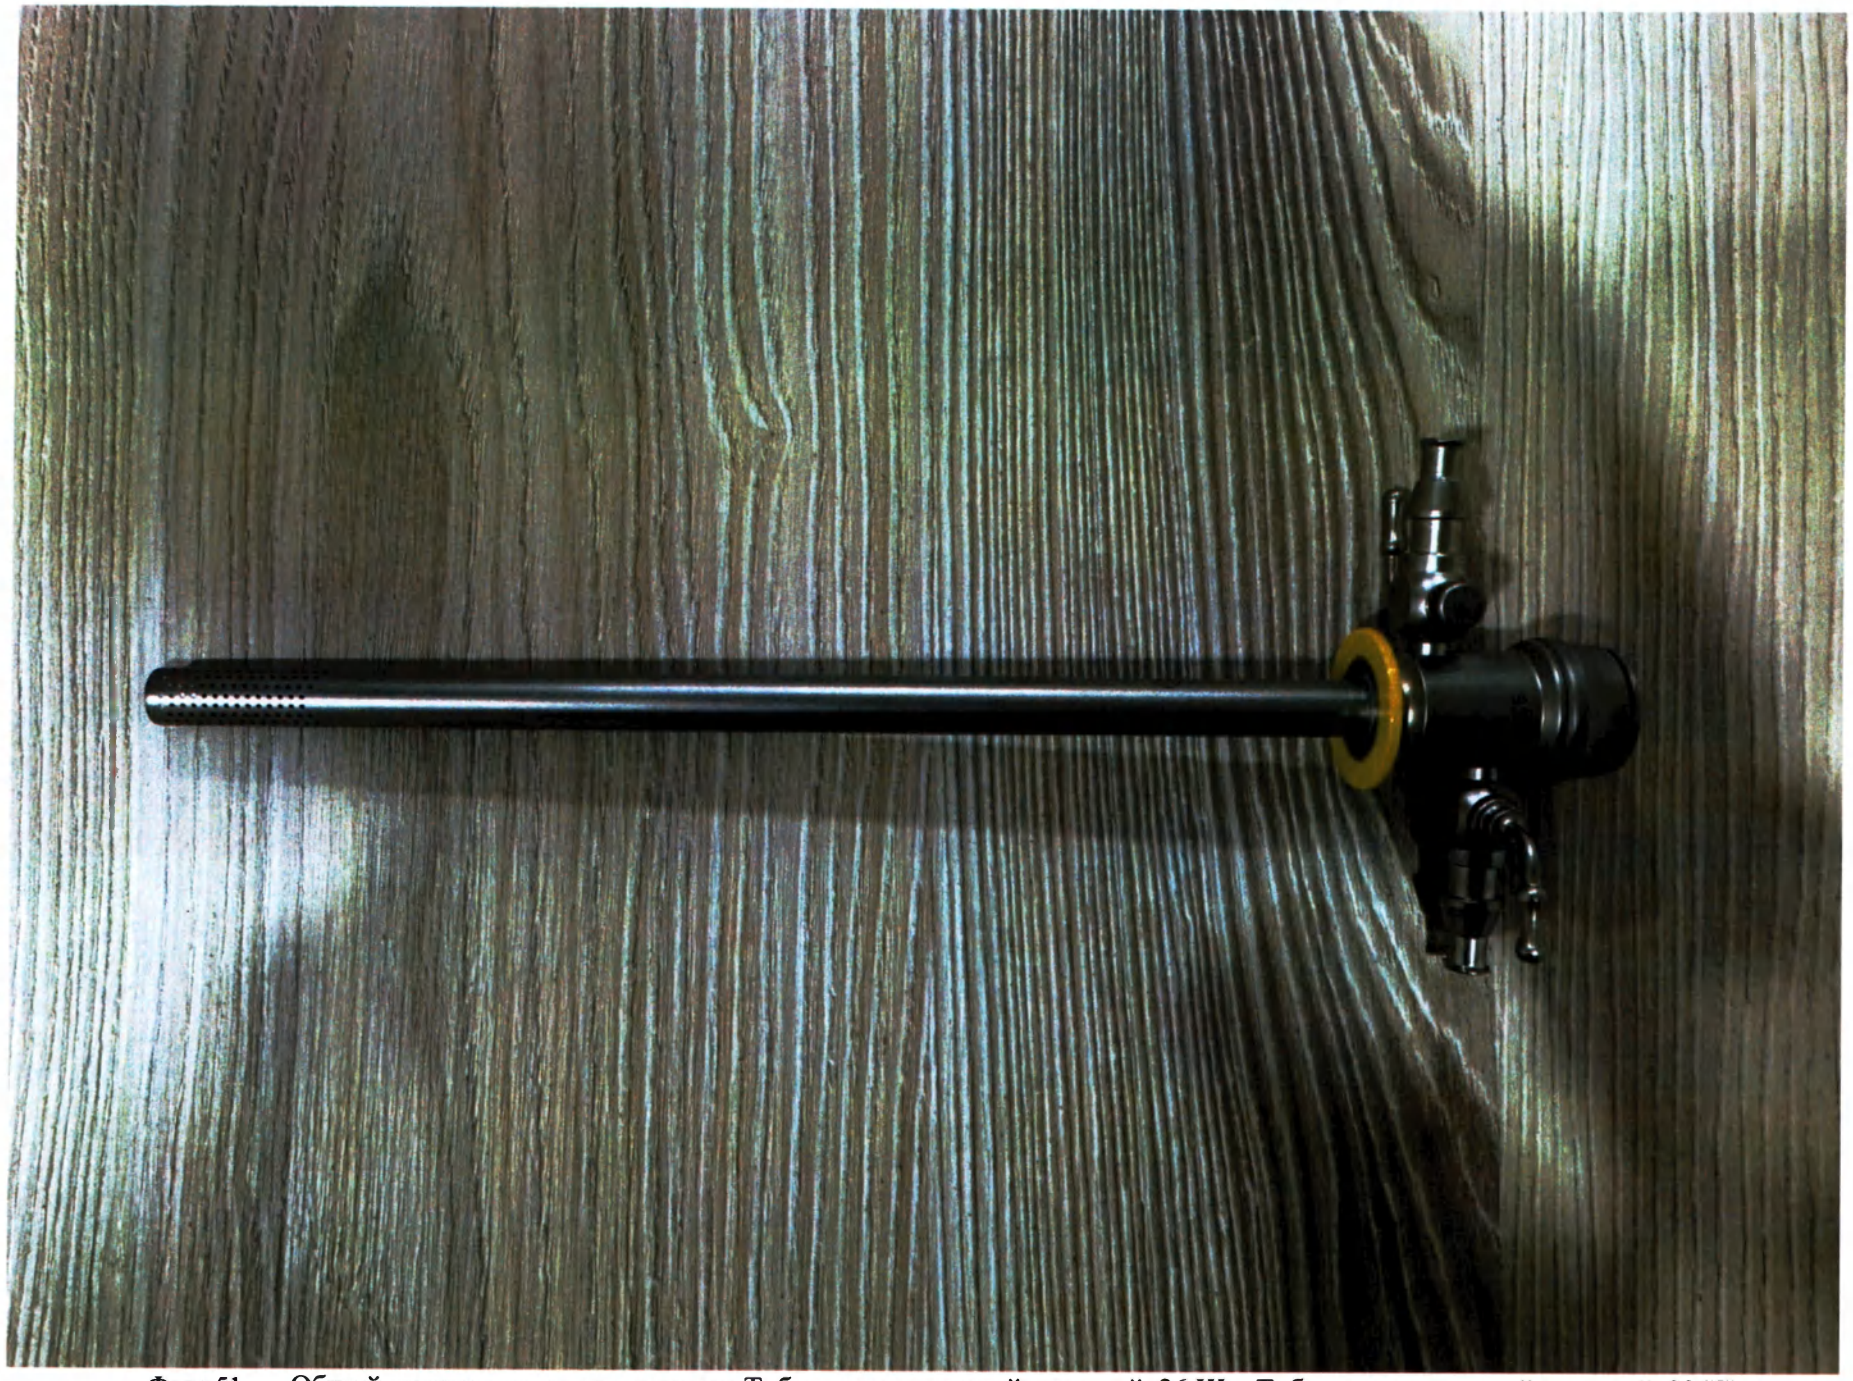


Фото 51. Общий вид вариантов исполнения: Тубус универсальный внешний, 26 Шр; Тубус универсальный внешний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

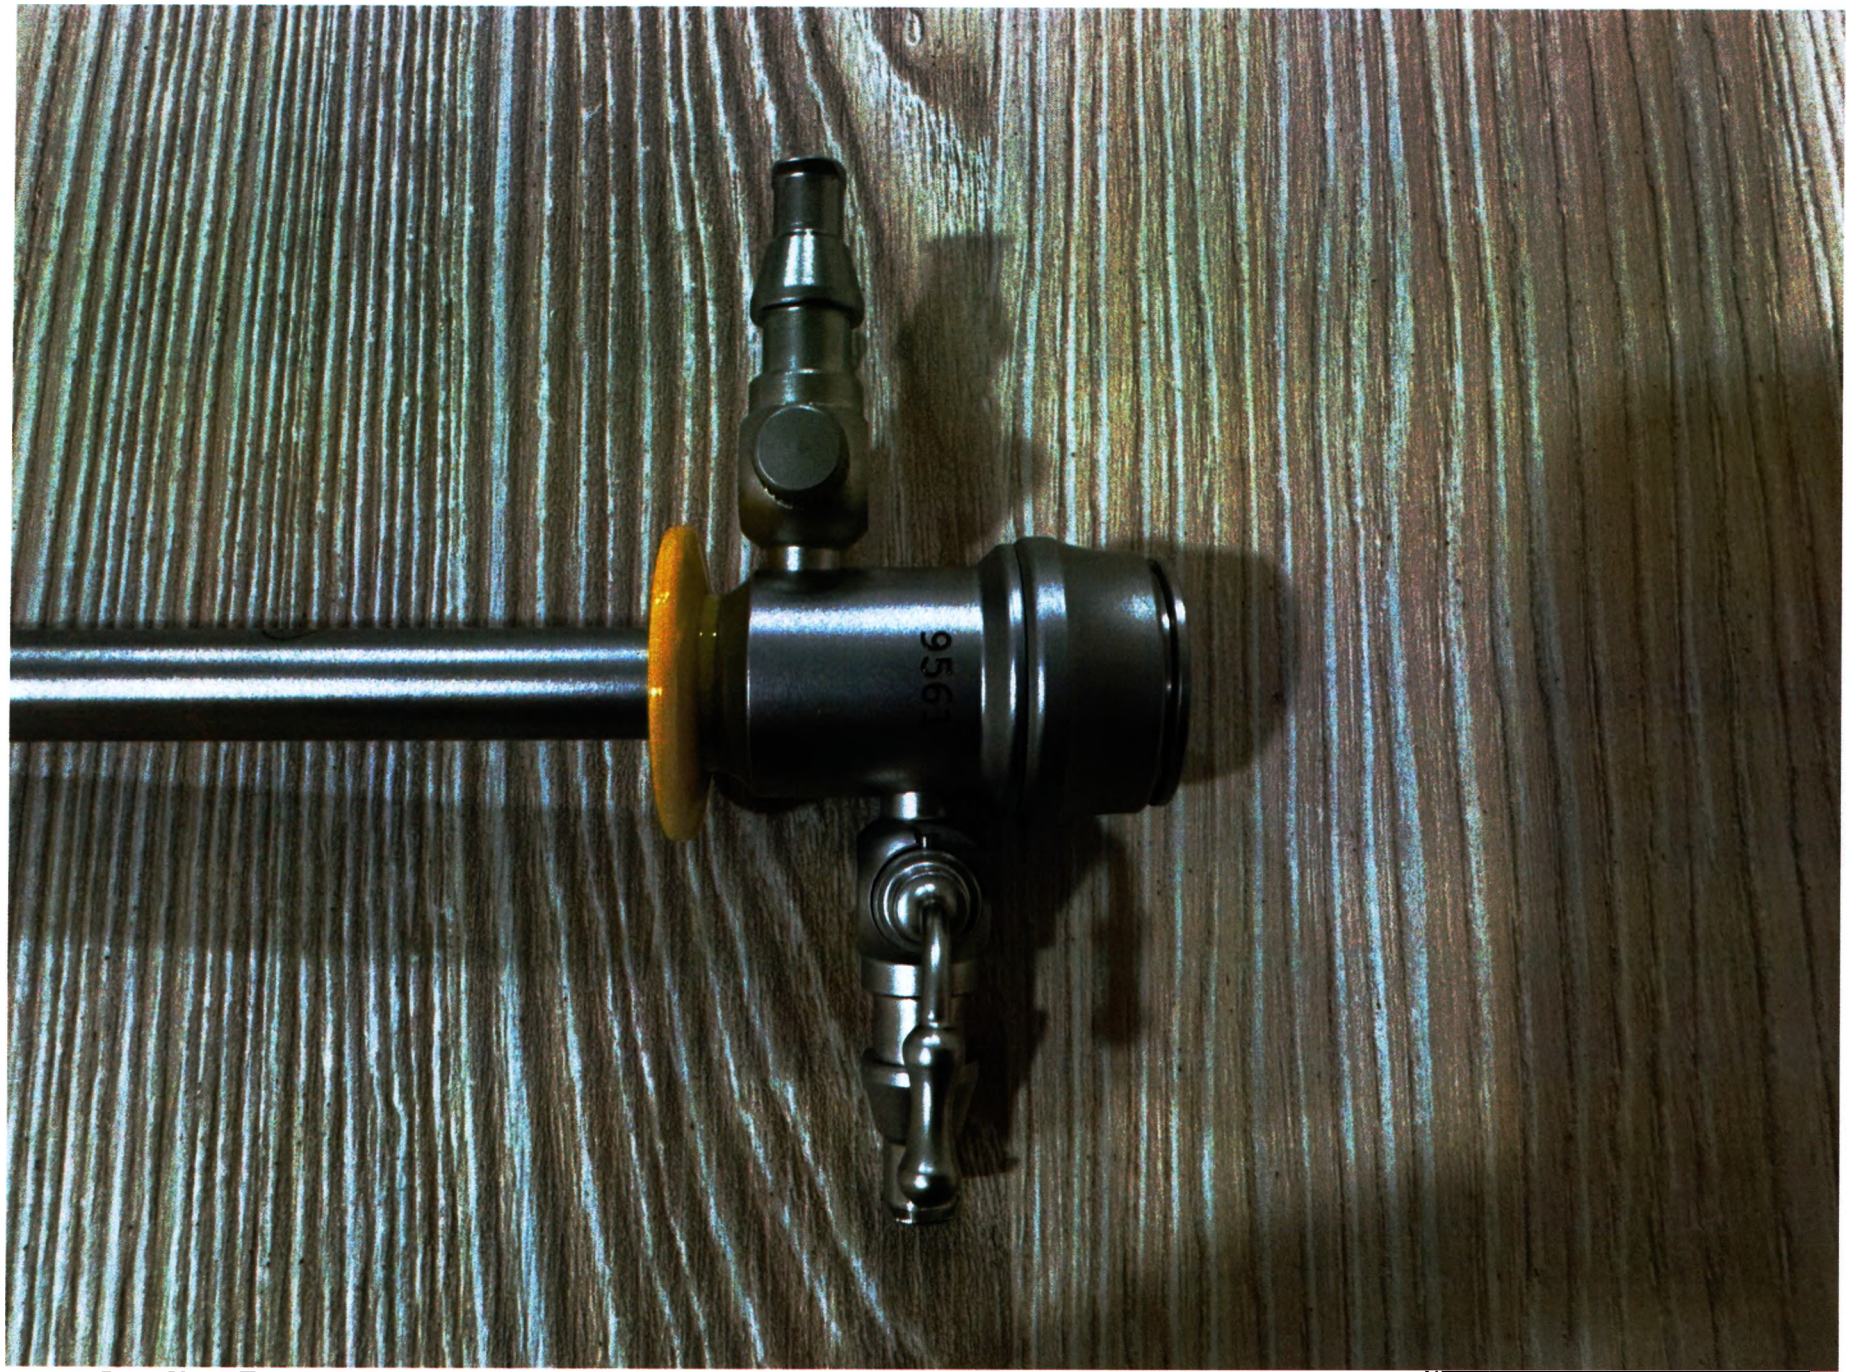


Фото 52. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус универсальный внешний, 26 Шр; Тубус универсальный внешний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

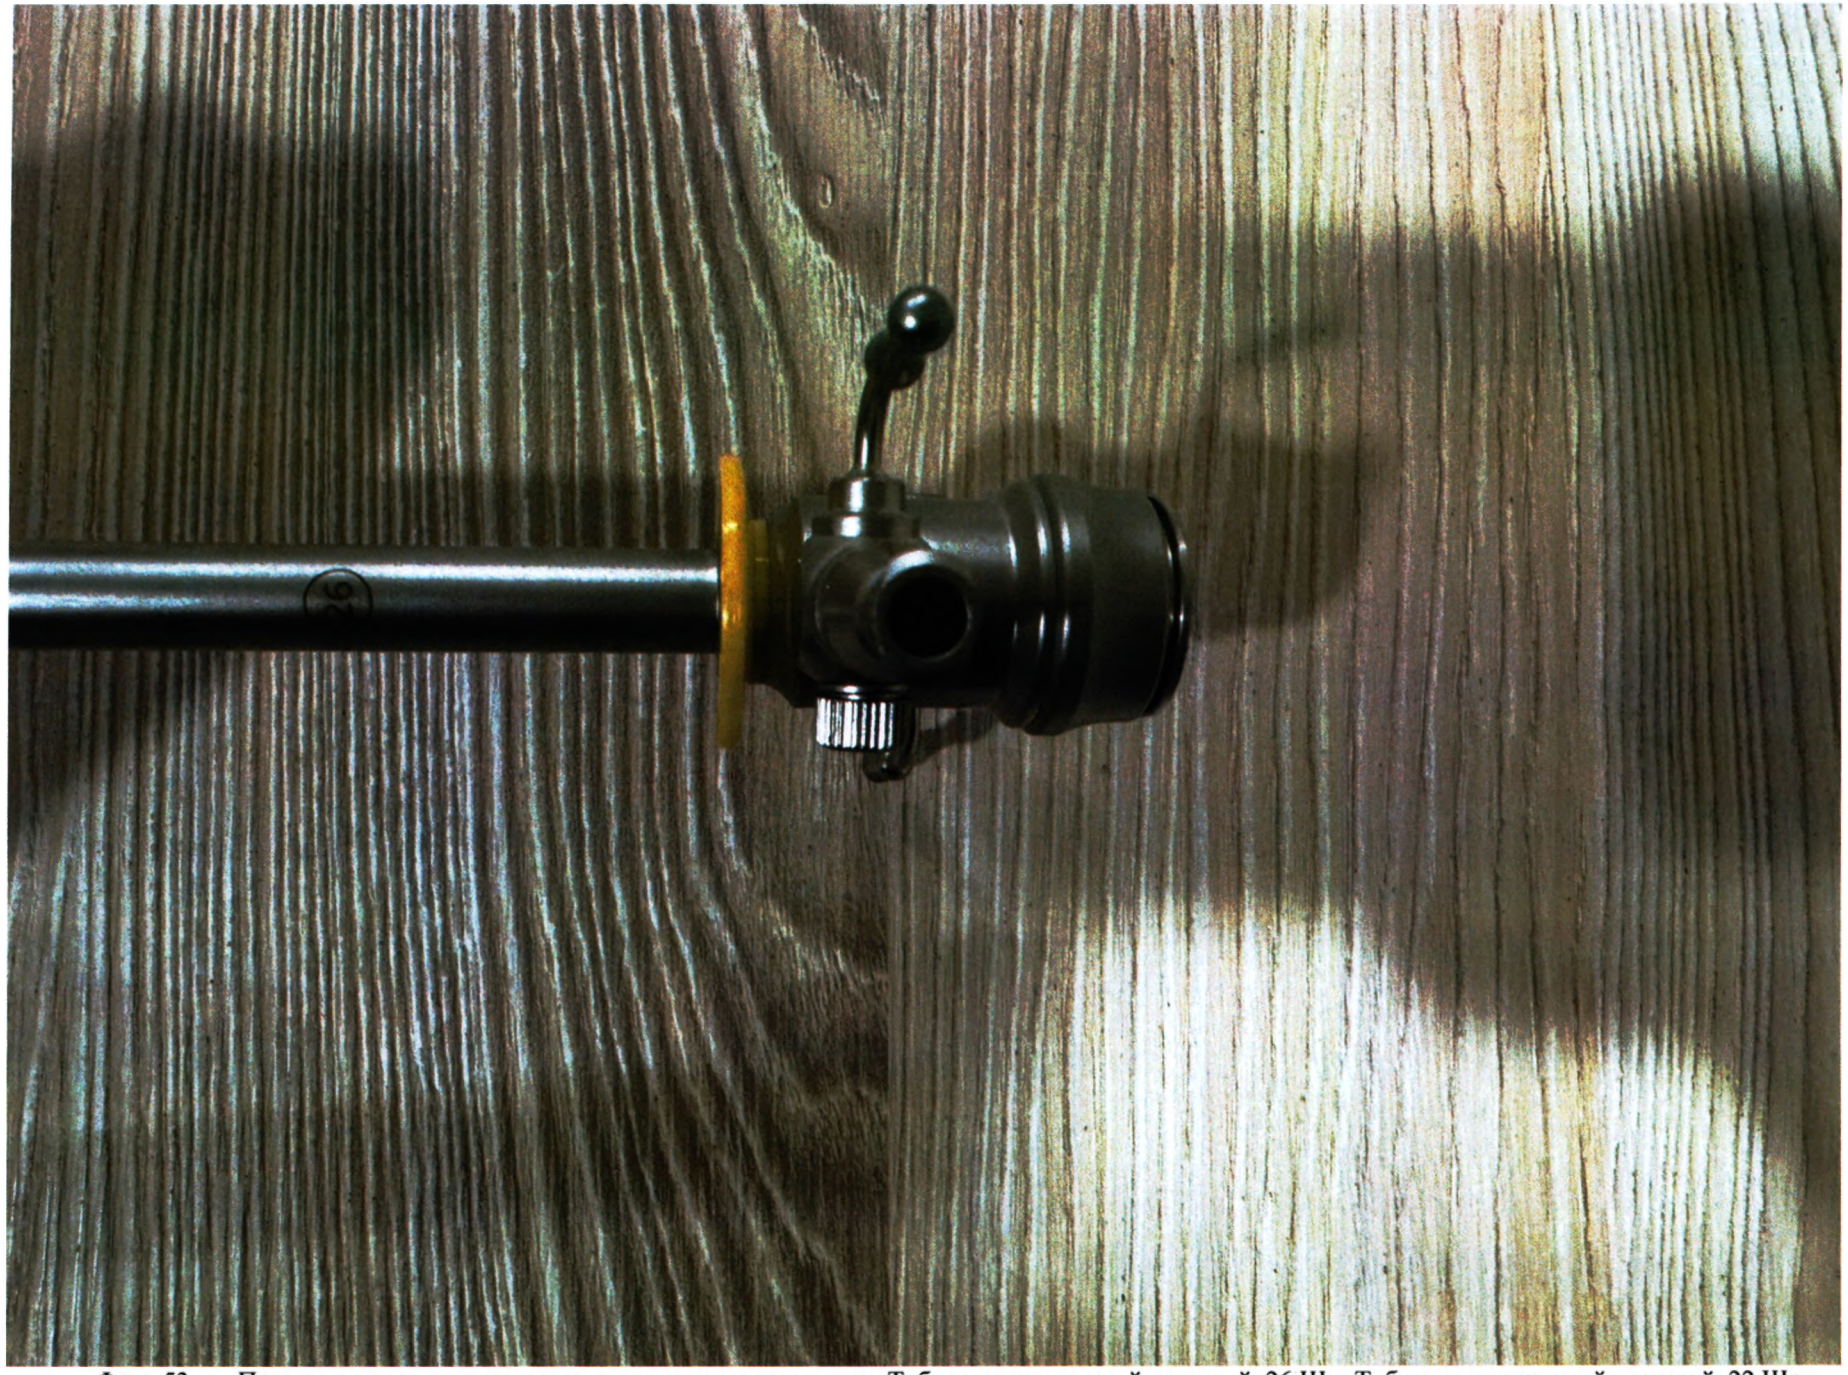


Фото 53. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус универсальный внешний, 26 Шр; Тубус универсальный внешний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 54. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Тубус универсальный внешний, 26 Шр; Тубус универсальный внешний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 55. Общий вид вариантов исполнения: Тубус универсальный внутренний, 26 Шр; Тубус универсальный внутренний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

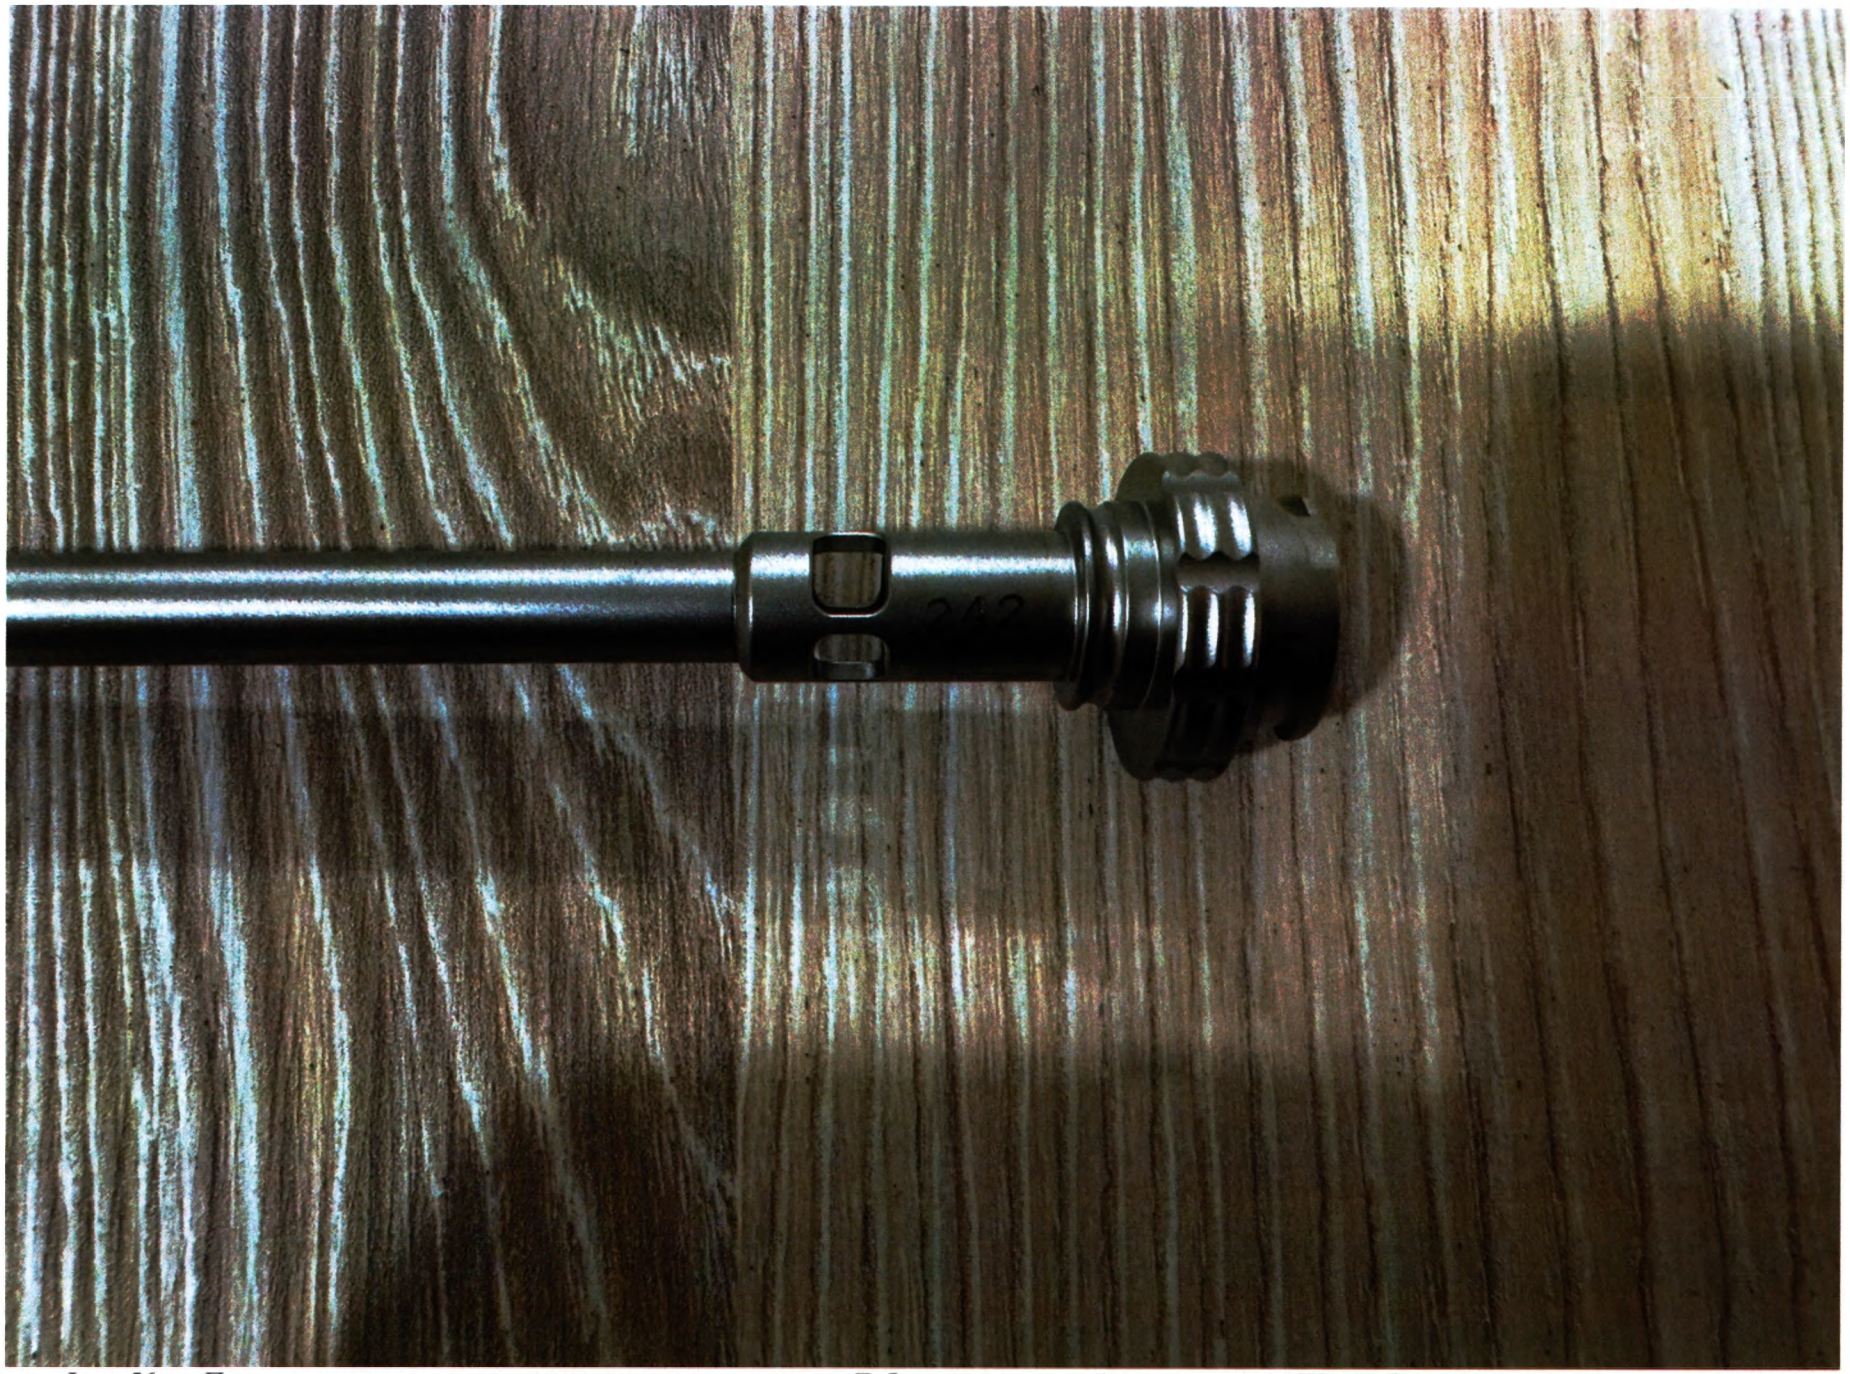


Фото 56. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Тубус универсальный внутренний, 26 Шр; Тубус универсальный внутренний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

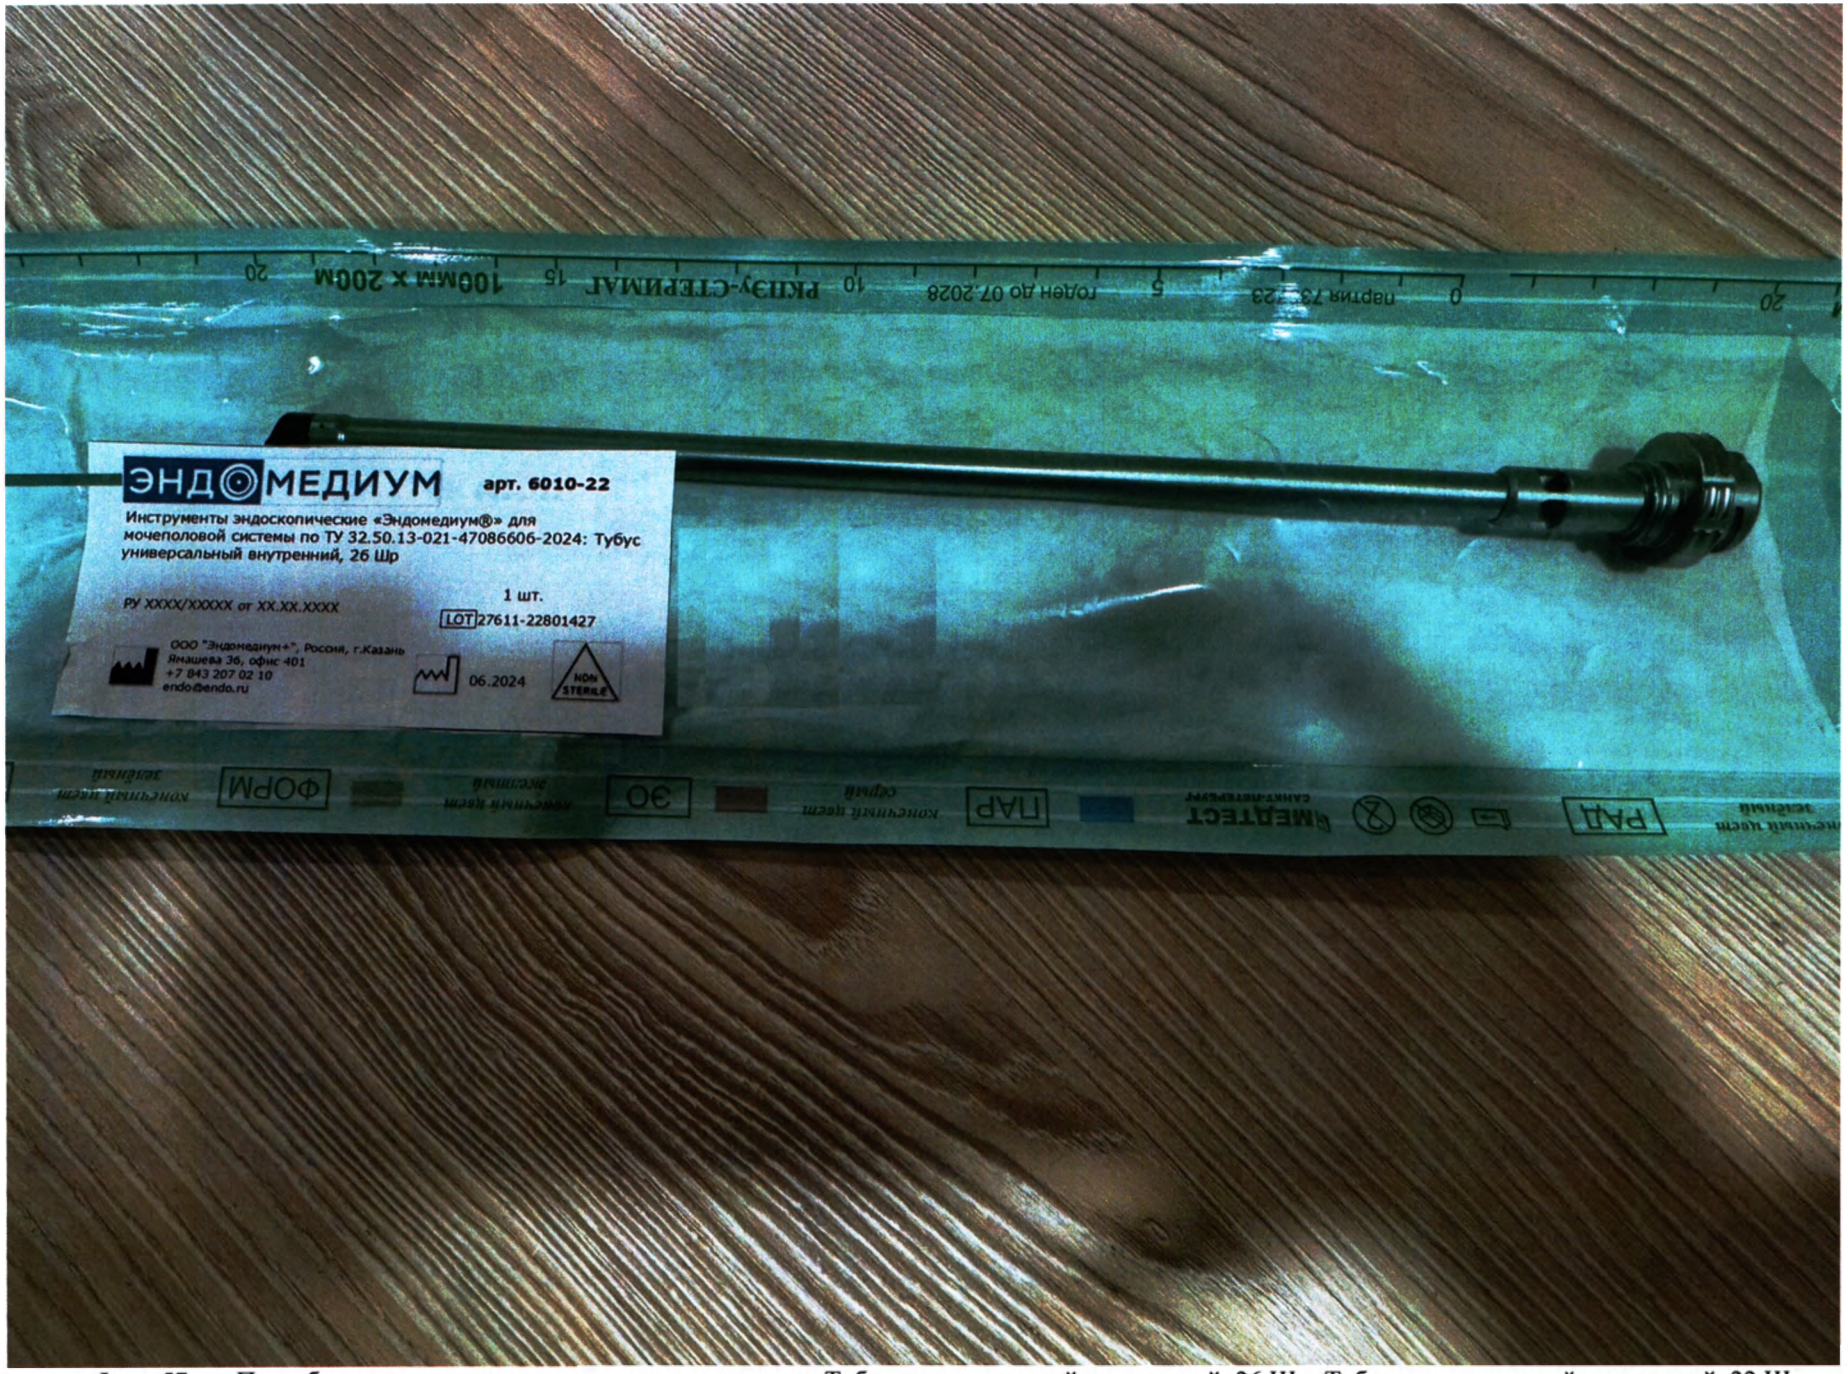


Фото 57. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Тубус универсальный внутренний, 26 Шр; Тубус универсальный внутренний, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 58. Общий вид и пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Дилататор цельный 15-32 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 59. Общий вид вариантов исполнения: Дилататор сегментированный 8-24 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 60. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Дилататор сегментированный 8-24 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

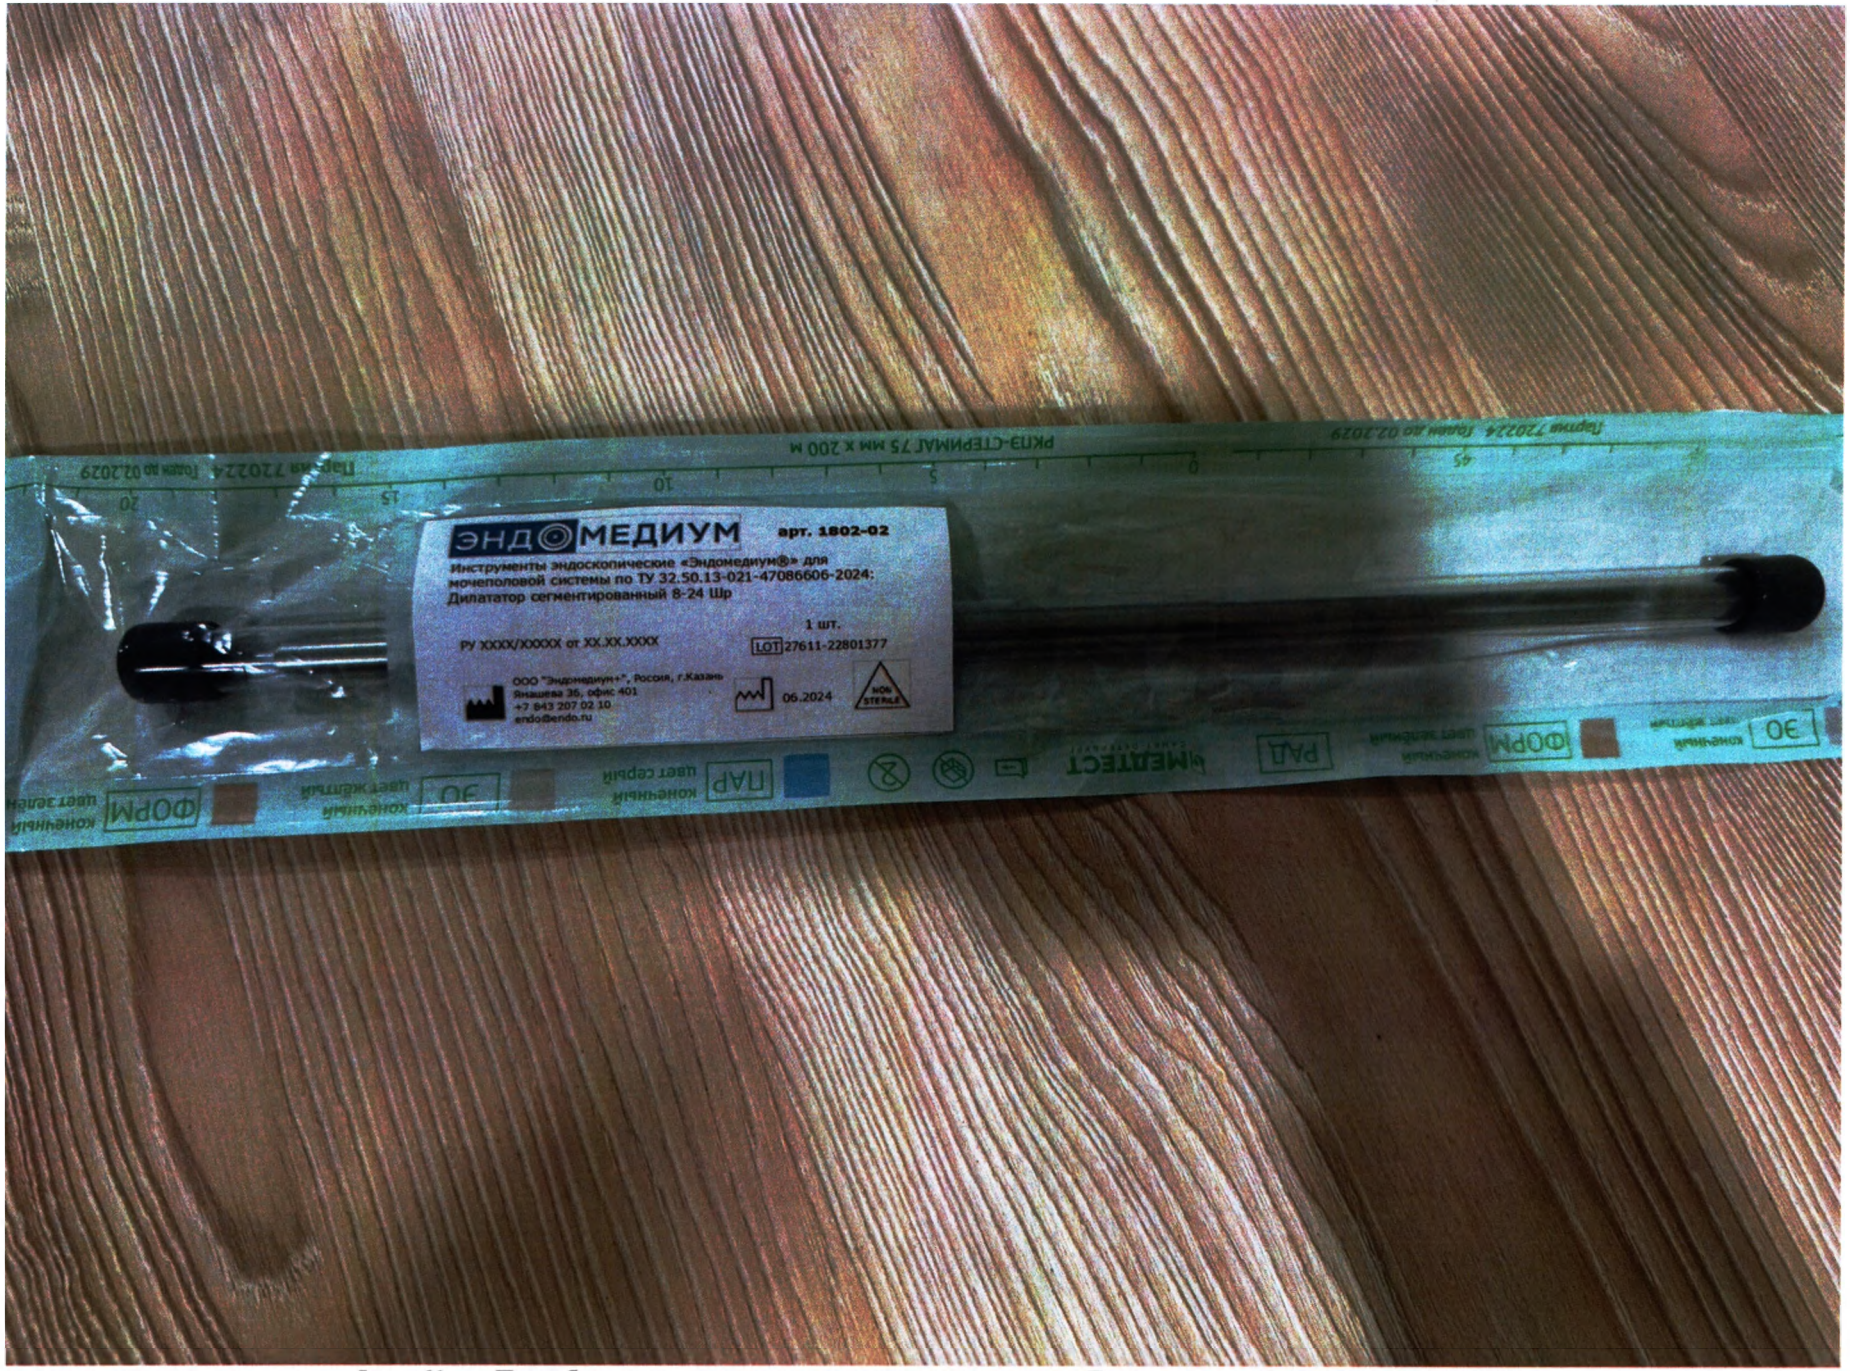


Фото 61. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Дилататор сегментированный 8-24 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

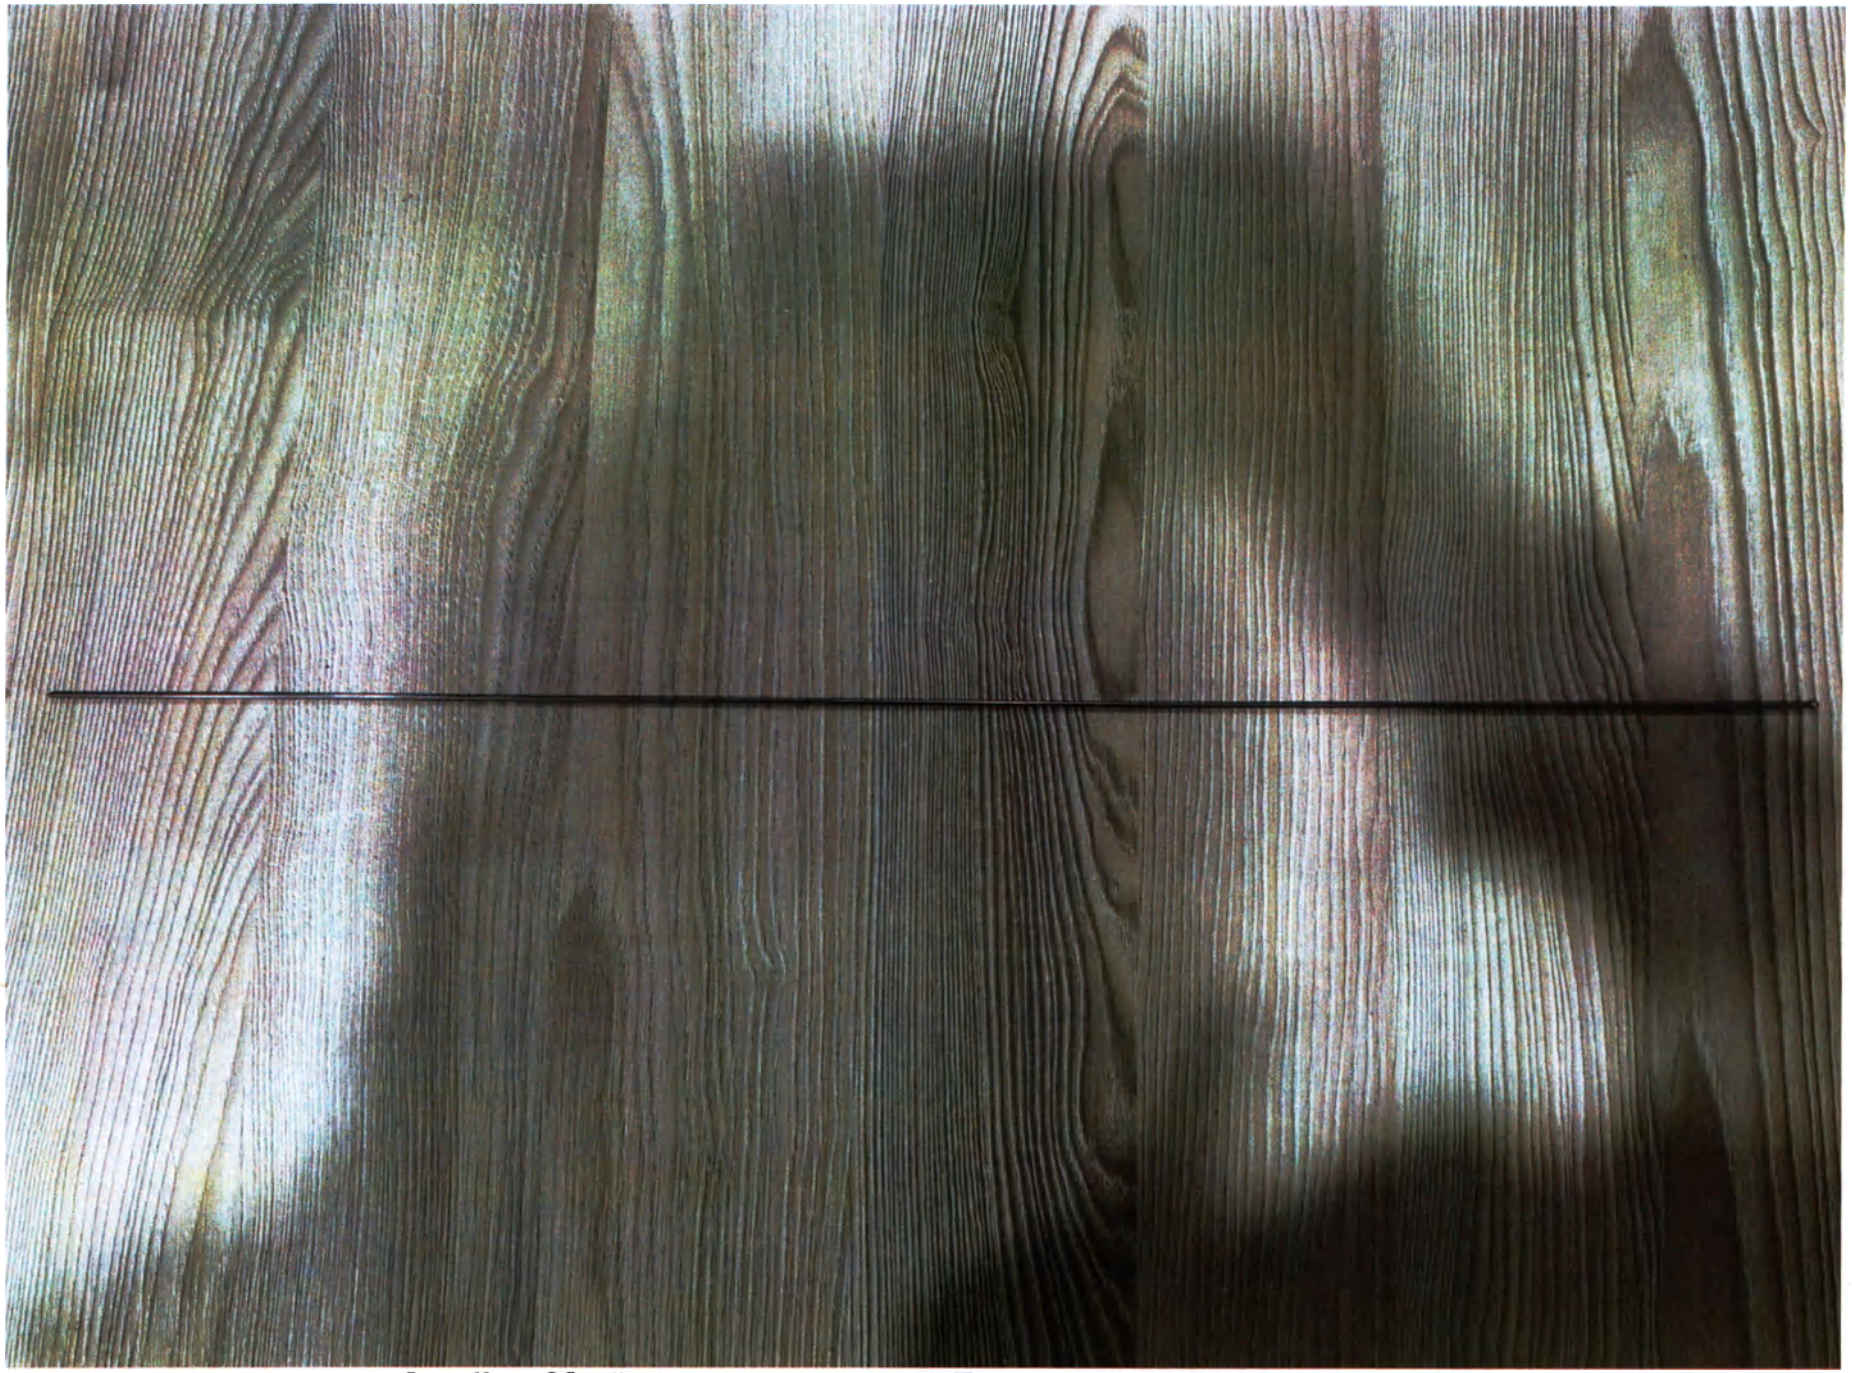


Фото 62. Общий вид вариантов исполнения: Проводник для сегментированного дилатора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

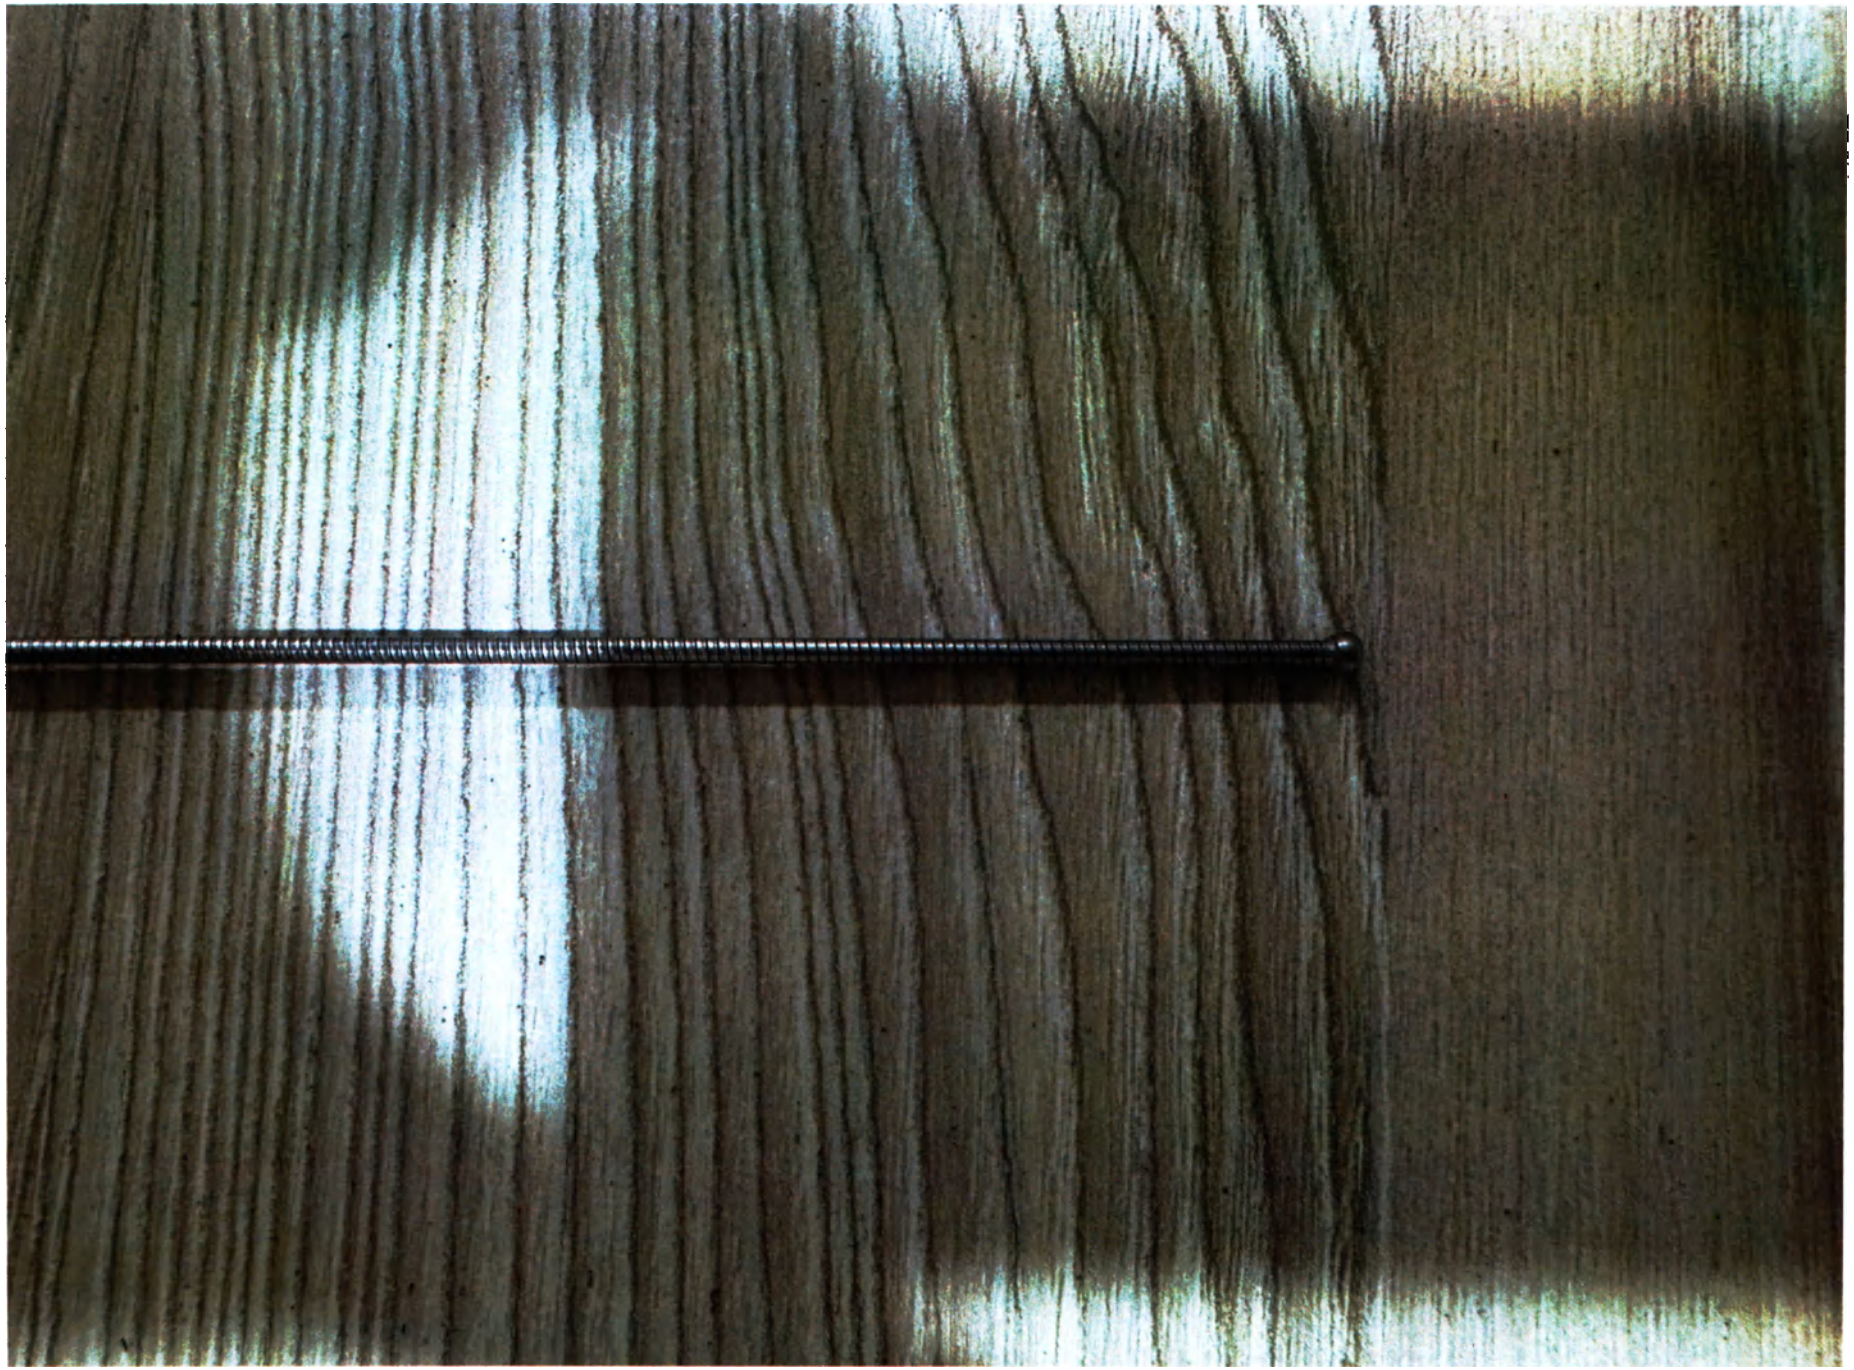


Фото 63. Общий вид вариантов исполнения: Проводник для сегментированного дилатора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 64. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Проводник для сегментированного дилатора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

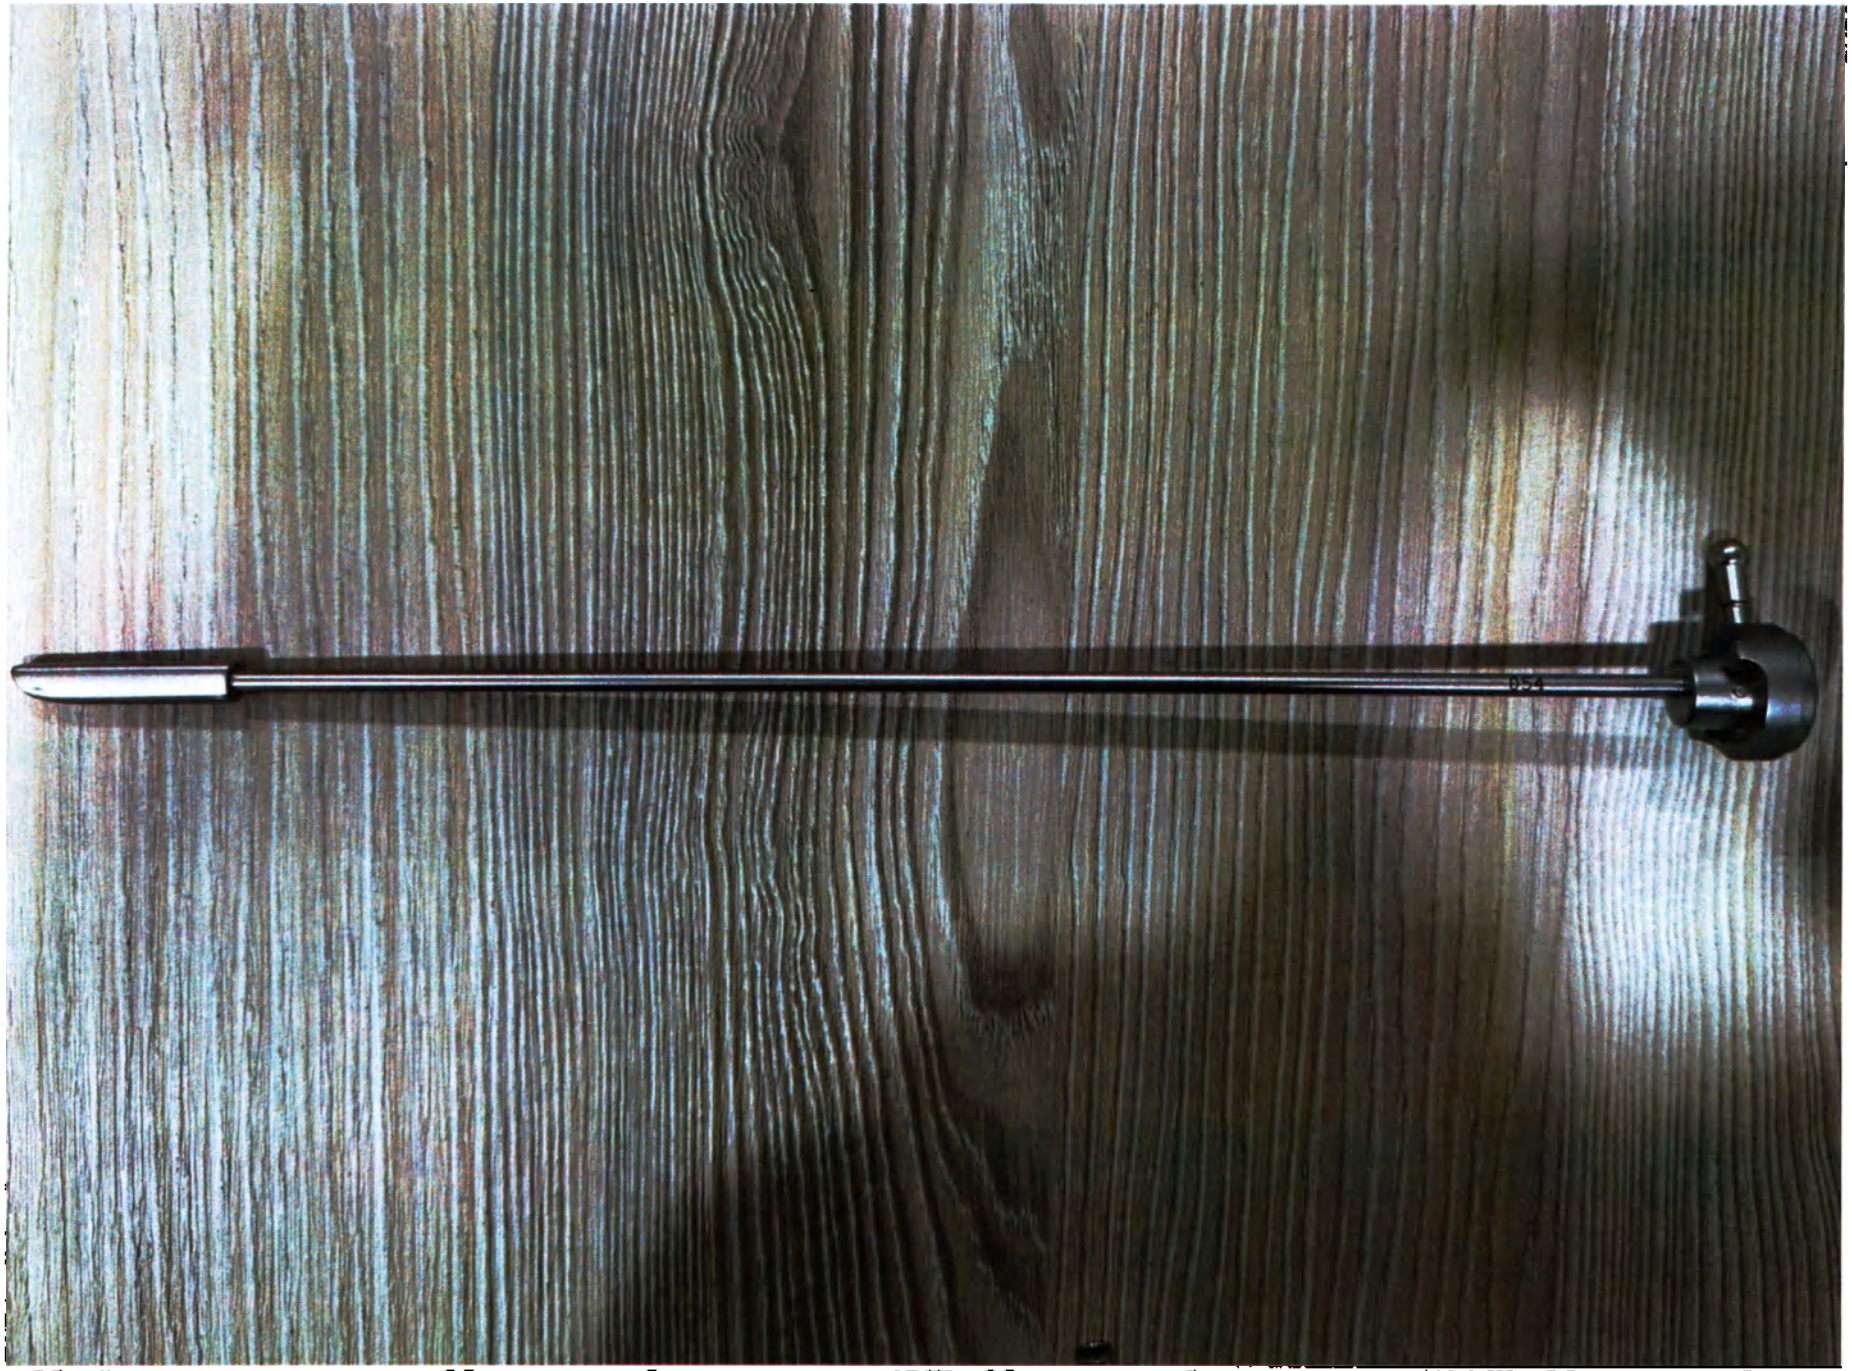


Фото 65. Общий вид вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального 17 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

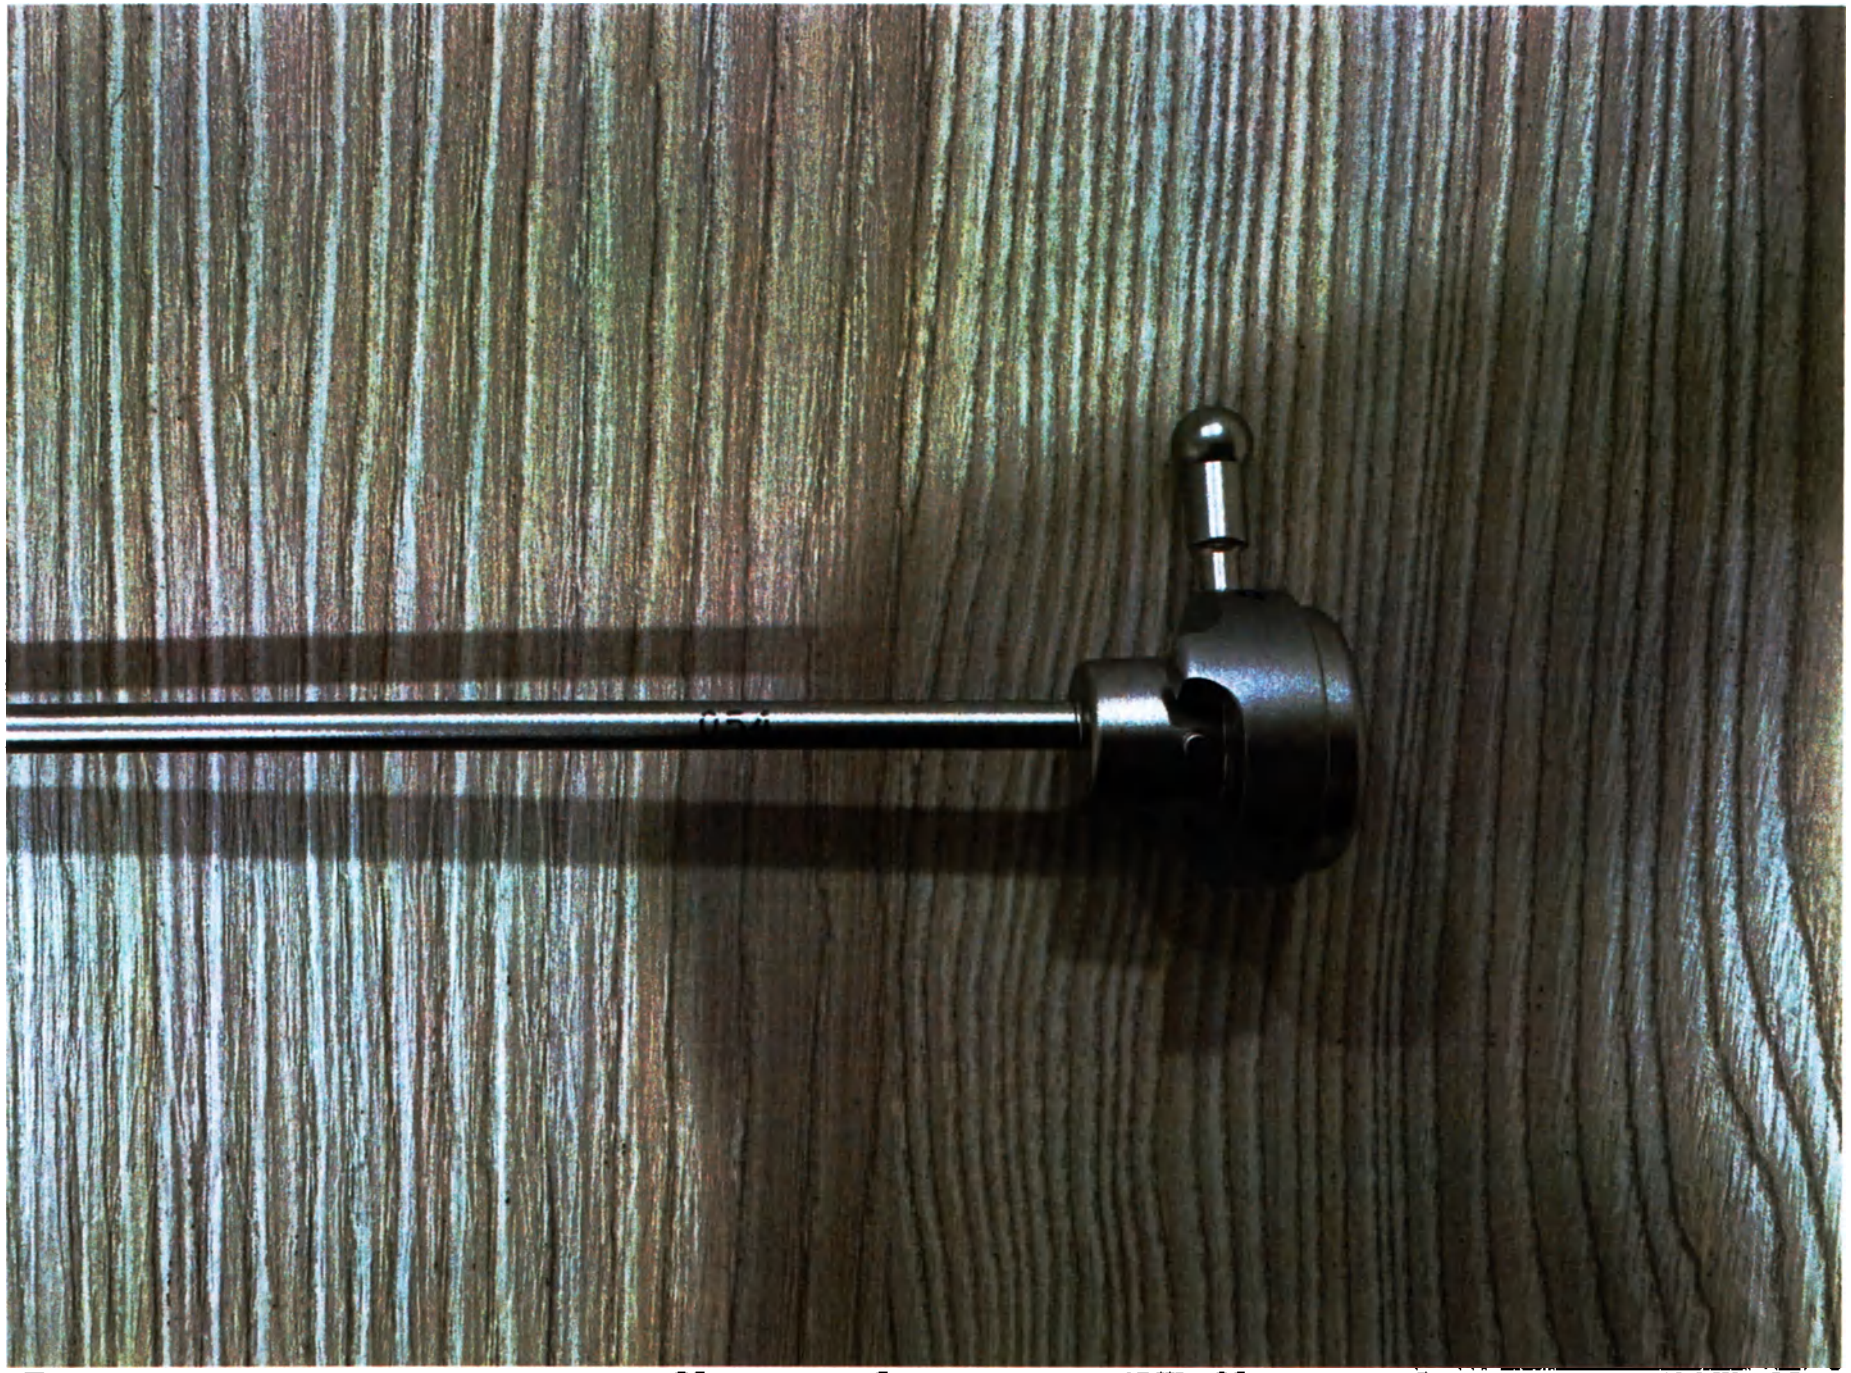


Фото 66. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального 17 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

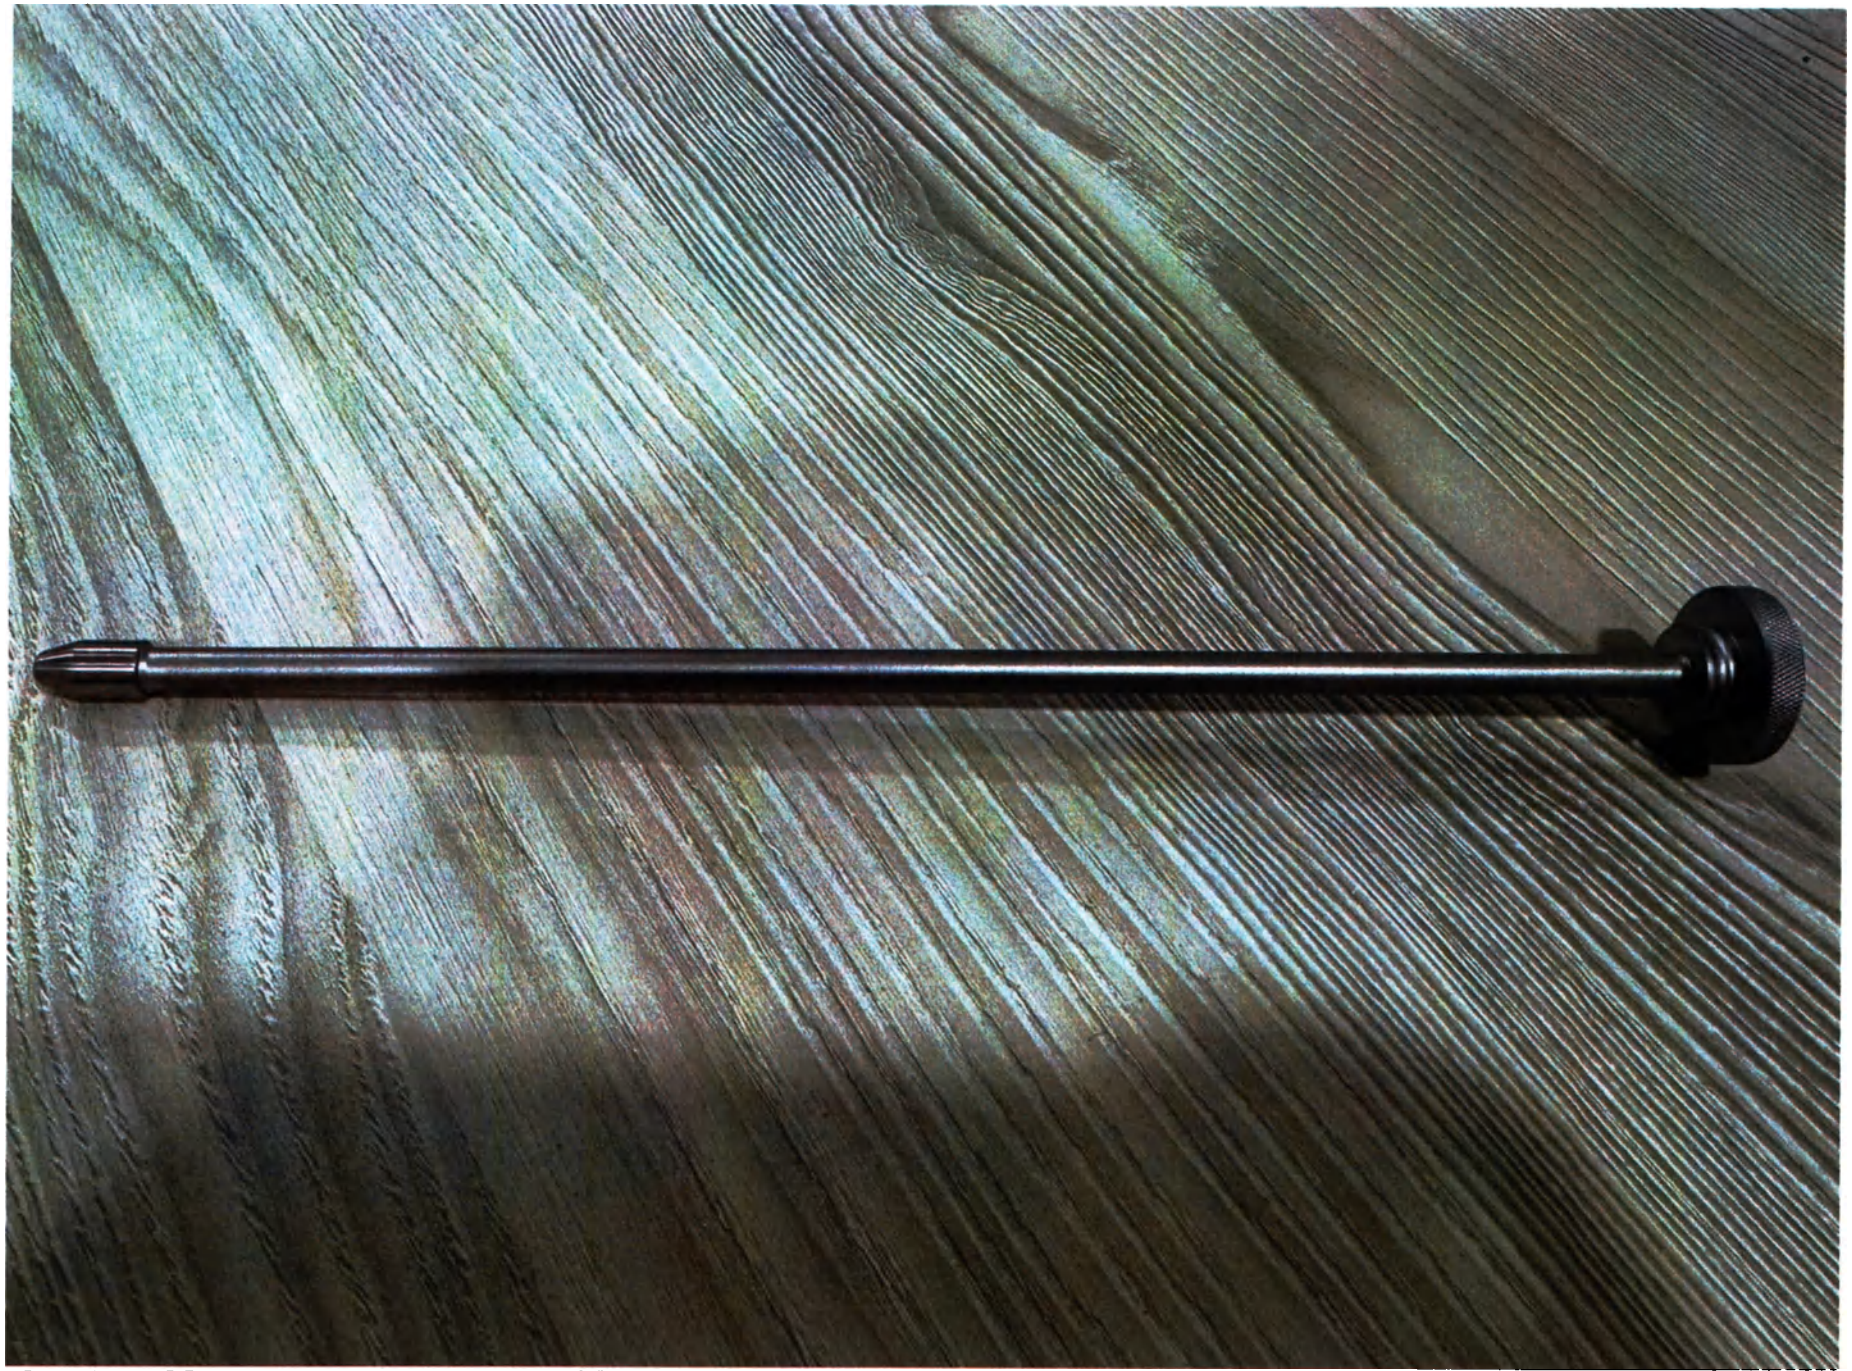


Фото 67. Общий вид вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 68. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

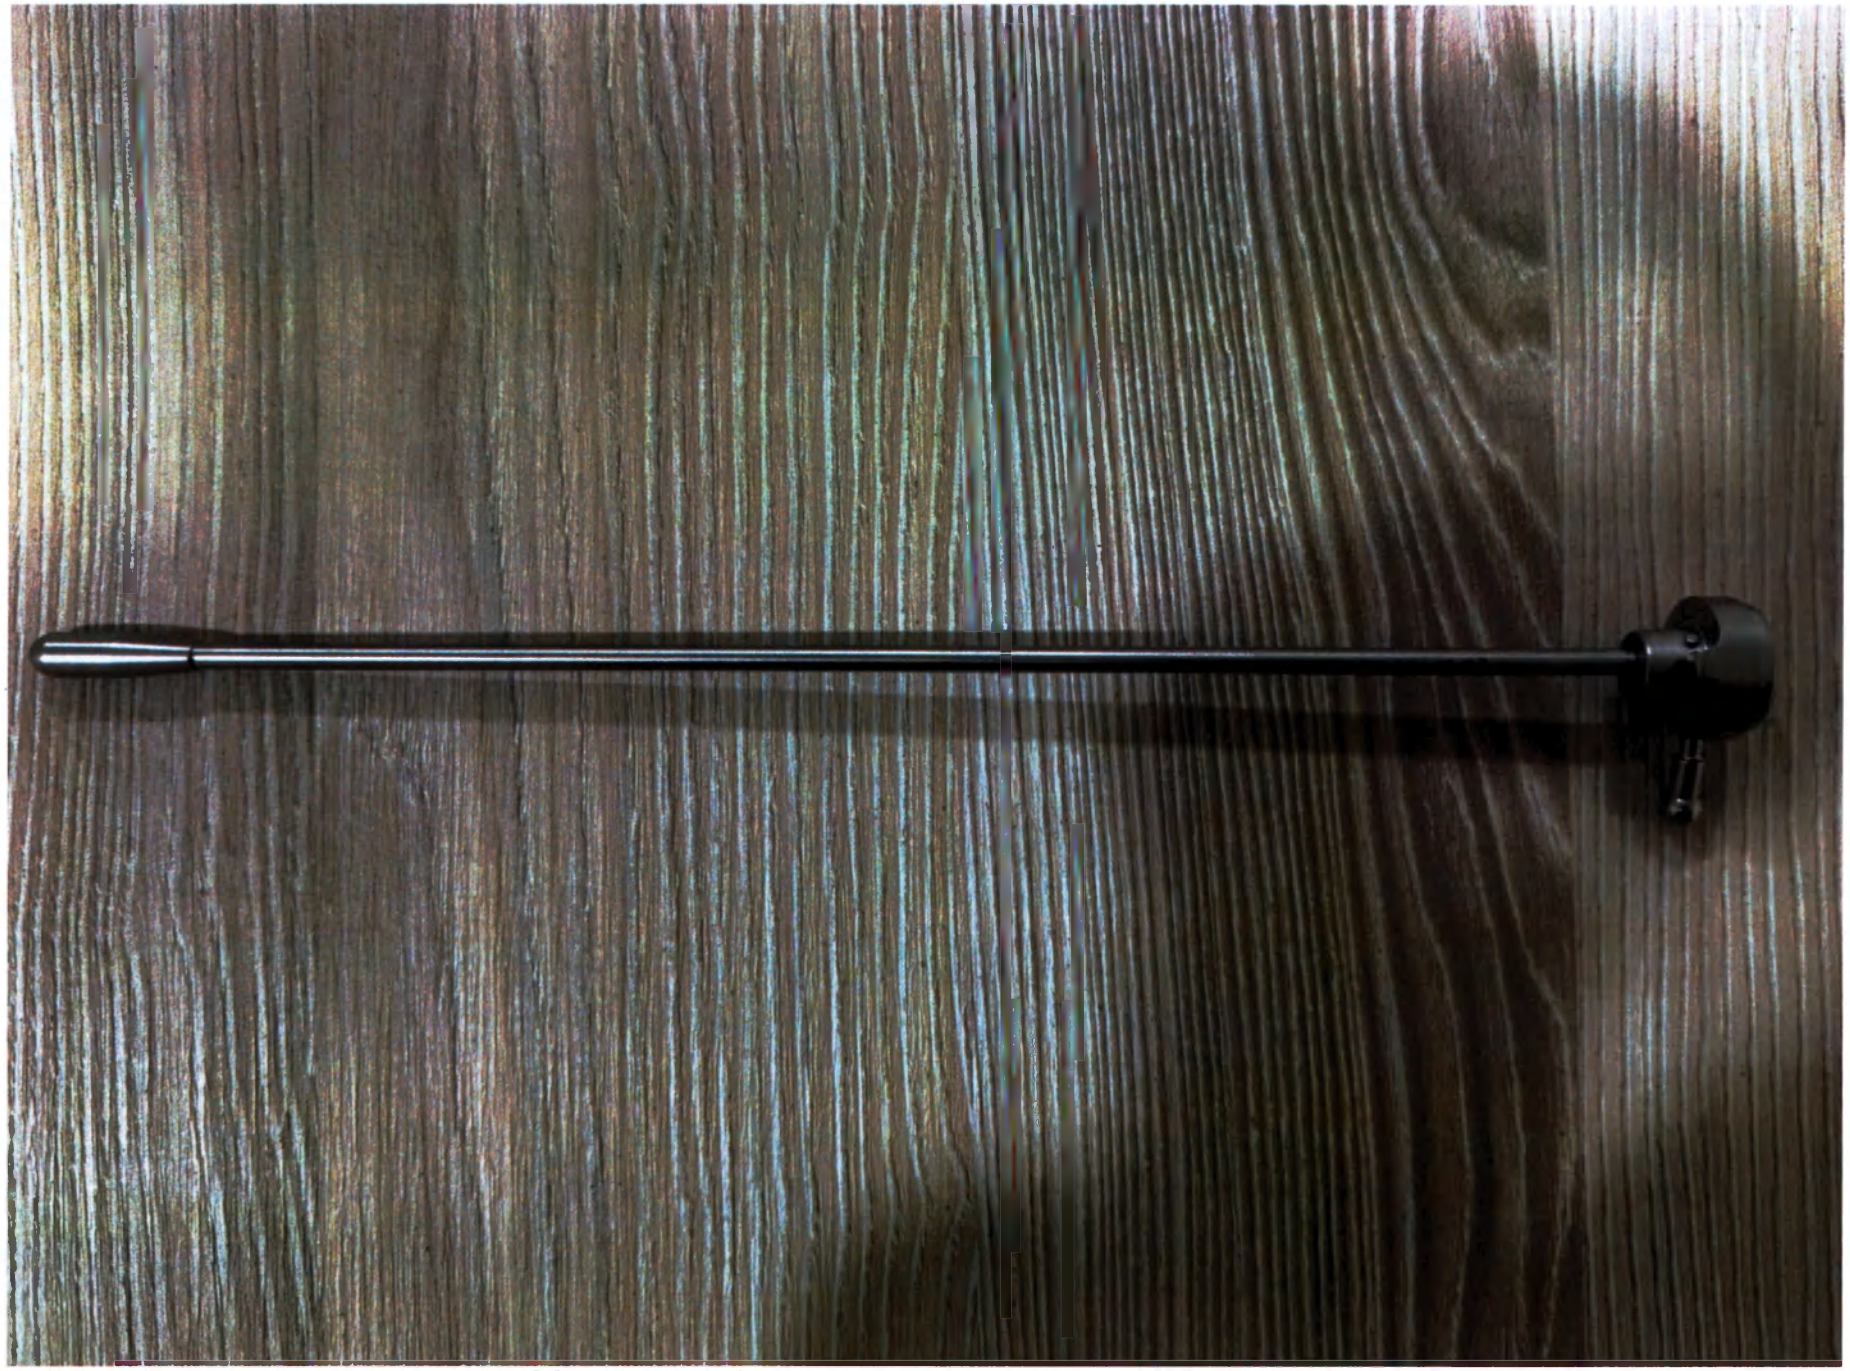


Фото 69. Общий вид вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 70. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 22 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

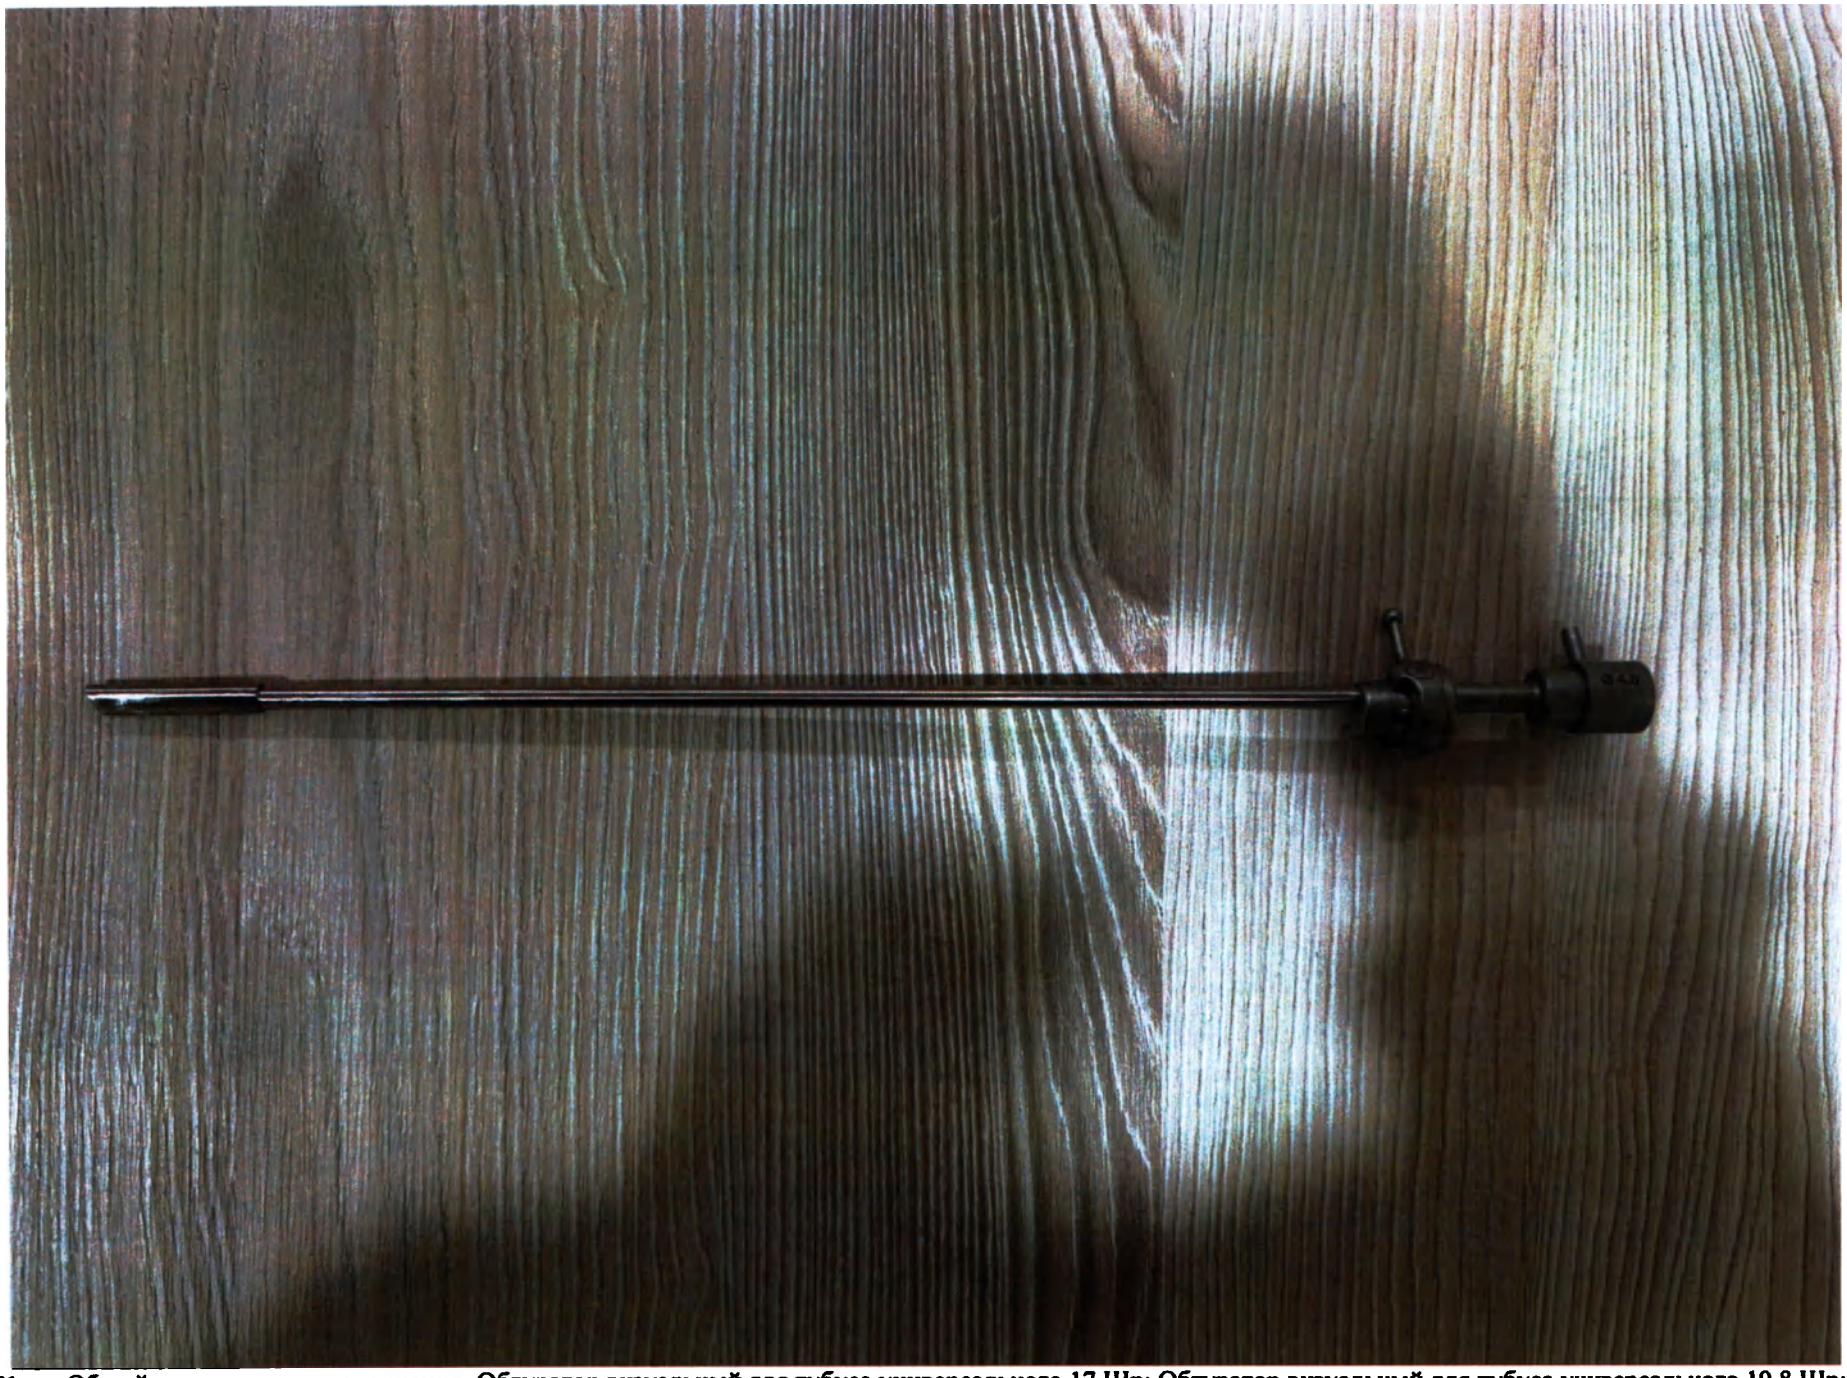


Фото 71. Общий вид вариантов исполнения: Обтуратор визуальный для тубуса универсального 17 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

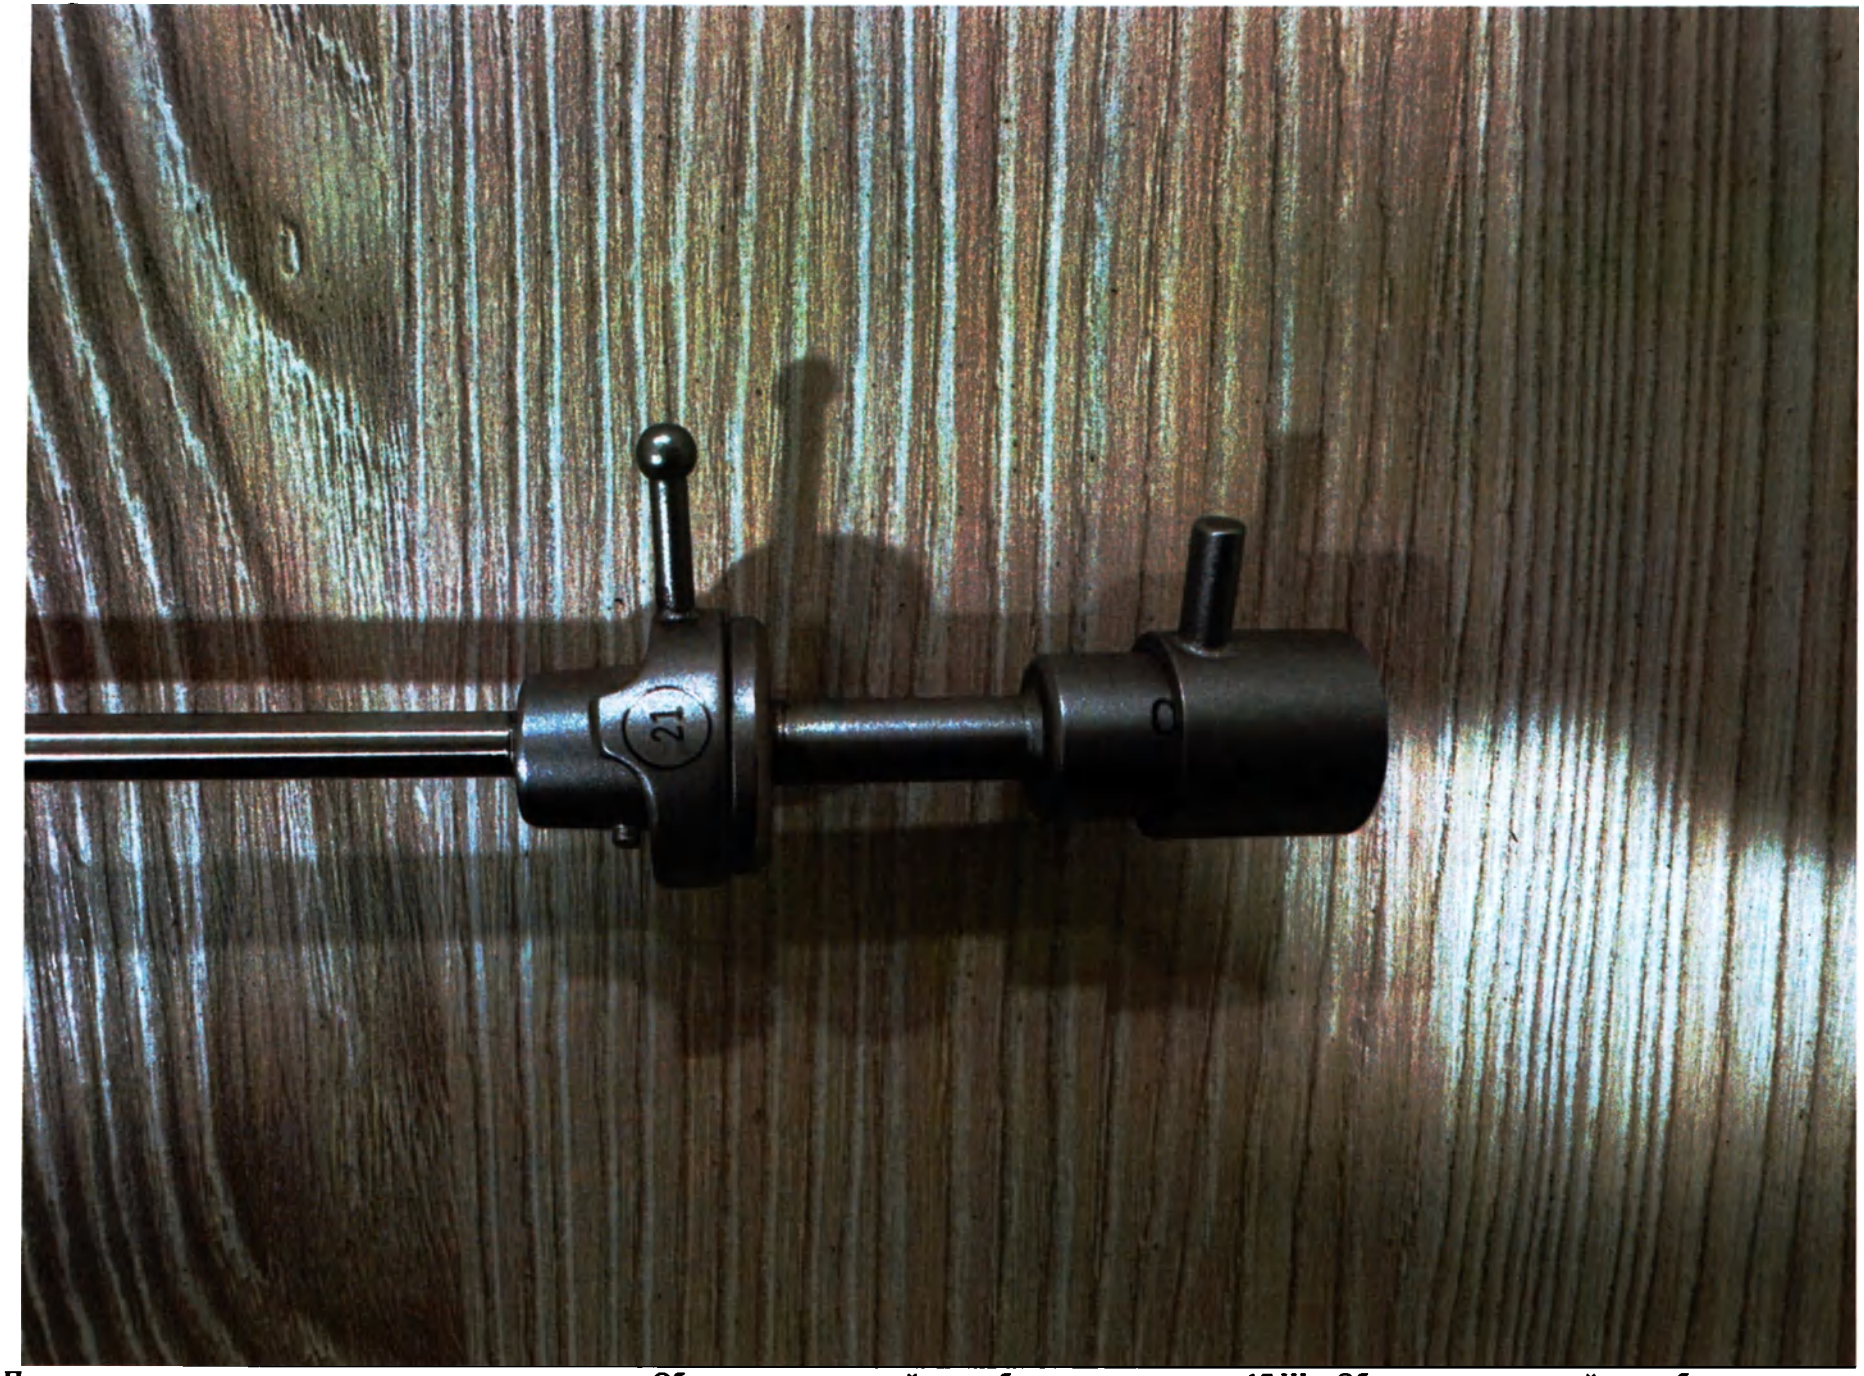


Фото 72. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор визуальный для тубуса универсального 17 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 22.5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

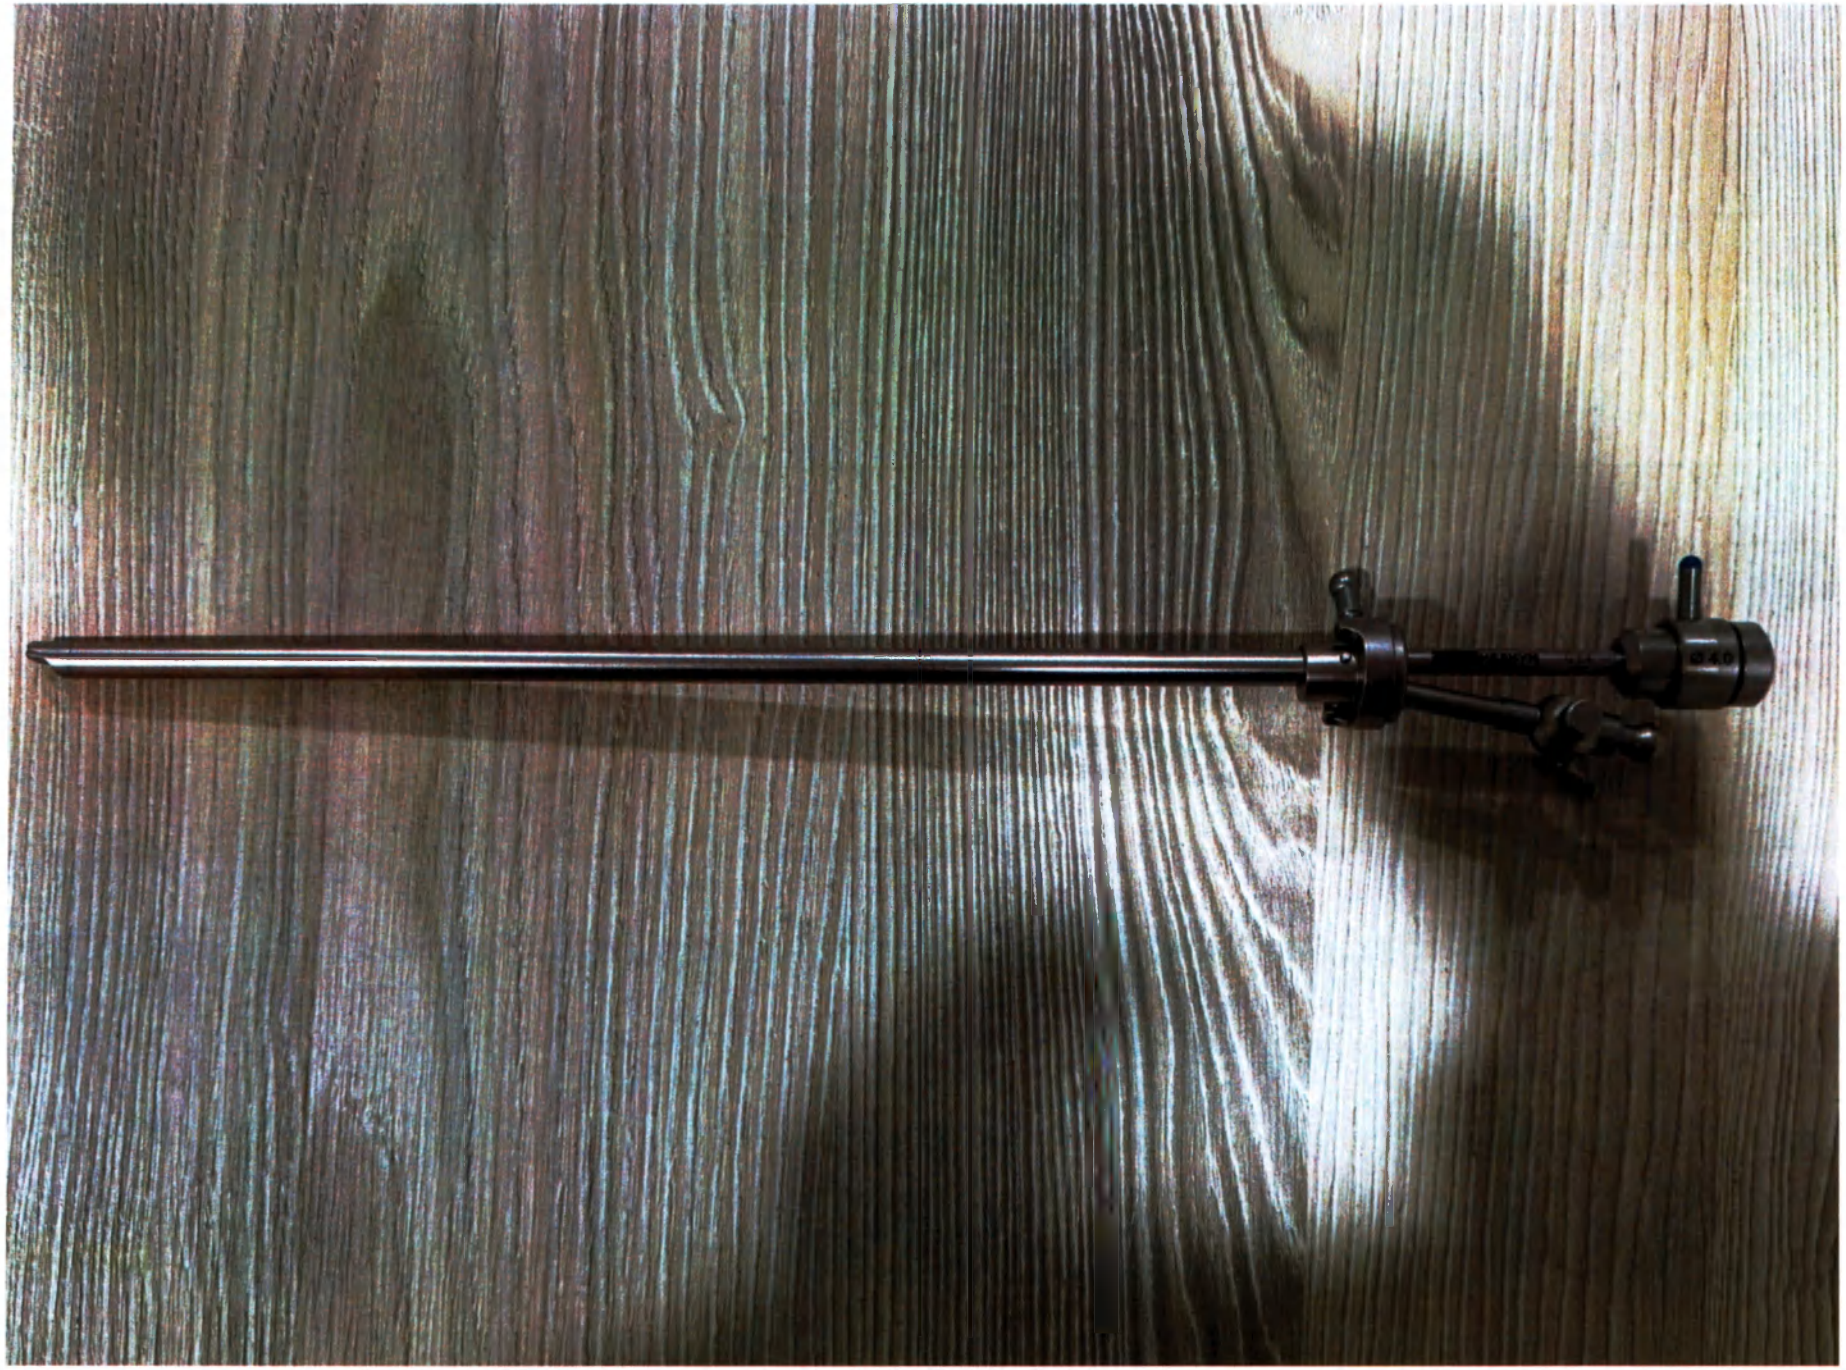


Фото 73. Общий вид вариантов исполнения: Обтуратор визуальный с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

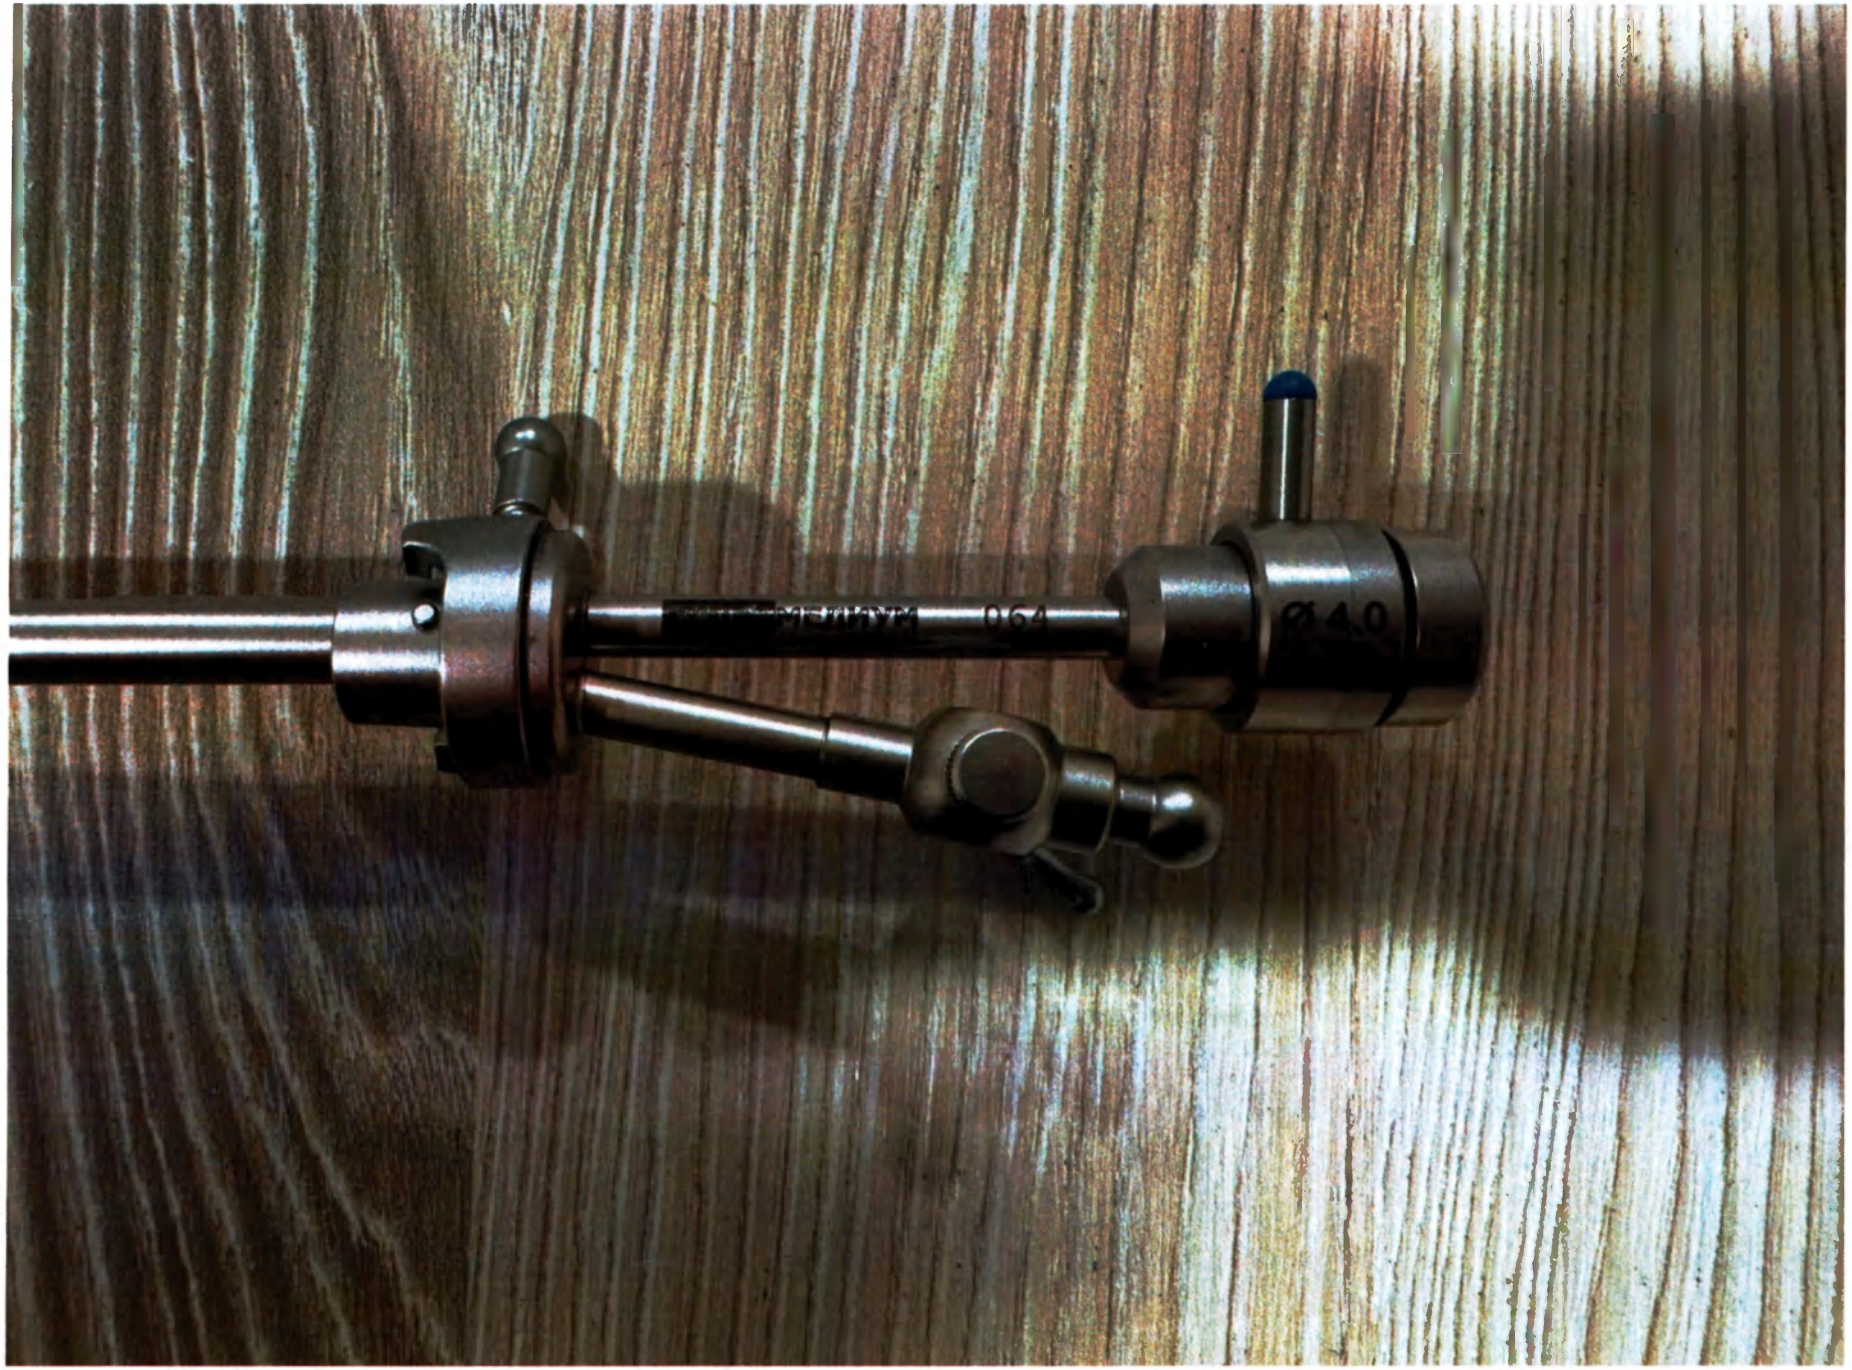


Фото 74. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор визуальный с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

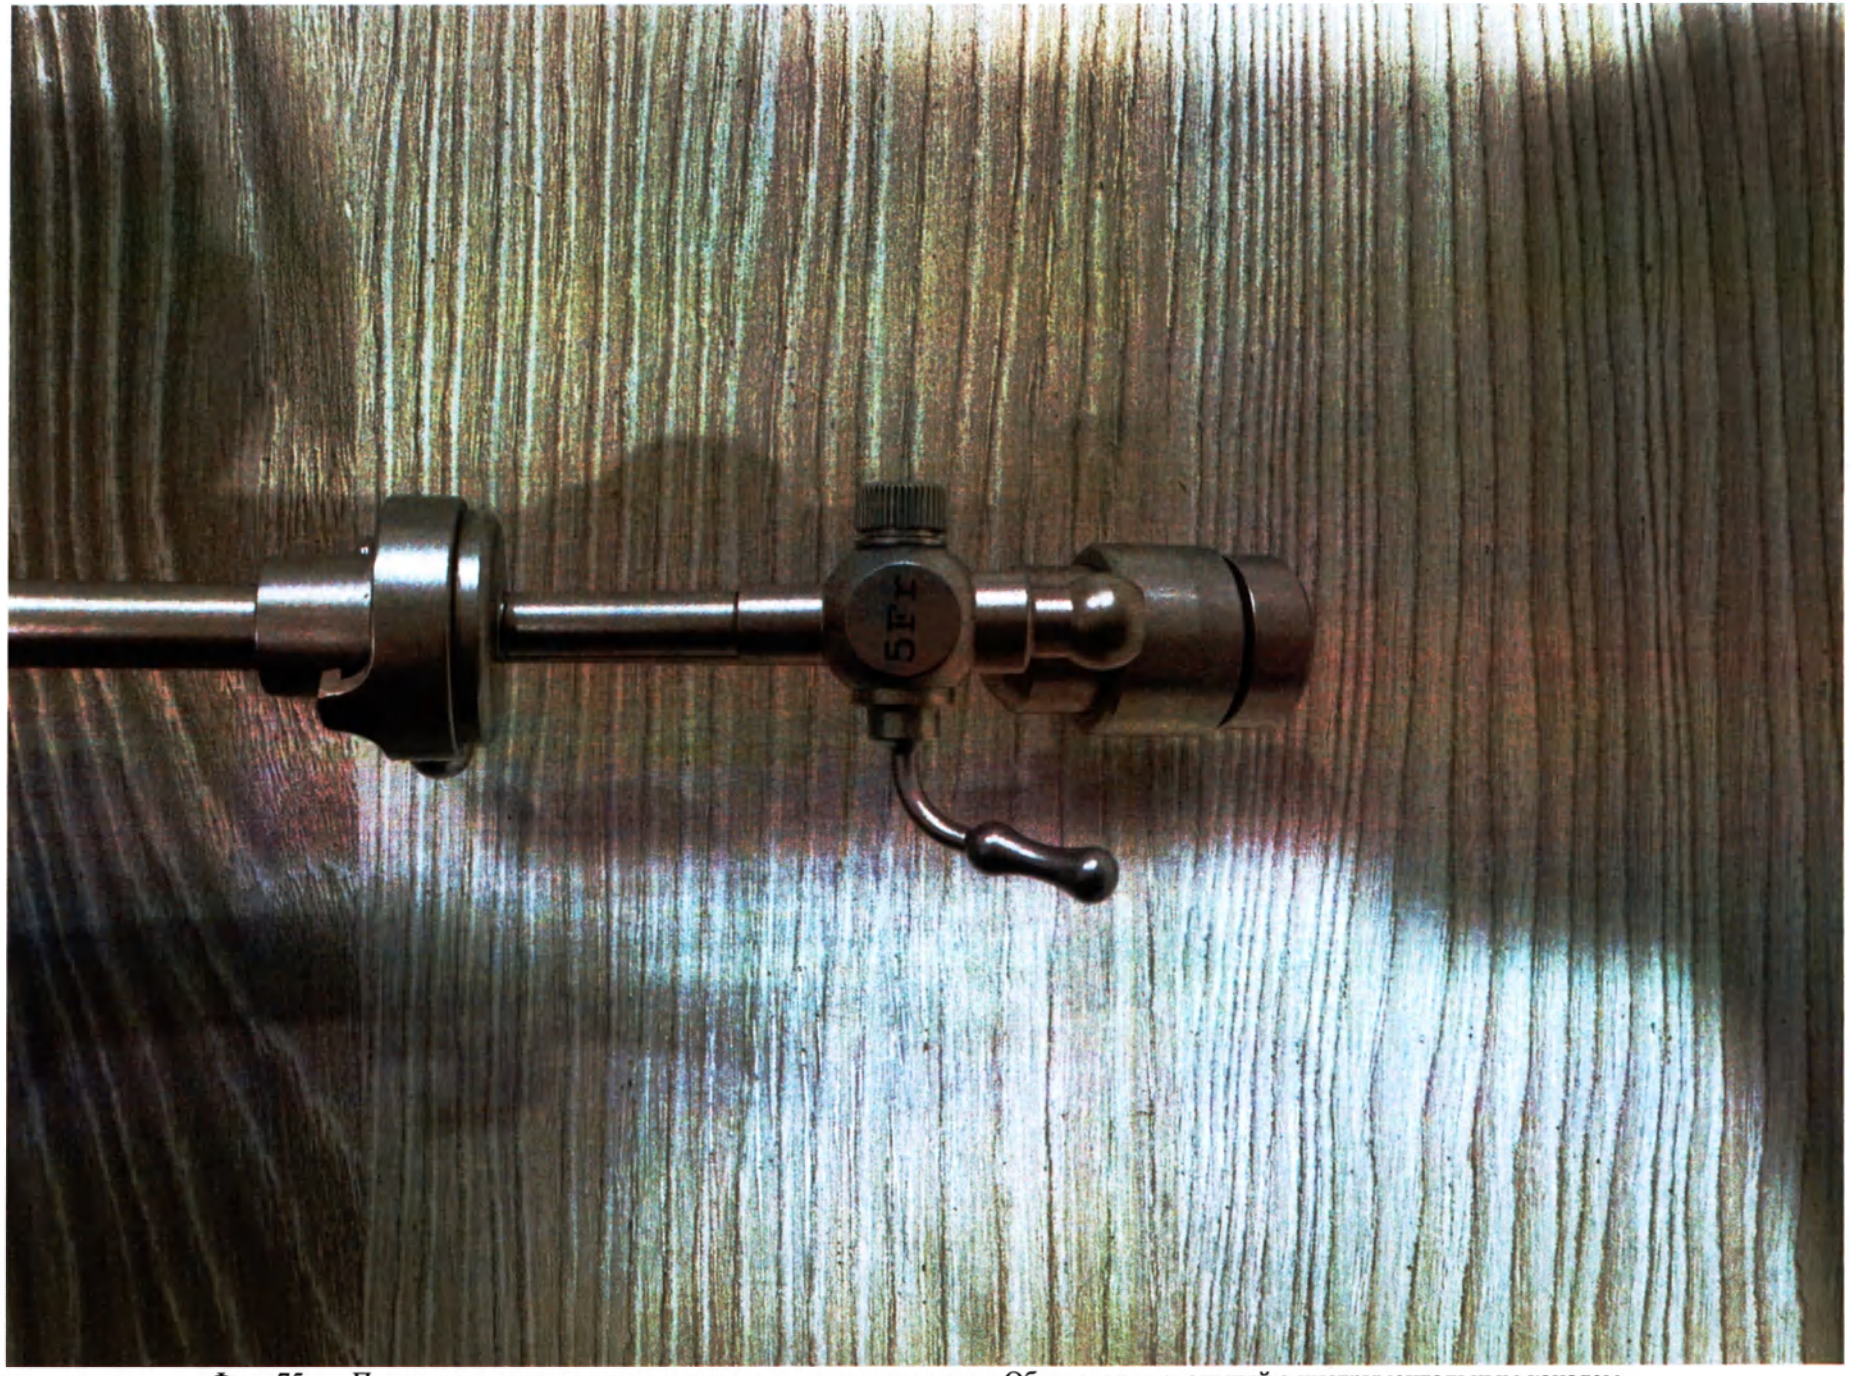


Фото 75. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Обтуратор визуальный с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

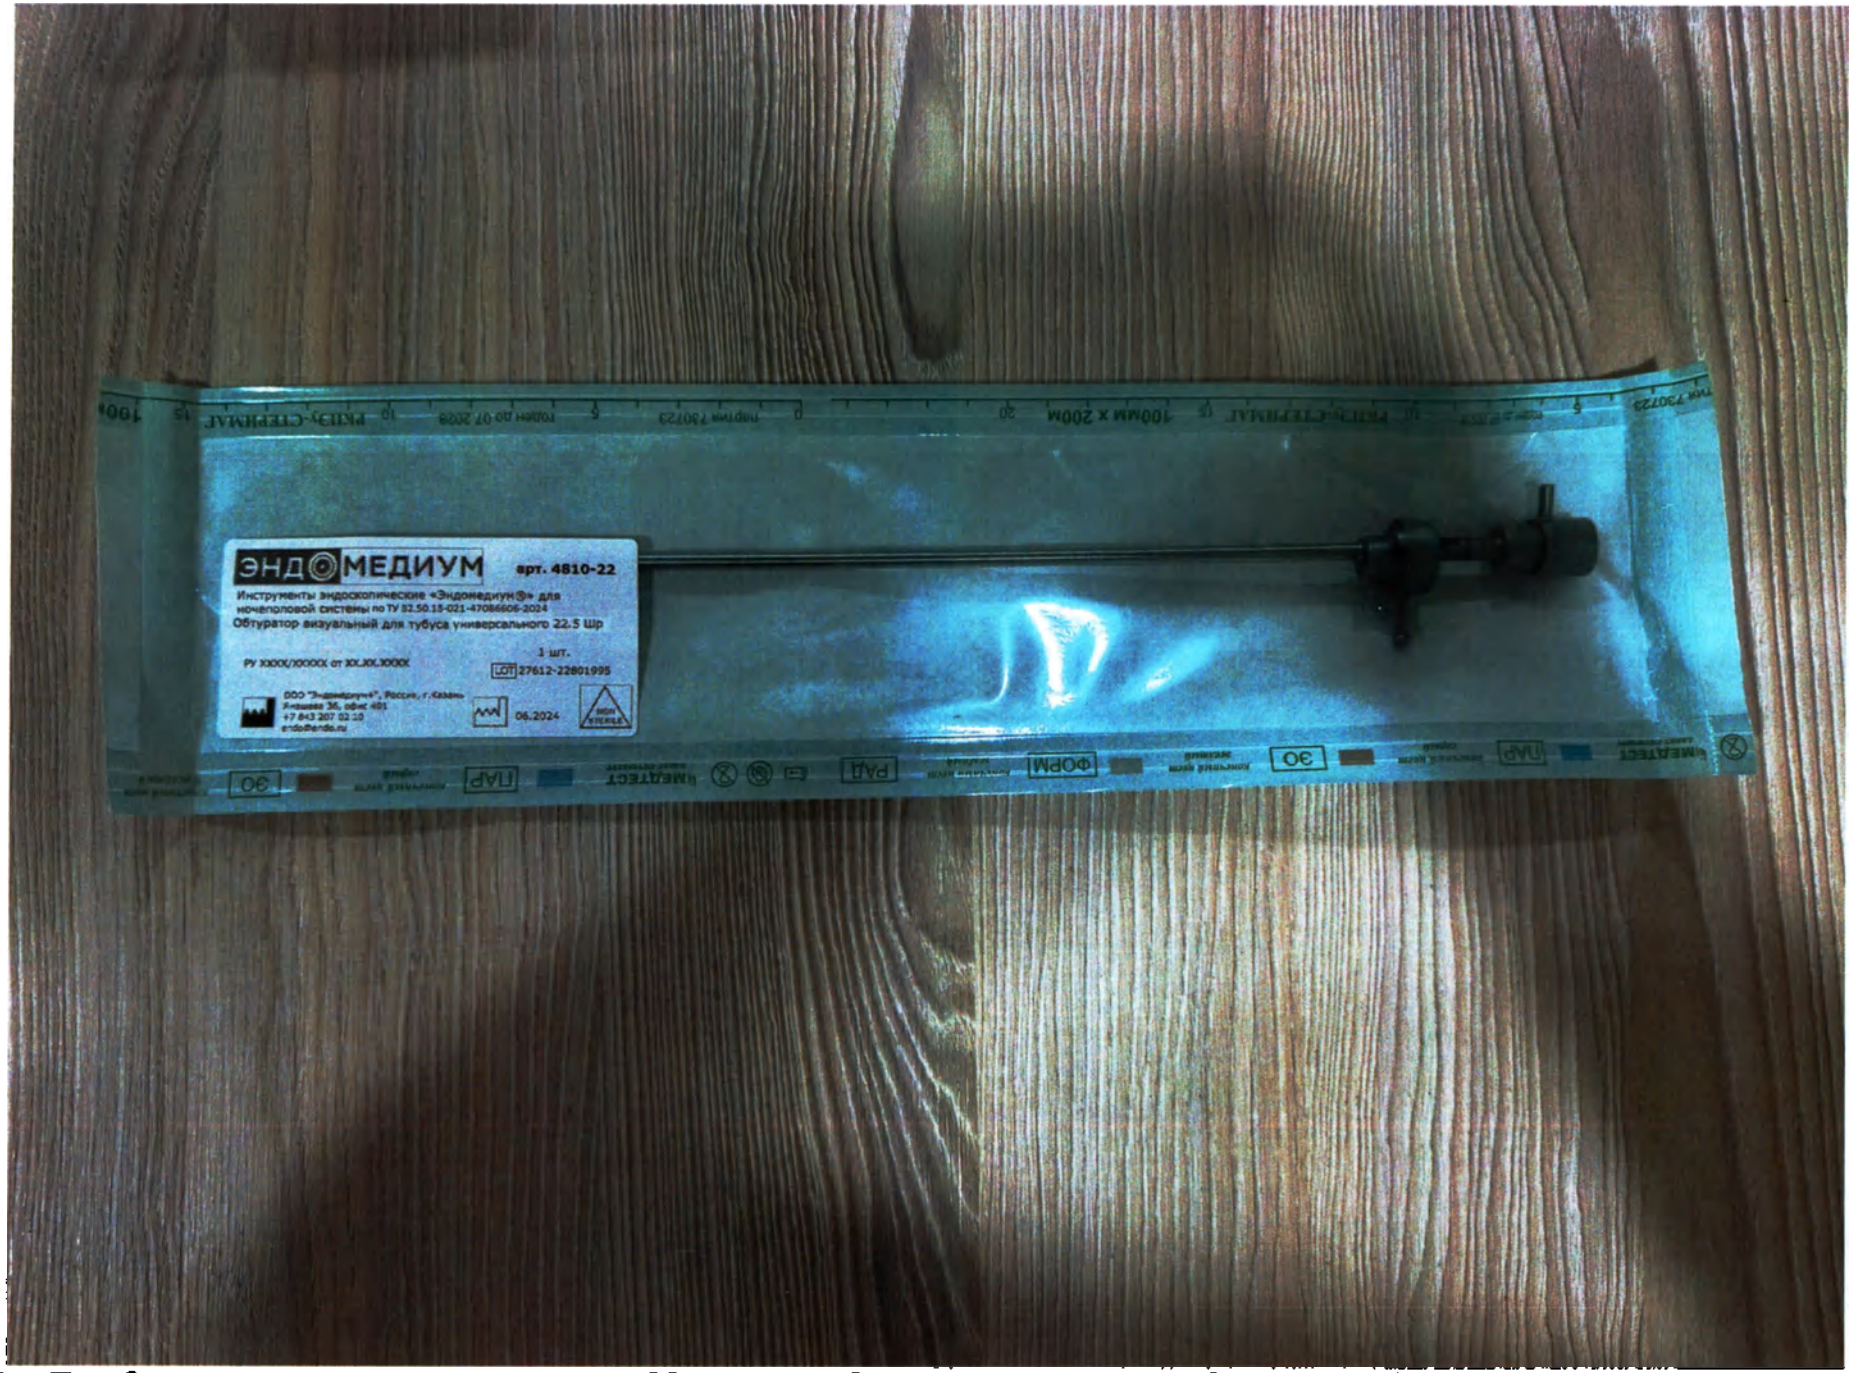


Фото 76. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Обтуратор для тубуса универсального 17 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор для тубуса универсального 22.5 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внешнего, 22 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 26 Шр; Обтуратор для тубуса универсального внутреннего, 22 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 17

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 19.8 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 21 Шр; Обтуратор визуальный для тубуса универсального 22.5 Шр; Обтуратор визуальный с инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 77. Общий вид вариантов исполнения: Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 22 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

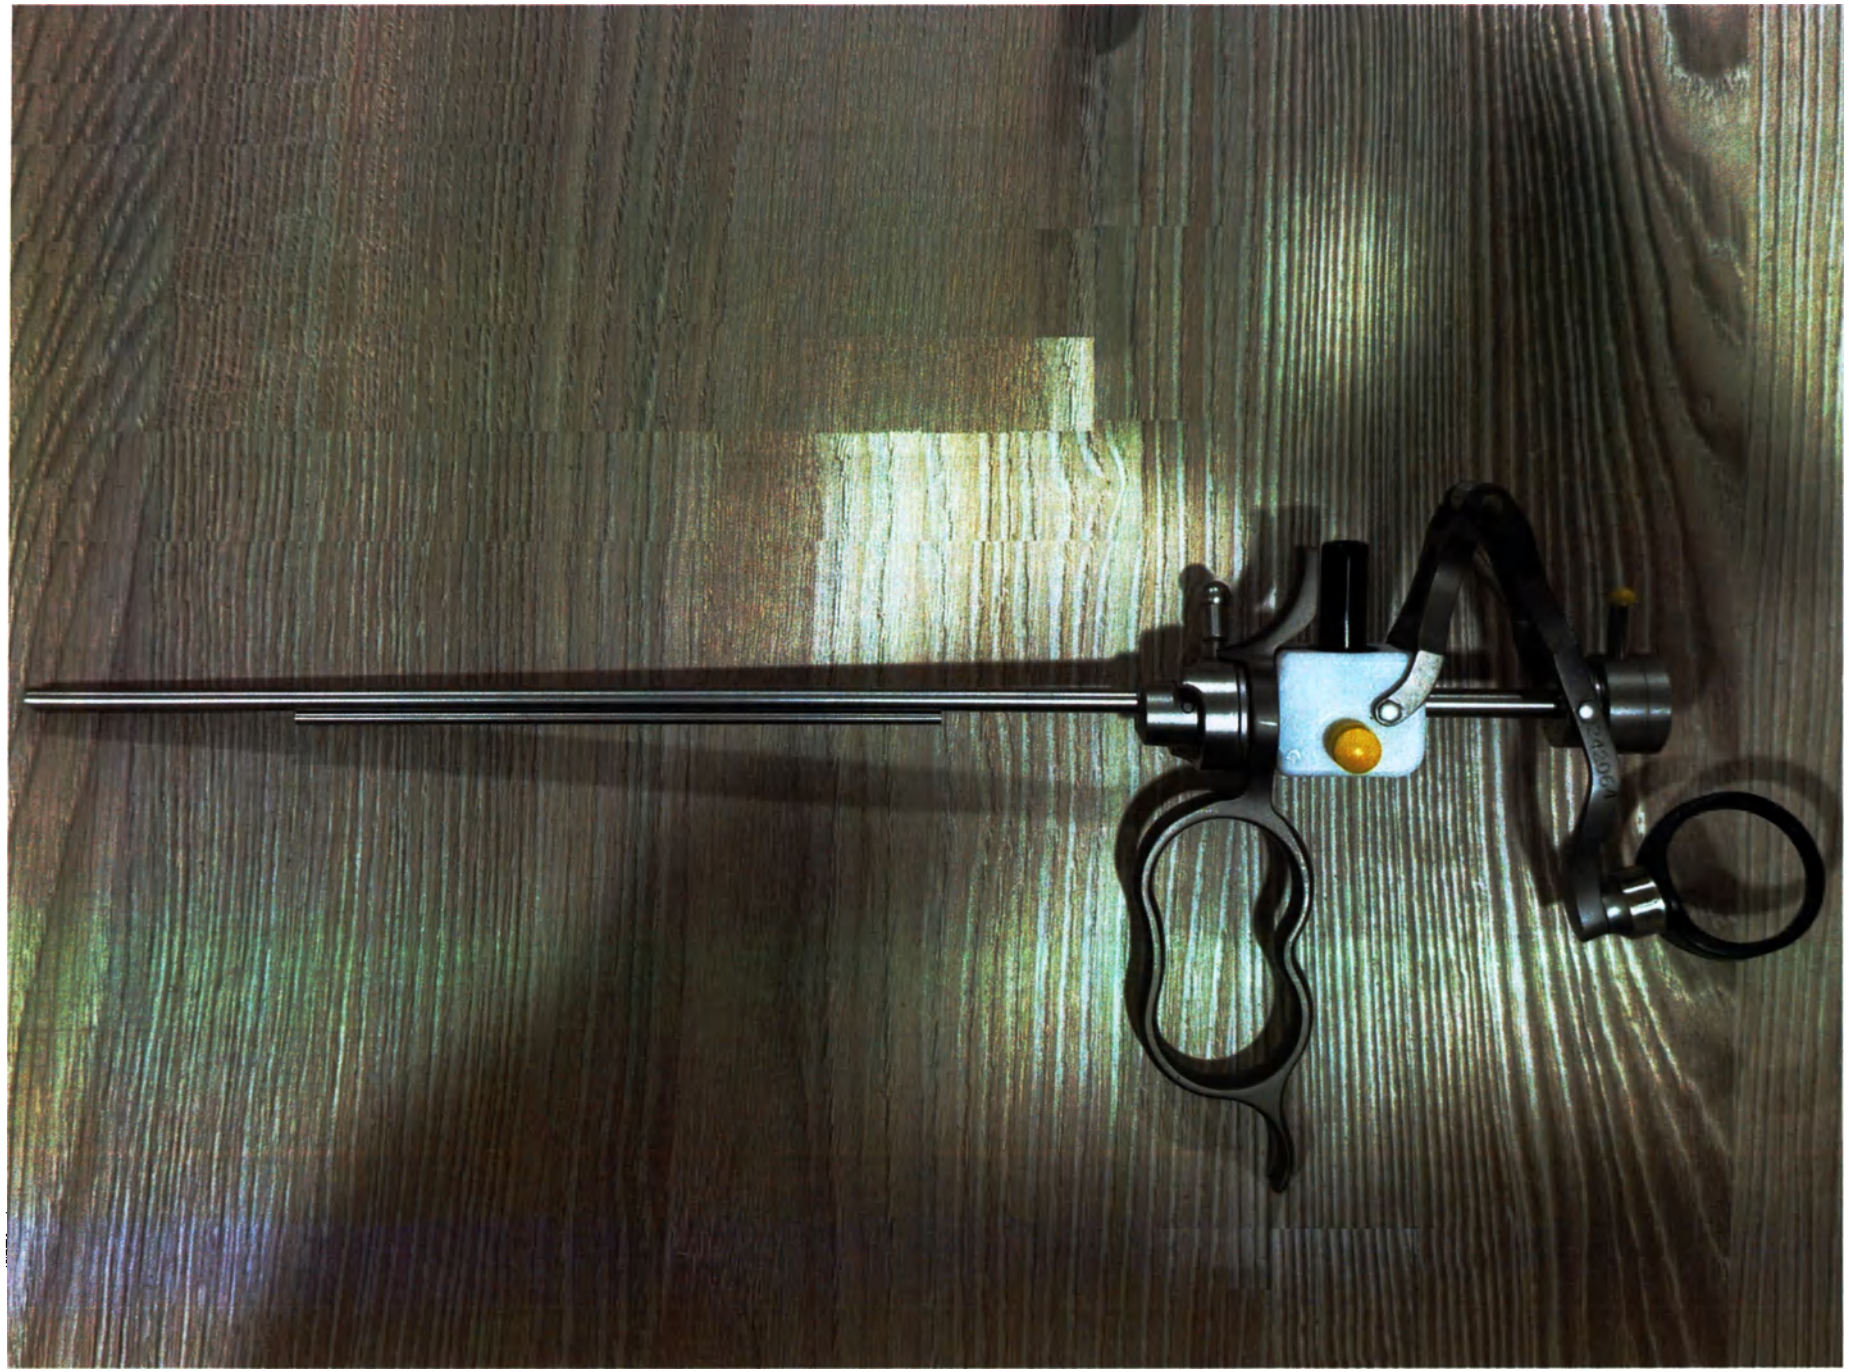


Фото 78. Общий вид вариантов исполнения: Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 22 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

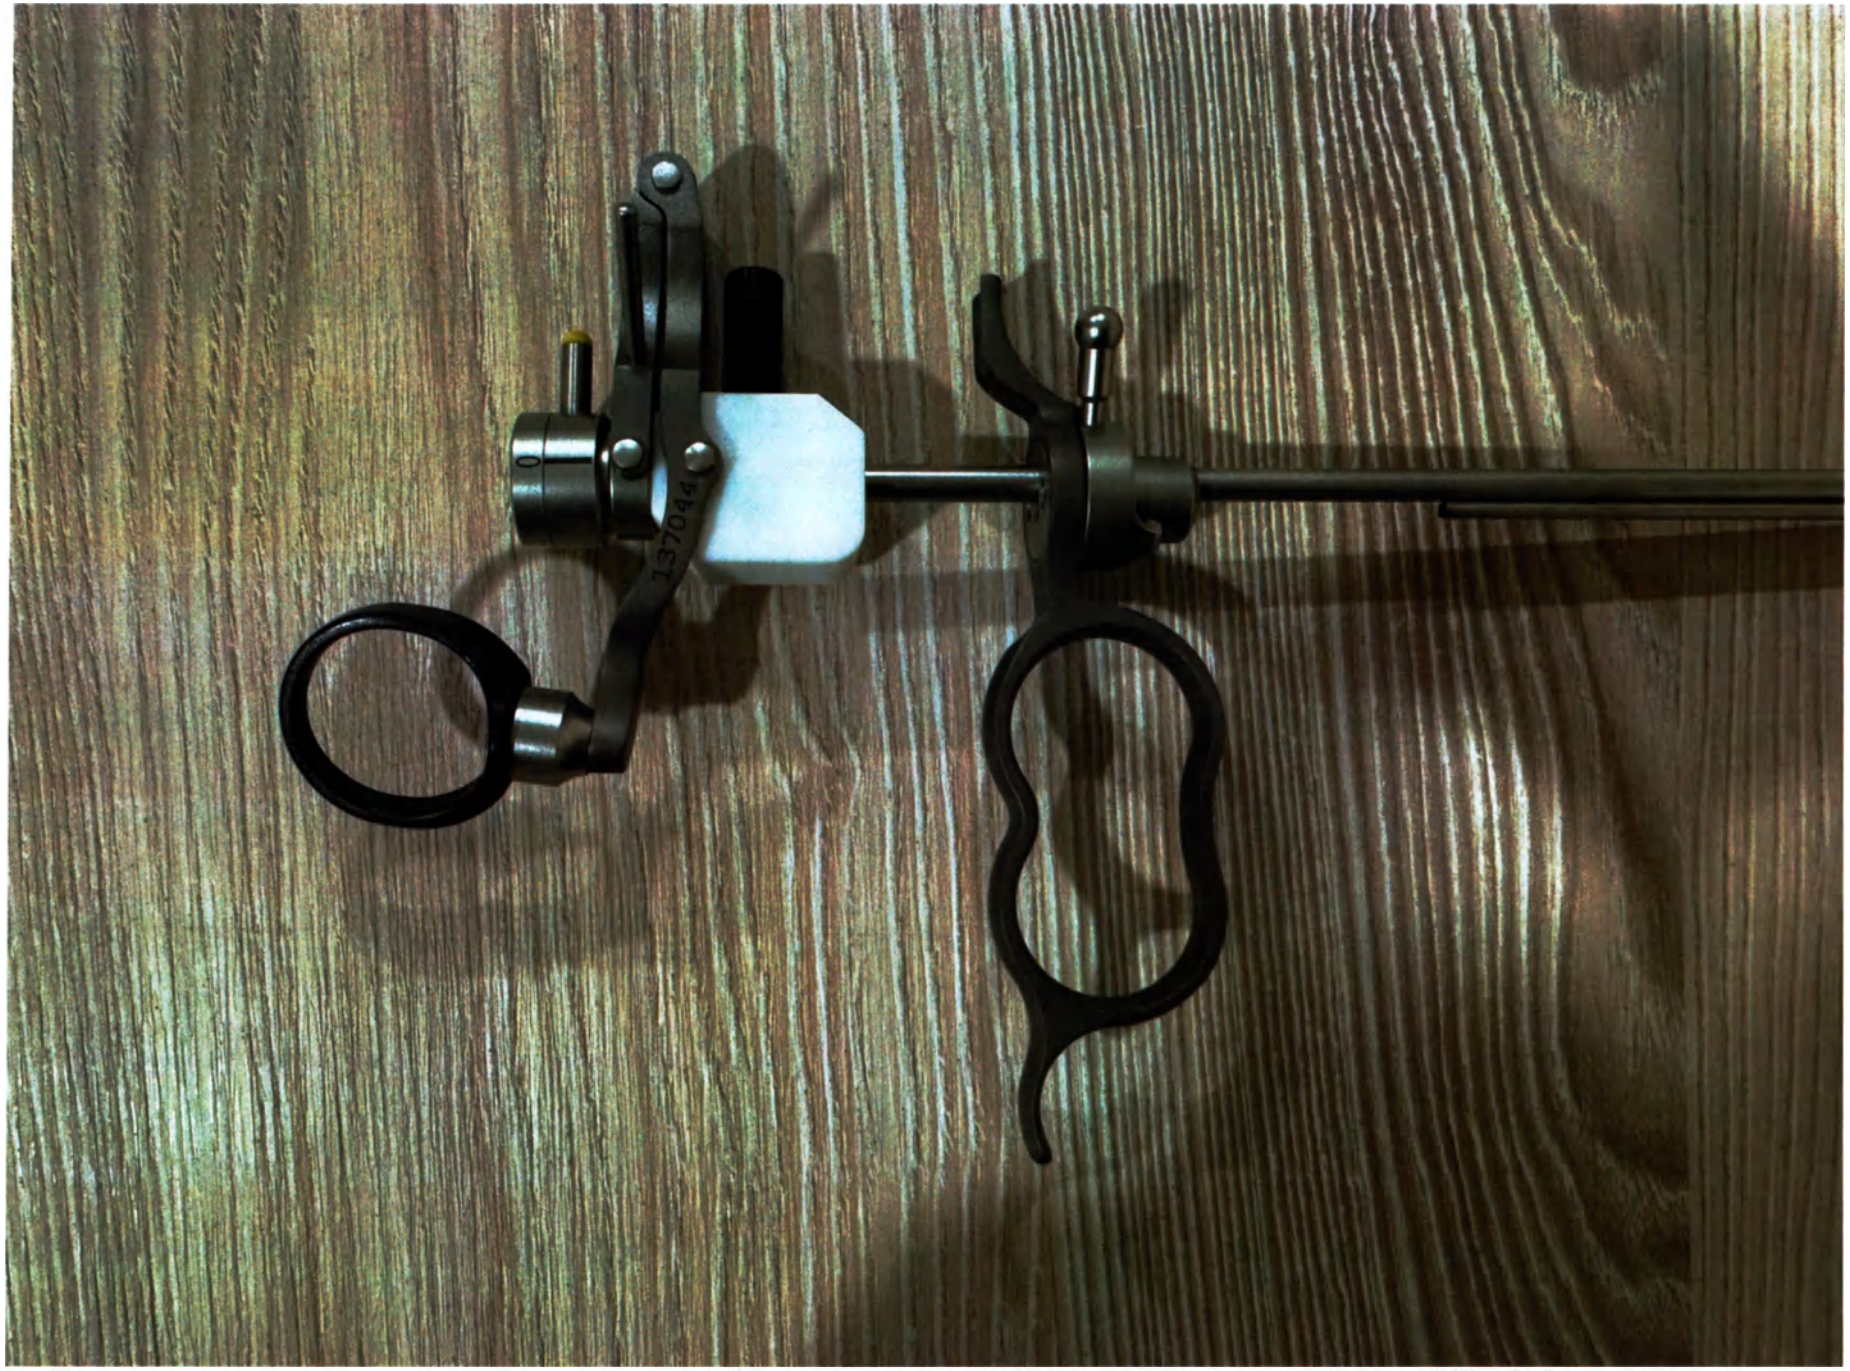


Фото 80. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 22 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 22 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие с инструментальным каналом 26 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 81. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие 22 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 26 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие 22 Шр.; Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие с инструментальным каналом 26 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 82. Общий вид вариантов исполнения: Электрод Вапоризатор 5 мм; Электрод Вапоризатор 3 мм; Электрод Петлевой 0° 22 Шр; Электрод Петлевой 0°; Электрод Петлевой 30° 22 Шр; Электрод Петлевой 30°; Электрод Петлевой 90° 22 Шр; Электрод Петлевой 90°; Электрод усиленный Петлевой 30°; Электрод усиленный Петлевой 30° 22 Шр; Электрод усиленный Петлевой 90°; Электрод Ролик; Электрод Ролик 3 мм 22 Шр; Электрод Ролик шипованный 5 мм; Электрод Ролик шипованный 3 мм; Электрод Шар 5 мм; Электрод Шар 3 мм; Электрод Шар 3 мм 22 Шр; Электрод Плато; Электрод Плато 22 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

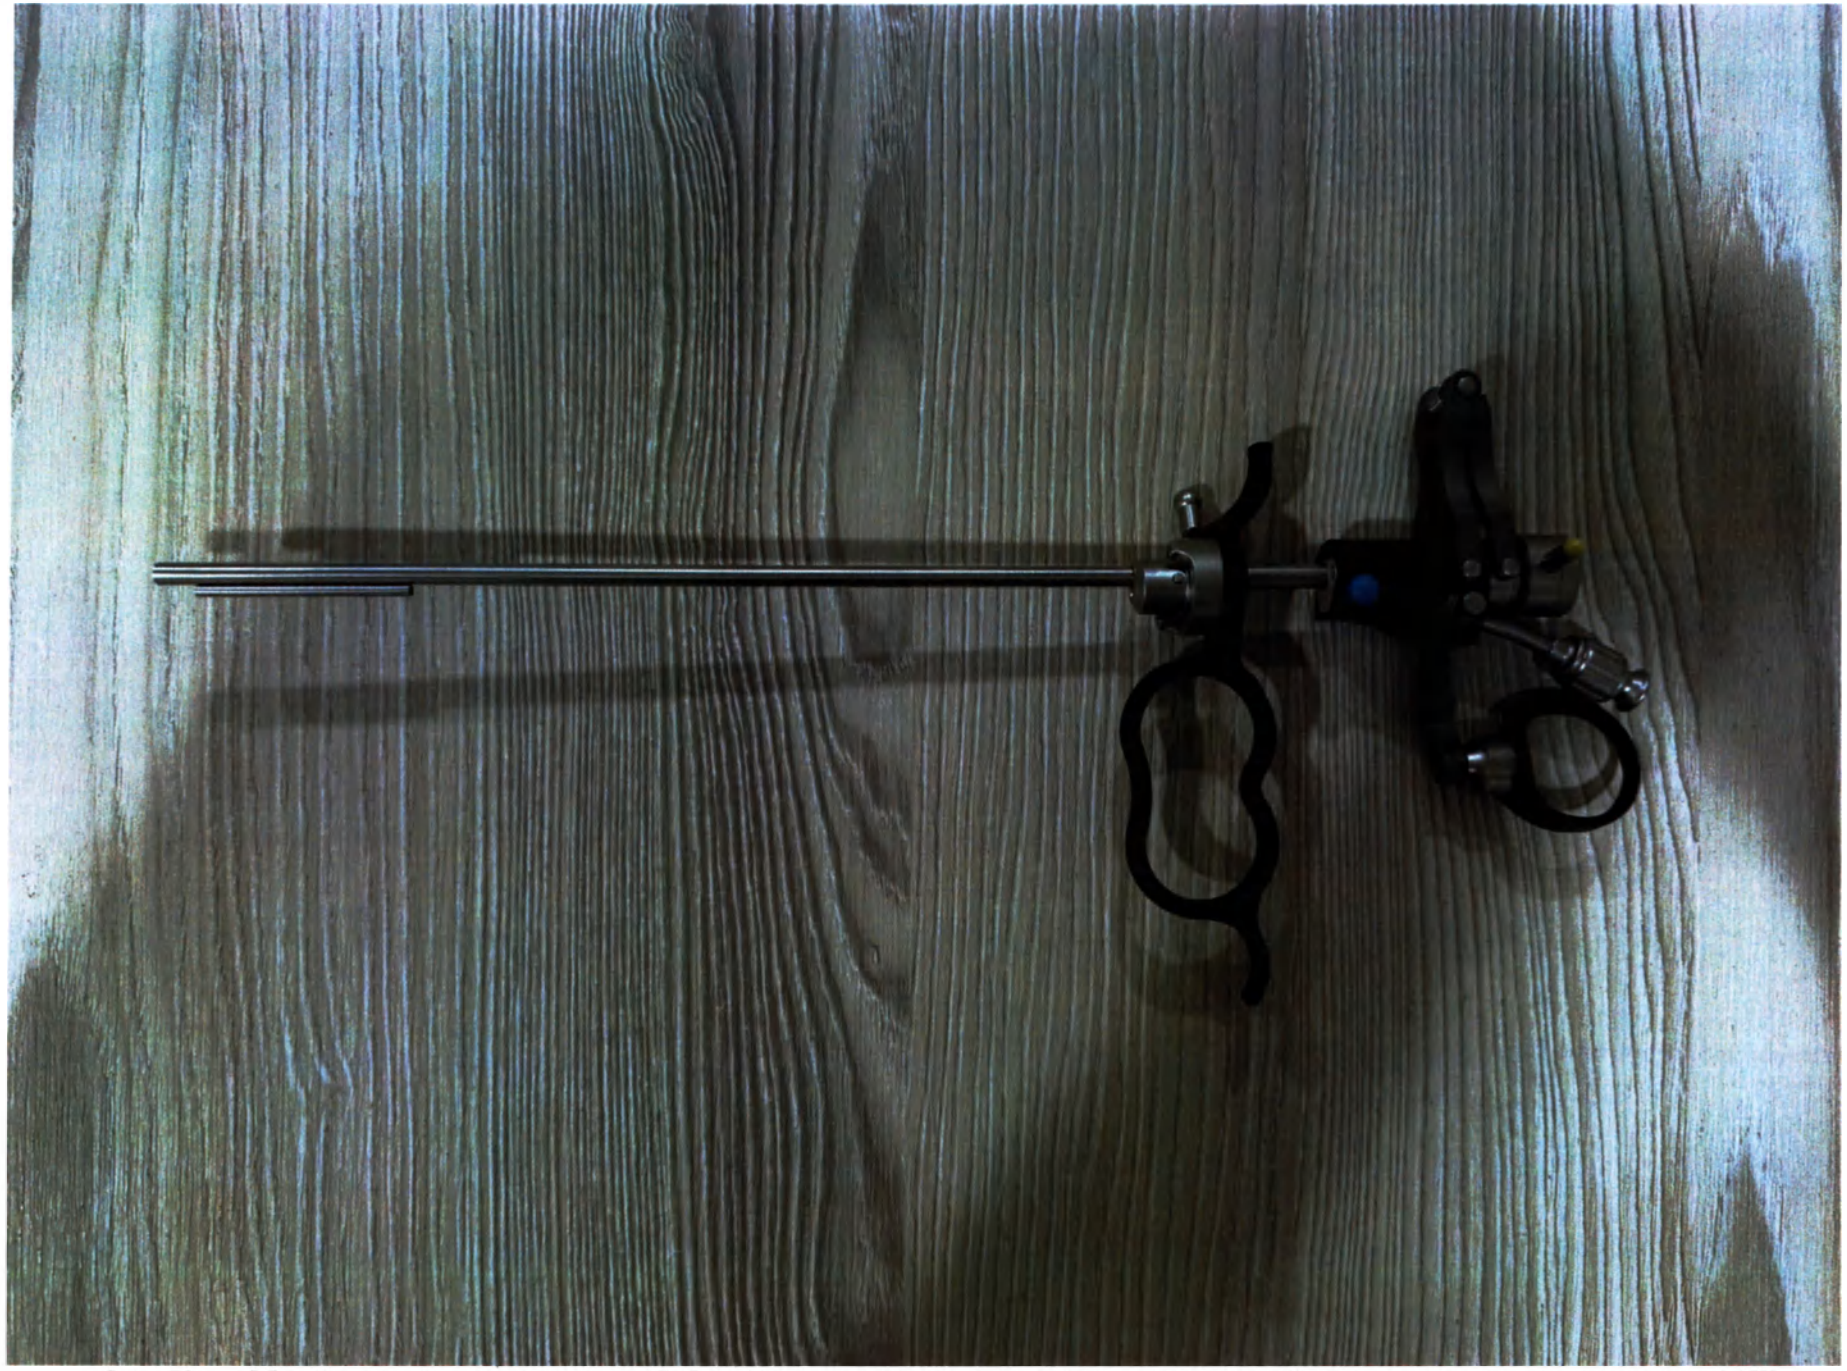


Фото 79. Общий вид вариантов исполнения: Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие с инструментальным каналом 26 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 83. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Электрод Вапоризатор 5 мм; Электрод Вапоризатор 3 мм; Электрод Петлевой 0° 22 Шр; Электрод Петлевой 0°; Электрод Петлевой 30° 22 Шр; Электрод Петлевой 30°; Электрод Петлевой 90° 22 Шр; Электрод Петлевой 90°; Электрод усиленный Петлевой 30°; Электрод усиленный Петлевой 30° 22 Шр; Электрод усиленный Петлевой 90°; Электрод Ролик; Электрод Ролик 3 мм 22 Шр; Электрод Ролик шипованный 5 мм; Электрод Ролик шипованный 3 мм; Электрод Шар 5 мм; Электрод Шар 3 мм; Электрод Шар 3 мм 22 Шр; Электрод Плато; Электрод Плато 22 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 84. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Электрод Вапоризатор 5 мм; Электрод Вапоризатор 3 мм; Электрод Петлевой 0° 22 Шр; Электрод Петлевой 0°; Электрод Петлевой 30° 22 Шр; Электрод Петлевой 30°; Электрод Петлевой 90° 22 Шр; Электрод Петлевой 90°; Электрод усиленный Петлевой 30°; Электрод усиленный Петлевой 30° 22 Шр; Электрод усиленный Петлевой 90°; Электрод Ролик; Электрод Ролик 3 мм 22 Шр; Электрод Ролик шипованный 5 мм; Электрод Ролик шипованный 3 мм; Электрод Шар 5 мм; Электрод Шар 3 мм; Электрод Шар 3 мм 22 Шр; Электрод Плато; Электрод Плато 22 Шр.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

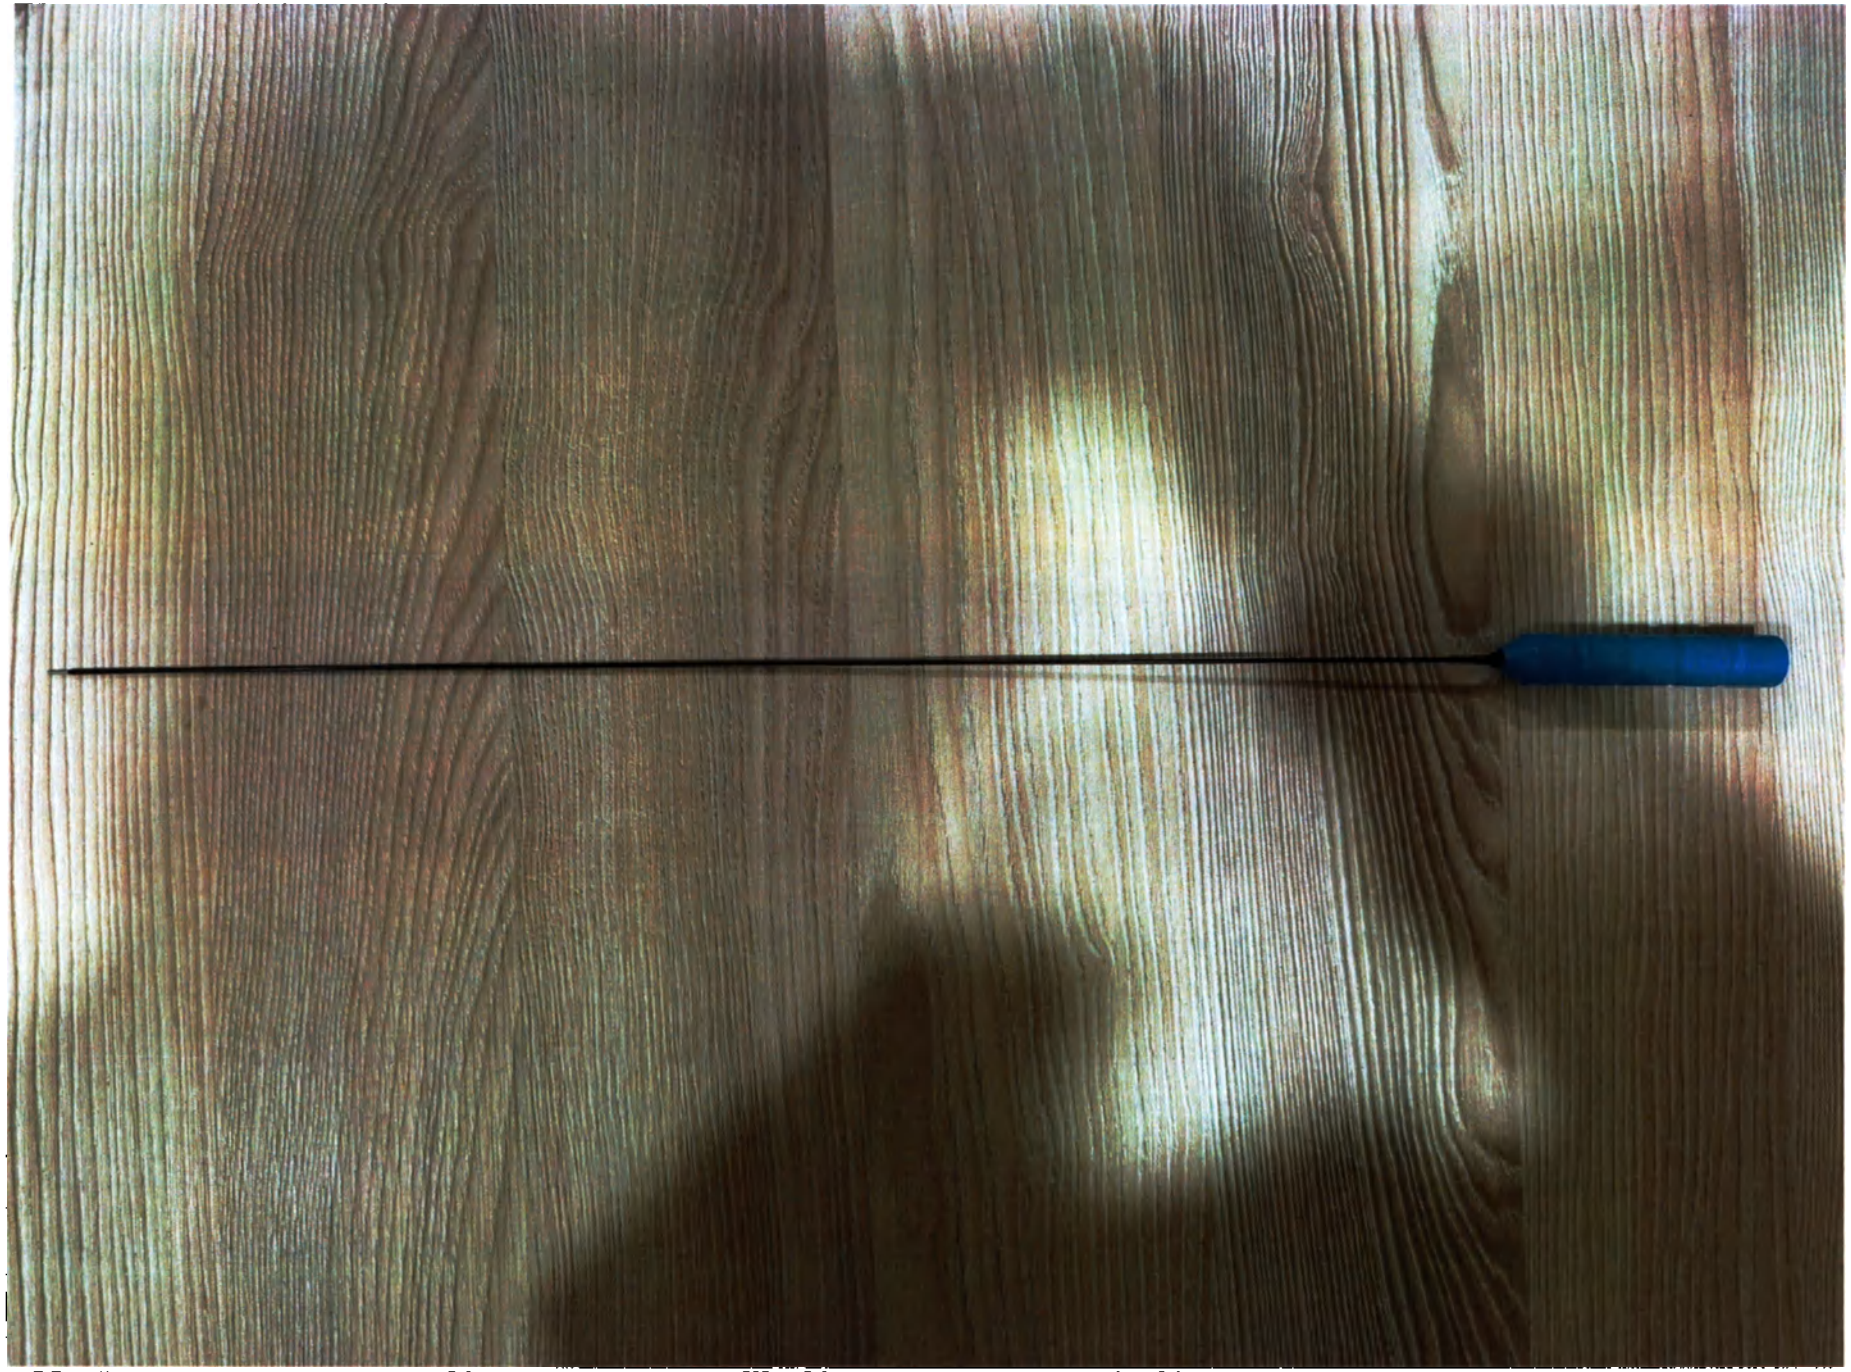


Фото 85. **Общий вид вариантов исполнения: Сферический электрод, 5 Шр; Сферический электрод, 6 Шр; Сферический электрод, 3 мм; Прямой игольчатый электрод, 5 Шр; Прямой игольчатый электрод, 6 Шр; Прямой игольчатый электрод, 3 мм; L-образный электрод, 3 мм**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

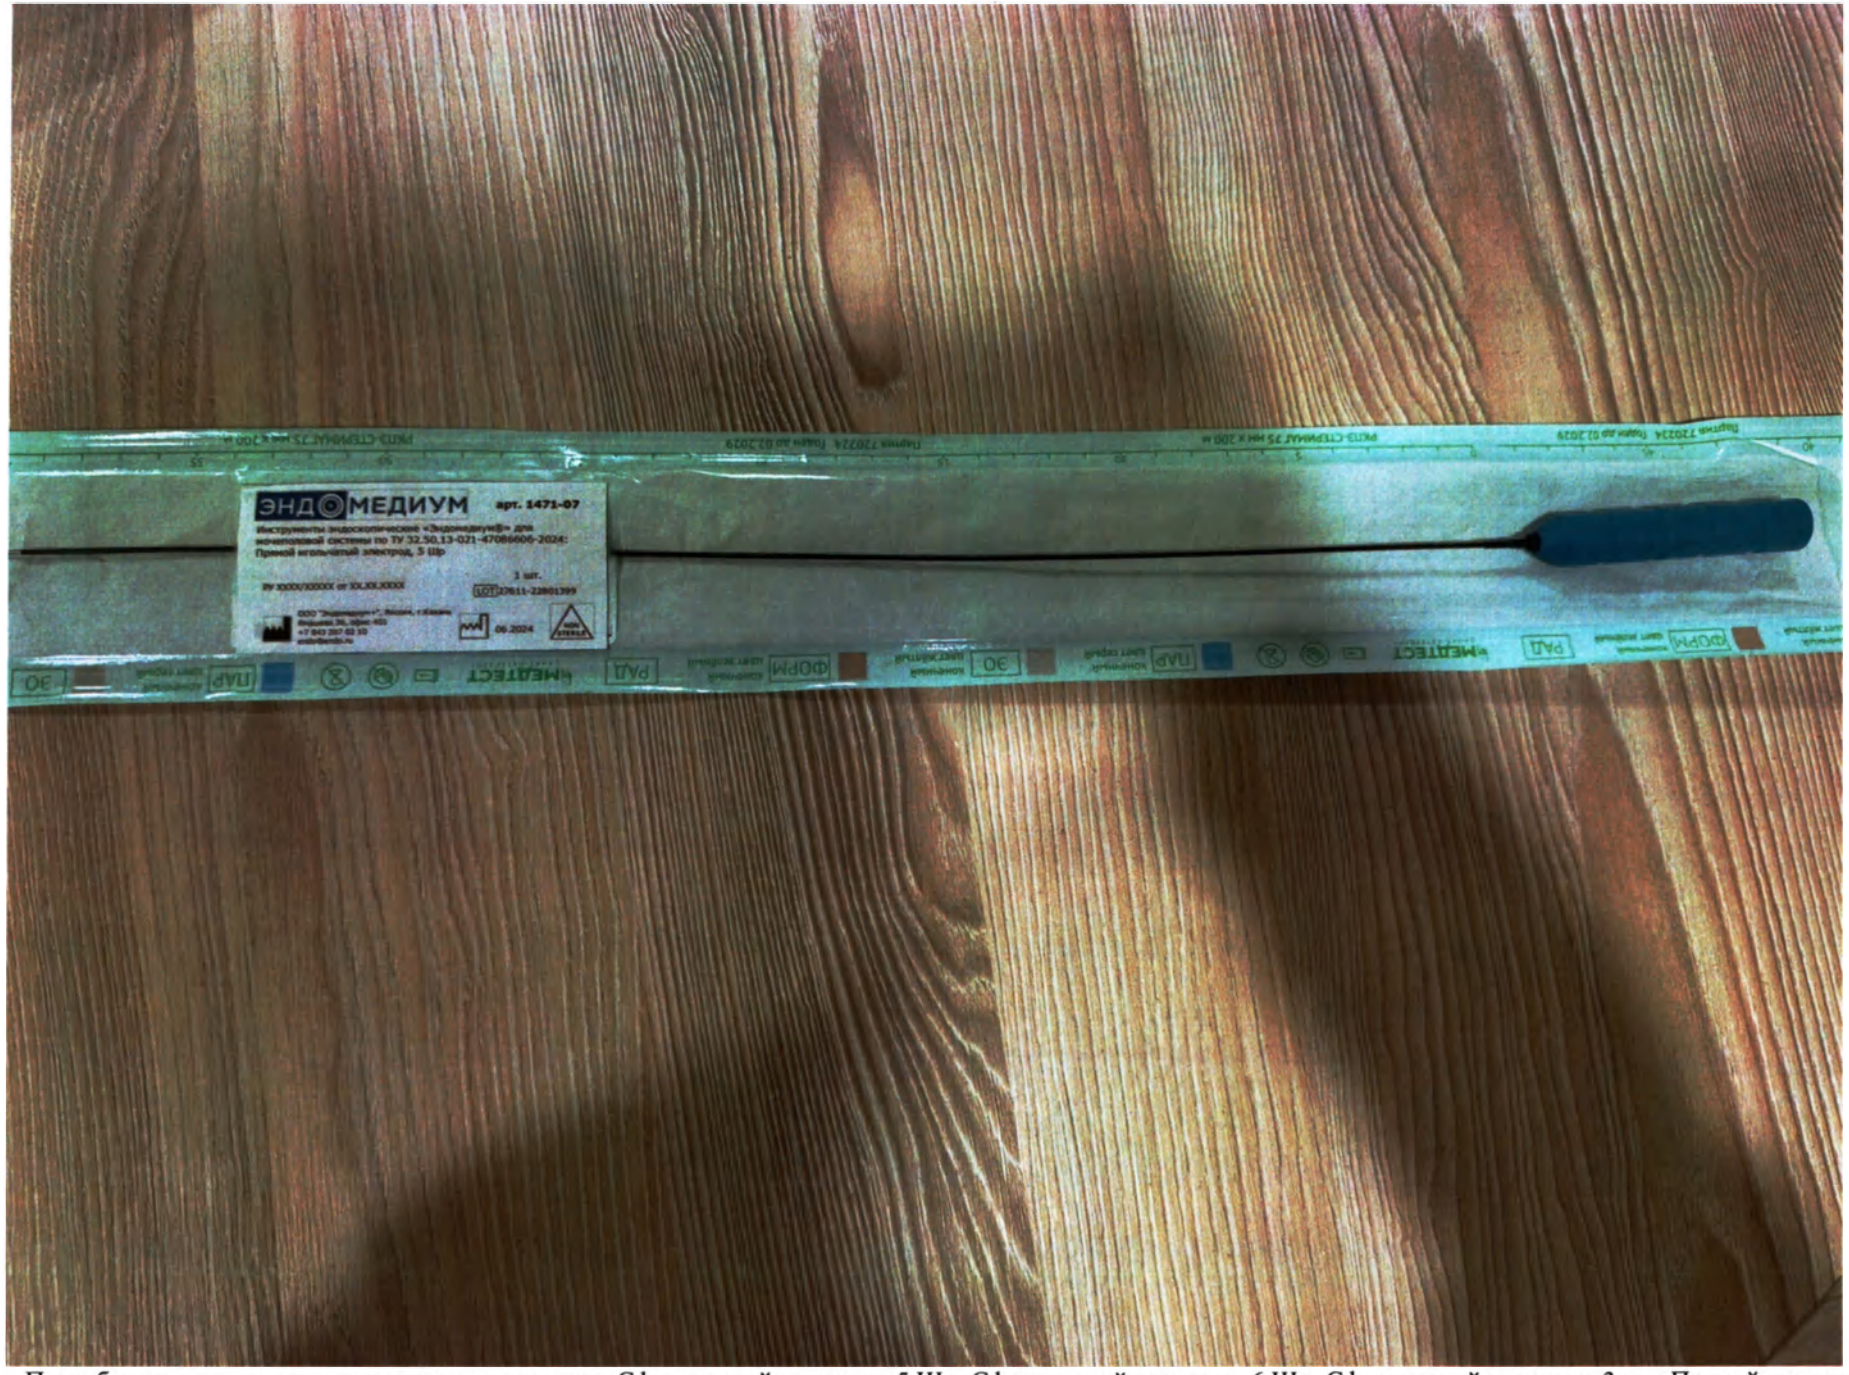


Фото 86. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Сферический электрод, 5 Шр; Сферический электрод, 6 Шр; Сферический электрод, 3 мм; Прямой игольчатый электрод, 5 Шр; Прямой игольчатый электрод, 6 Шр; Прямой игольчатый электрод, 3 мм; L-образный электрод, 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 87. Общий вид вариантов исполнения: Электрод Петля, 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 88. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Электрод Петля, 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

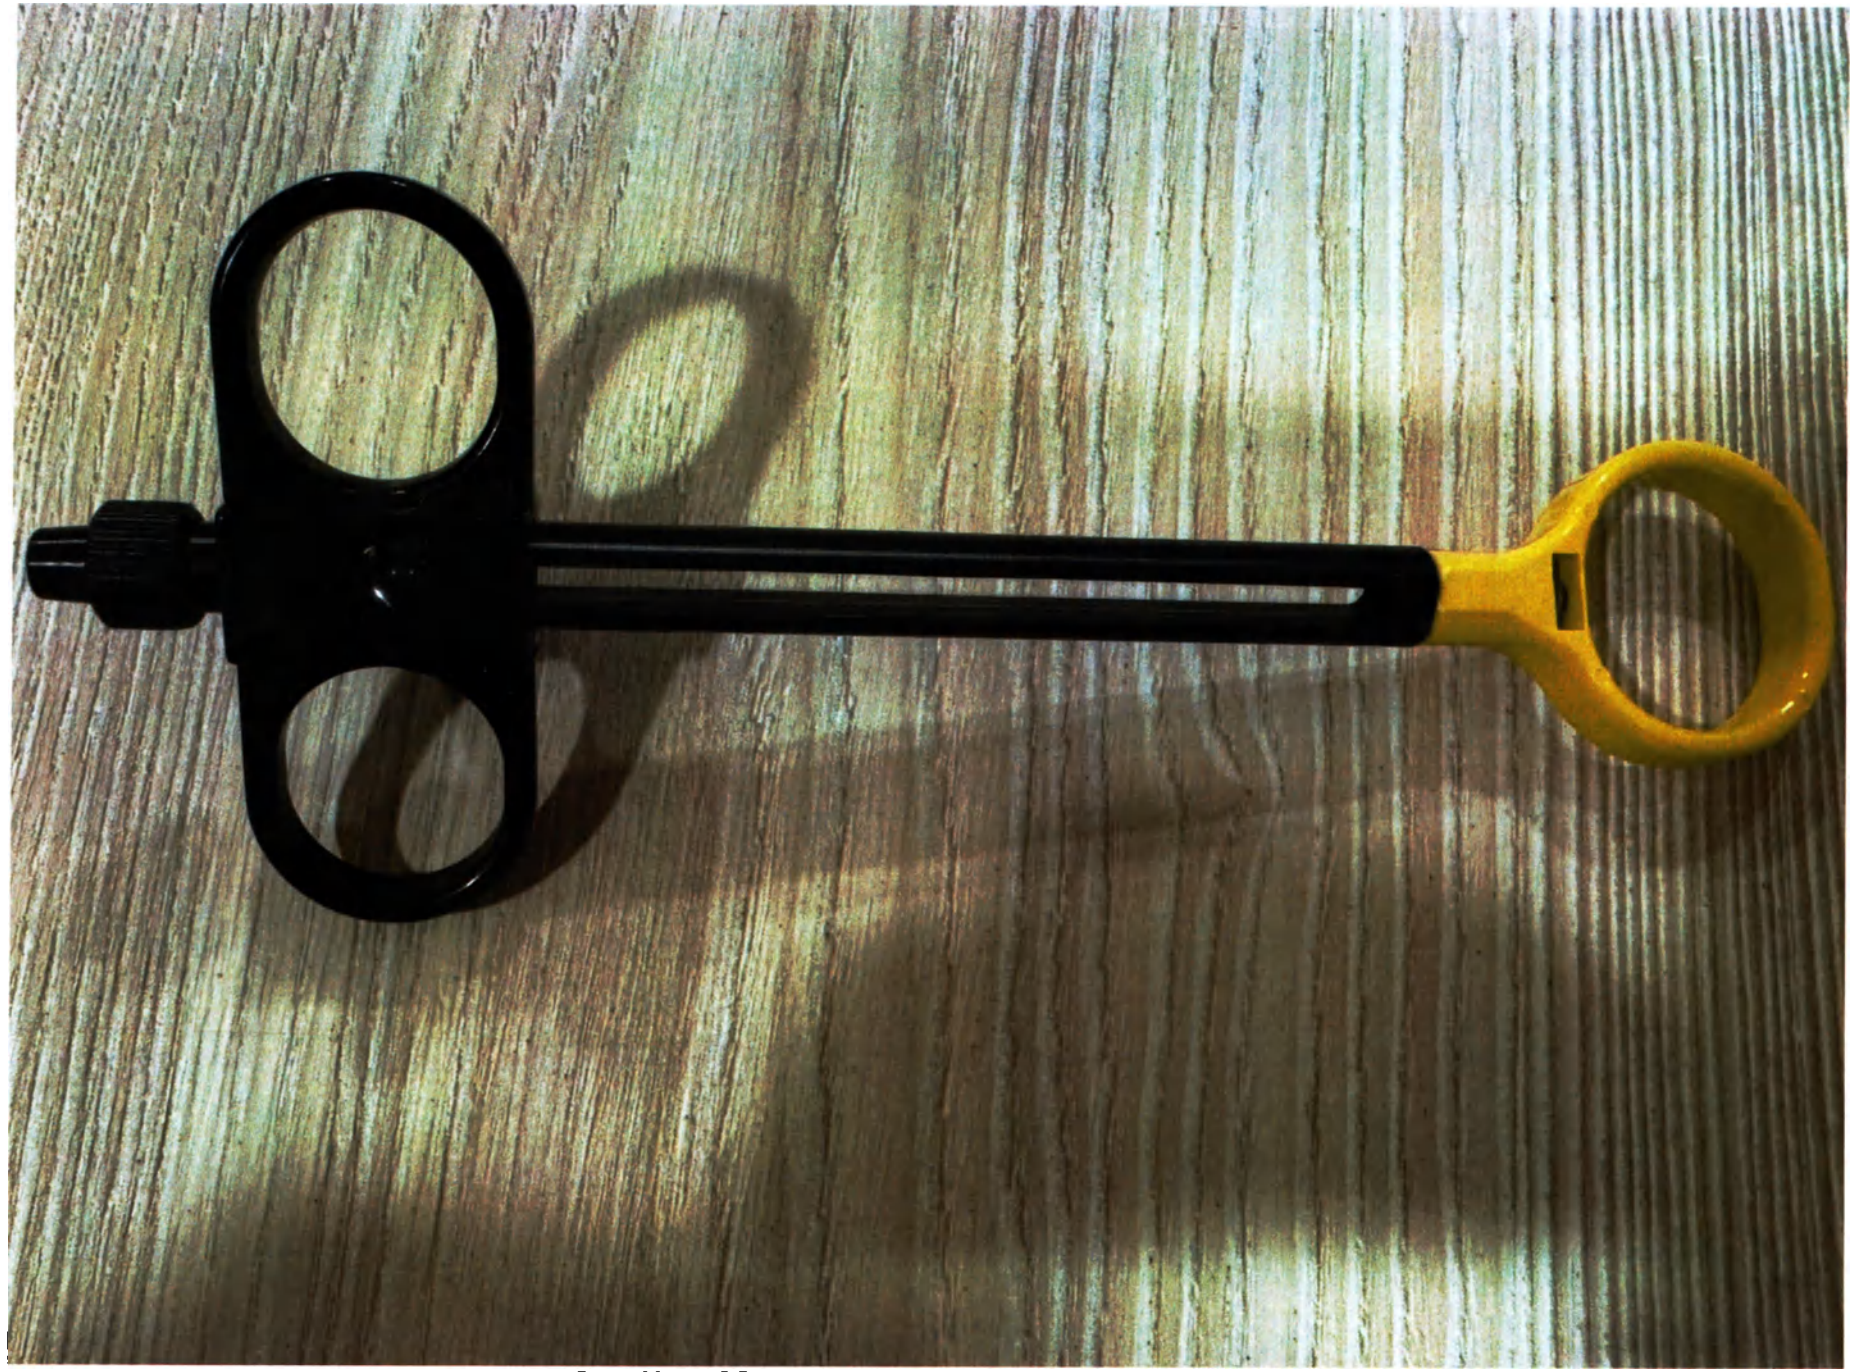


Фото 89. Общий вид вариантов исполнения: Рукоятка к петлям

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 90. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Рукоятка к петлям

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

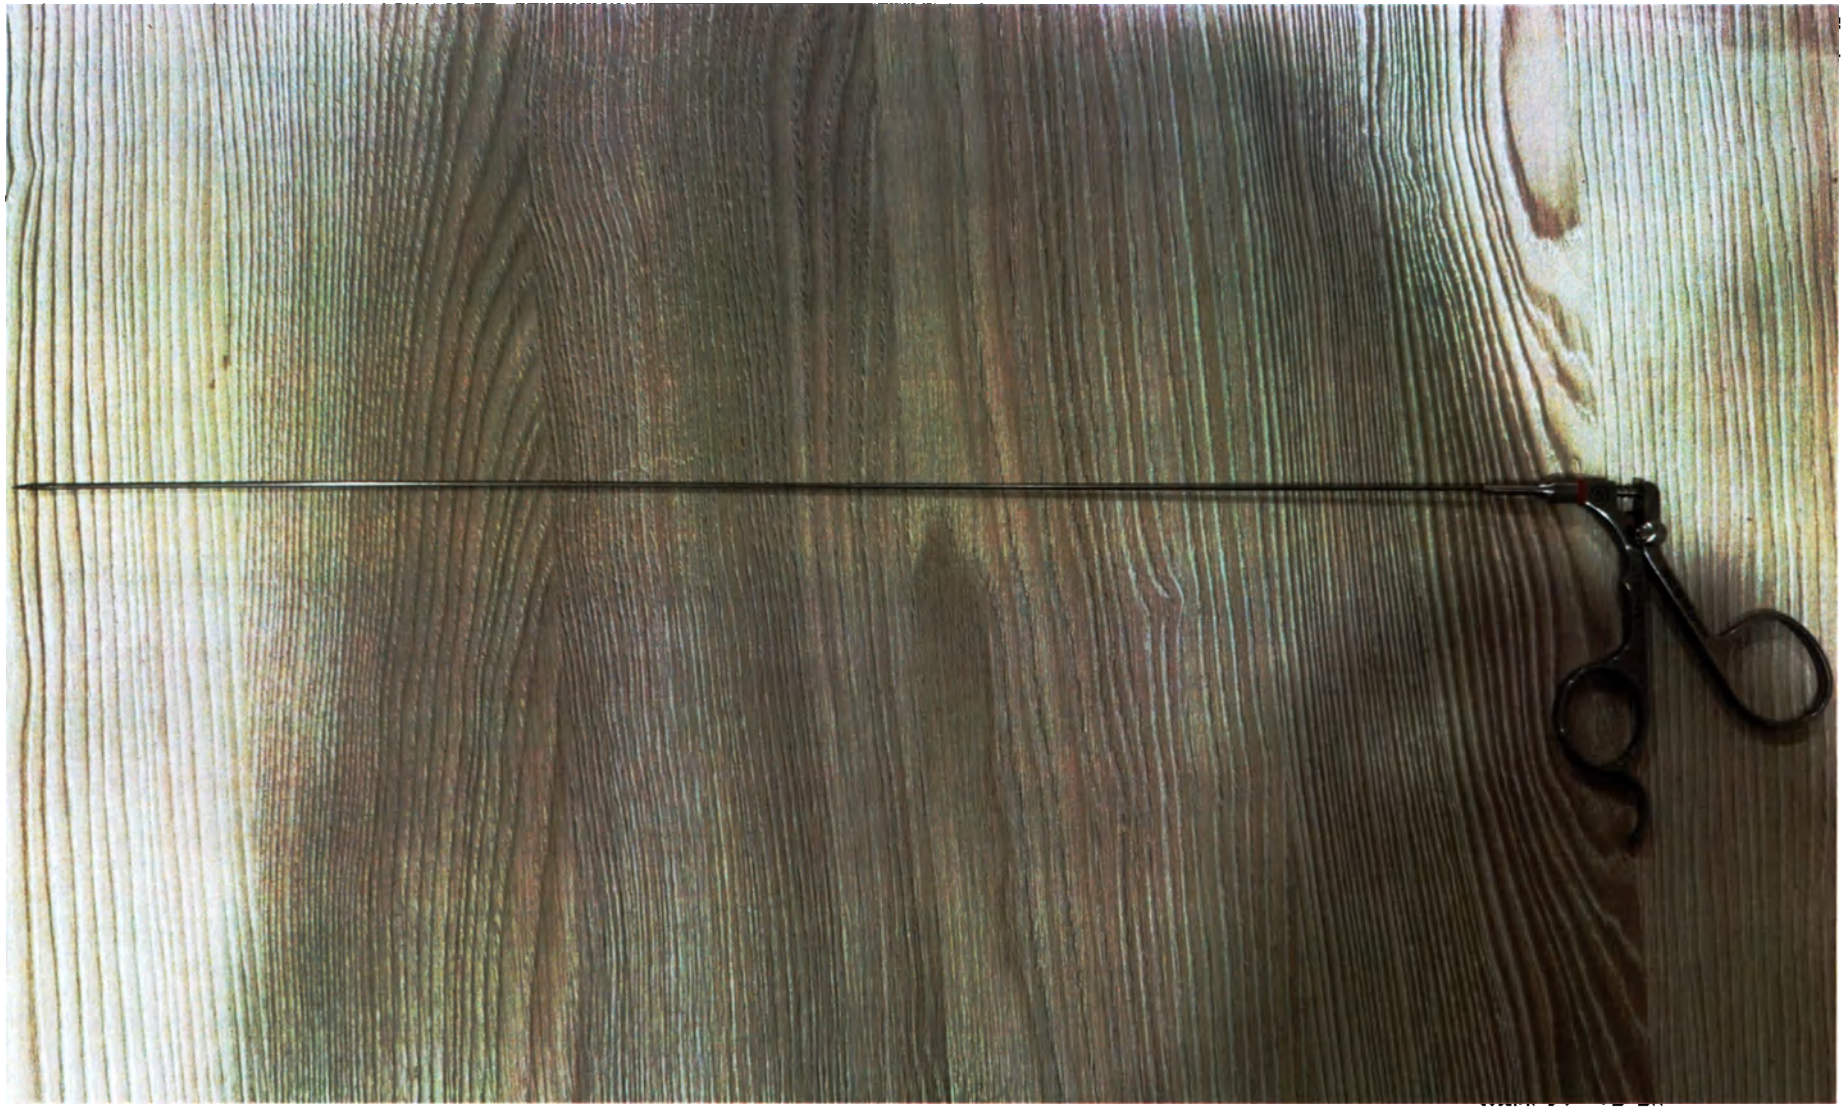


Фото 91. Общий вид вариантов исполнения: Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 40 см ; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 60 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 92. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 40 см ; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 60 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 93. Общий вид вариантов исполнения: Ножницы однобраншевые 3 мм, Ножницы двухбраншевые 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

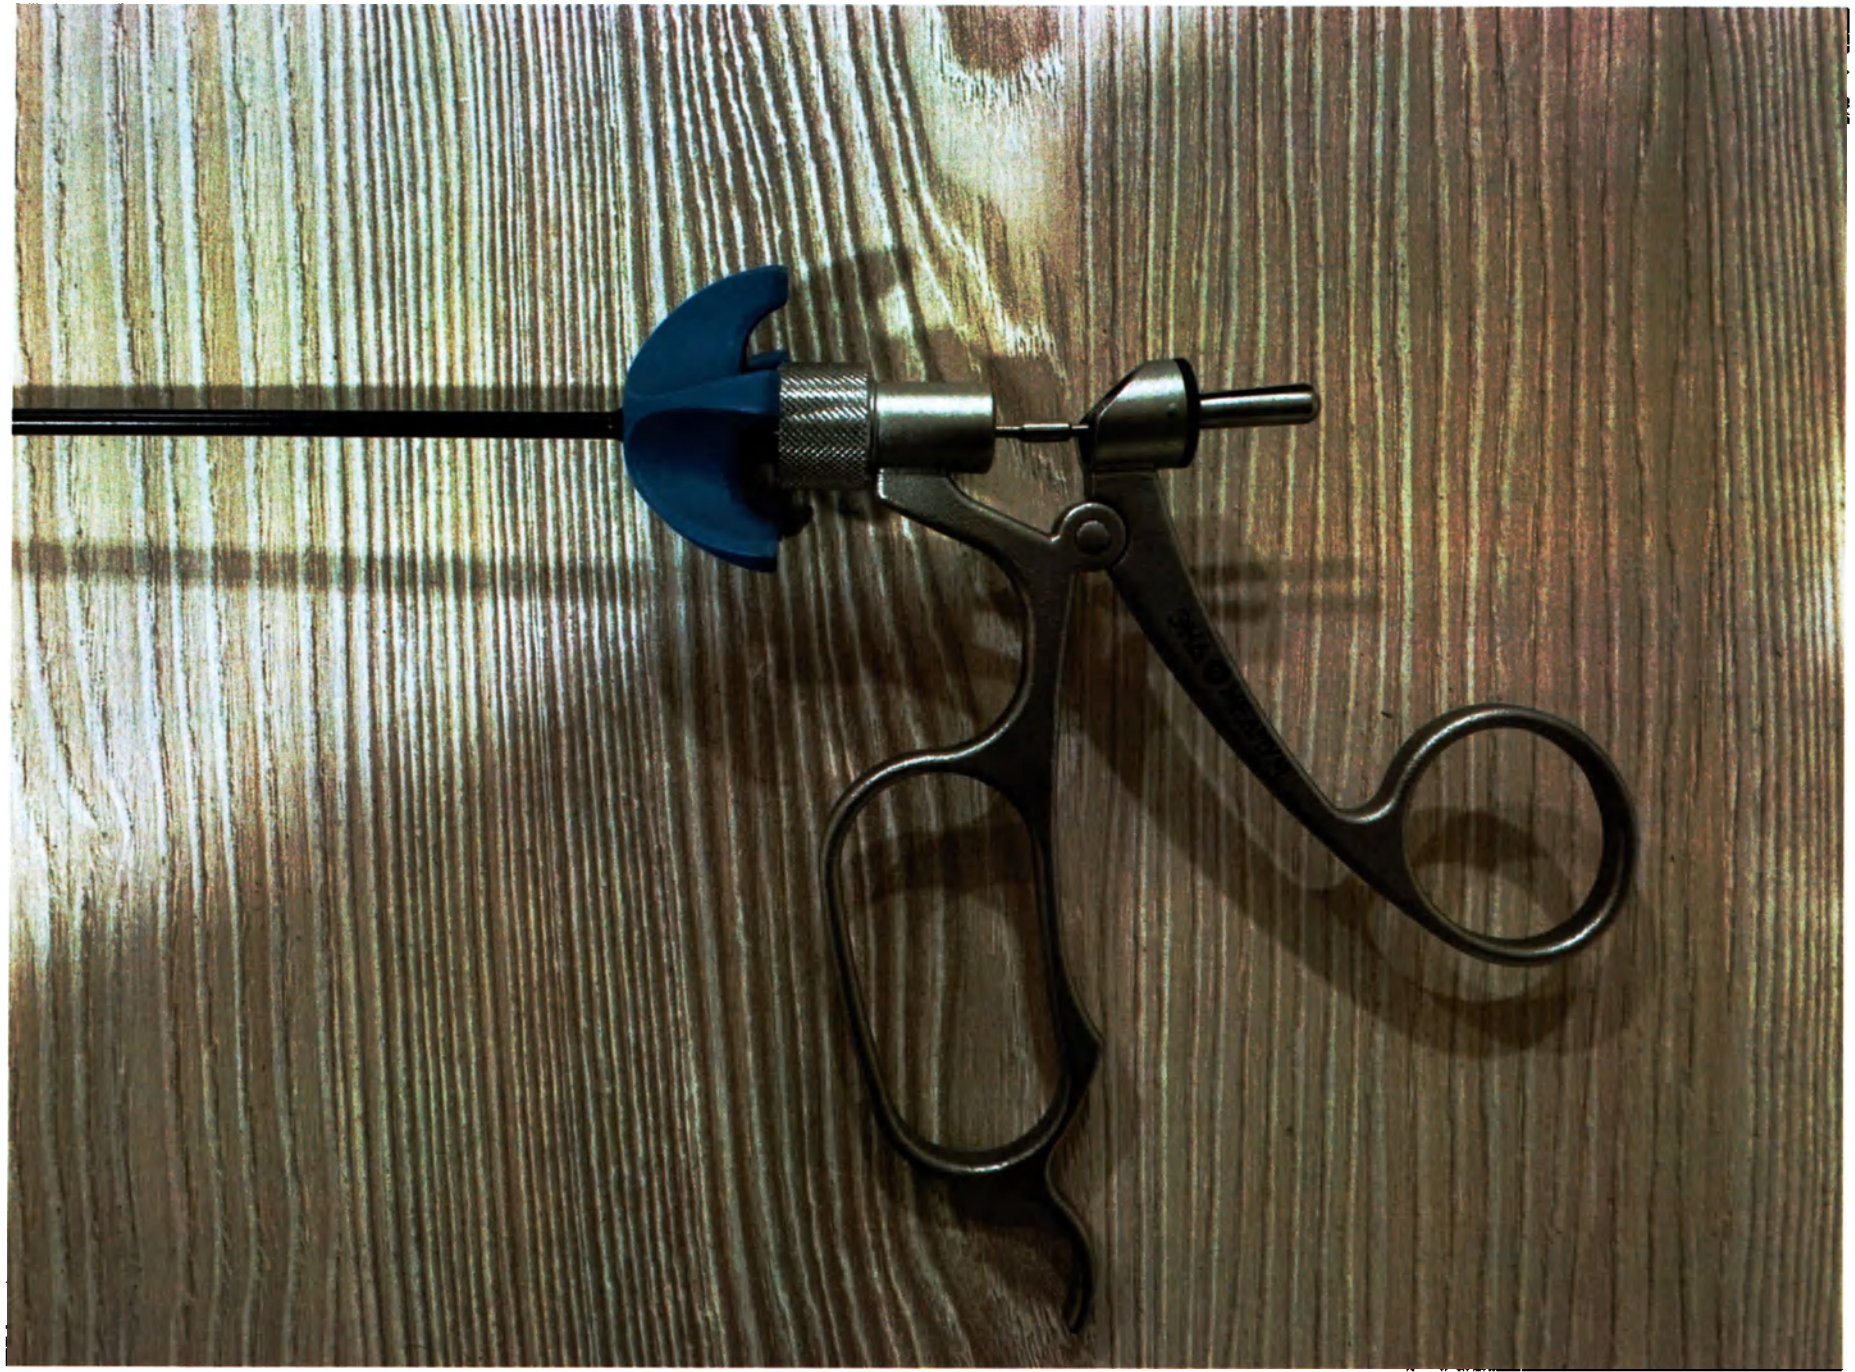


Фото 94. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Ножницы однобраншевые 3 мм, Ножницы двухбраншевые 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

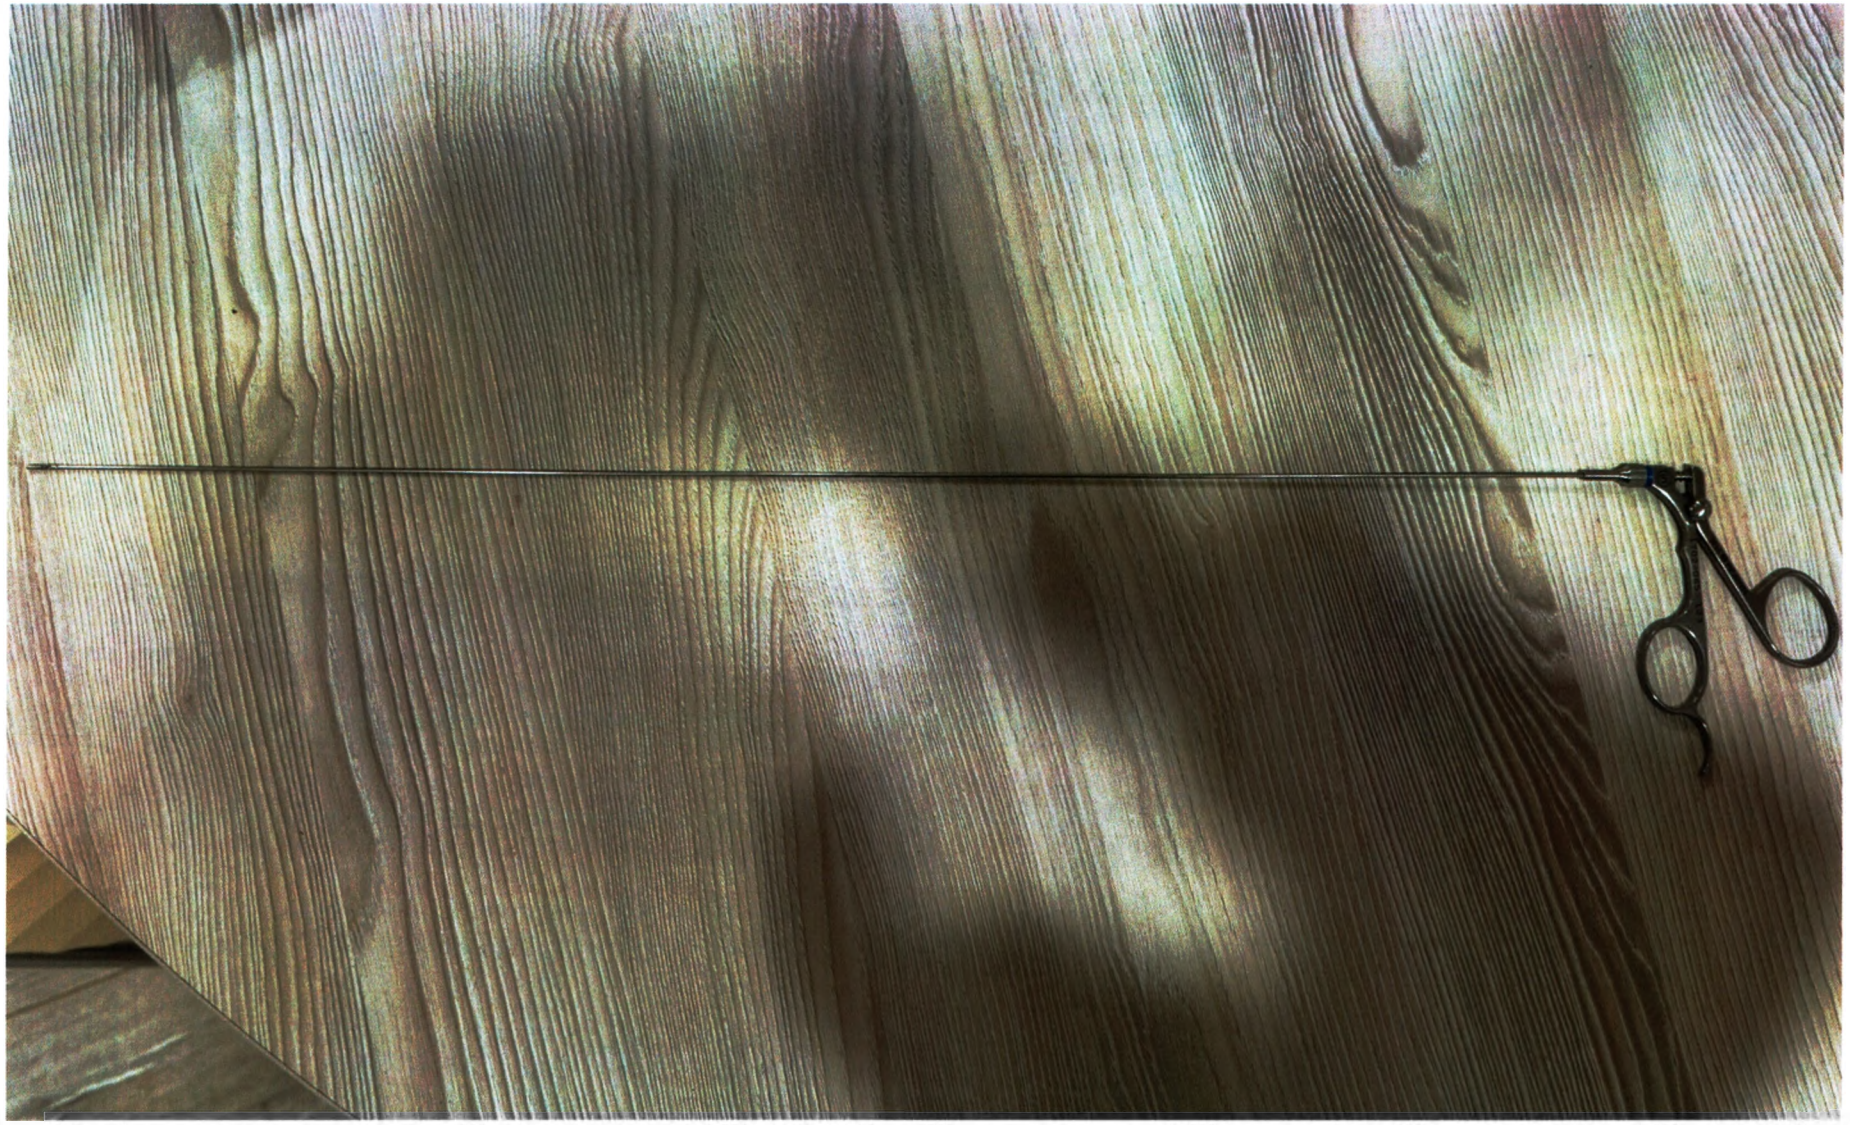


Фото 95. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы для захвата, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 96. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы для захвата, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 7 Шр, длина 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 97. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы для изалечения, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для изалечения, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 98. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы для извлечения, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

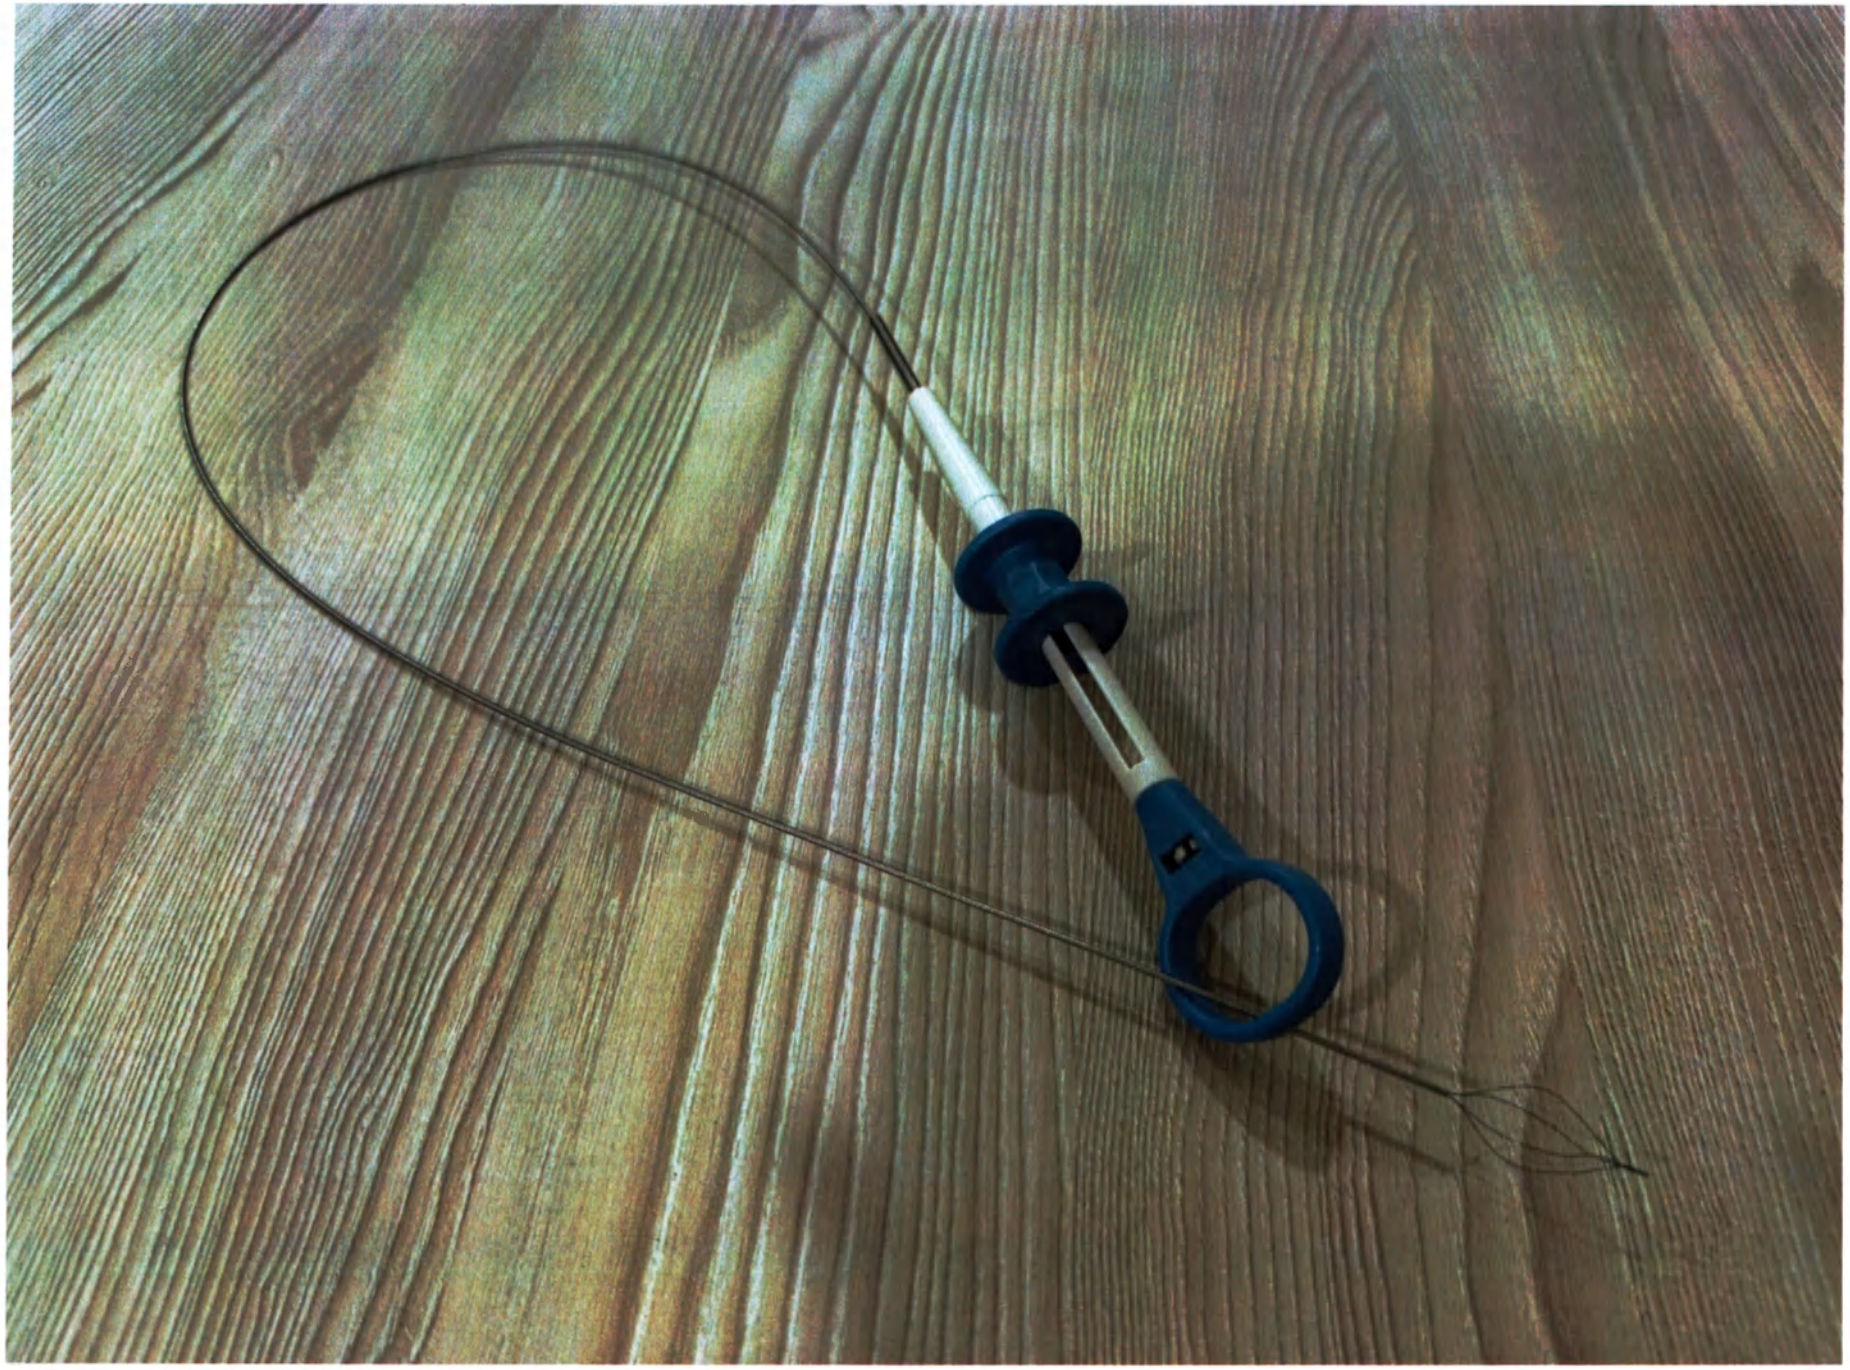


Фото 99. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы для извлечения корзинка, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения корзинка, 5 Шр, длина 60 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 100. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

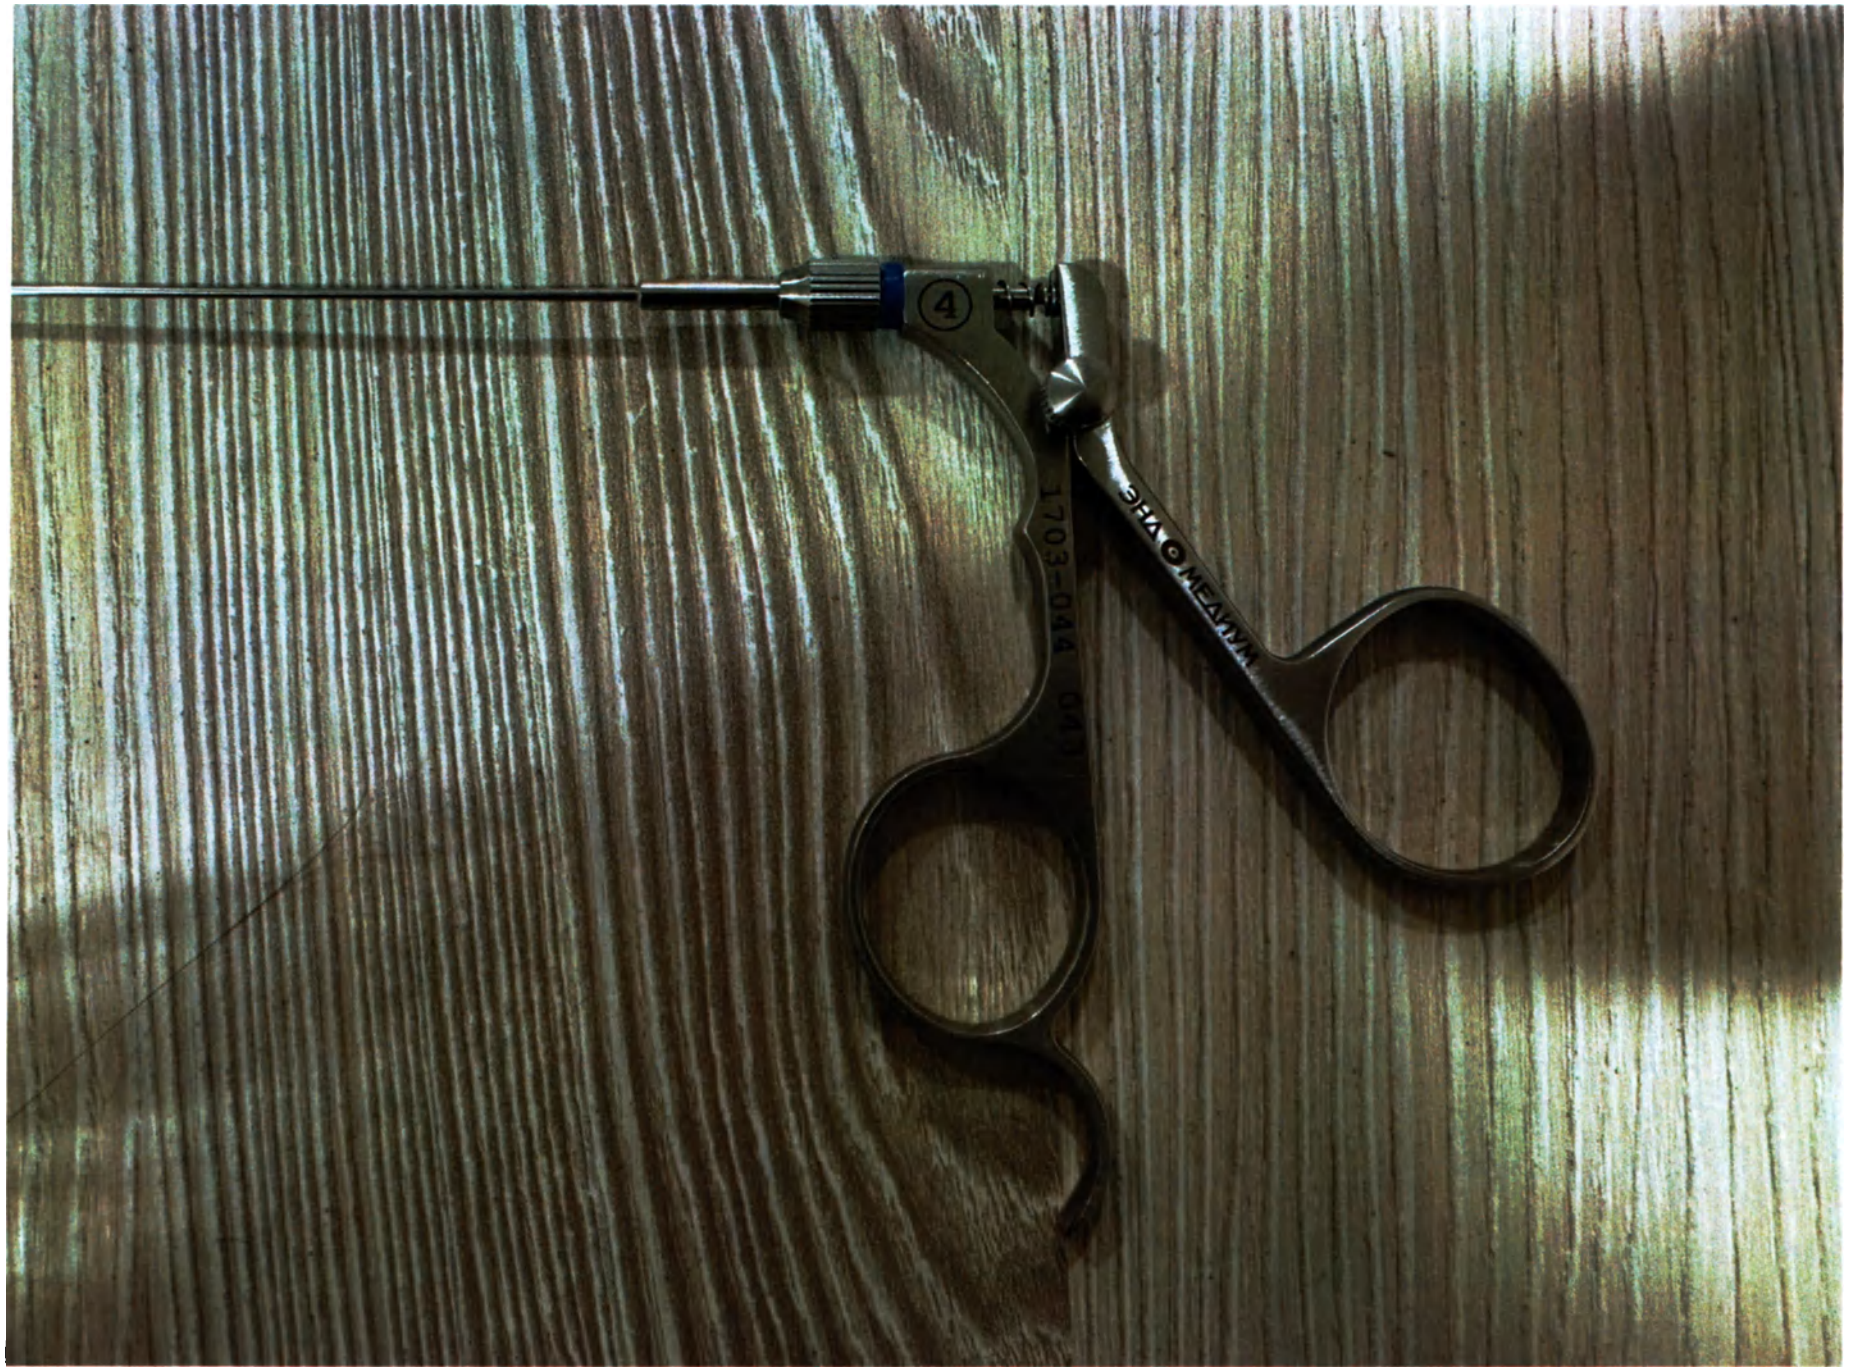


Фото 101. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 60 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 102. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы двухбраншевые для захвата, 3 мм, Щипцы однобраншевые для захвата, 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

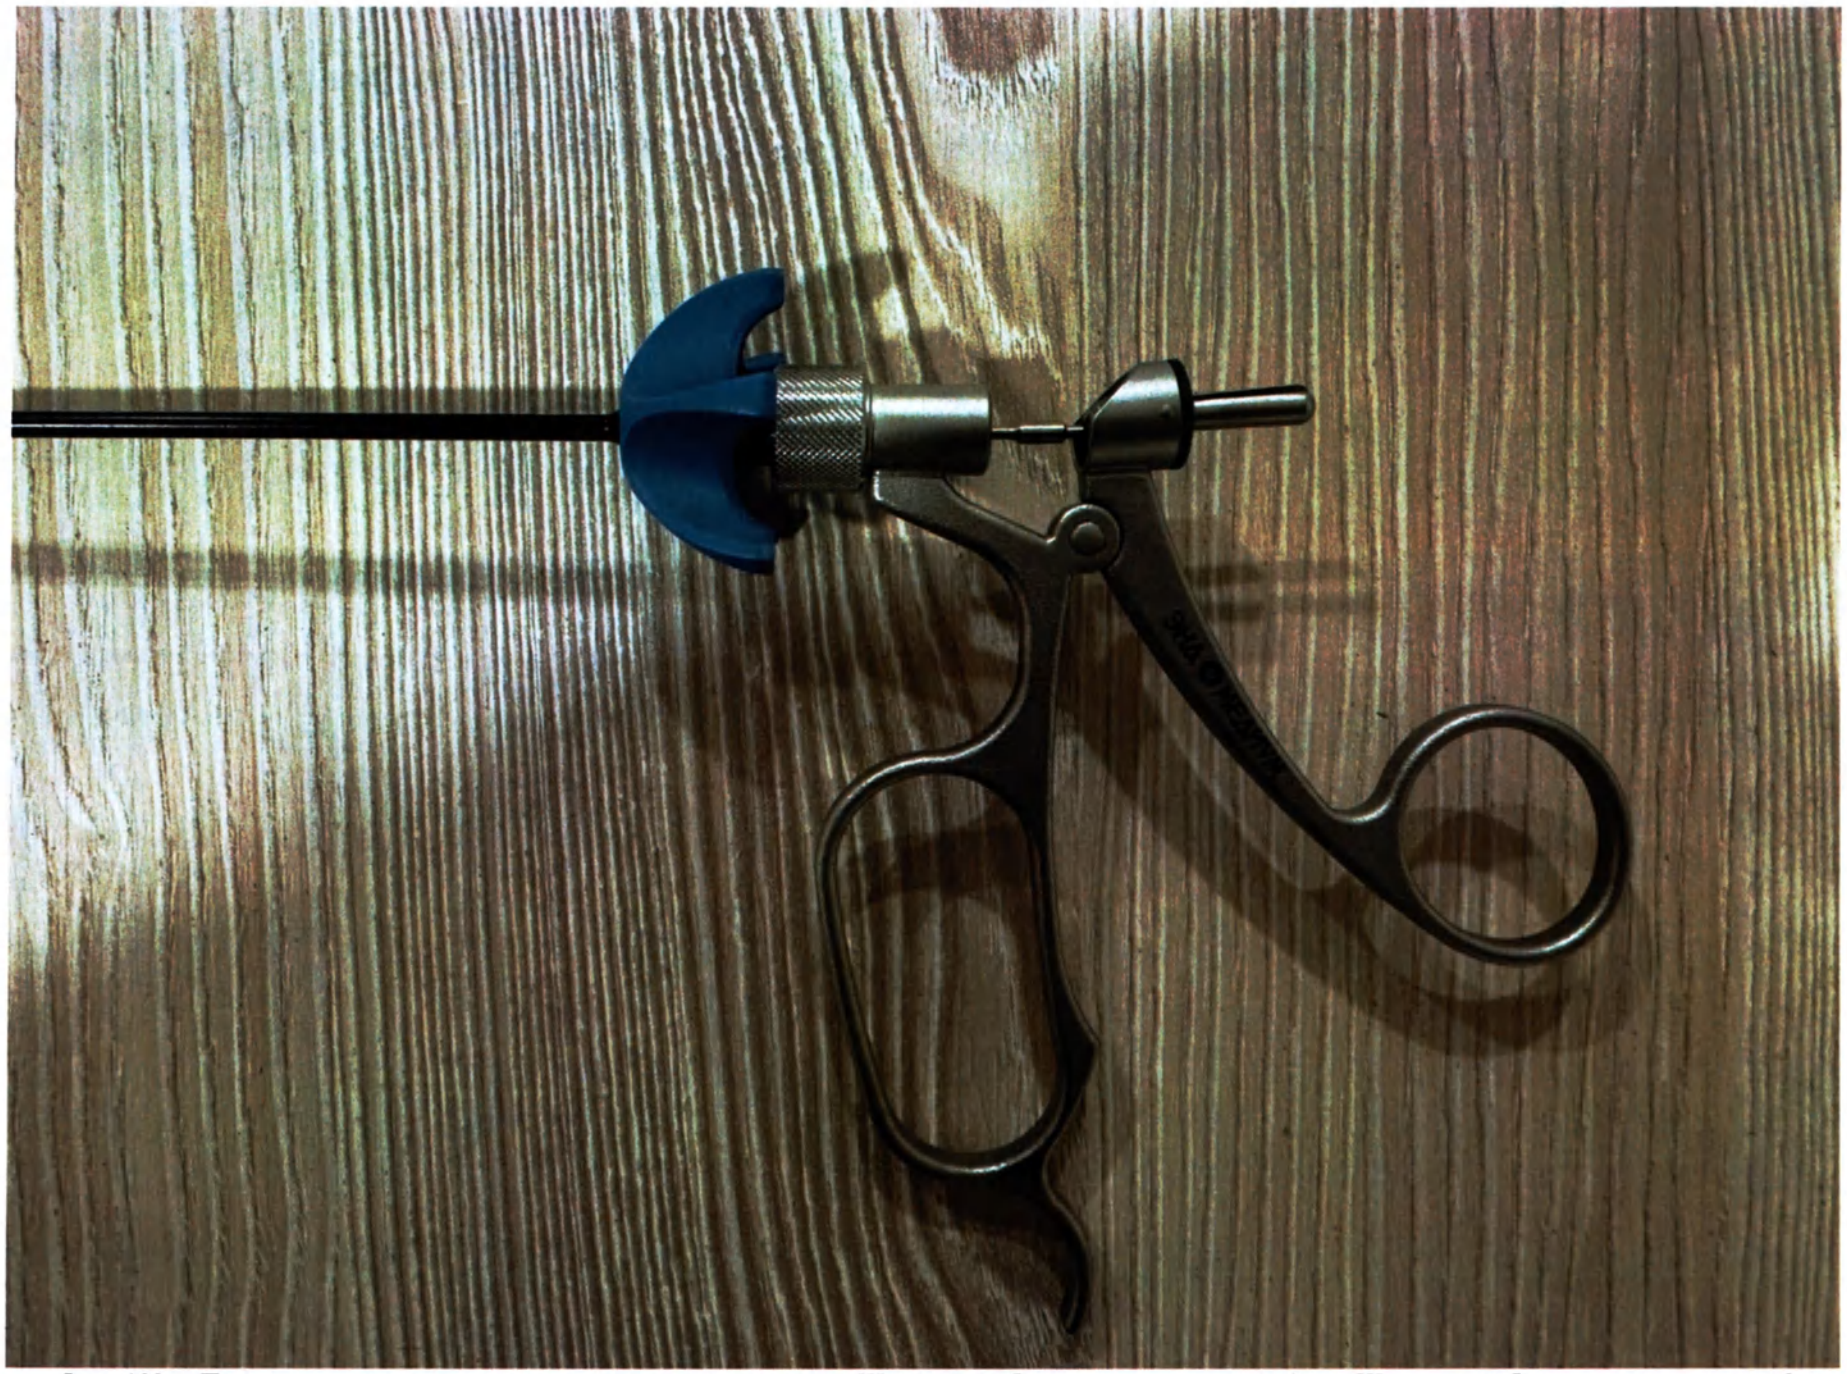


Фото 103. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы двухбраншевые для захвата, 3 мм, Щипцы однобраншевые для захвата, 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 104. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы для захвата с окончатыми браншами, 9 Шр, Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 9 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

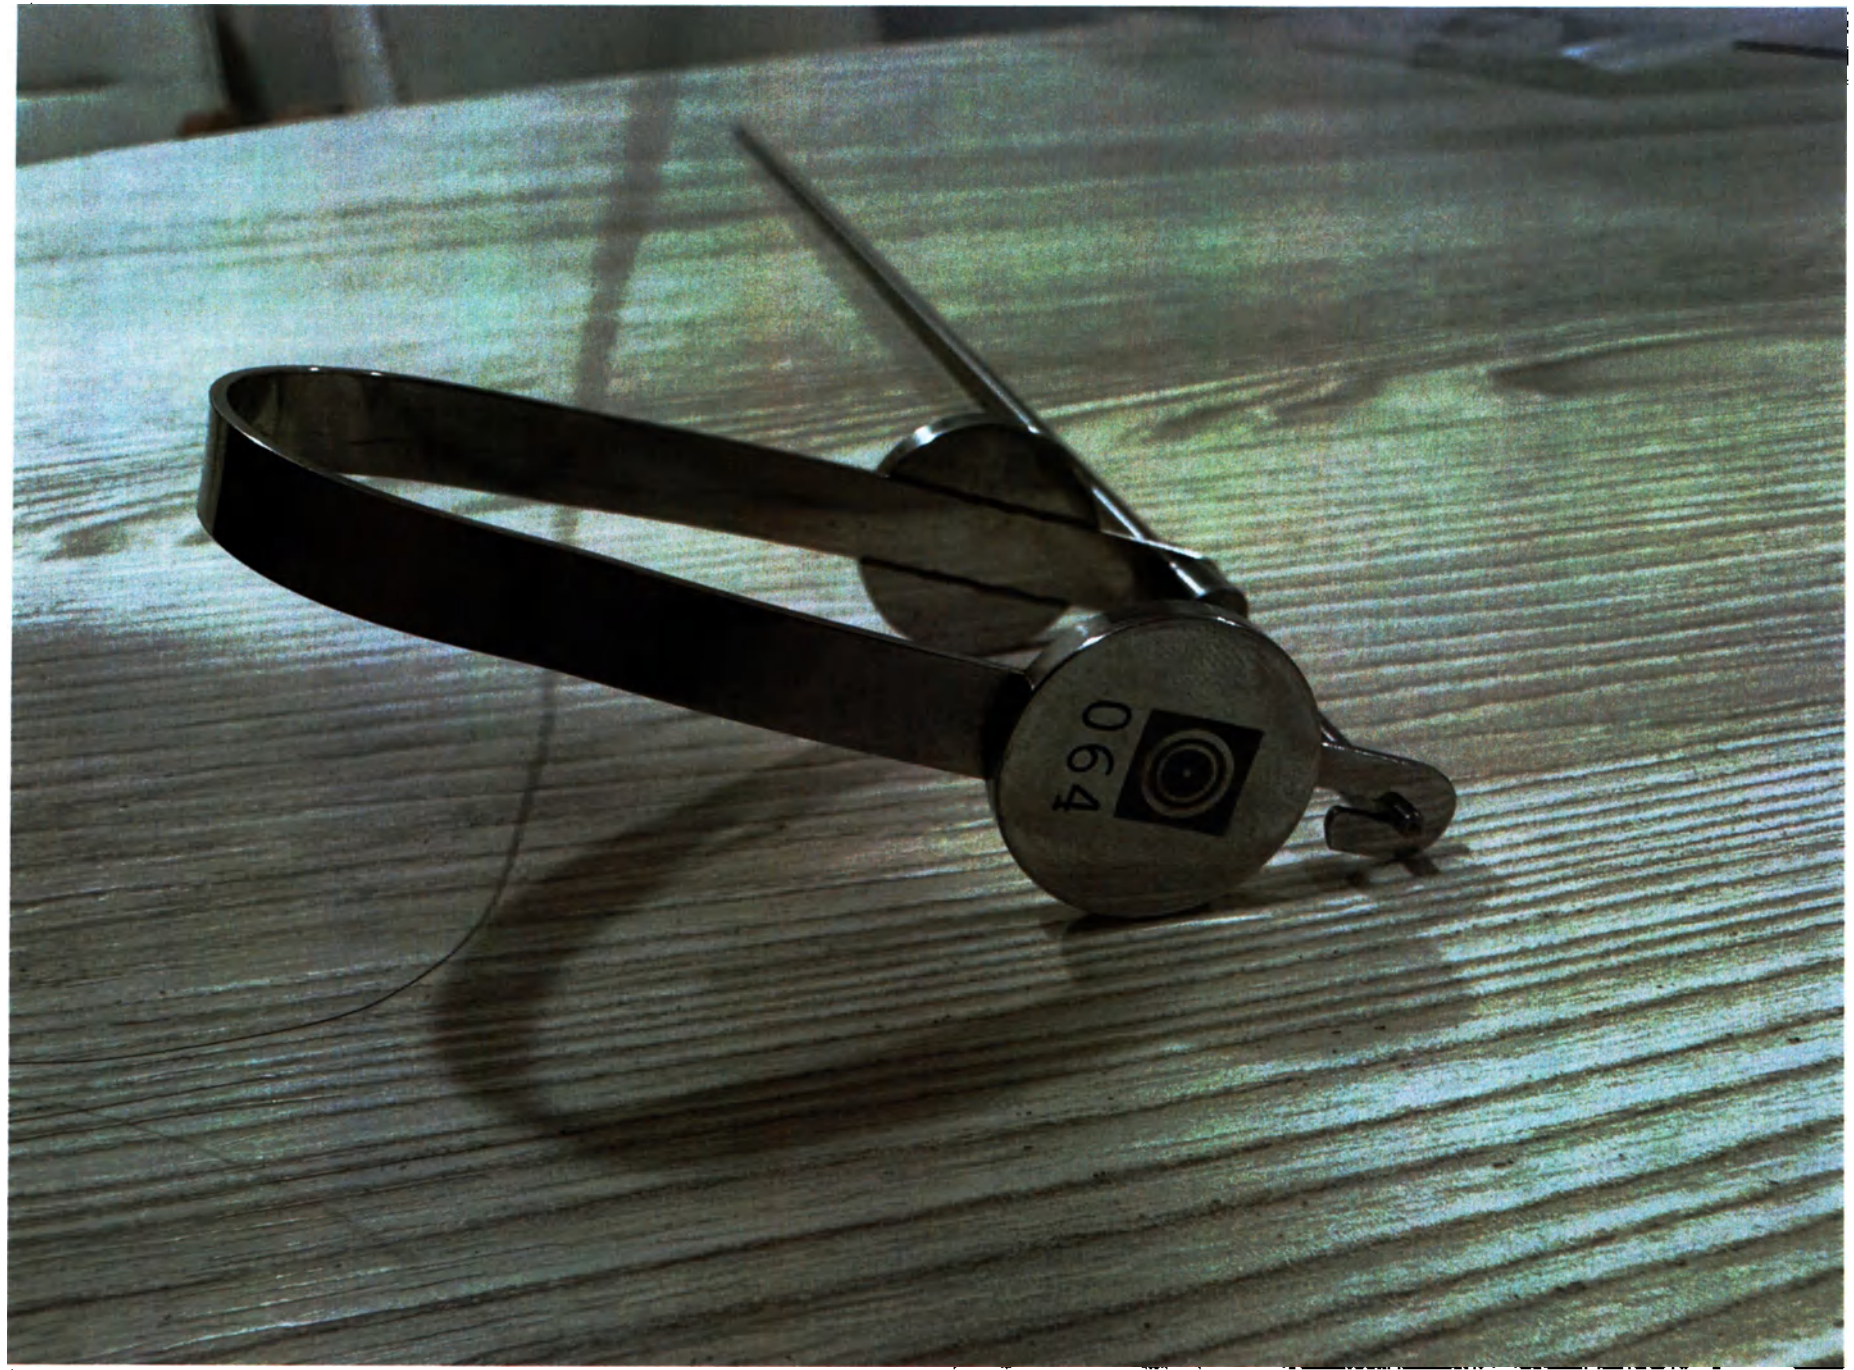


Фото 105. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы для захвата с окончатыми браншами, 9 Шр, Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 9 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 106. Общий вид вариантов исполнения: Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 107. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 5 Шр

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 108. Общий вид вариантов исполнения: Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 6 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 7 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 9 Шр, длина 40 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 109. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 6 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 7 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 9 Шр, длина 40 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

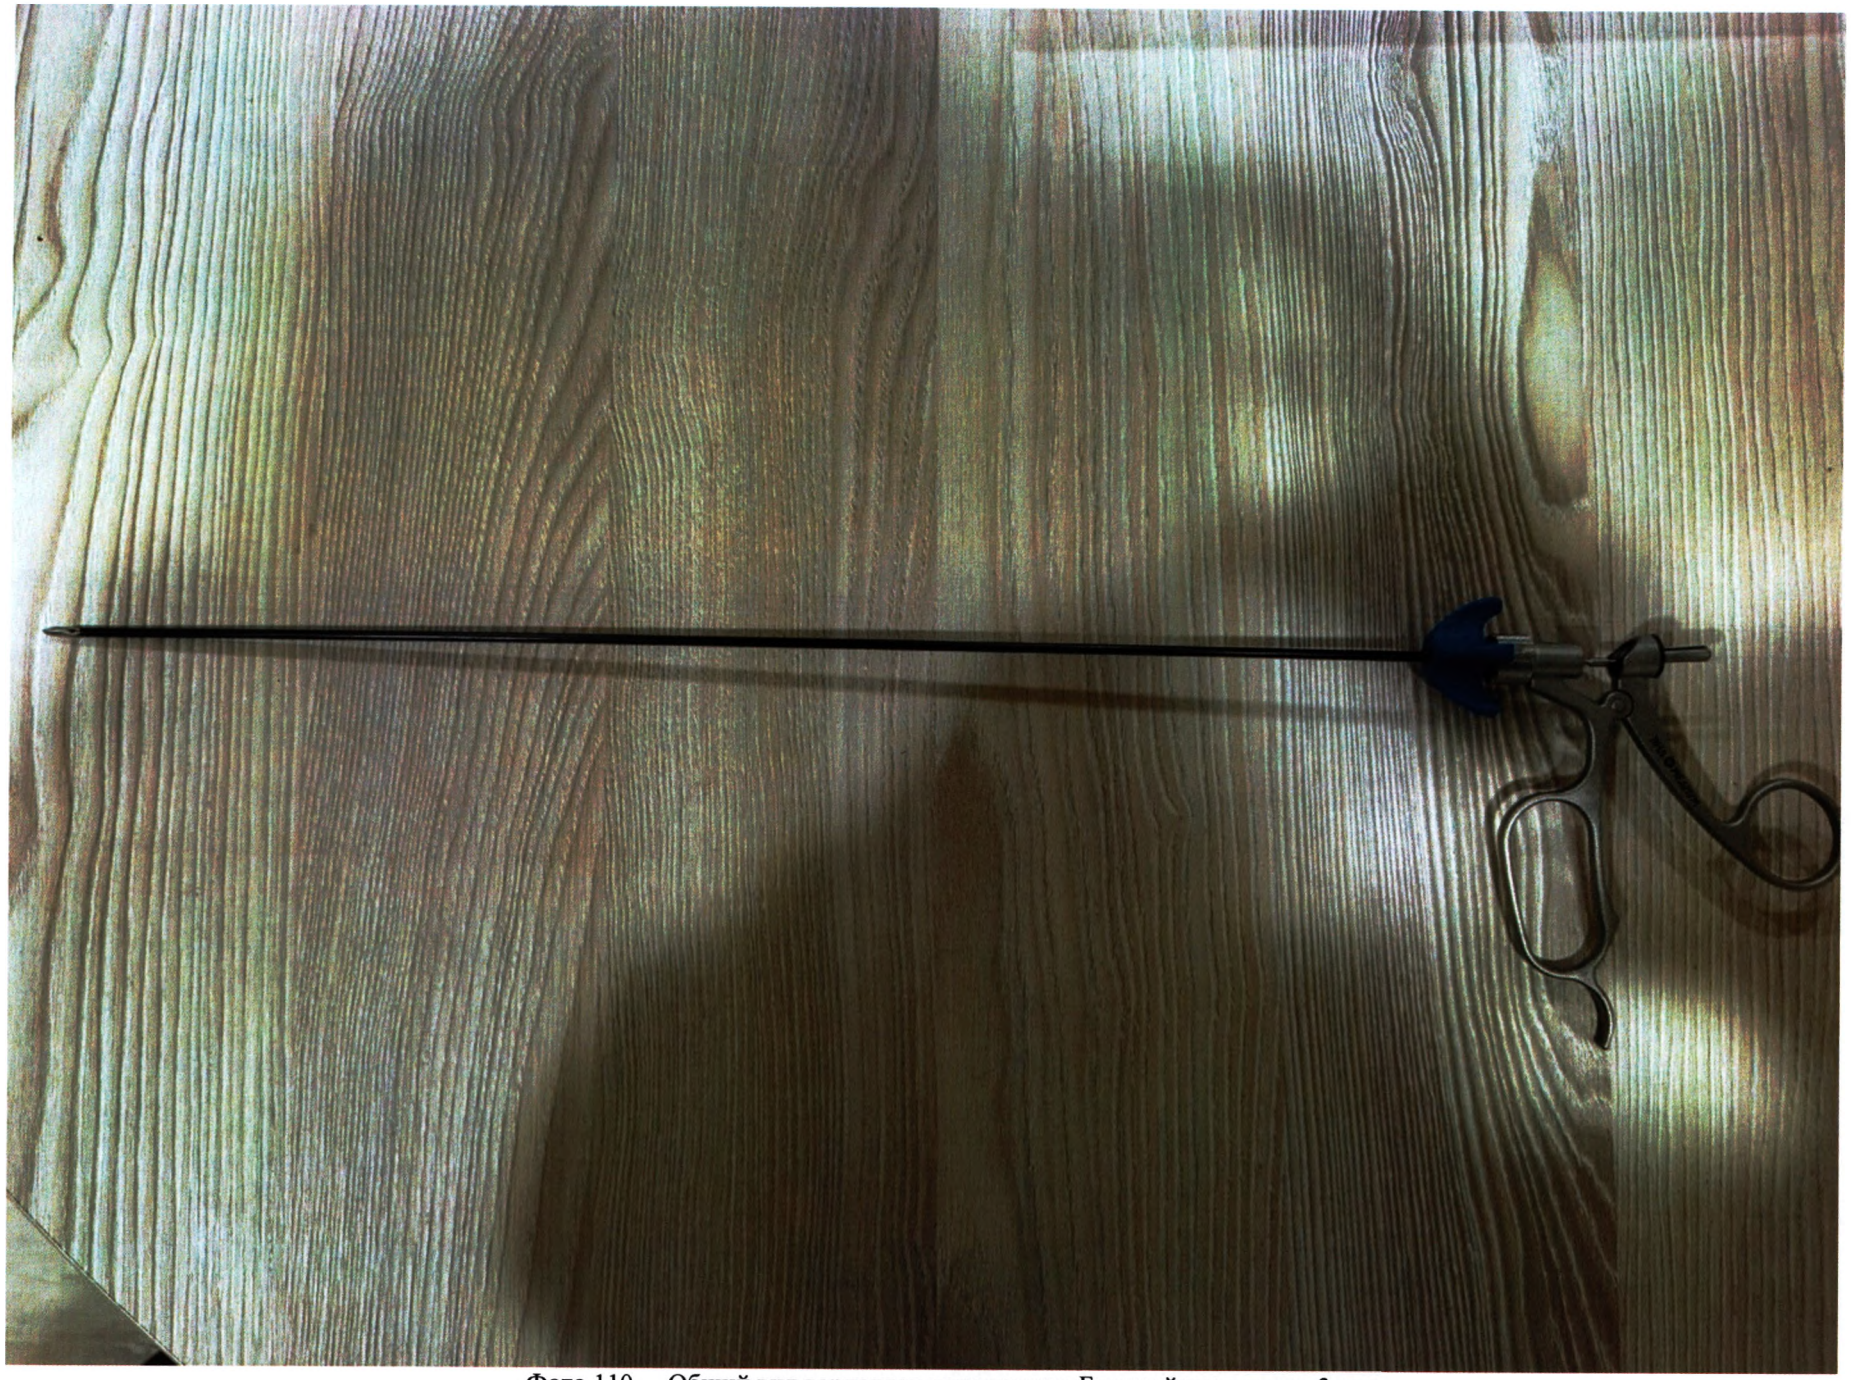


Фото 110. Общий вид вариантов исполнения: Биопсийные щипцы 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

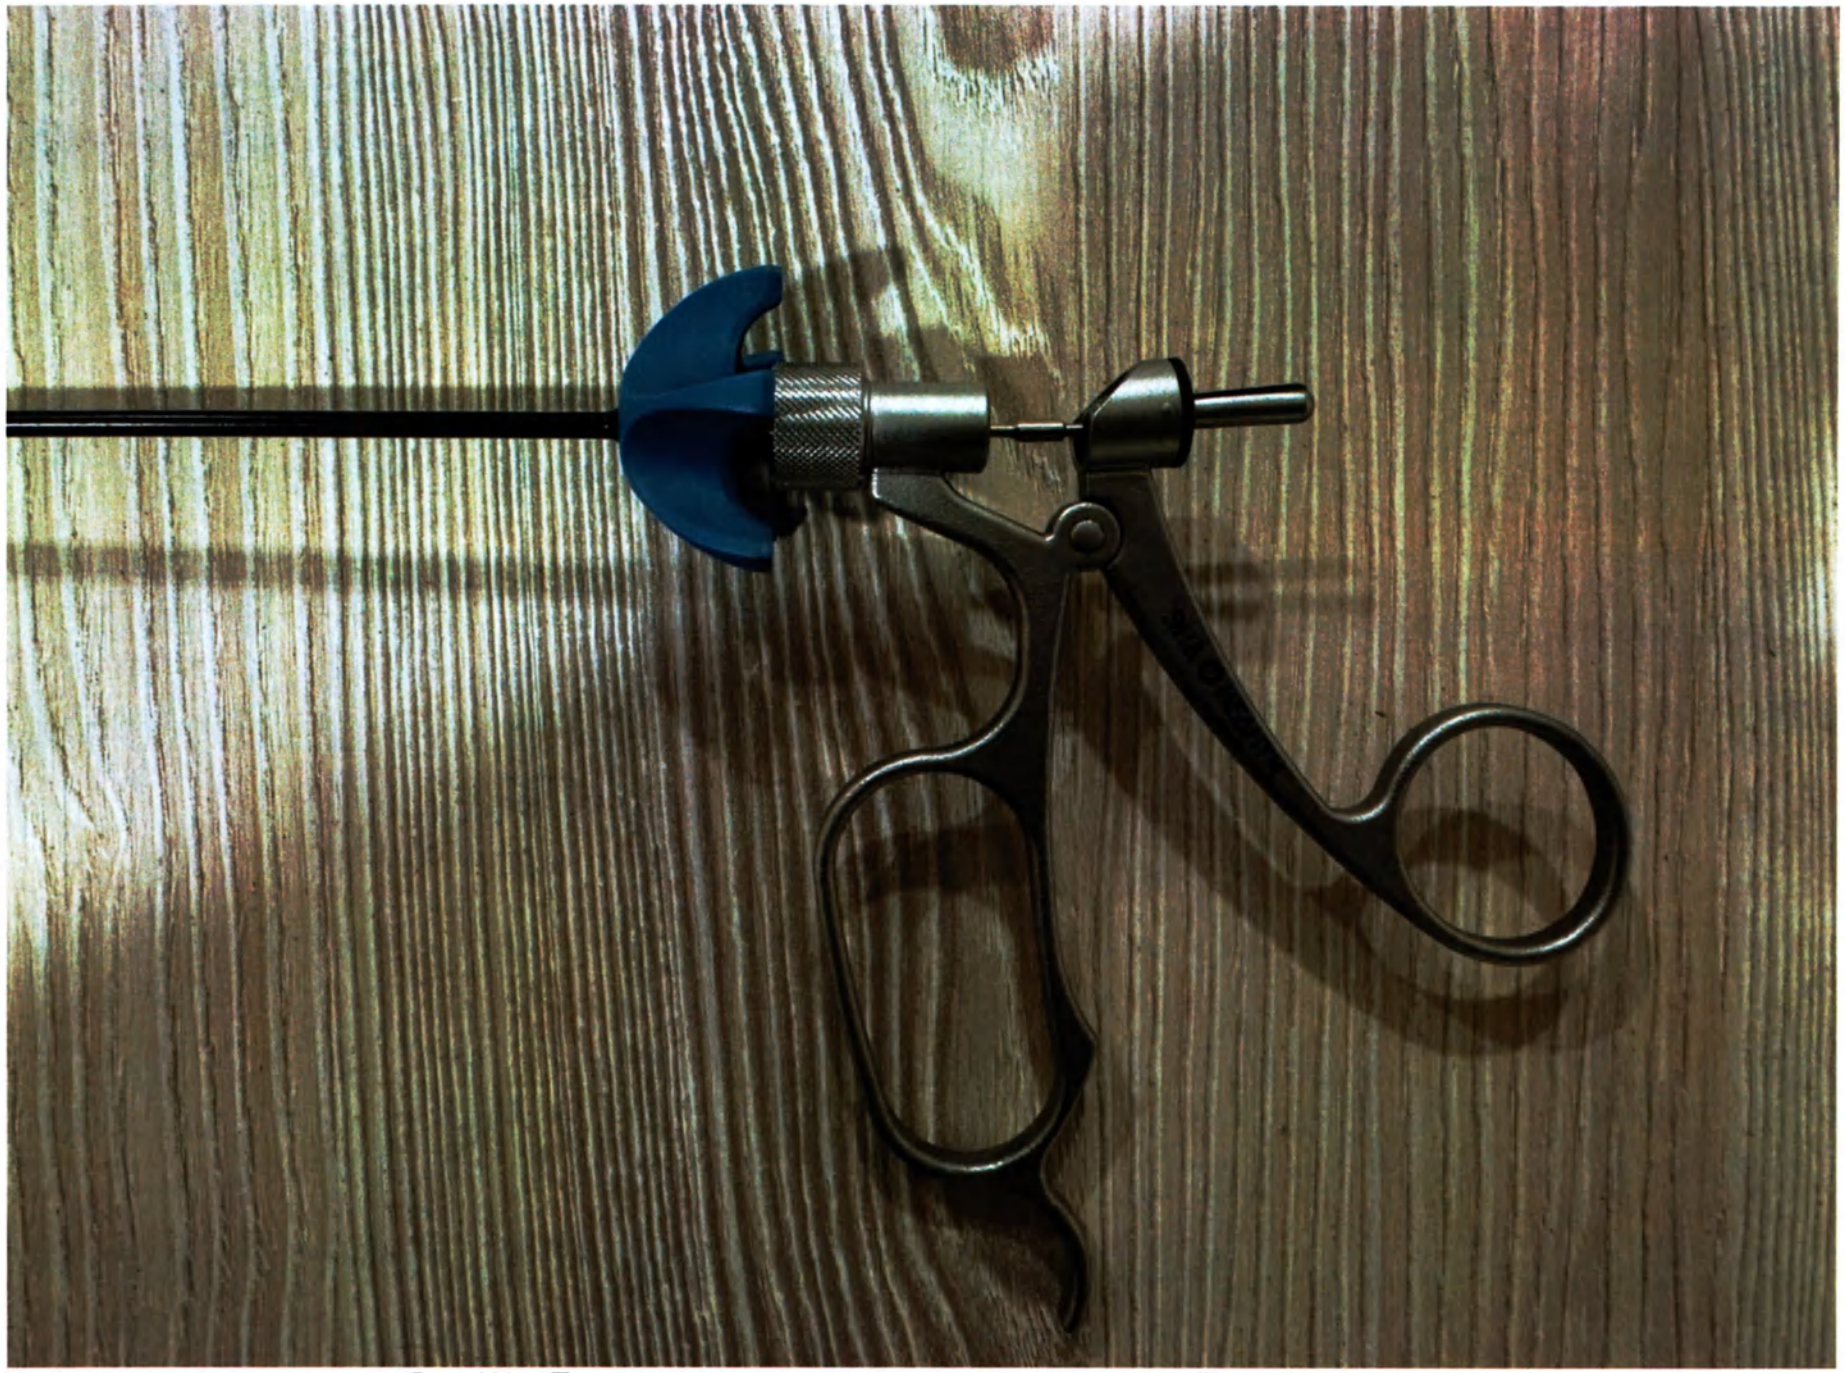


Фото 111. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Биопсийные щипцы 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

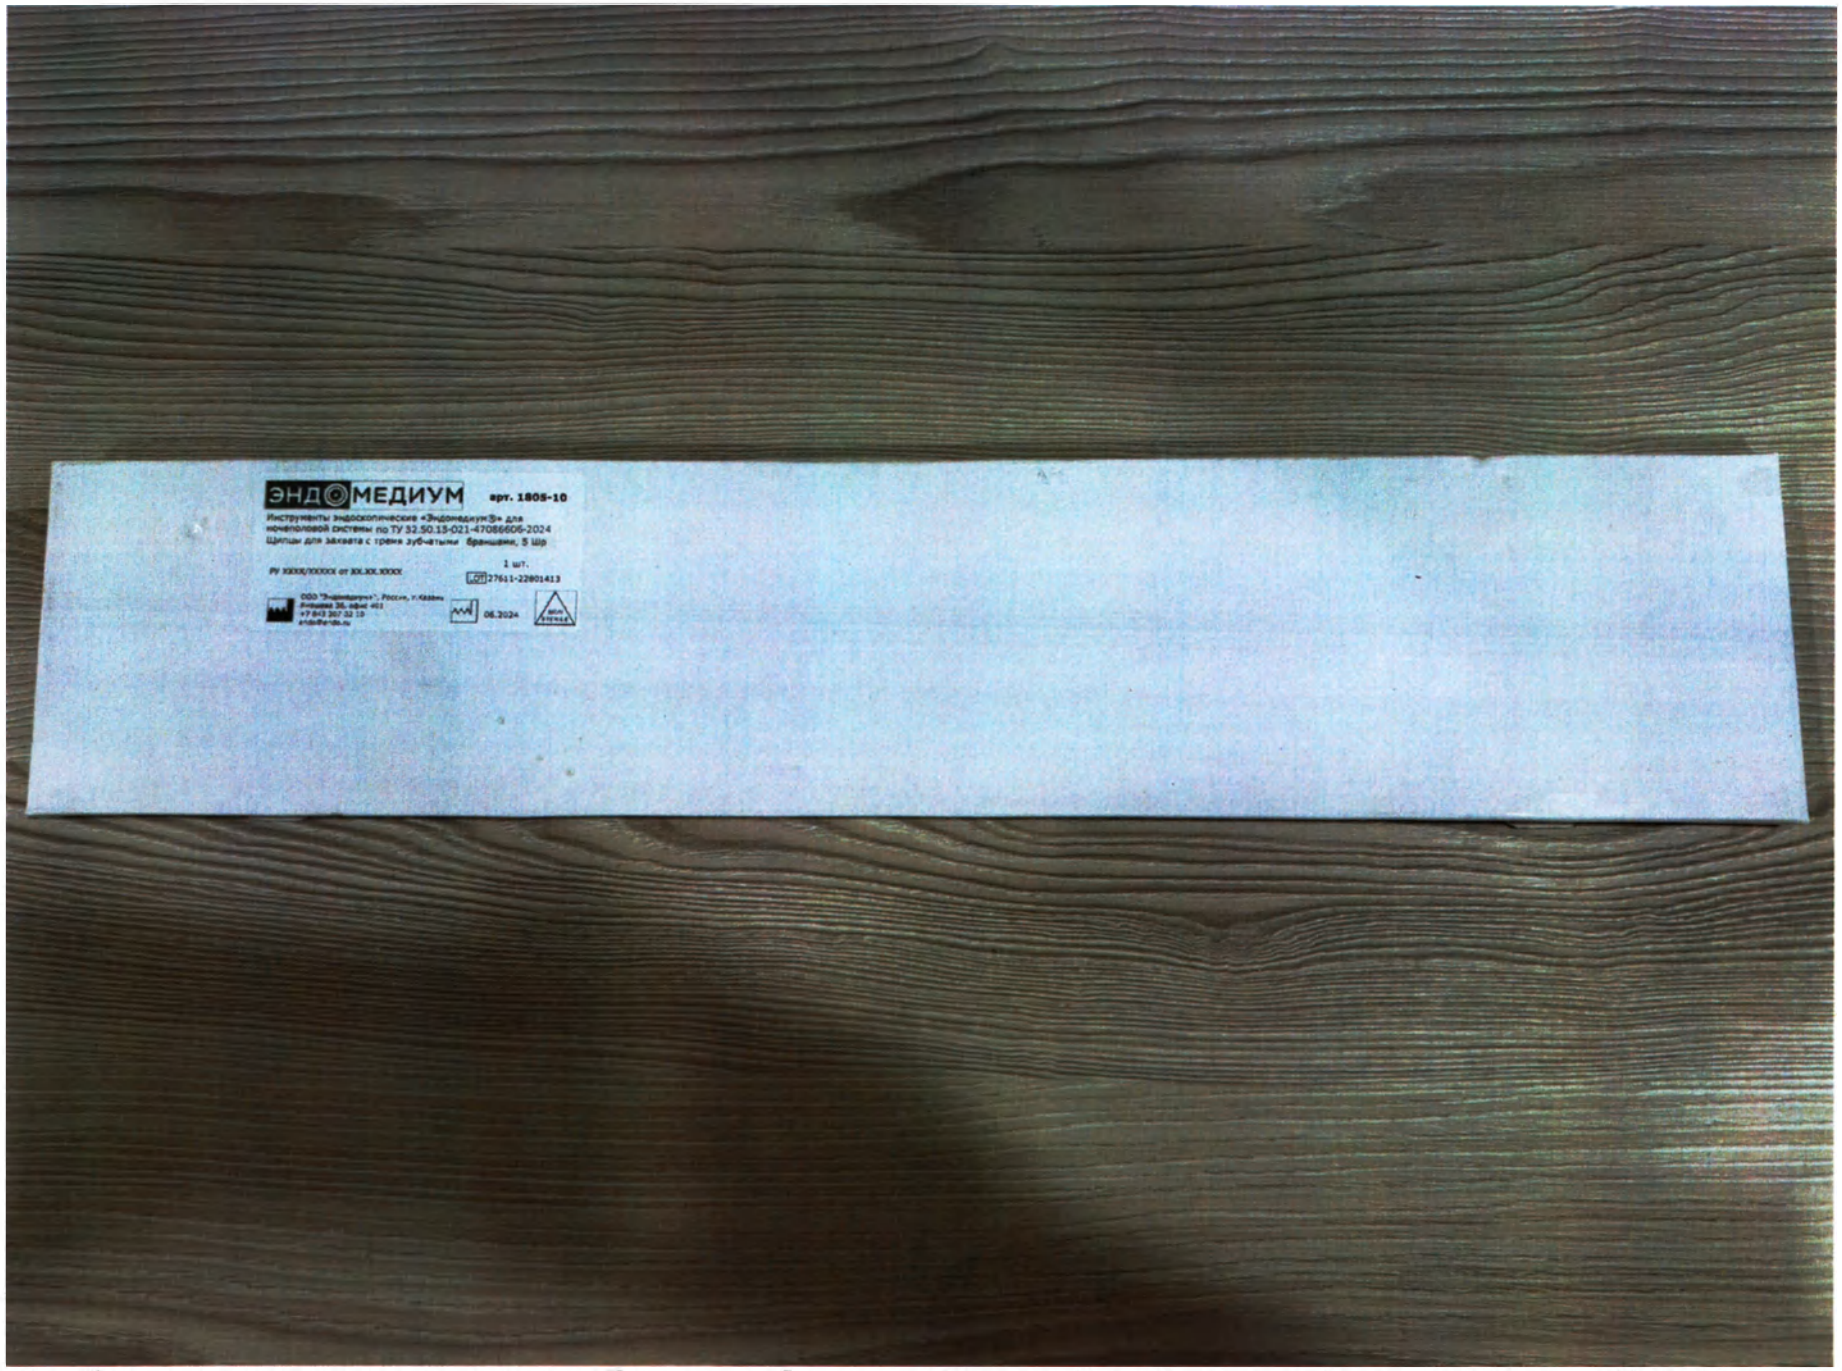


Фото 112. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы двухбраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы двухбраншевые, 5 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 6 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 7 Шр, длина 40 см; Ножницы однобраншевые, 4 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые, 5 Шр, длина 60 см; Ножницы однобраншевые 3 мм, Ножницы двухбраншевые 3 мм; Щипцы для захвата,

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для захвата большие, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для захвата большие, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы для извлечения, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения корзинка, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы для извлечения корзинка, 5 Шр, длина 60 см; Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 6 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 7 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 9 Шр, длина 40 см; Щипцы каменная дорожка, 4 Шр, длина 60 см; Щипцы каменная дорожка, 5 Шр, длина 60 см.; Щипцы двухбраншевые для захвата, 3 мм, Щипцы однобраншевые для захвата, 3 мм; Щипцы для захвата с окончатыми браншами, 9 Шр; Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 9 Шр; Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, 5 Шр; Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 6 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 7 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы, 4 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 5 Шр, длина 60 см; Биопсийные щипцы, 9 Шр, длина 40 см; Биопсийные щипцы 3 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографические изображения. Принадлежности к инструментам эндоскопическим

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 113. Общий вид вариантов исполнения: Кабель световой, длина 2 м; Кабель световой, длина 2,5 м; Кабель световой, длина 3 м

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 114. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Кабель световой, длина 2 м; Кабель световой, длина 2,5 м; Кабель световой, длина 3 м

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

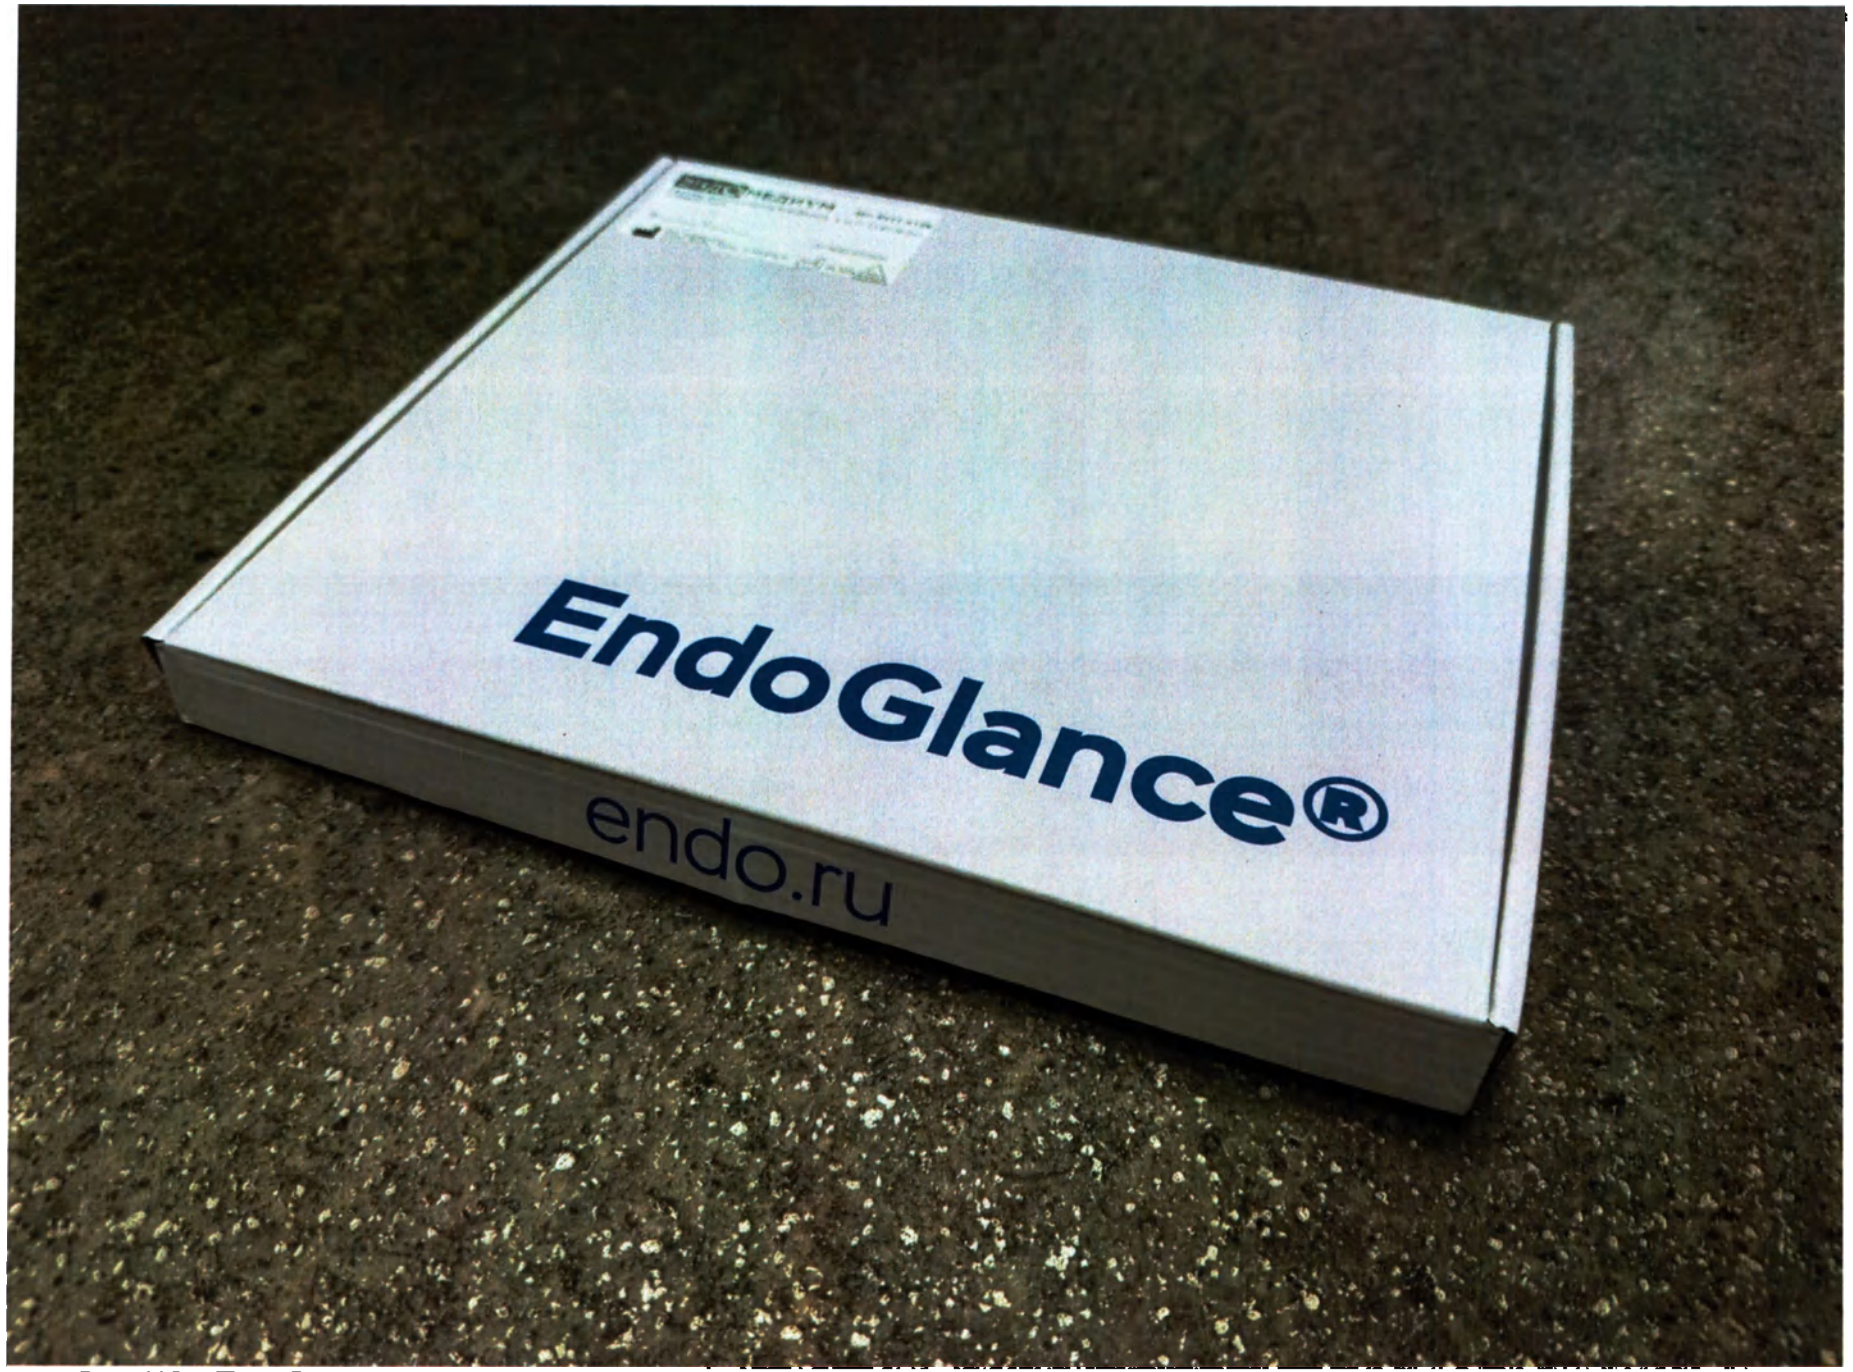


Фото 115. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Кабель световой, длина 2 м; Кабель световой, длина 2,5 м; Кабель световой, длина 3 м

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 116. Общий вид вариантов исполнения: Колпачок инструментального канала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Фото 117. Общий вид вариантов исполнения: Прокладка инструментального канала для телескопов с параллельным окуляром

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 118. Потребительская упаковка вариантов исполнения: Колпачок инструментального канала. Прокладка инструментального канала для телескопов с параллельным окуляром

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

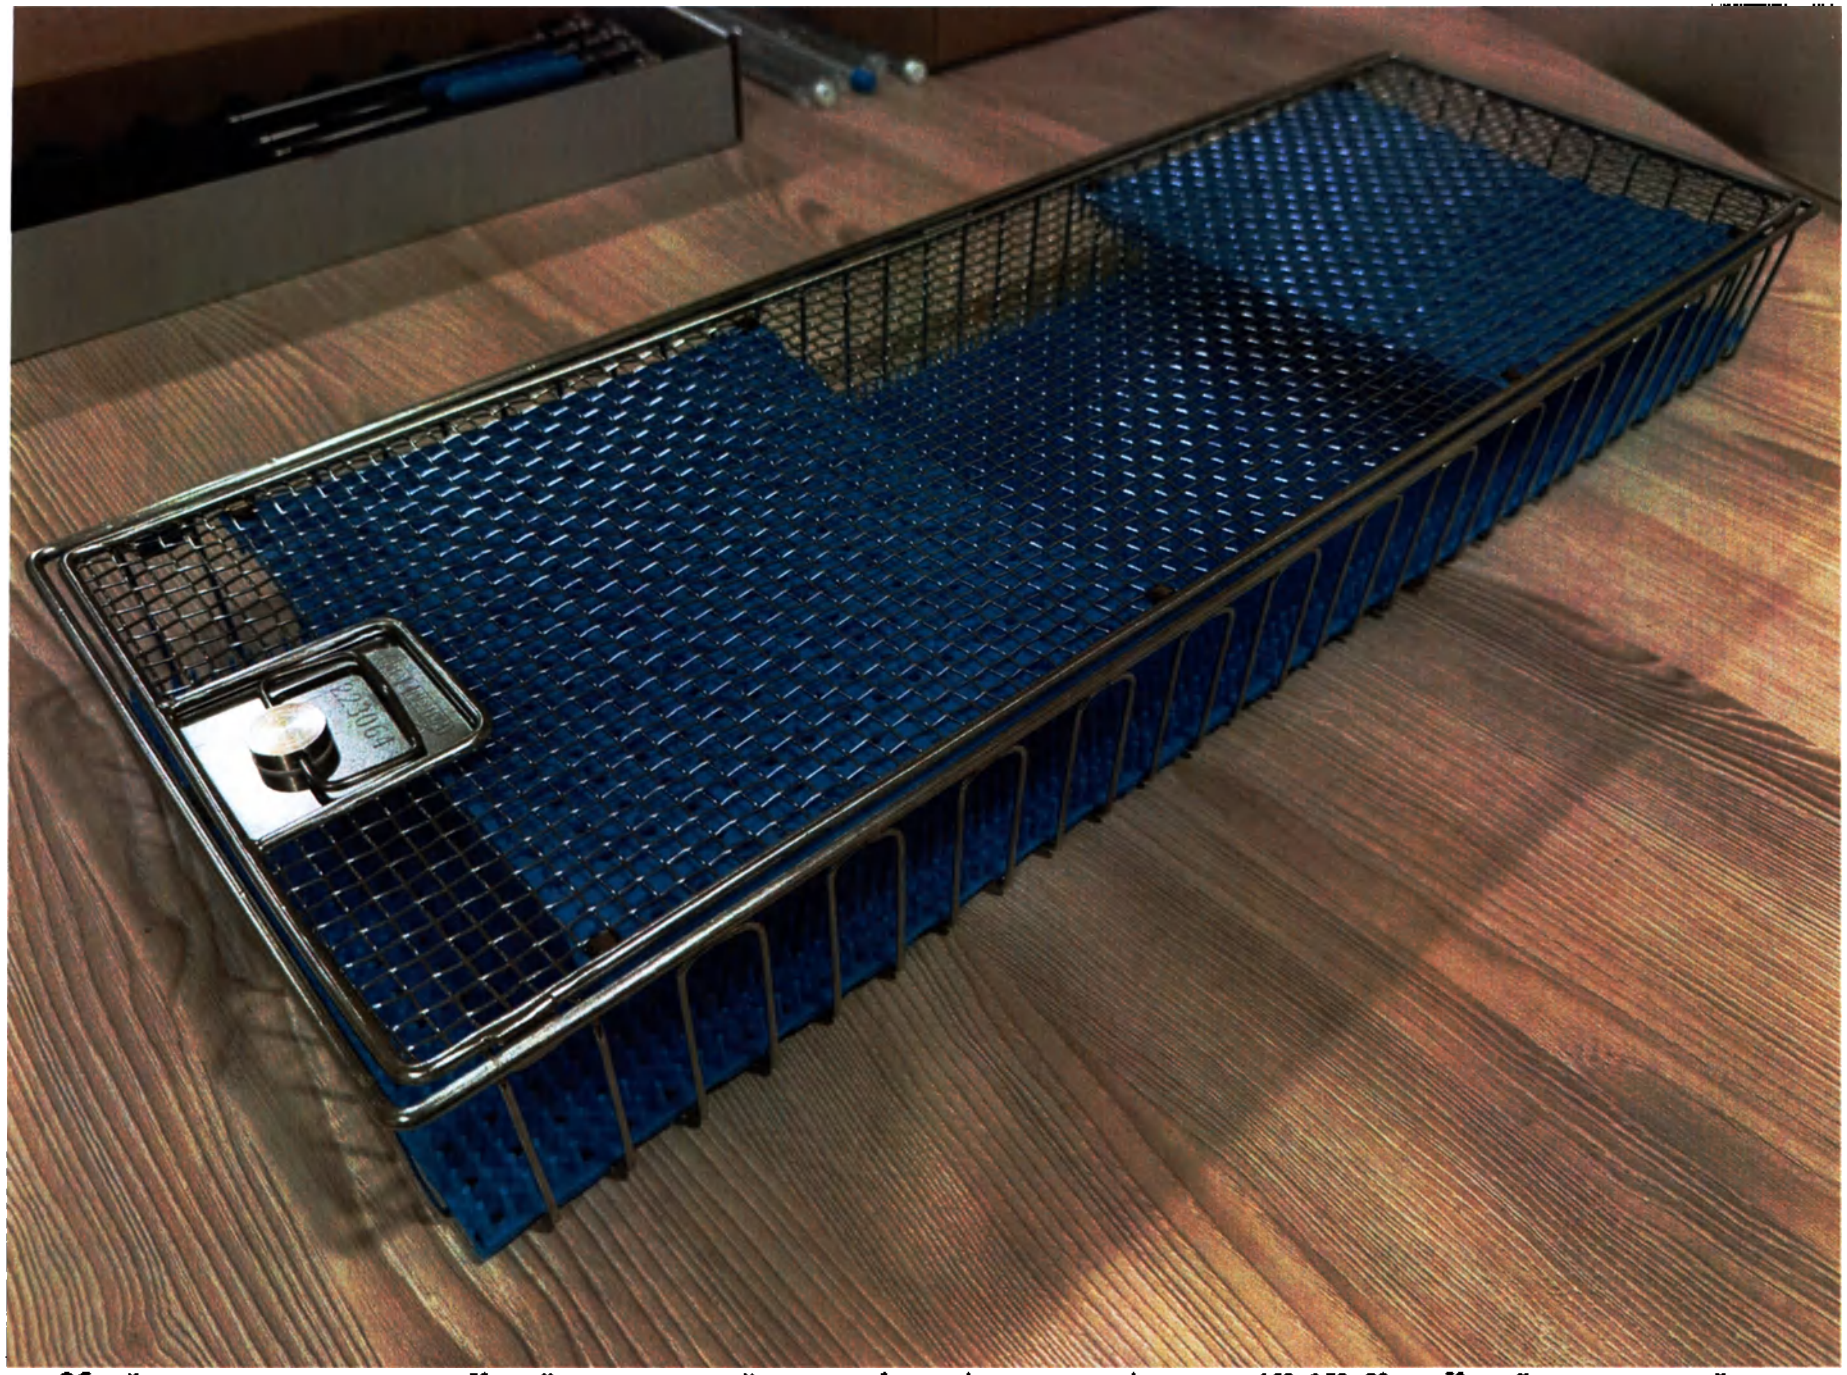

Общий вид вариантов исполнения: Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х80 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х100 мм ; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х80 мм; Контейнер проволочный для

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х100 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х80 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х100 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

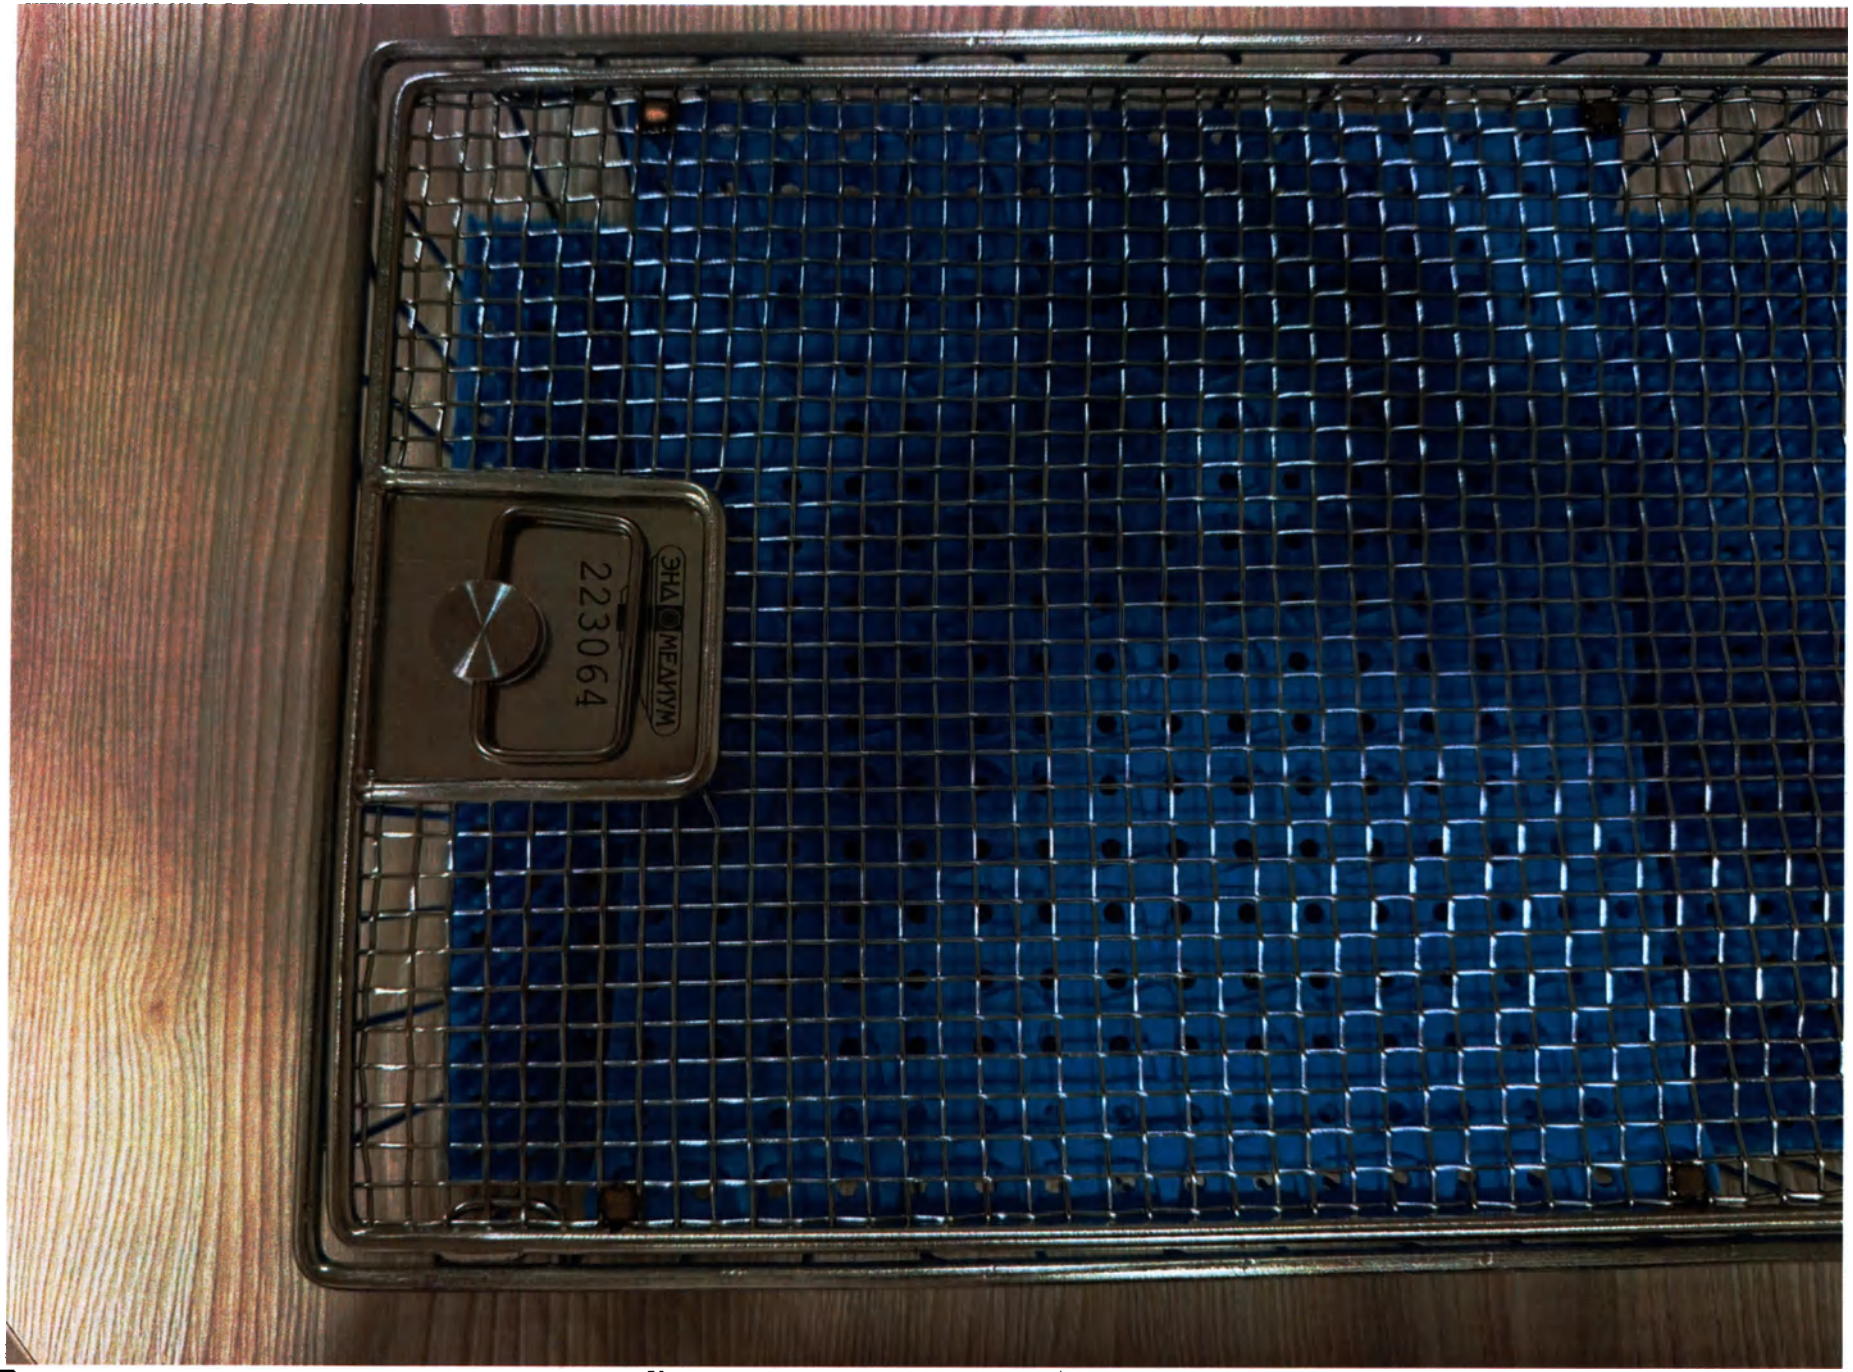


Фото 119. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х80 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 460х150х100 мм ; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х80 мм; Контейнер проволочный для

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

дезинфекции/стерилизации/хранения, 640х150х100 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х50 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х80 мм; Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, 700х250х100 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 120. Общий вид вариантов исполнения: Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 375 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 240 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 435 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 470 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 615 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 121. Пример маркировки на изделии вариантов исполнения: Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 375 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 240 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 435 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 470 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 615 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 122. Потребительская упаковка вариантов исполнений: Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 375 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 240 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 435 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 470 мм; Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина 615 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

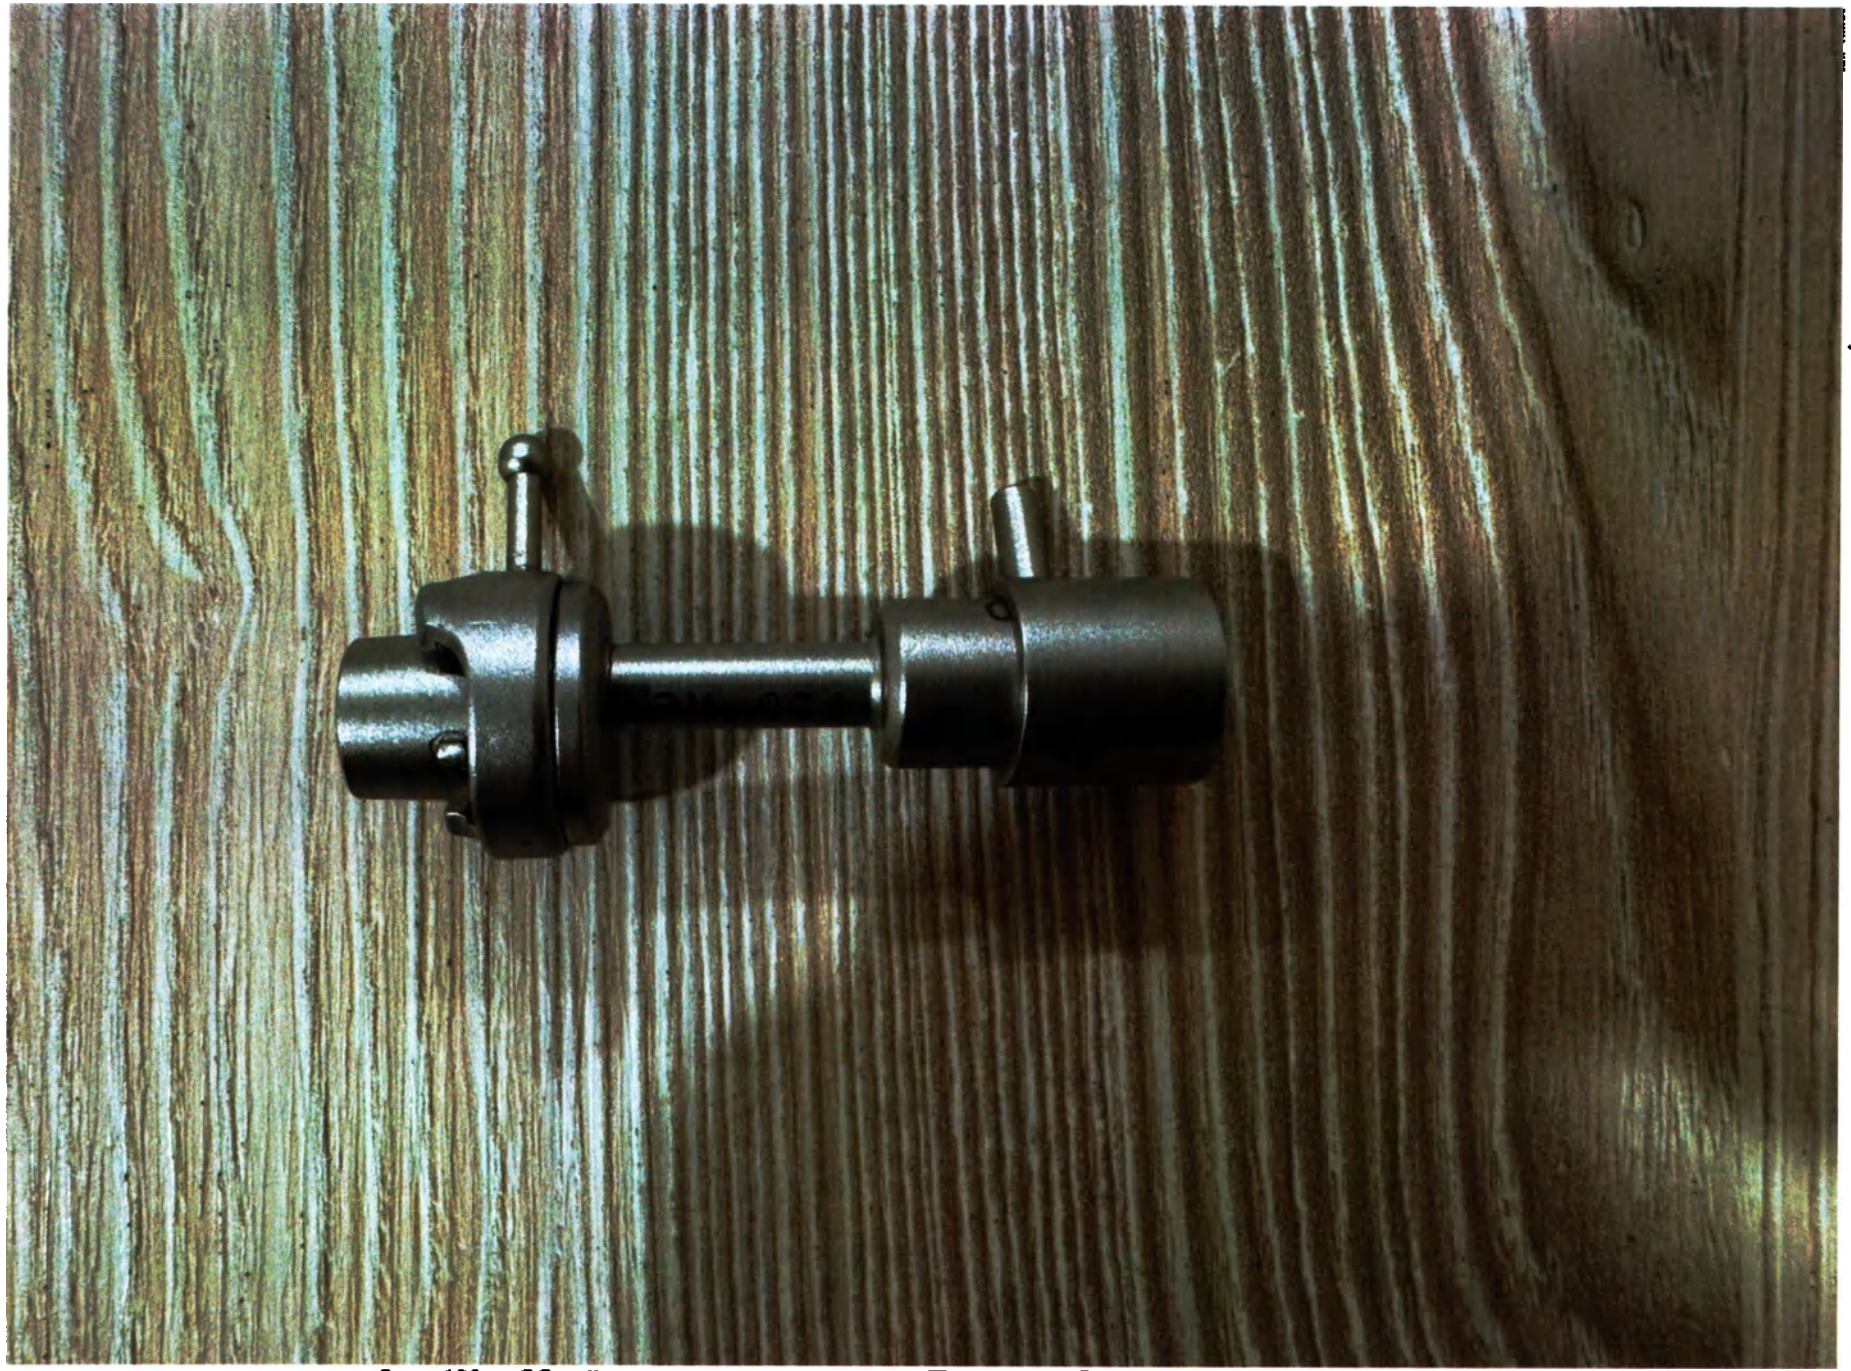


Фото 123. Общий вид вариантов исполнения: Переходник без инструментального канала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

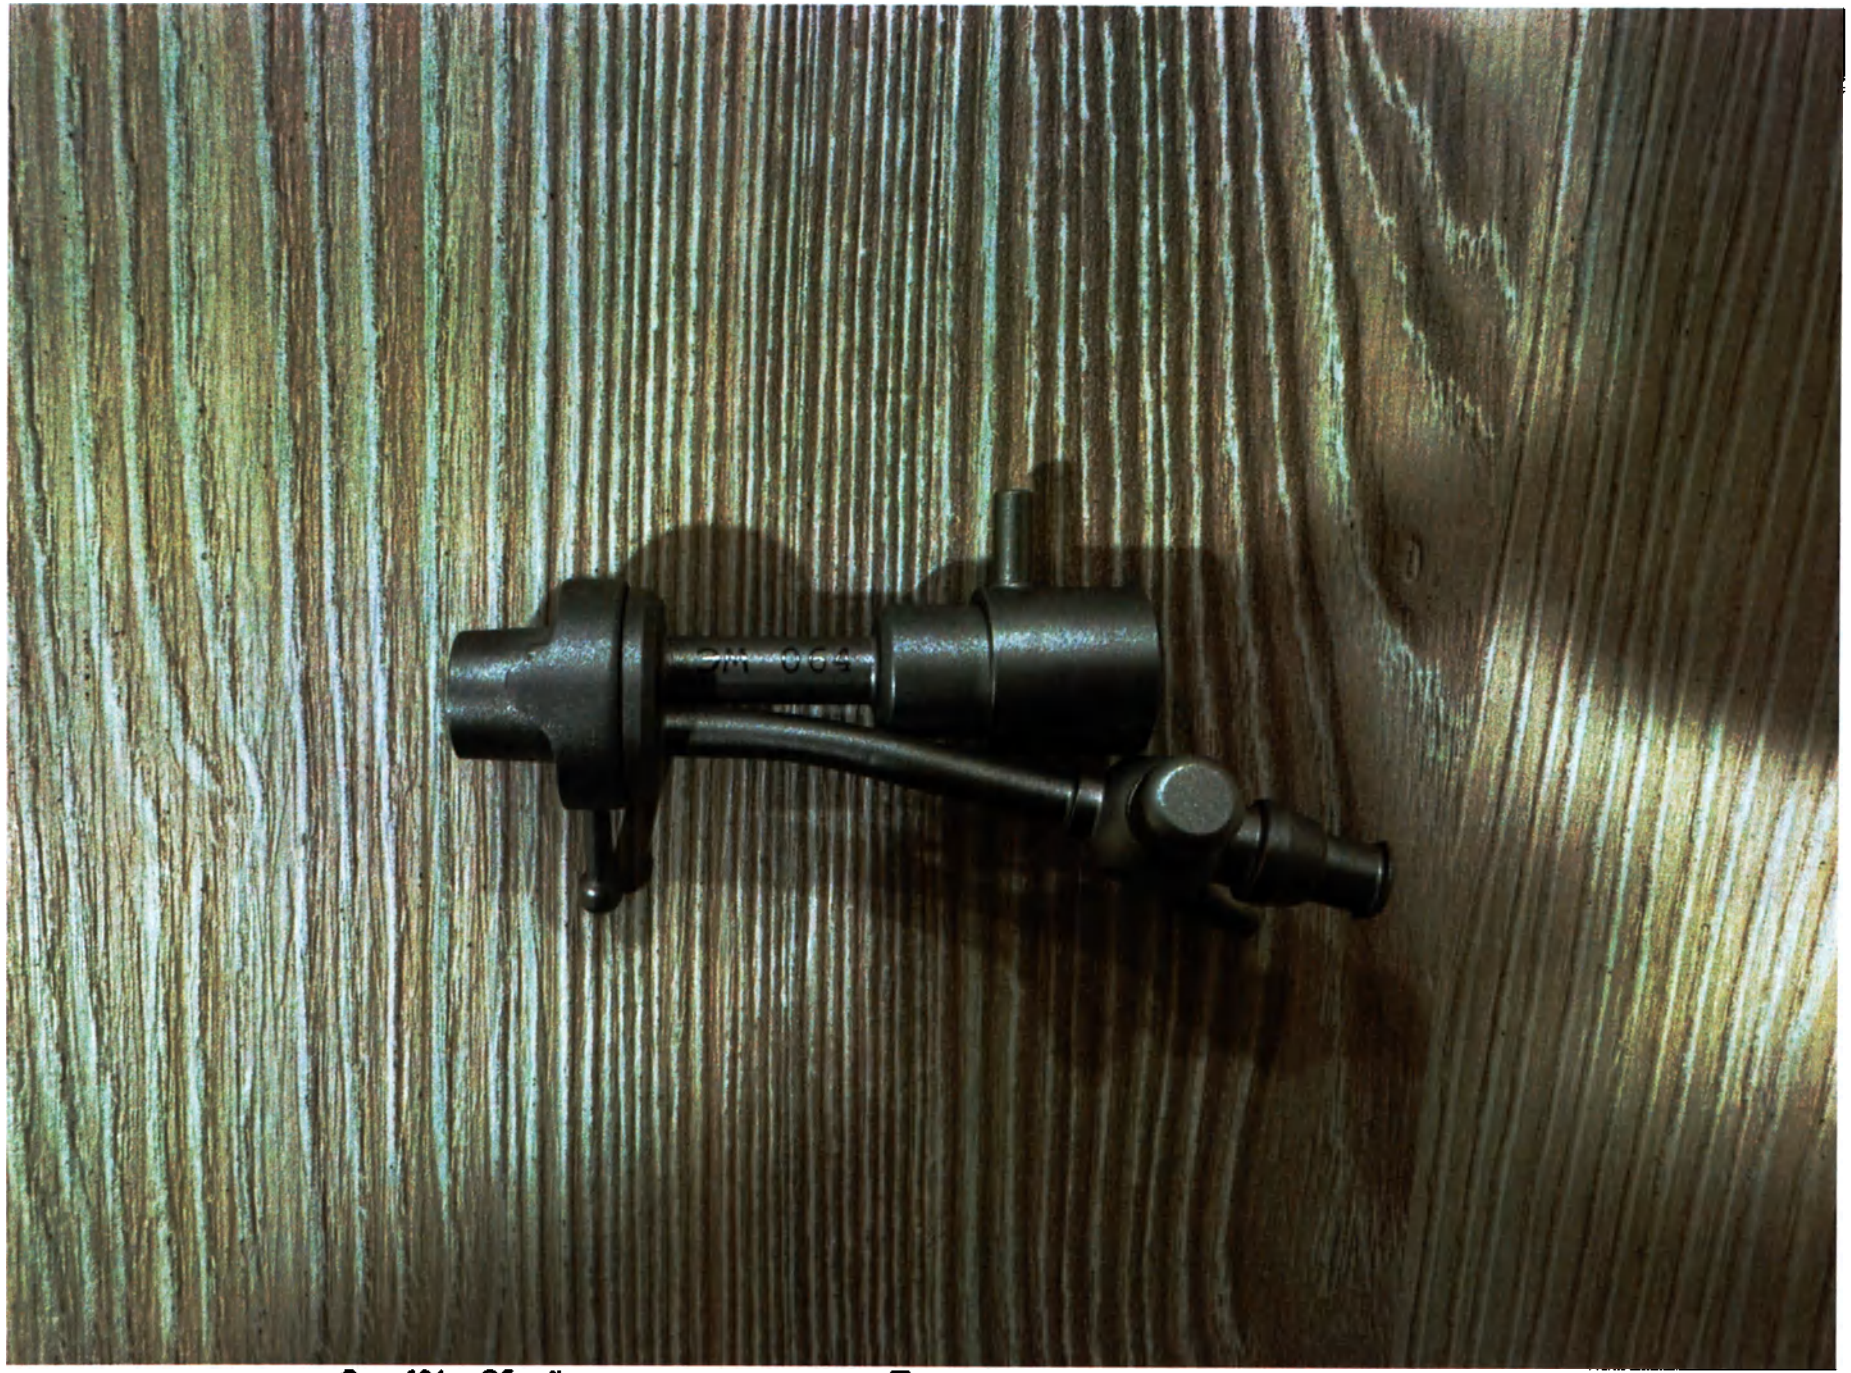


Фото 124. Общий вид вариантов исполнения: Переходник с одним инструментальным каналом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

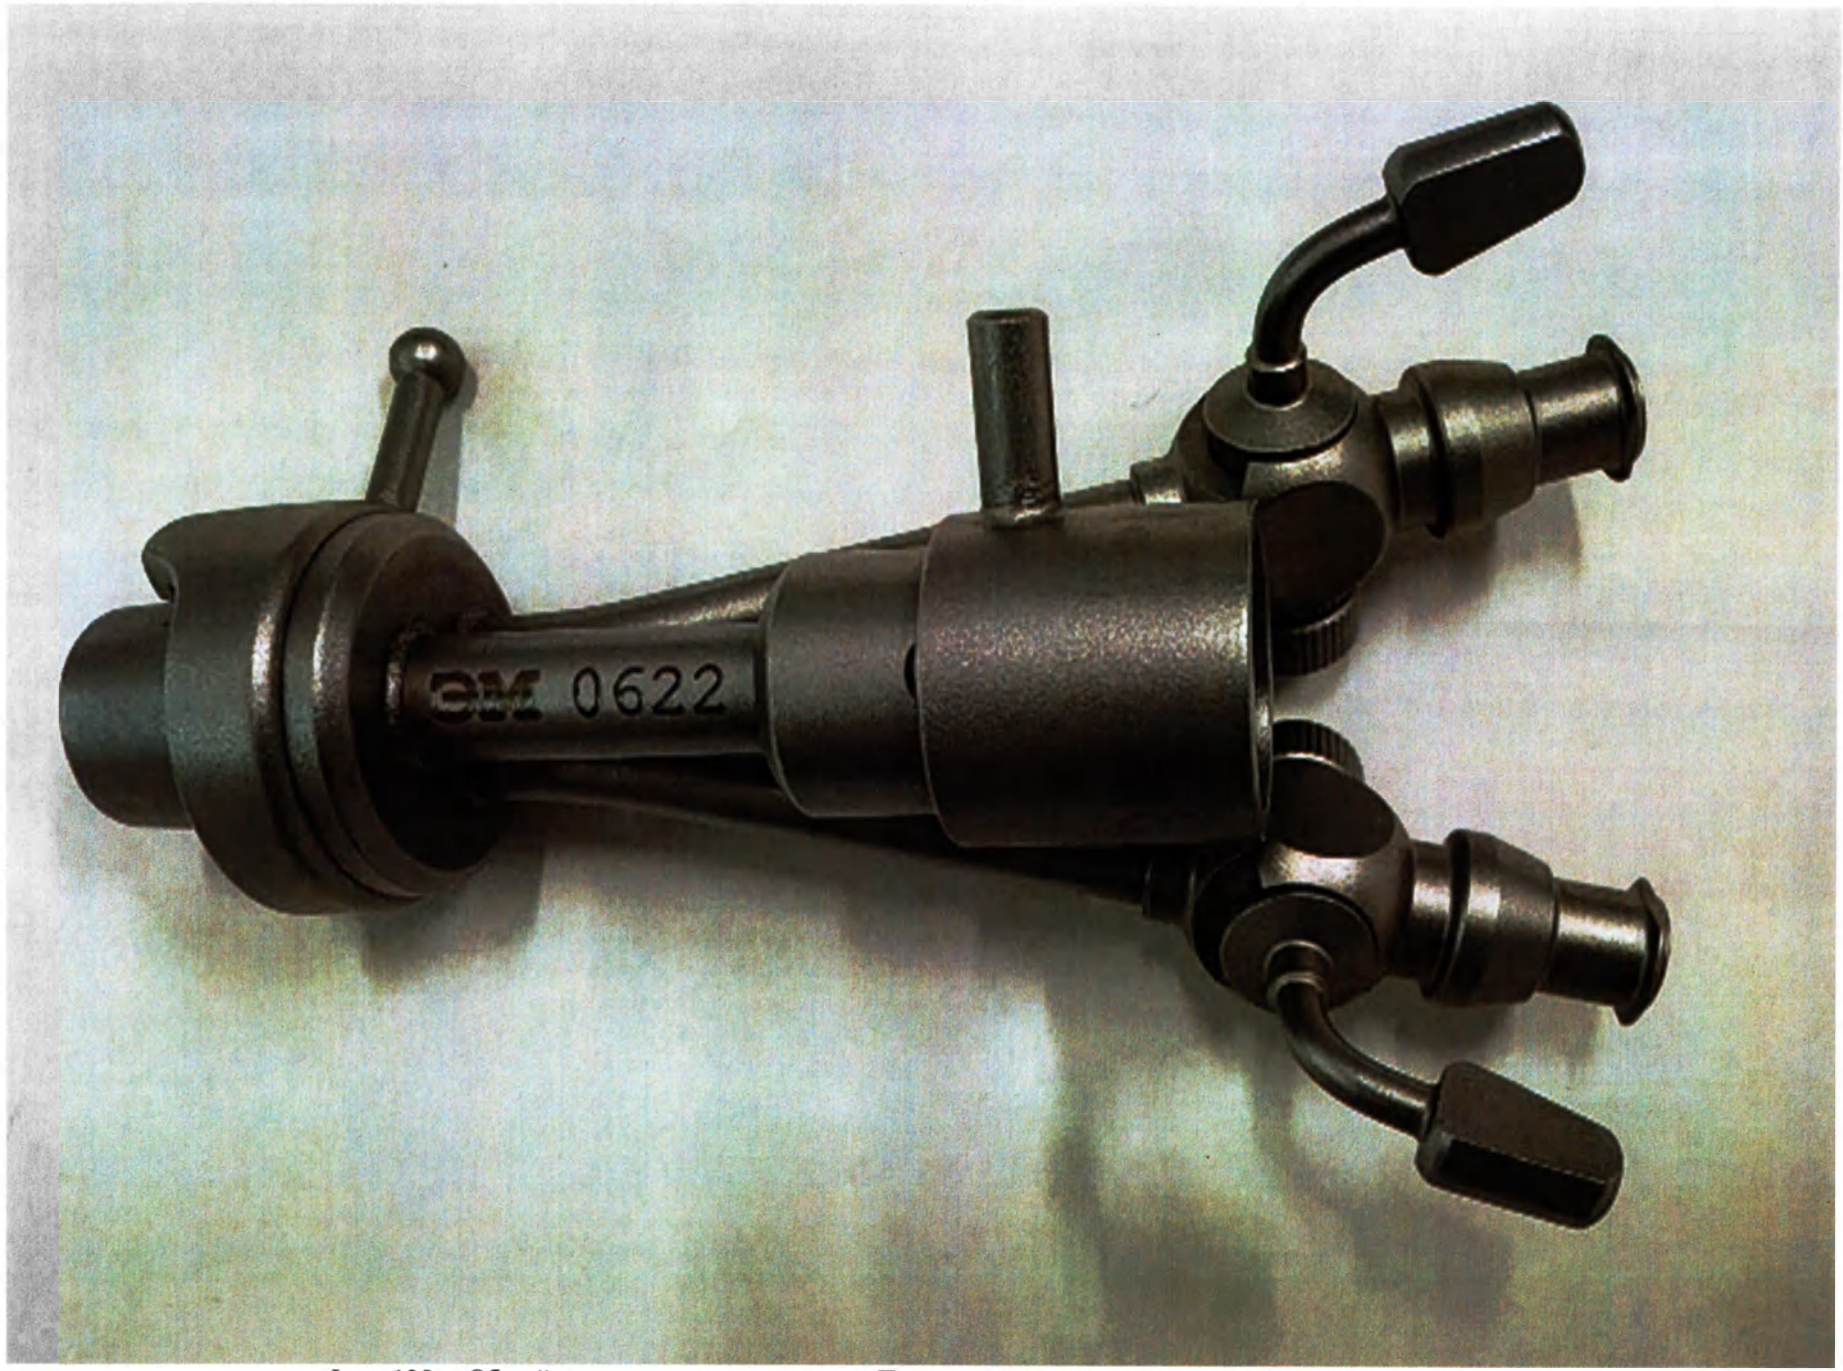


Фото 125. Общий вид вариантов исполнения: Переходник с двумя инструментальными каналами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

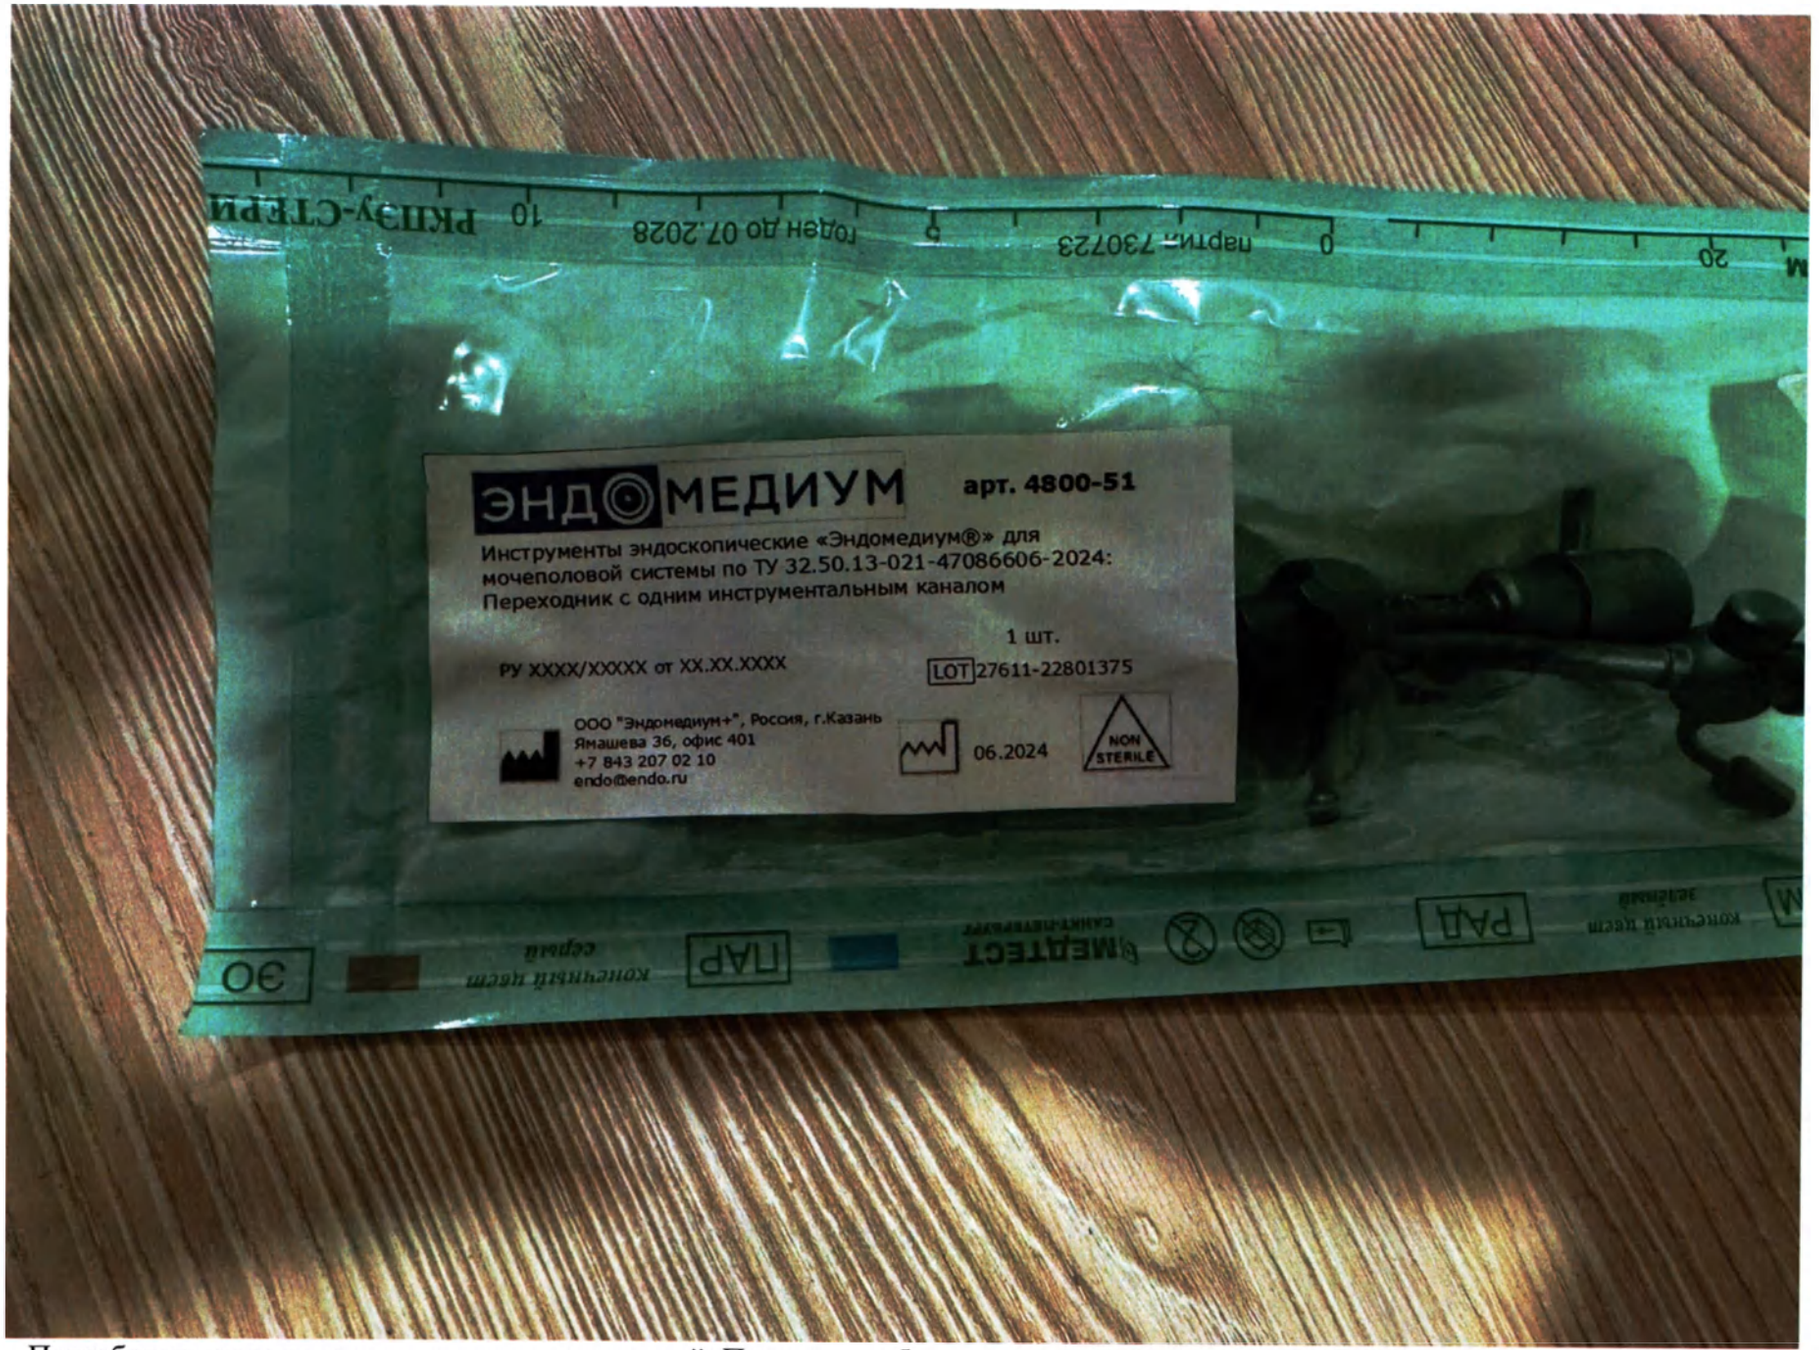


Фото 126. Потребительская упаковка вариантов исполнений: Переходник без инструментального канала; Переходник с одним инструментальным каналом; Переходник с двумя инструментальными каналами

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 127. Общий вид. Транспортная упаковка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макеты маркировок потребительских упаковок

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XXX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Гистероскоп EndoGlance® жесткий оптический XX мм, XX°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XXX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Цистоскоп EndoGlance® жесткий оптический XX мм, XX°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Уретерореноскоп жесткий оптический XXX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

НДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Телескоп универсальный оптический с параллельным окуляром XX Шр, направление наблюдения X° и прямым инструментальным каналом

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Телескоп универсальный оптический с угловым окуляром XX Шр, направление наблюдения XX° и прямым инструментальным каналом

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Тубус без инструментального канала XX Шр, направление наблюдения XX°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Тубус XX Fr с инструментальным каналом X Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Тубус универсальный XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:Тубус универсальный внешний XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Тубус универсальный внутренний XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Дилататор цельный 15-32 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Дилататор сегментированный 8-24 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Проводник для сегментированного дилатора

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Обтуратор для тубуса универсального XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Обтуратор для тубуса универсального внешнего XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Обтуратор для тубуса универсального внутреннего XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Обтуратор визуальный для тубуса универсального XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Обтуратор визуальный с инструментальным каналом

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Рабочий элемент резектоскопа, активное режущее действие XX Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие XX Шр.

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Рабочий элемент резектоскопа, пассивное режущее действие с инструментлным каналом XX Шр.

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Вапоризатор 5 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Вапоризатор 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 0° 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 0°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 30° 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 30°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 90° 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петлевой 90°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод усиленный Петлевой 30°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод усиленный Петлевой 30° 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод усиленный Петлевой 90°

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Ролик

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Ролик 3 мм 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Ролик шипованный 5 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Ролик шипованный 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Шар 5 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Шар 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Шар 3 мм 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Плато

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Плато 22 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1000В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Сферический электрод, 5 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Сферический электрод, 6 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Сферический электрод, 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Прямой игольчатый электрод, 5 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Прямой игольчатый электрод, 6 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Прямой игольчатый электрод, 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: L-образный электрод, 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Электрод Петля, 5 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Рукоятка к петлям

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX
Номинальное напряжение 1500В±10%

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Ножницы двухбраншевые, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

[illegible]рументы эндоскопические «Эндомедиум®» для [illegible]еполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Ножницы однобраншевые, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Ножницы однобраншевые 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Ножницы двухбраншевые 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для захвата, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для захвата большие, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для извлечения, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для извлечения корзинка, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы каменная дорожка, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы двухбраншевые для захвата, 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.
LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы однобраншевые для захвата, 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для захвата с окончатыми браншами, 9 Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Щипцы для захвата с тремя зубчатыми браншами, X Шр

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Биопсийные щипцы, X Шр, длина XX см

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Биопсийные щипцы 3 мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Кабель световой, длина X м

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Колпачок инструментального канала

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт/уп.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Прокладка инструментального канала для телескопов с параллельным окуляром

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт/уп.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, XXXxXXXxXXX мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Контейнер цилиндрический для дезинфекции/стерилизации/хранения, длина XXX мм

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Переходник без инструментального канала

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ЭНДОМЕДИУМ арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024:
Переходник с одним инструментальным каналом

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

X шт.

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ЭНДОМЕДИУМ

арт. XXXX-XX

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024: Переходник с двумя инструментальными каналами

X шт.

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

LOT XXXXX-XXXXXXXX

ООО "Эндомедиум+", Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru

XX.XXXX

NON STERILE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Производитель эндохирургического оборудования

ЭНДОМЕДИУМ

endo.ru

Инструменты эндоскопические «Эндомедиум®» для мочеполовой системы по ТУ 32.50.13-021-47086606-2024 в вариантах исполнения, с принадлежностями

РУ XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

XX.XXXX

ООО "Эндомедиум+"
Россия, г.Казань
Ямашева 36, офис 401
+7 843 207 02 10
endo@endo.ru endo.ru

endo.ru

Фото 117.Макет маркировки транспортной упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 144 листов.

Директор ООО «Эндомедиум +»

_____О.А. Гусев

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАН ШӘҺӘРЕ ЖАВАПЛЫЛЫГЫ ЧИКЛӘНГӘН ЖАМГЫЯТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ГОРОД КАЗАНЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭНДОМЕДИУМ+"
ИНН
1657024909

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU