ОКПД2 26.60.12.129

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХСОФТ»

_____ /Л.Г. Задорожный/

«13» февраля 2025 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул», в вариантах исполнения, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХСОФТ», Россия 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д

Ставрополь,
2025

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

1 Маркировка терминала

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № ……от……..

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № ……от……..

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № .....от.....

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № ……от……..

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистáнционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № ……от……..

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № .....от.....

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 10



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт





Сделано в России

РУ № .....от.....

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1

ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт

SN



Сделано в России

РУ № ……от……..


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2

ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д

Параметры сети:
230 ± 10% В, 50/60 Гц,
Потребляемая мощность 28 Вт

SN



Сделано в России

РУ № ……от……..

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2 Макет маркировки транспортной упаковки

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д






Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....

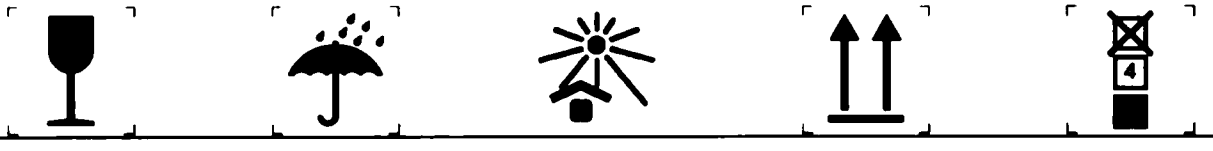

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № ……от……..



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....







ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № ……от……..



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д






Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....

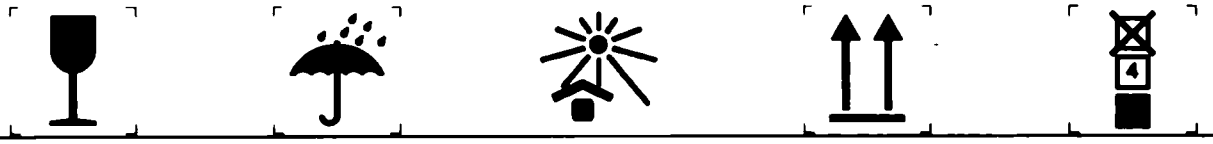

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № ……от……..







ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д







Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....











ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 10



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № ……от……..











ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул», в вариантах исполнения, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д







Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 $мс^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.


Сделано в России

РУ № .....от.....












ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 $мс^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № ……от……..



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и
скреплено 9 листов
ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Генеральный директор
_____ / Л.Г.Задорожный
« 3 » февраля 2025г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ОКПД2 26.60.12.129

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХСОФТ»

_____/Л.Г. Задорожный/

«13» февраля 2025 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Терминал аппаратно-программный
для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Производства: Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХСОФТ», Россия 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д

Ставрополь,
2025

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

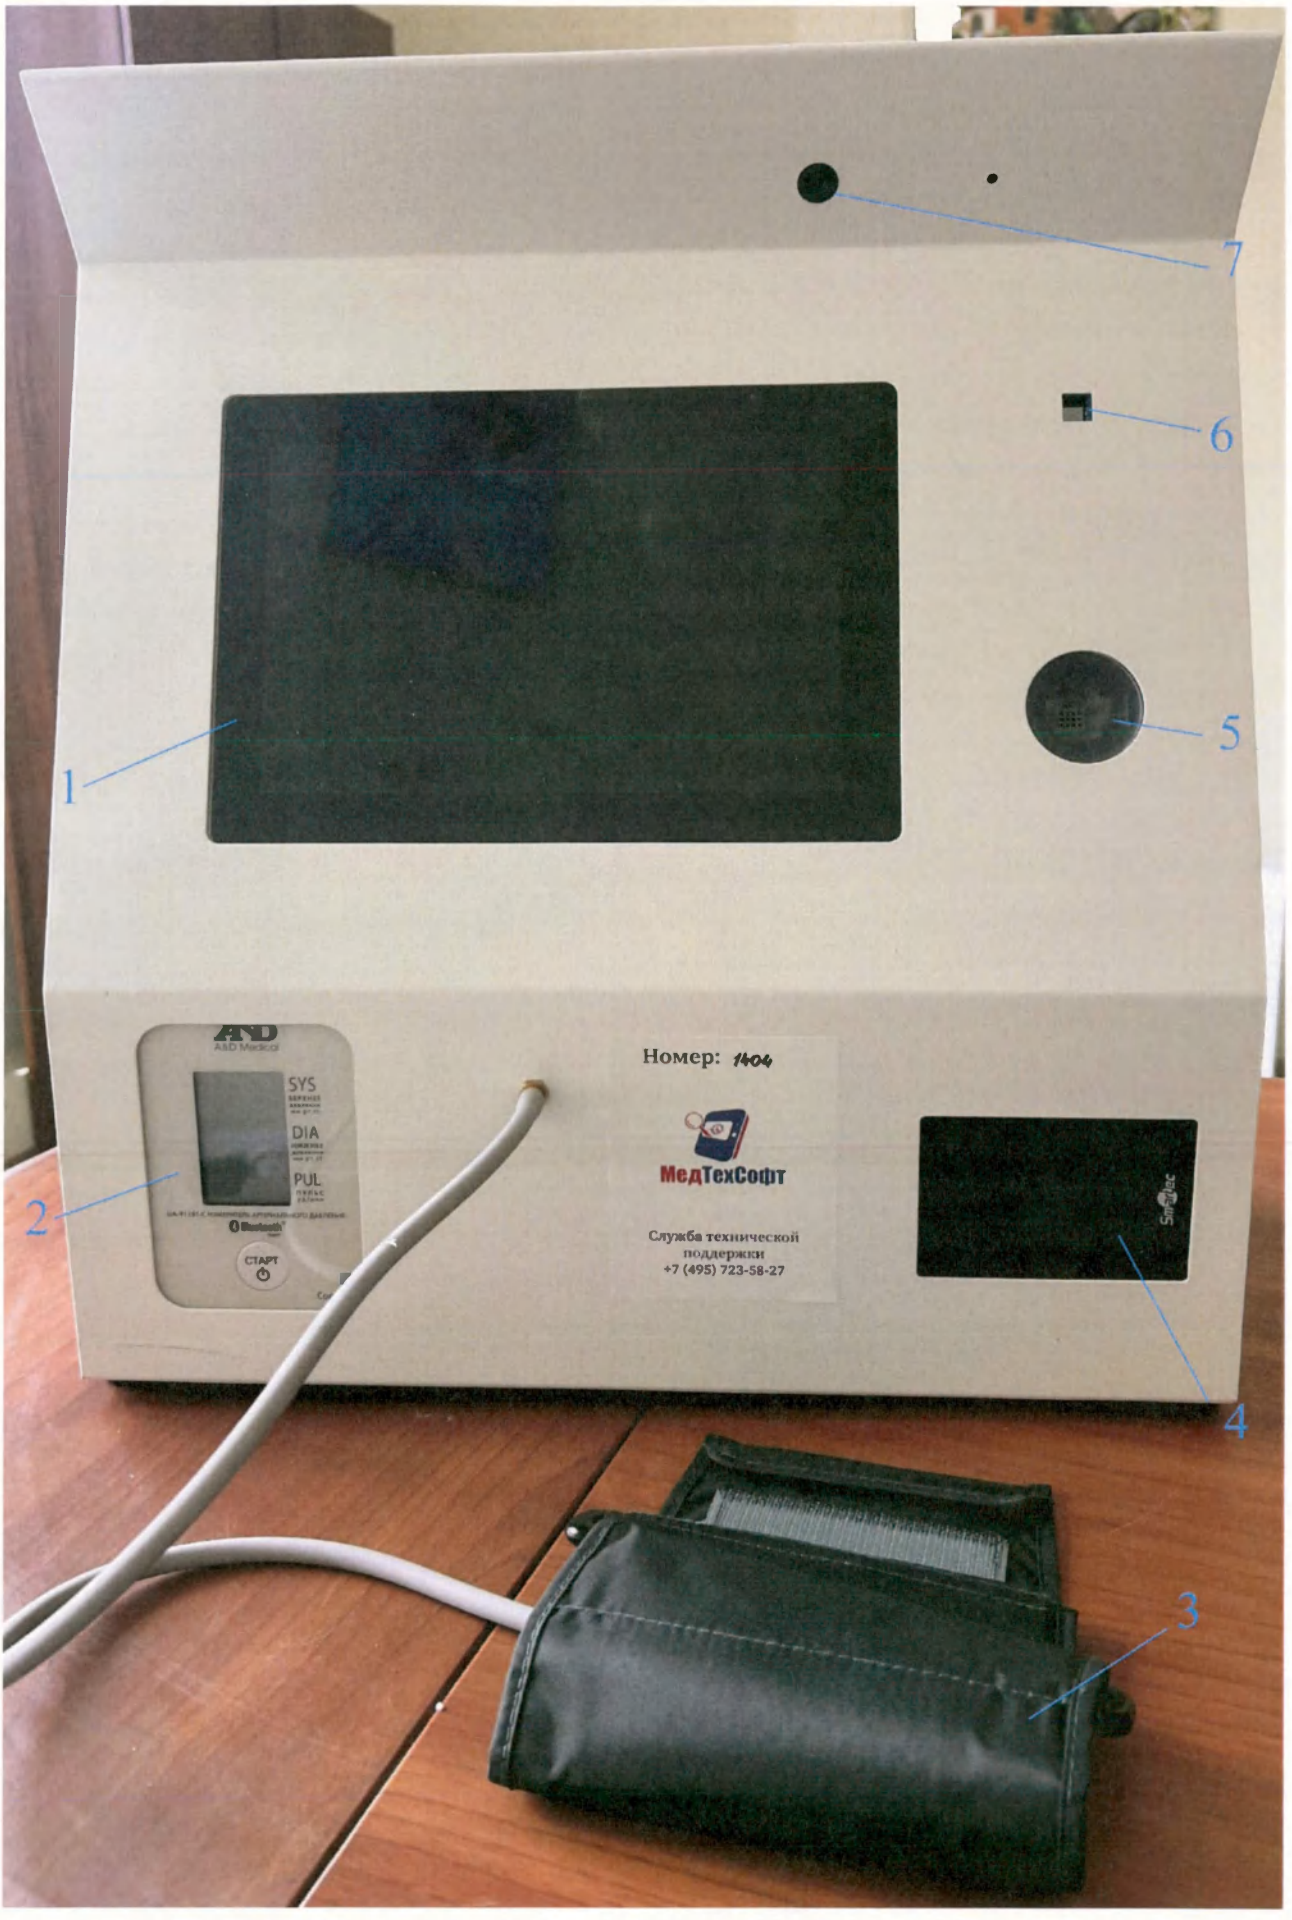

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 1 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, вид спереди:

1 – Дисплей; *2* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *3* – Манжета компрессионная Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *4* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *5* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения: Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 12.03.2018 г.); *6* – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *7* – Видеокамера RER-USB30W02M

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 2 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, вид спереди

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 3 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 4 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 5 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, вид слева:

1 – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 6 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5, вид справа:

1 – Кнопка питания терминала; *2, 3* – Разъем USB; *4* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

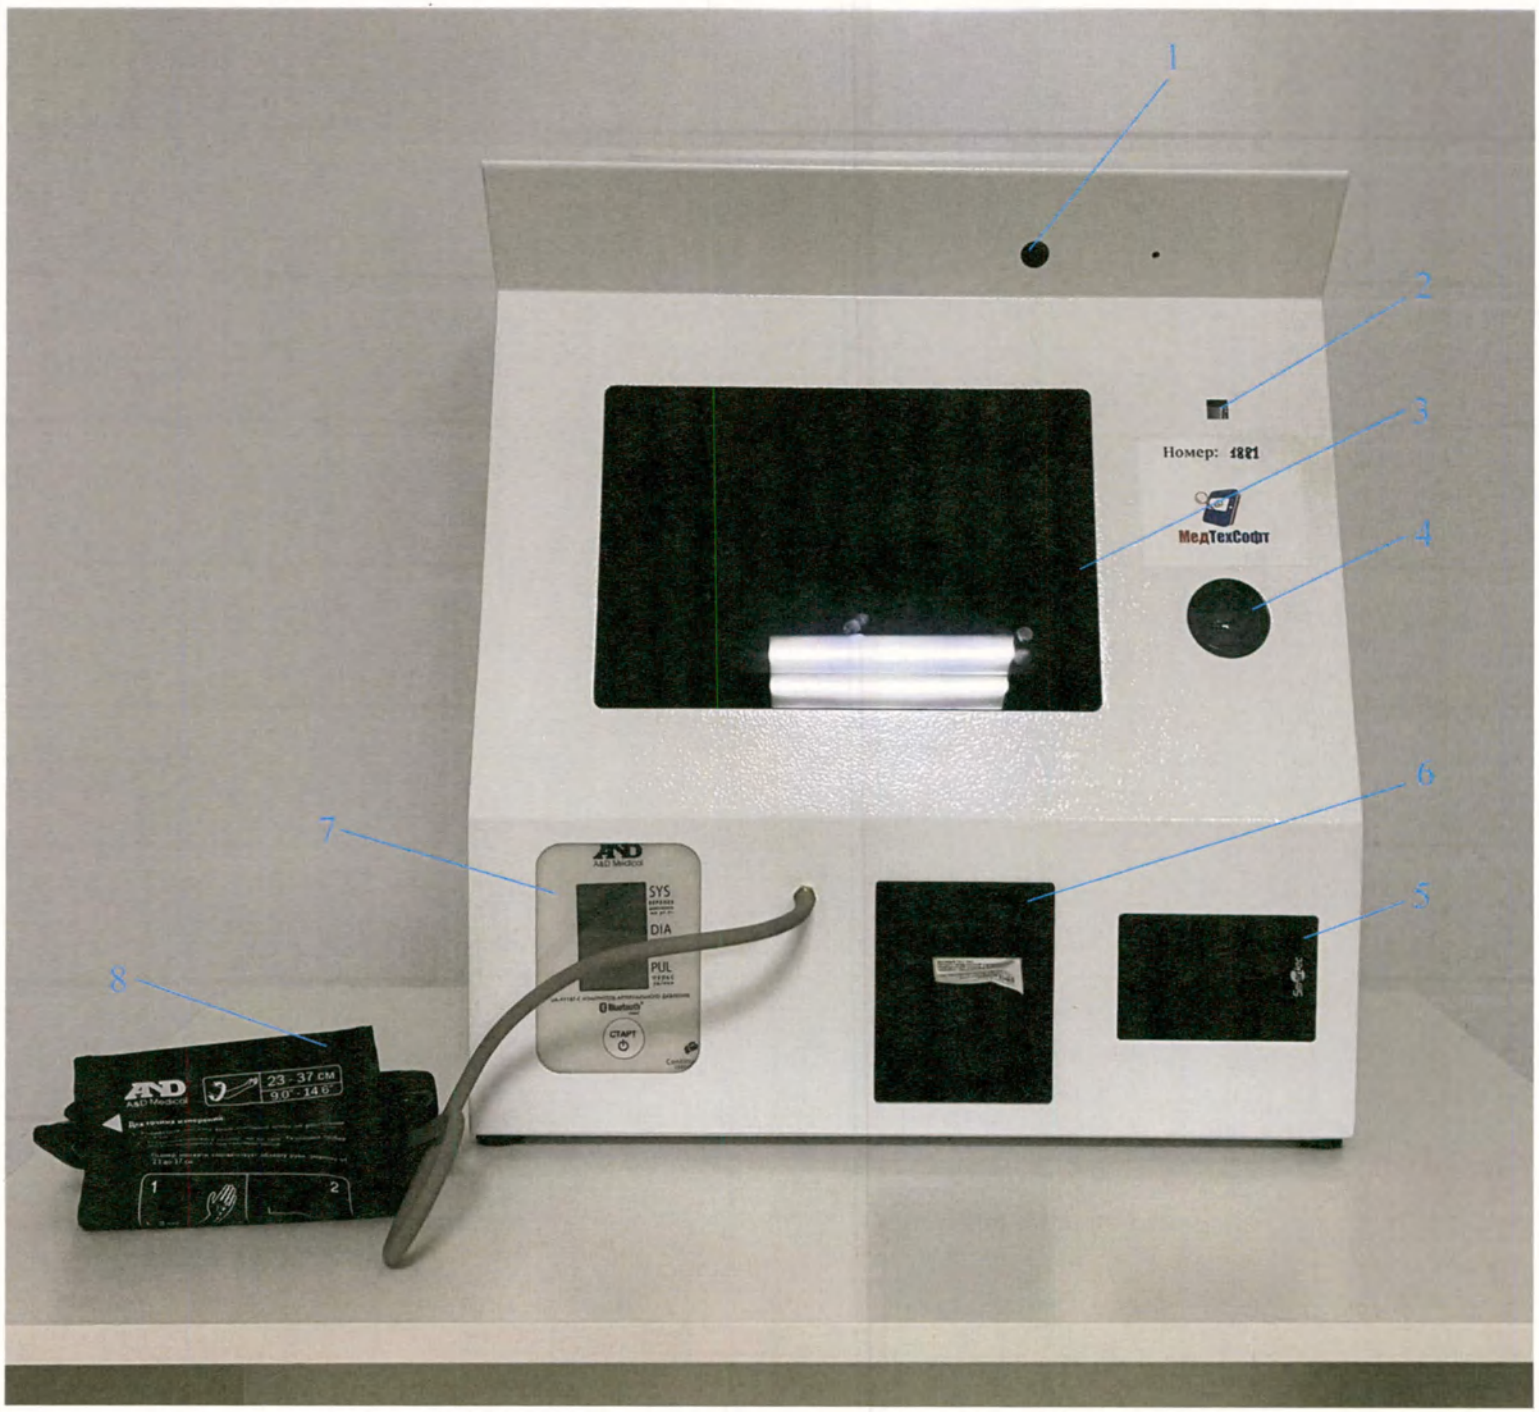

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 7 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1, вид спереди:

1 – Видеокамера RER-USB30W02M; *2* – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *3* – Дисплей; *4* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *5* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *6* – Термопринтер HSPOS XC-K23; *7* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *8* – Манжета компрессионная Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 8 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

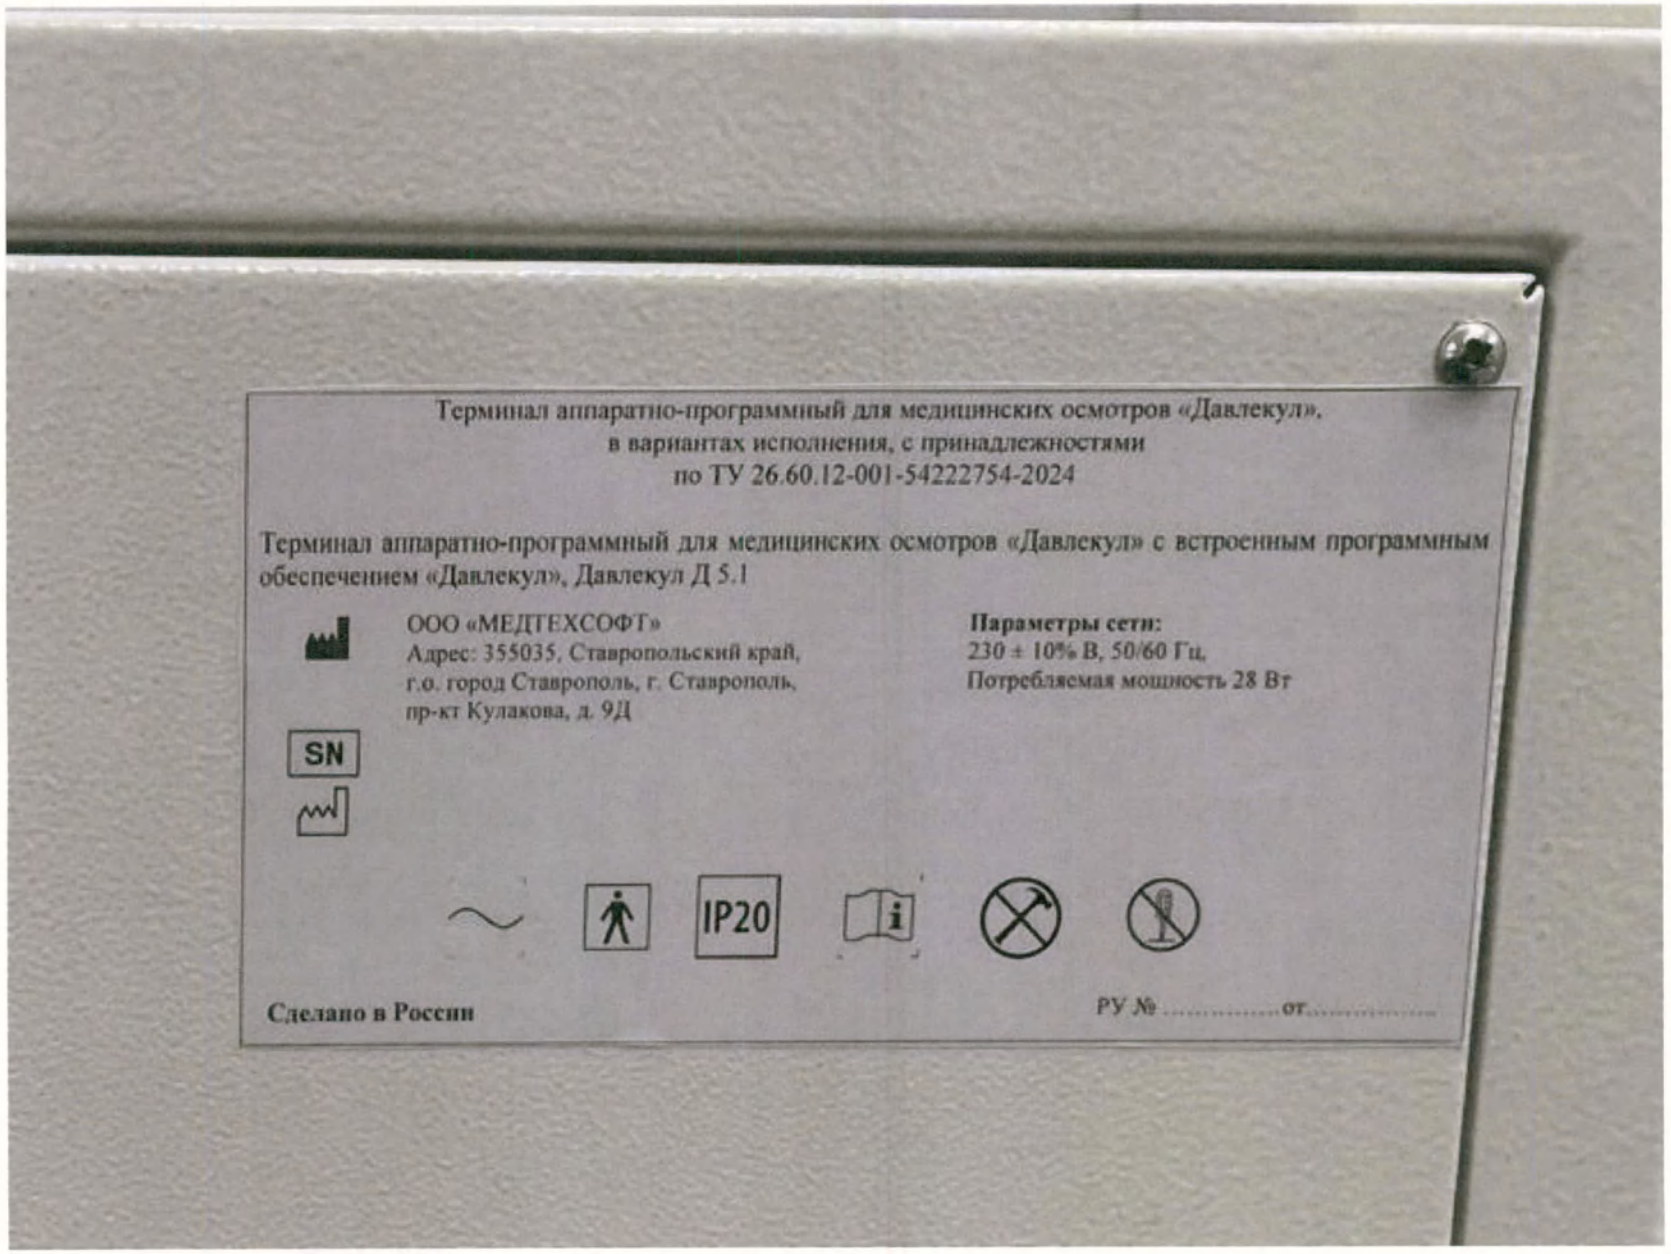


Рисунок 9 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

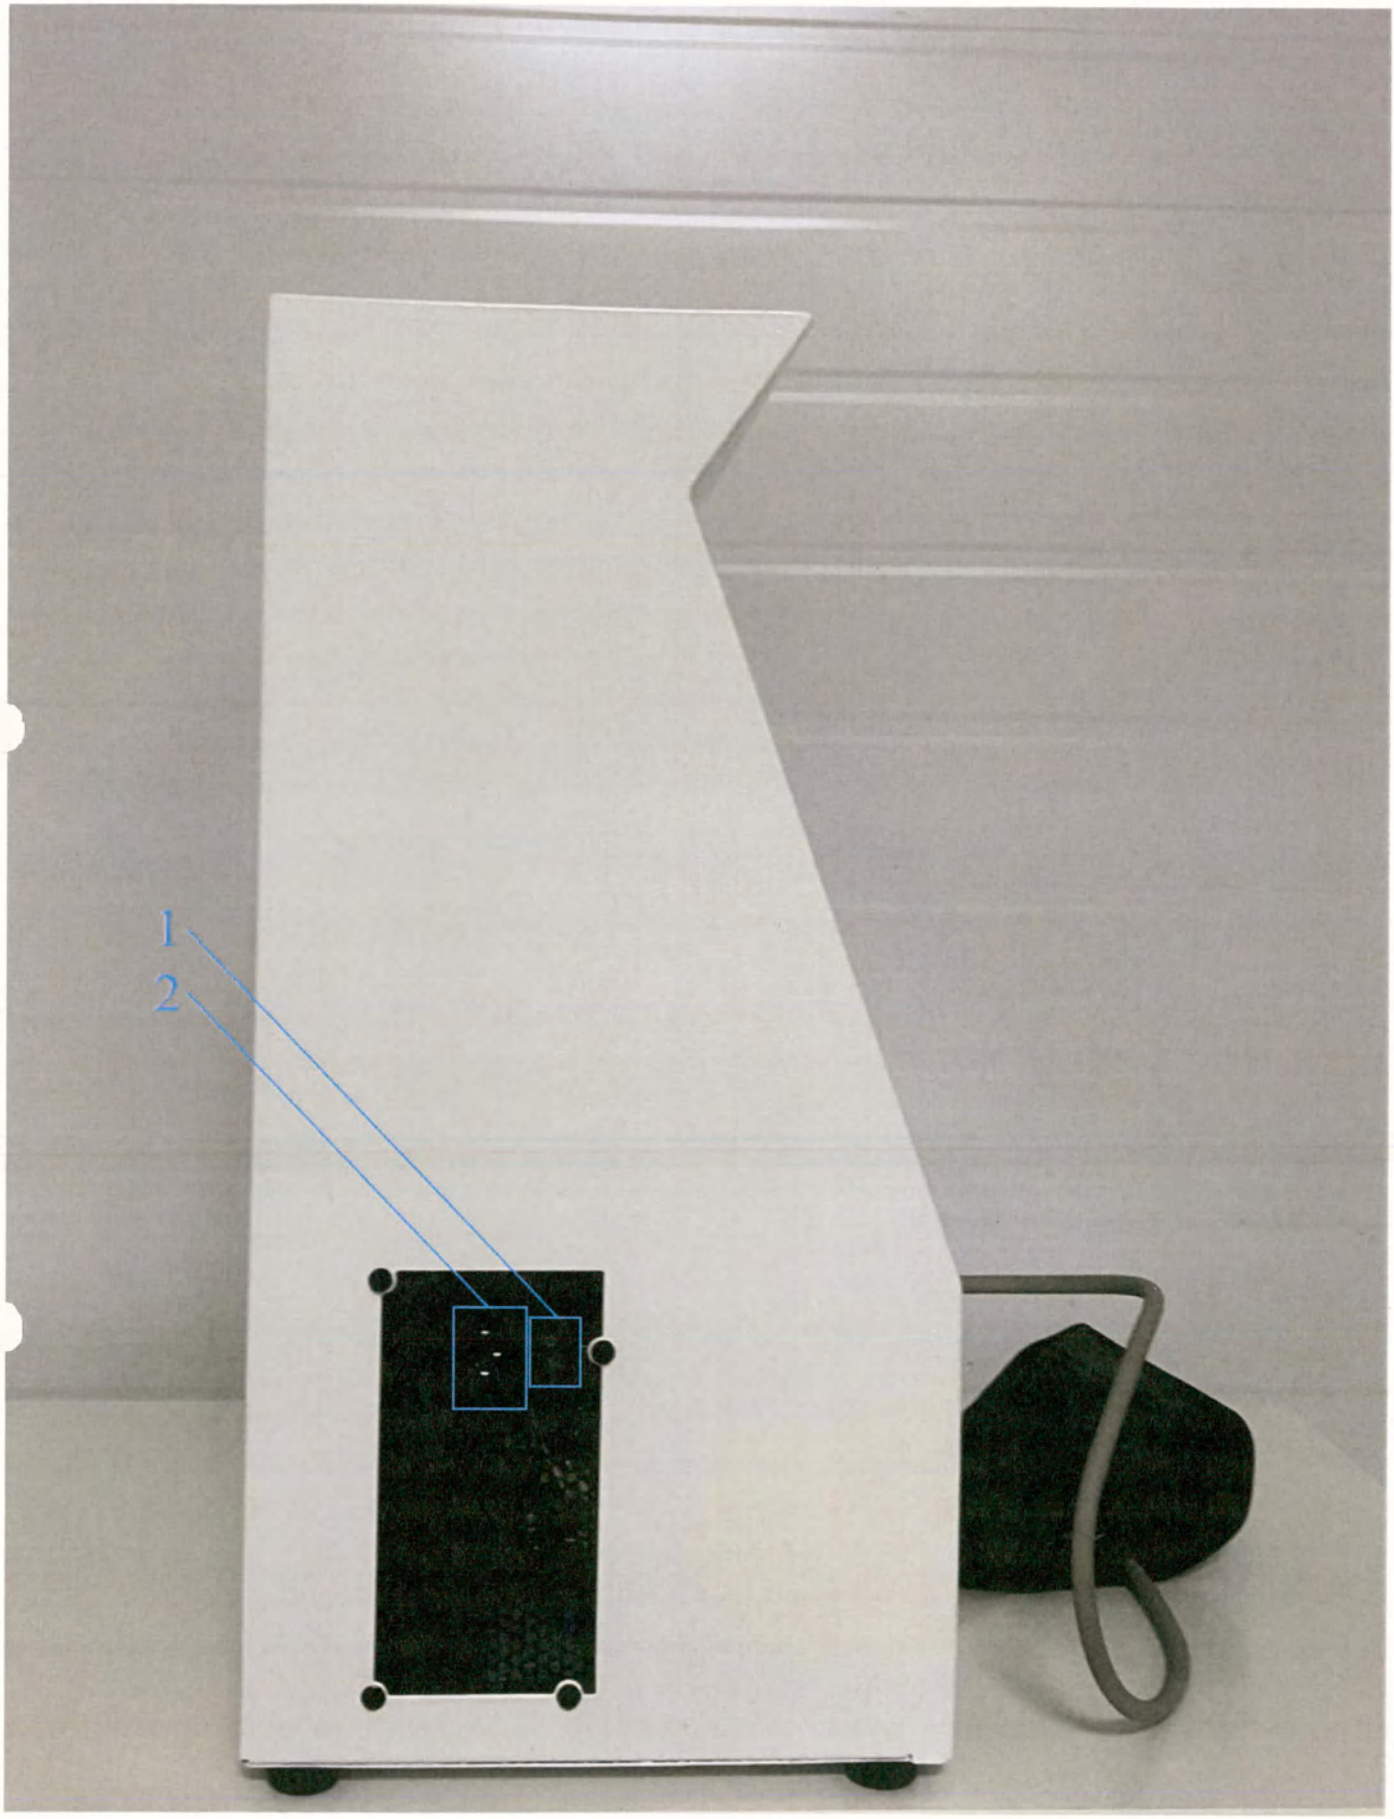


Рисунок 10 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1, вид слева:

1 – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

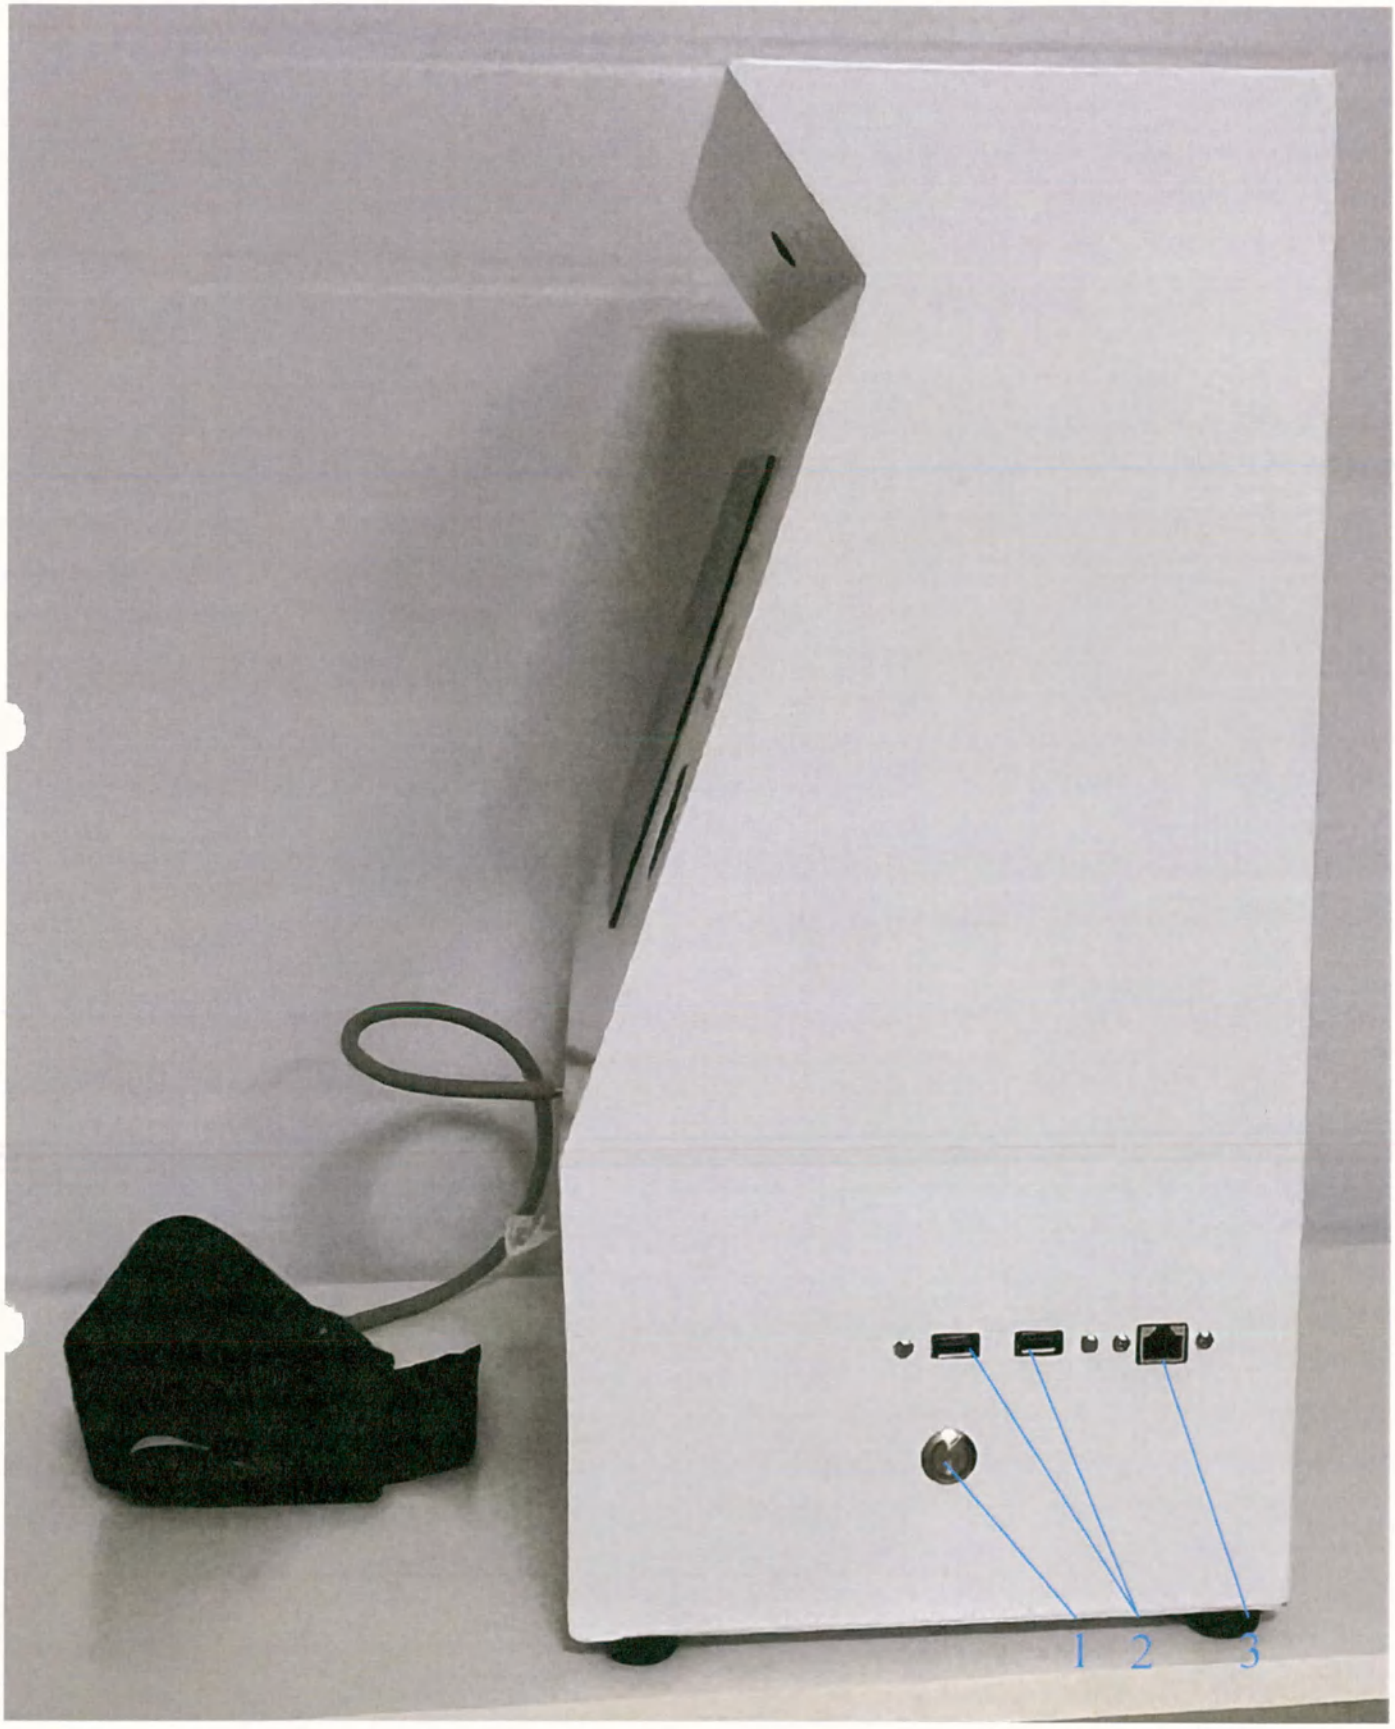


Рисунок 11 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1, вид справа:
1 – Кнопка питания терминала; *2* – Разъем USB; *3* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 12 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10, вид спереди:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *2* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *3* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *4* – Видеокамера RER-USB30W02M; *5* – Дисплей; *6* – Термопринтер этикеток Xprinter XP – 235B; *7* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *8* – Манжета компрессионная Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

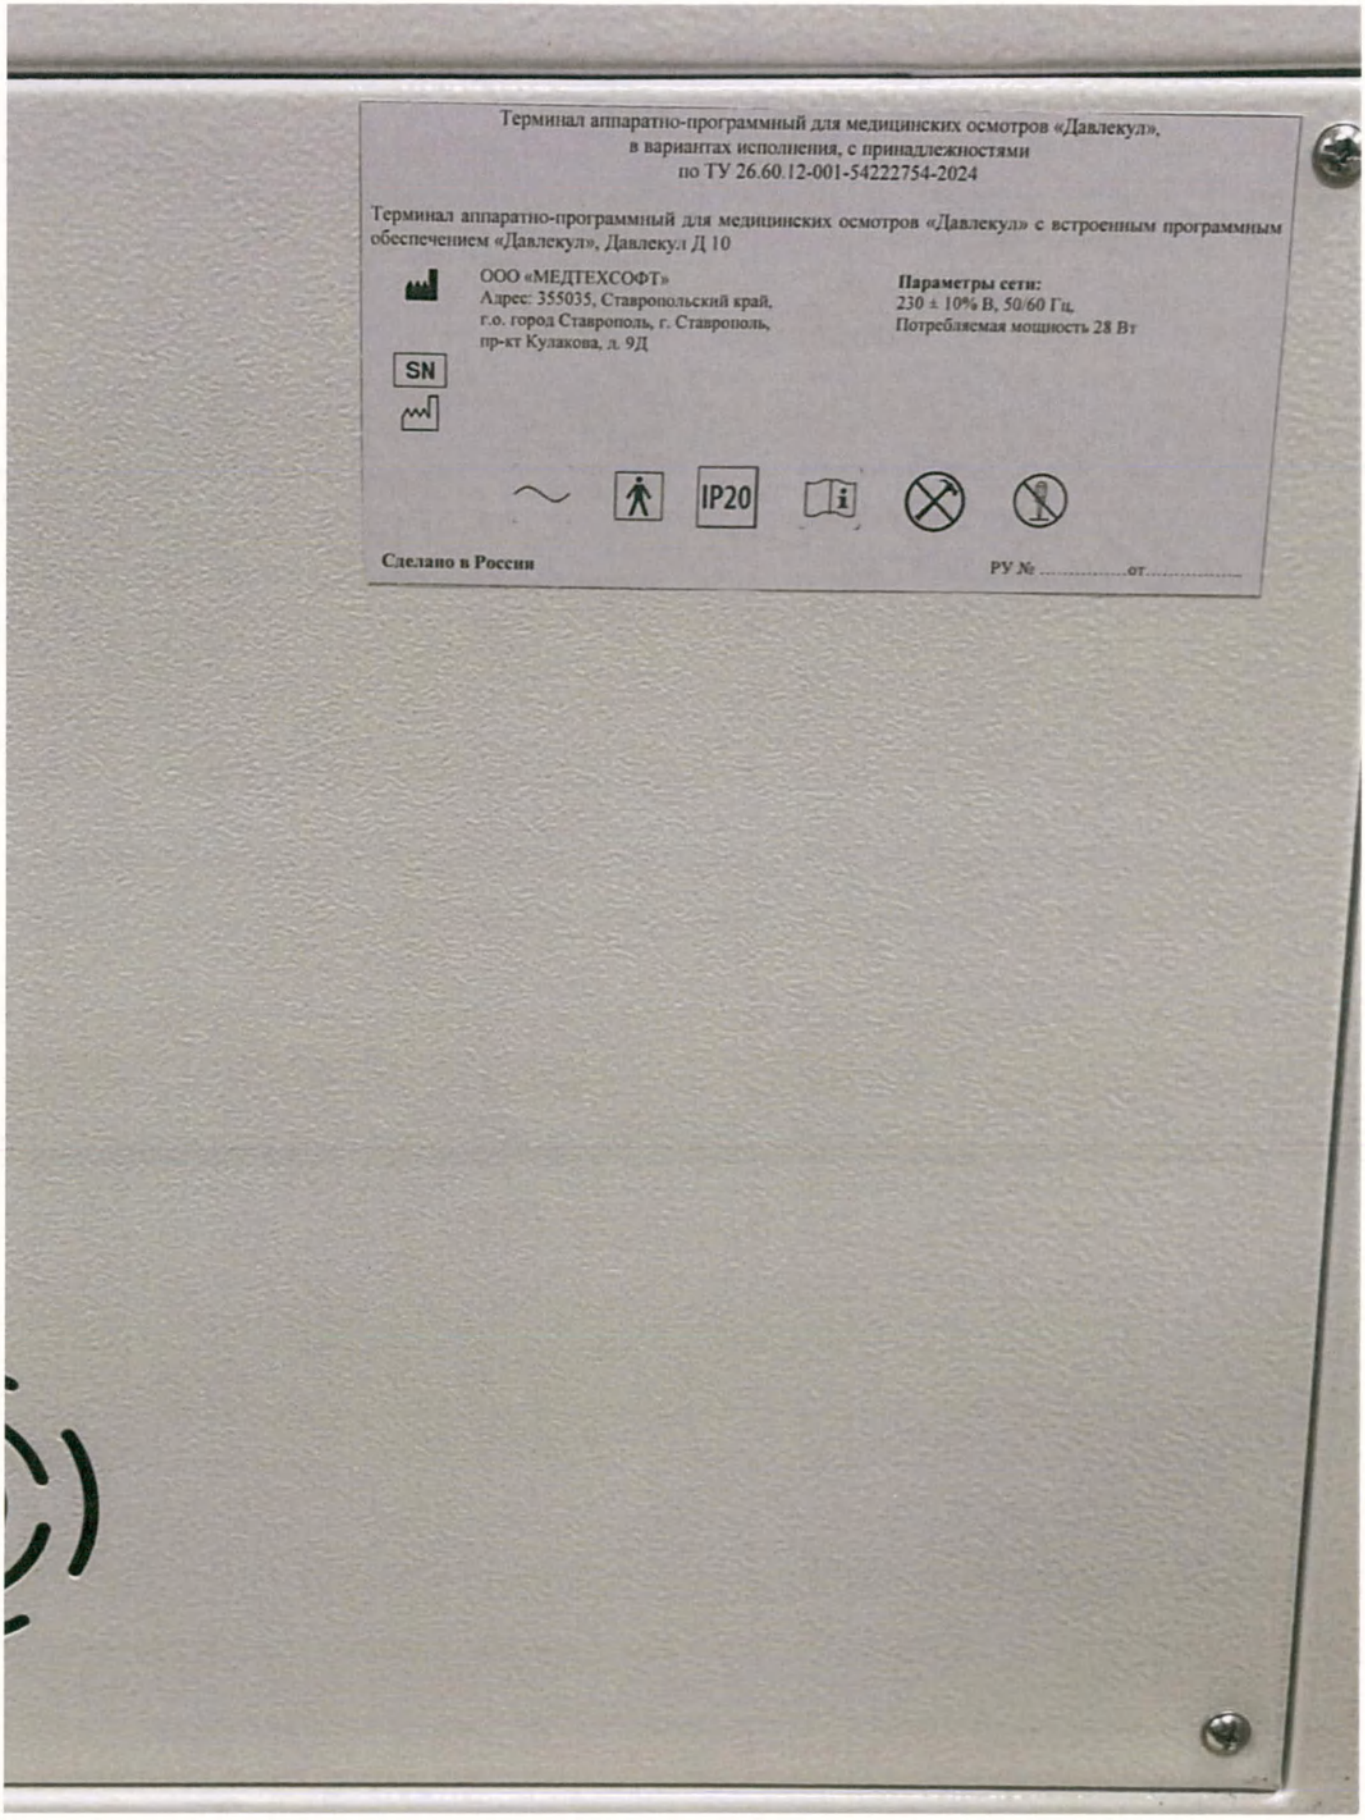


Рисунок 13 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

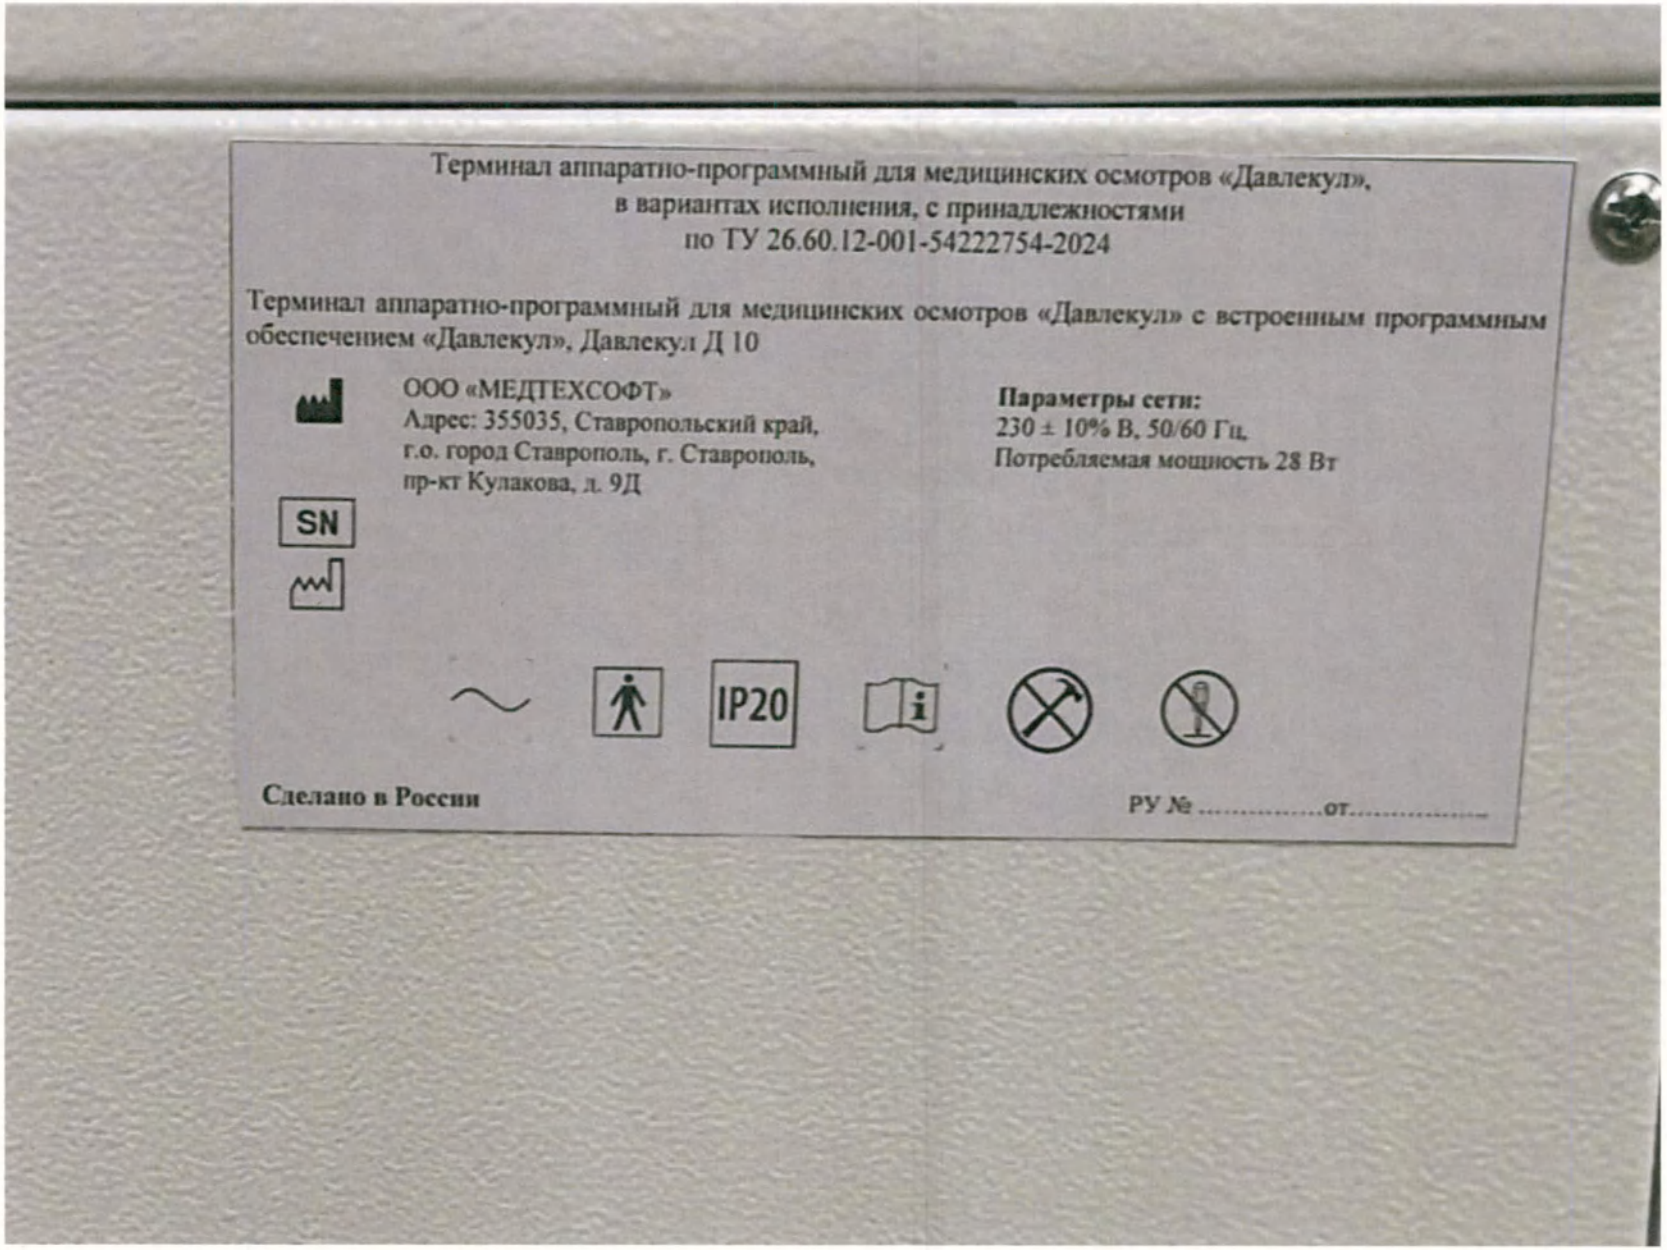


Рисунок 14 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 15 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10, вид слева:

1 – Разъем RJ-45; *2* – Разъем USB

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

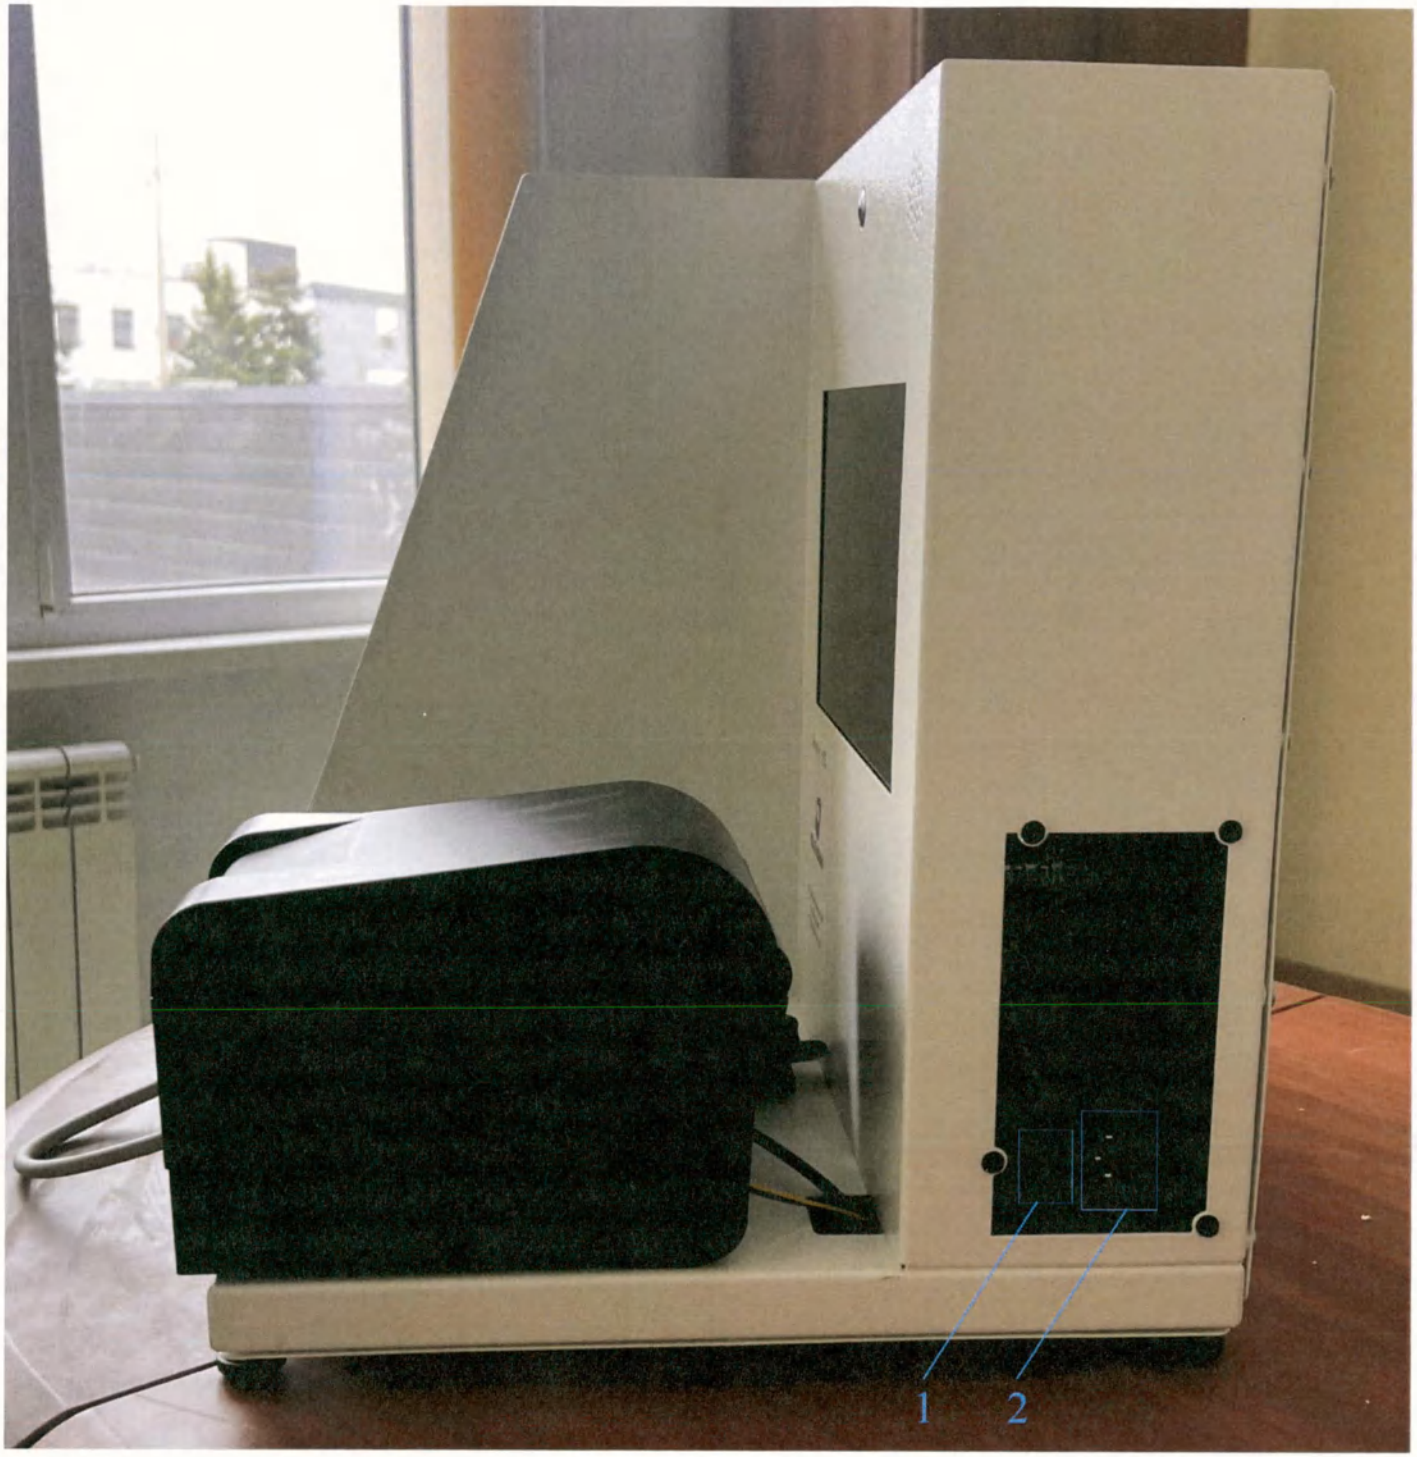


Рисунок 16 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10, вид справа:
1 – Переключатель включения/выключения; 2 – Разъем для подключения кабеля питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 17 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1, вид спереди: 1 – Видеокамера HBVCAM 1807; 2 – Видеокамера 2 RER-USB30W02M; 3 – Дисплей; 4 – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения: JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); 5 – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); 6 – Настольный RFID считыватель Smartec ST-CE011MF; 7 – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); 8 –

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Манжета компрессионная Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); 9 – Термопринтер этикеток HSPOS HS-K23

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

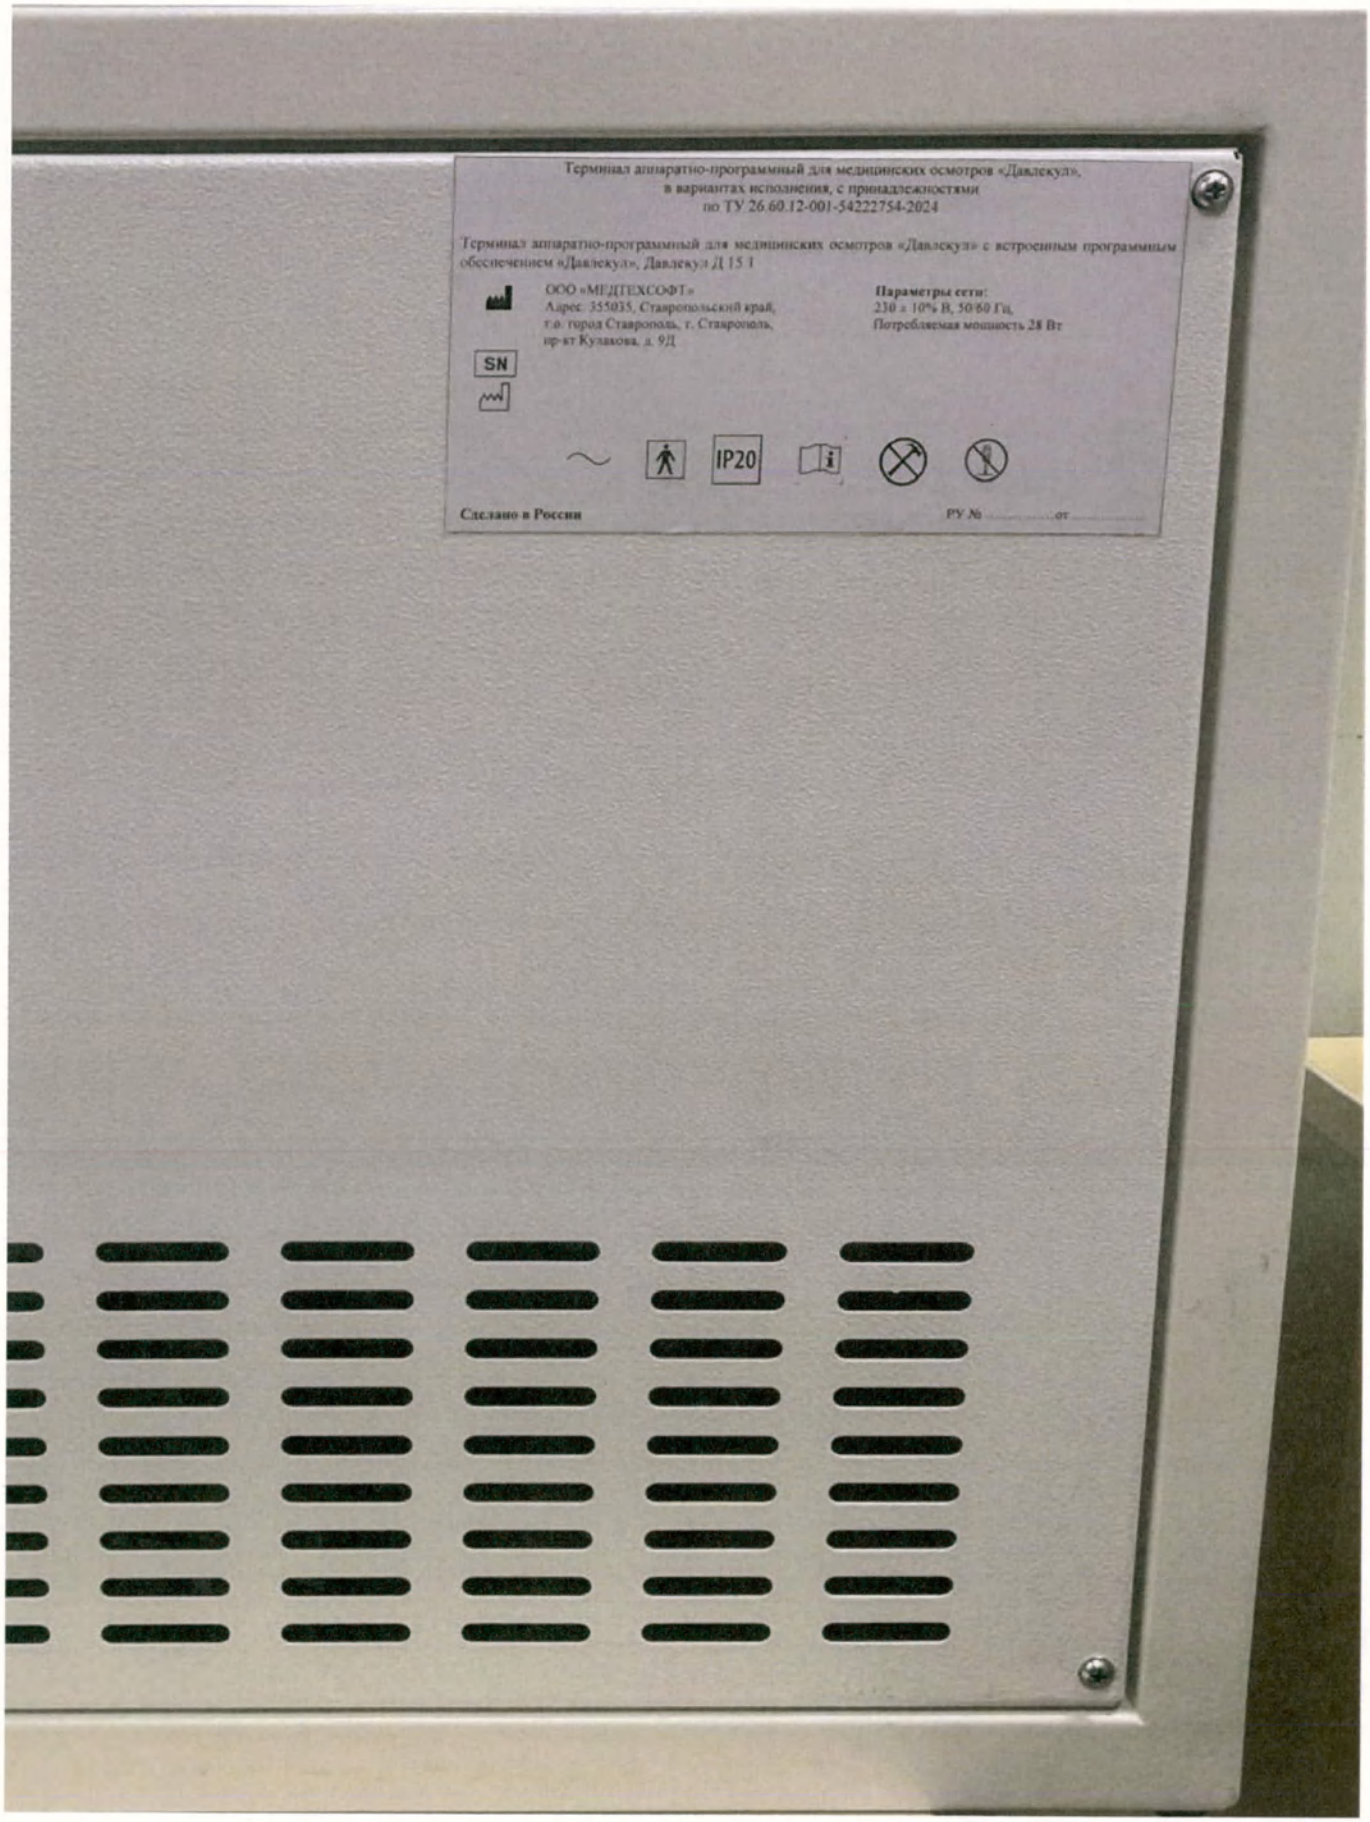


Рисунок 18 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

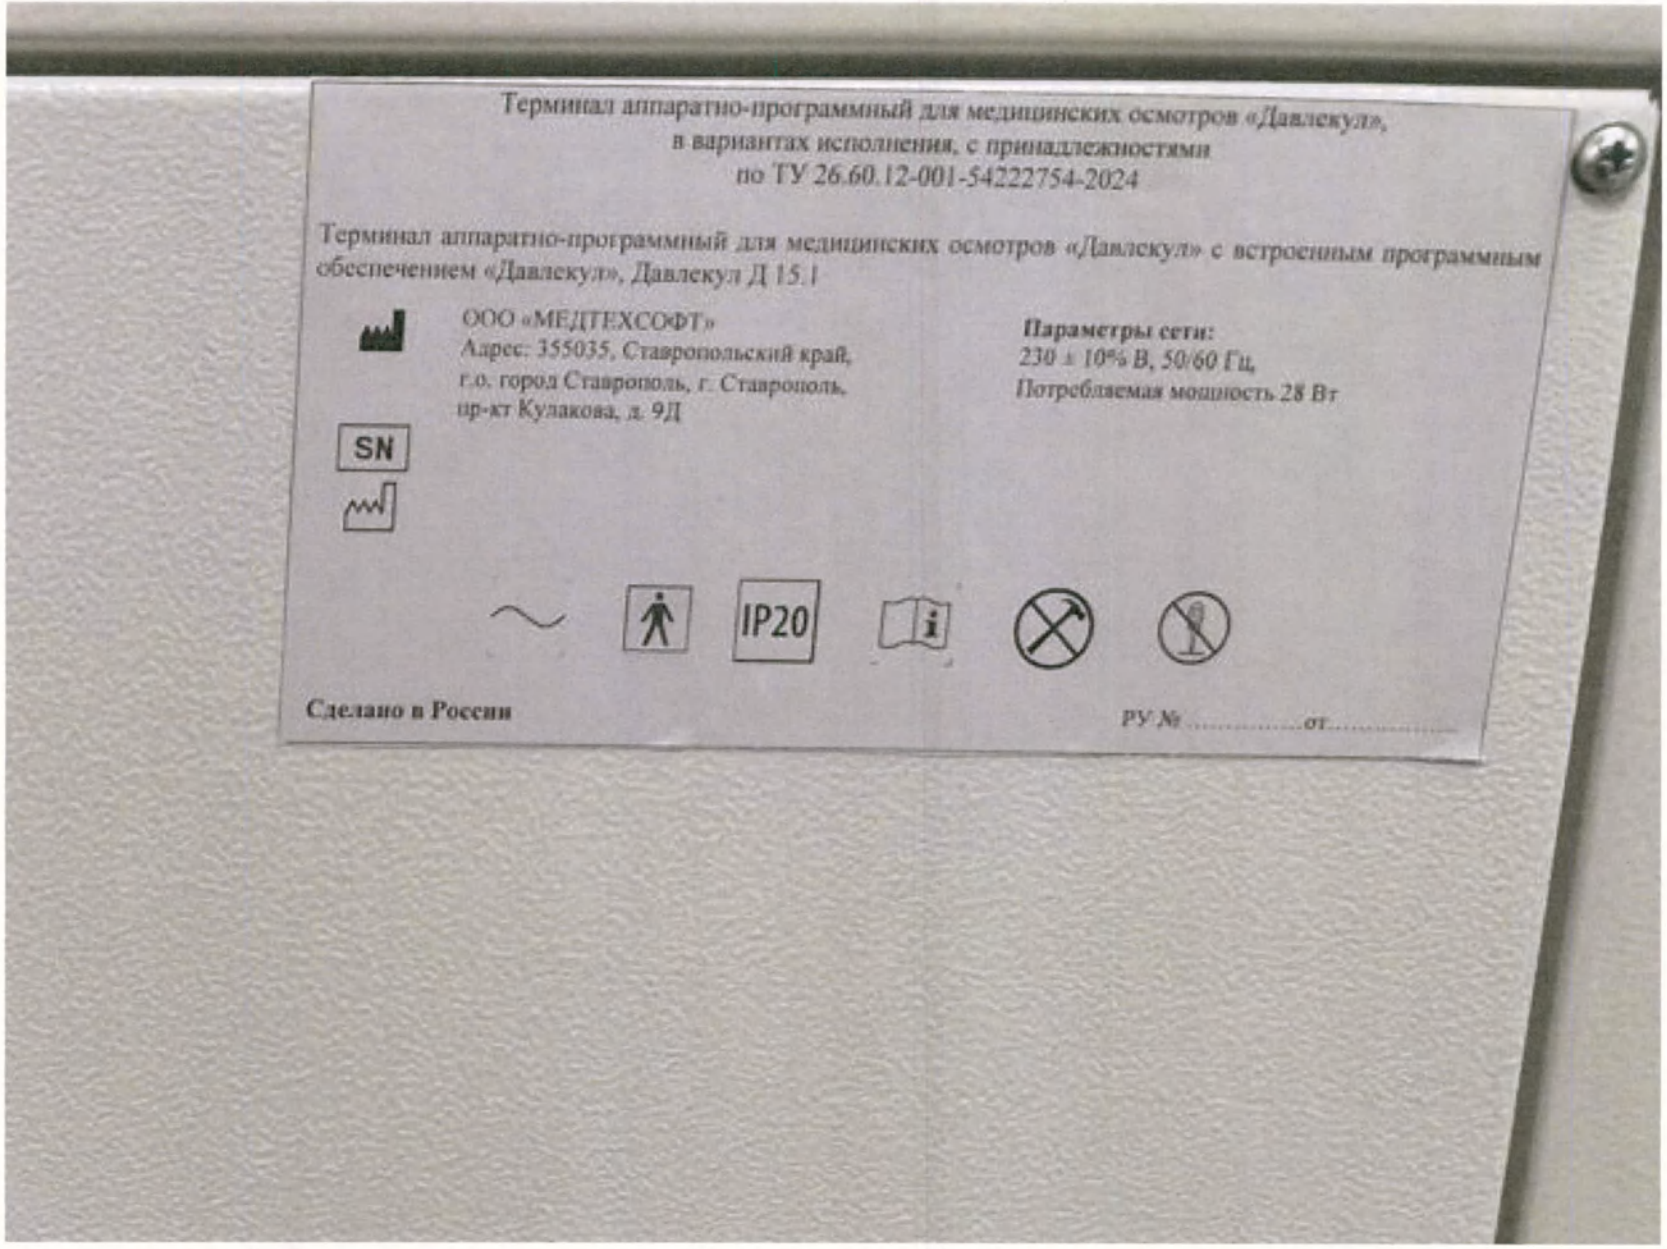


Рисунок 19 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

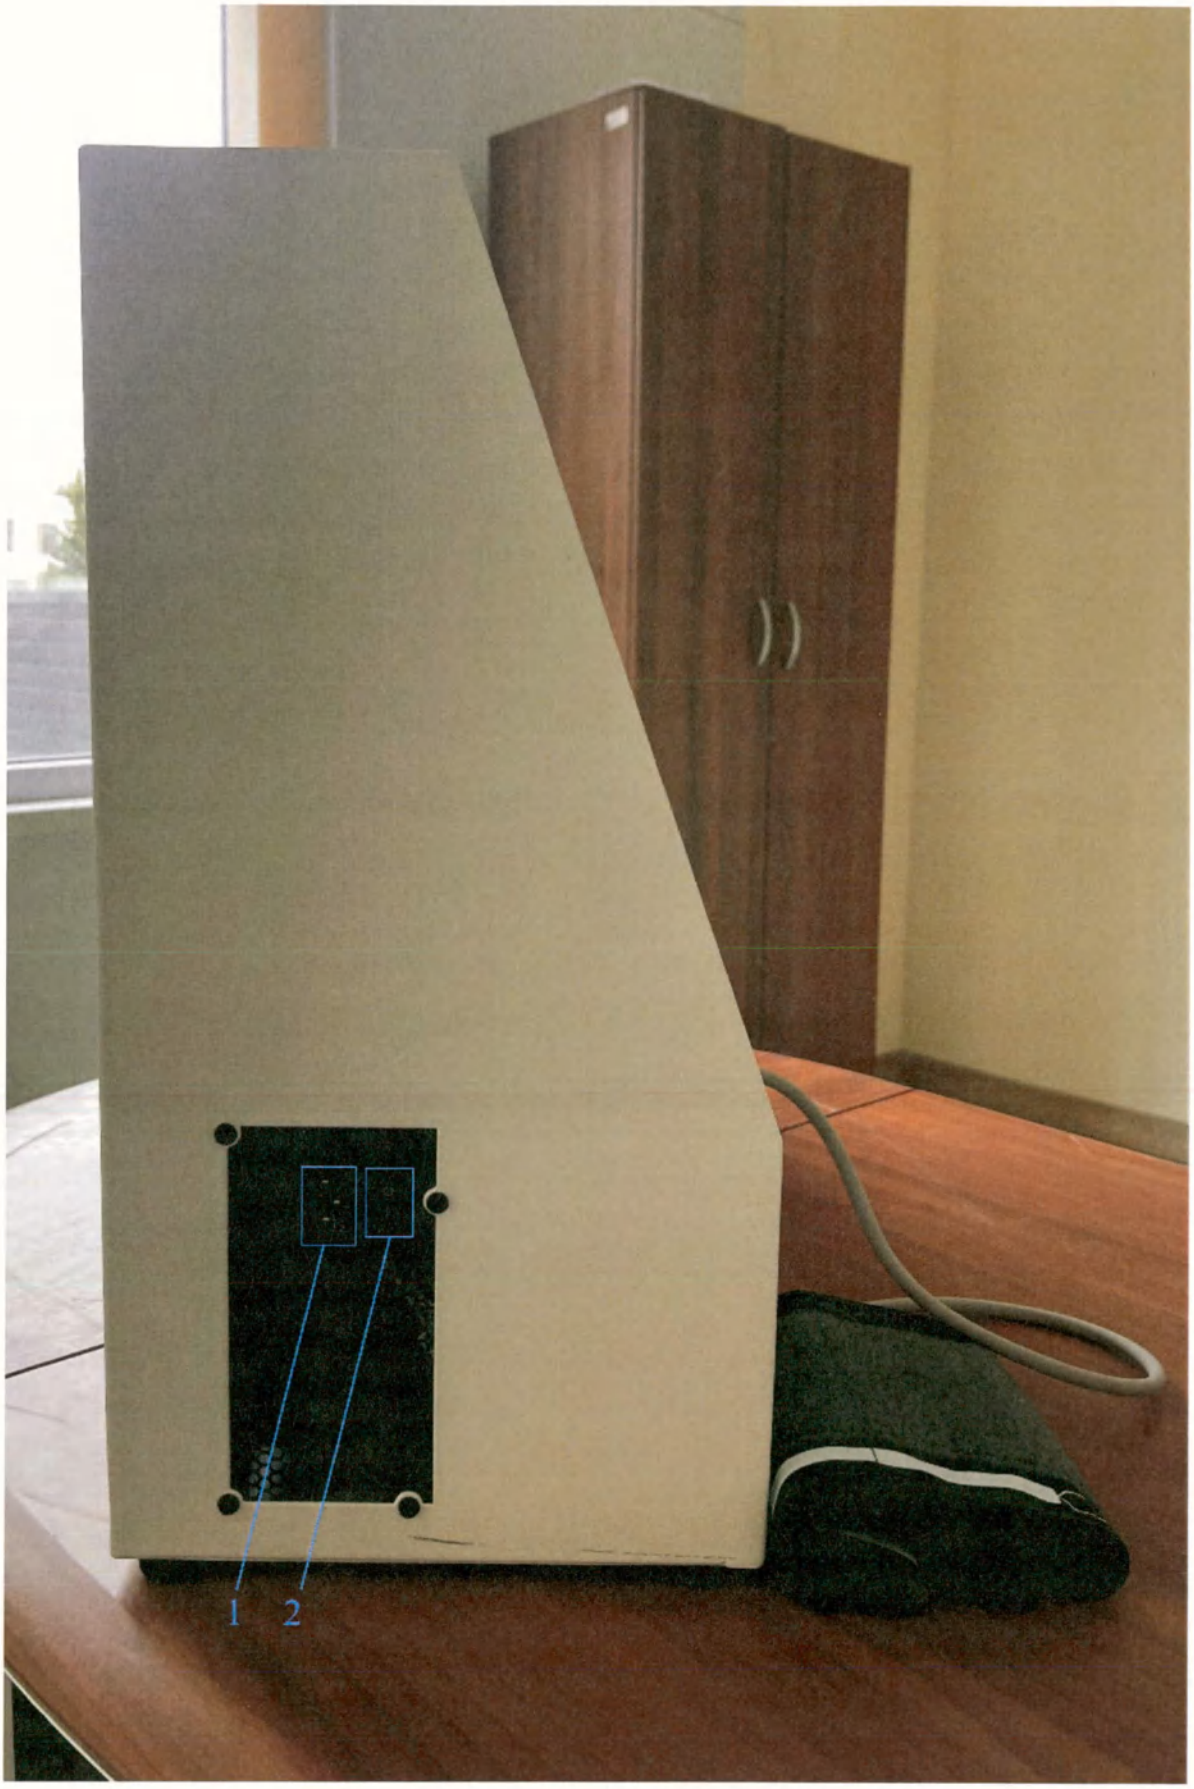


Рисунок 20 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1, вид слева:
1 – Разъем для подключения кабеля питания; 2 – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


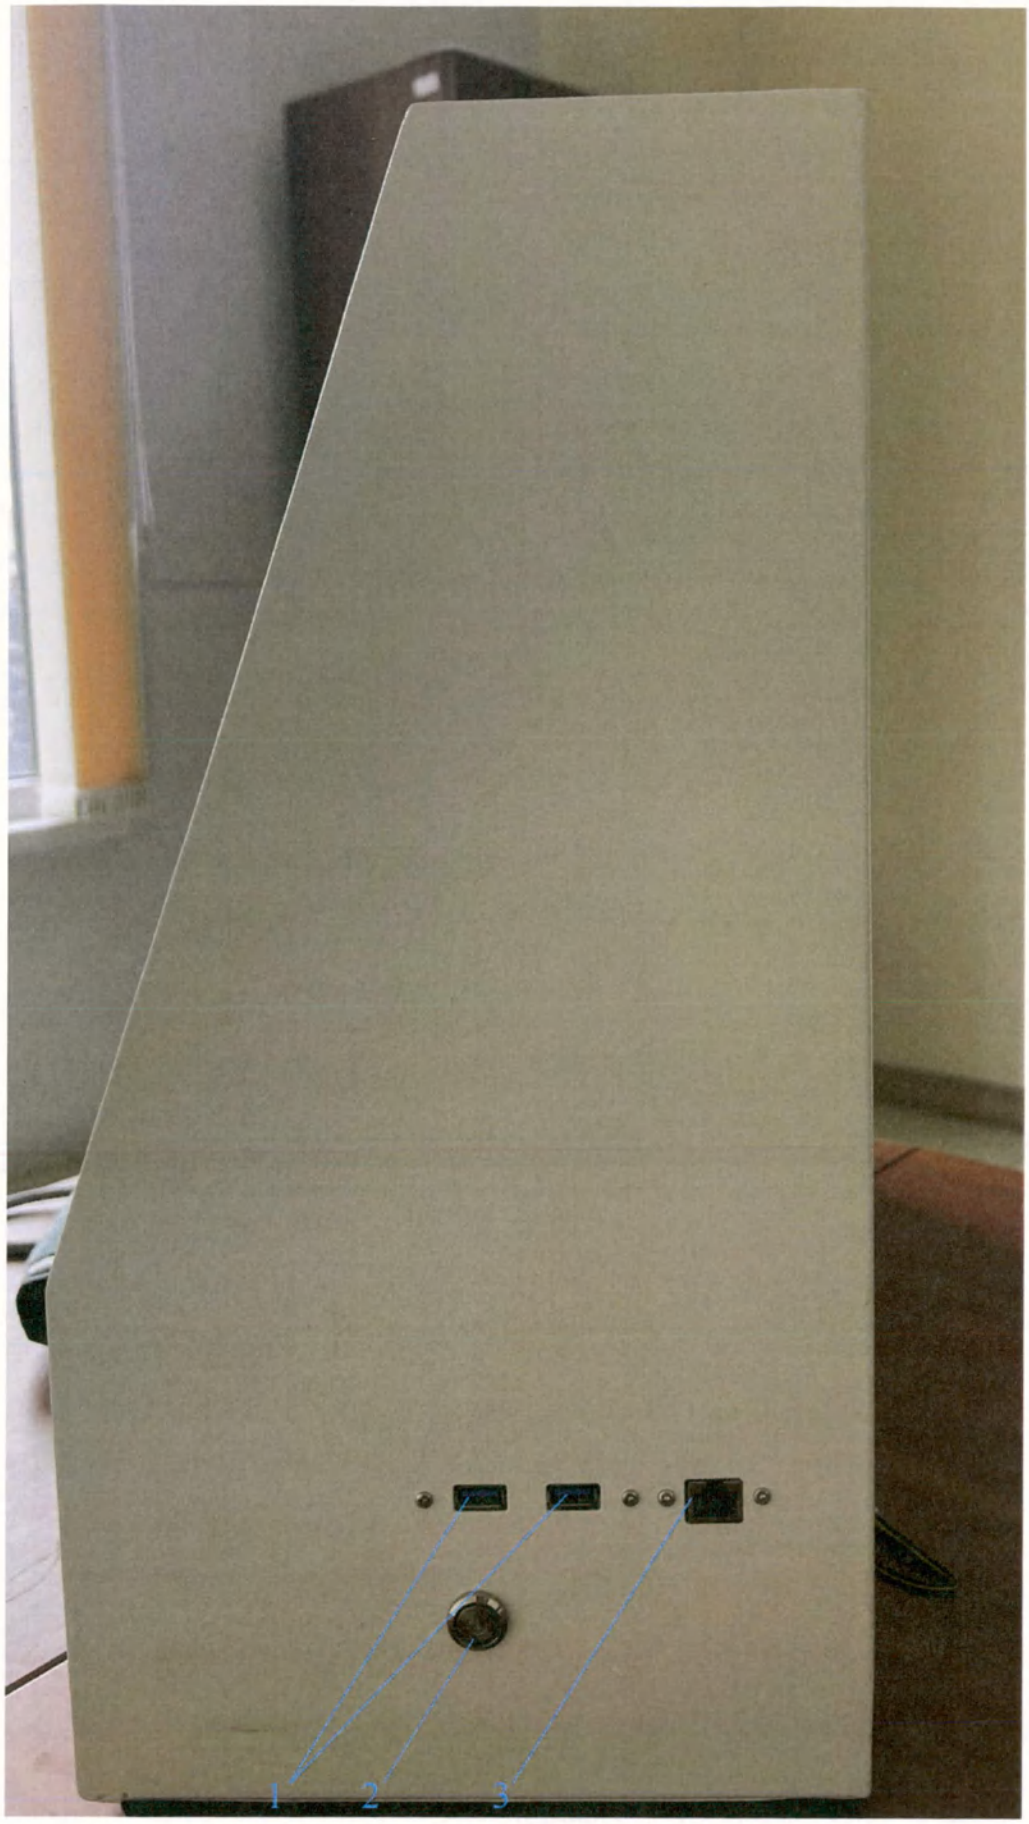


Рисунок 21 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1, вид справа

1 – Разъем USB; 2 – Кнопка питания терминала; 3 – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

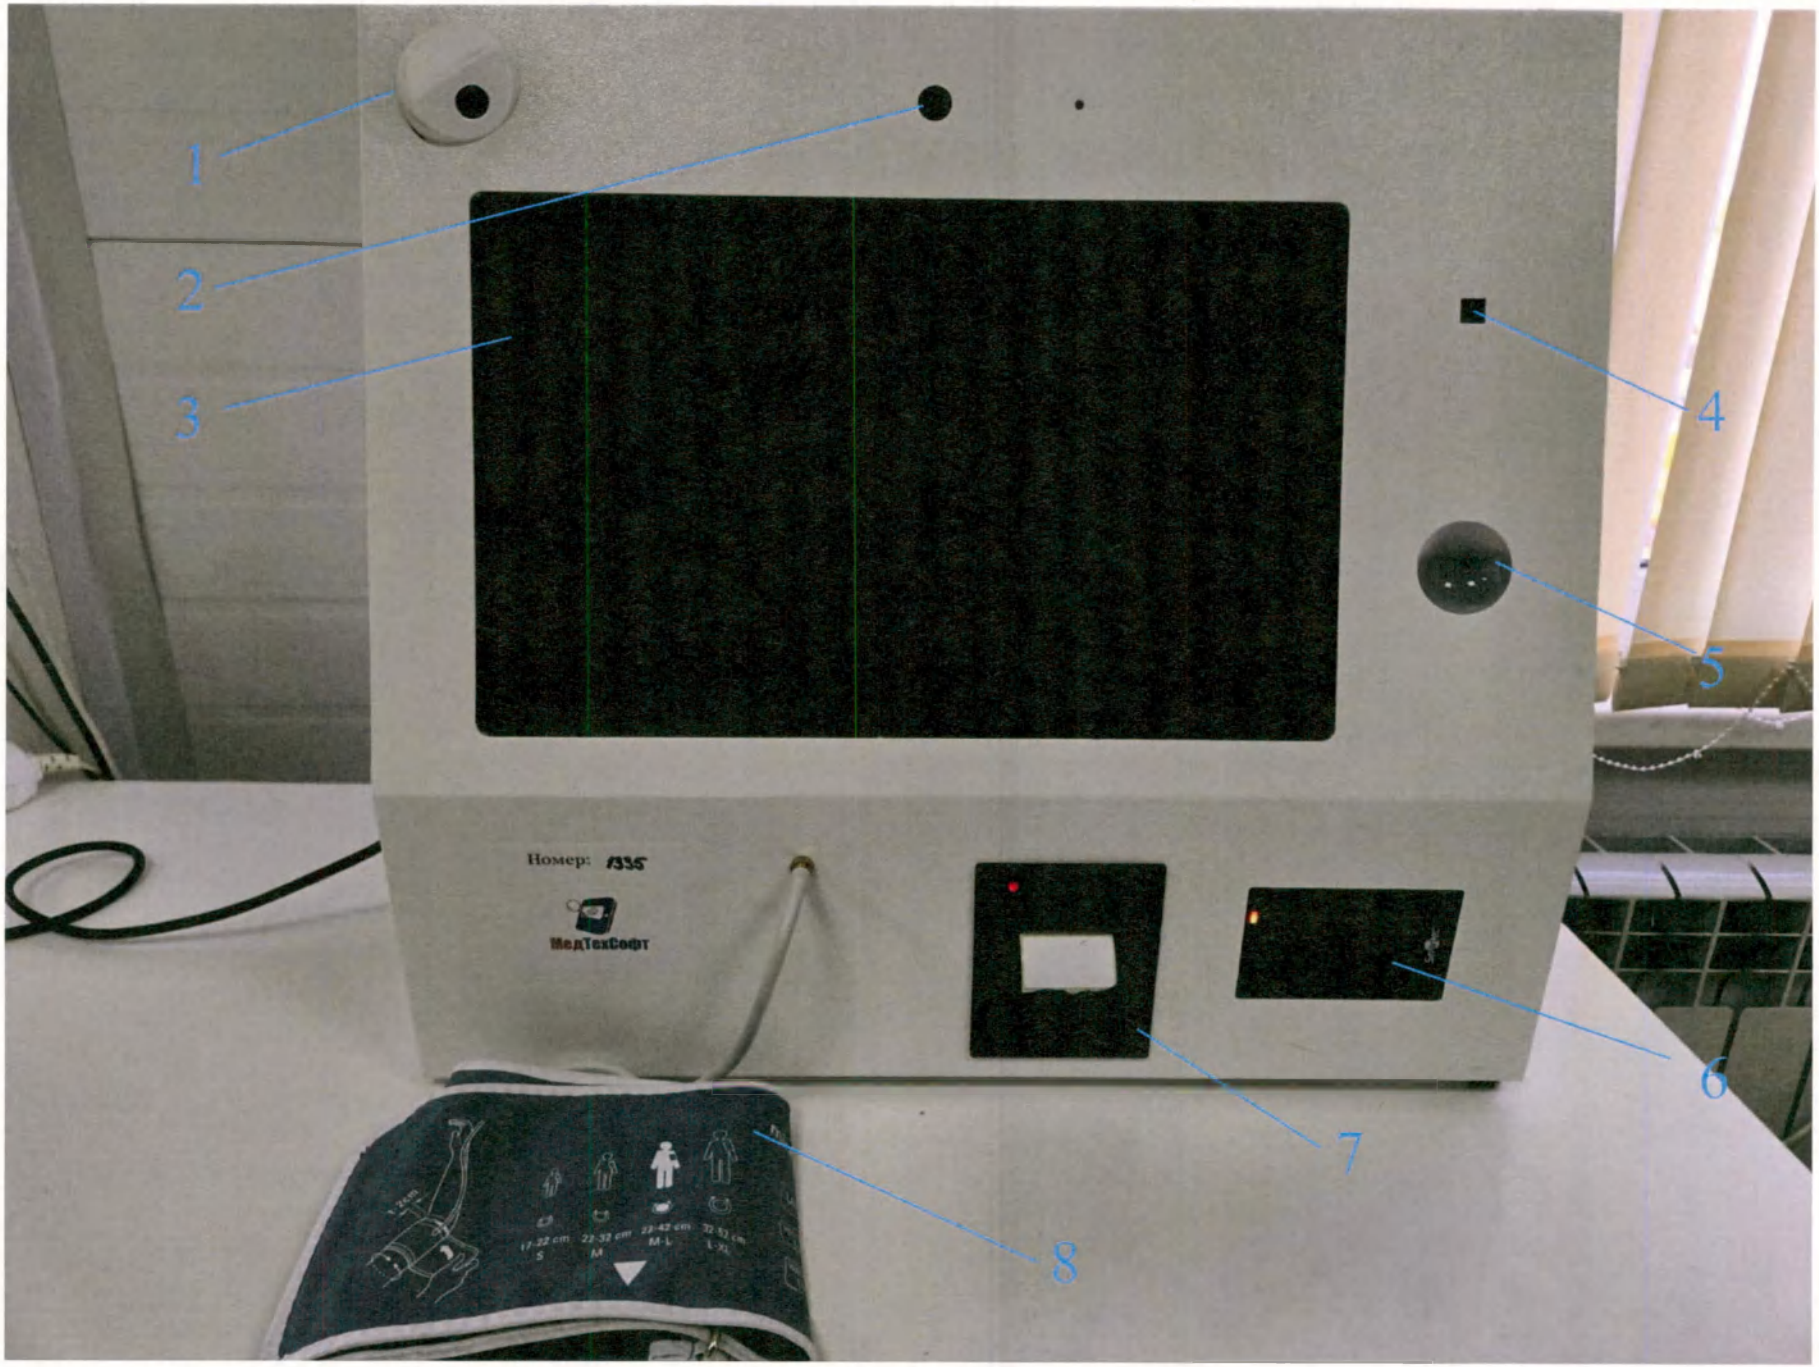

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 22 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2, вид спереди:

1 – Видеокамера HBVCAM 1807; 2 – Видеокамера 2 RER-USB30W02M; 3 – Дисплей; 4 – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения: JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); 5 – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); 6 – Настольный RFID считыватель Smartec ST-CE011MF; 7 – Термопринтер этикеток HSPOS HS-K23; 8 – Манжета Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса серии Watch BP Office портативный с манжетой на одно плечо, Watch BP Office с функцией Central (РУ № РЗН 2023/21110 от 15.01.2024 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

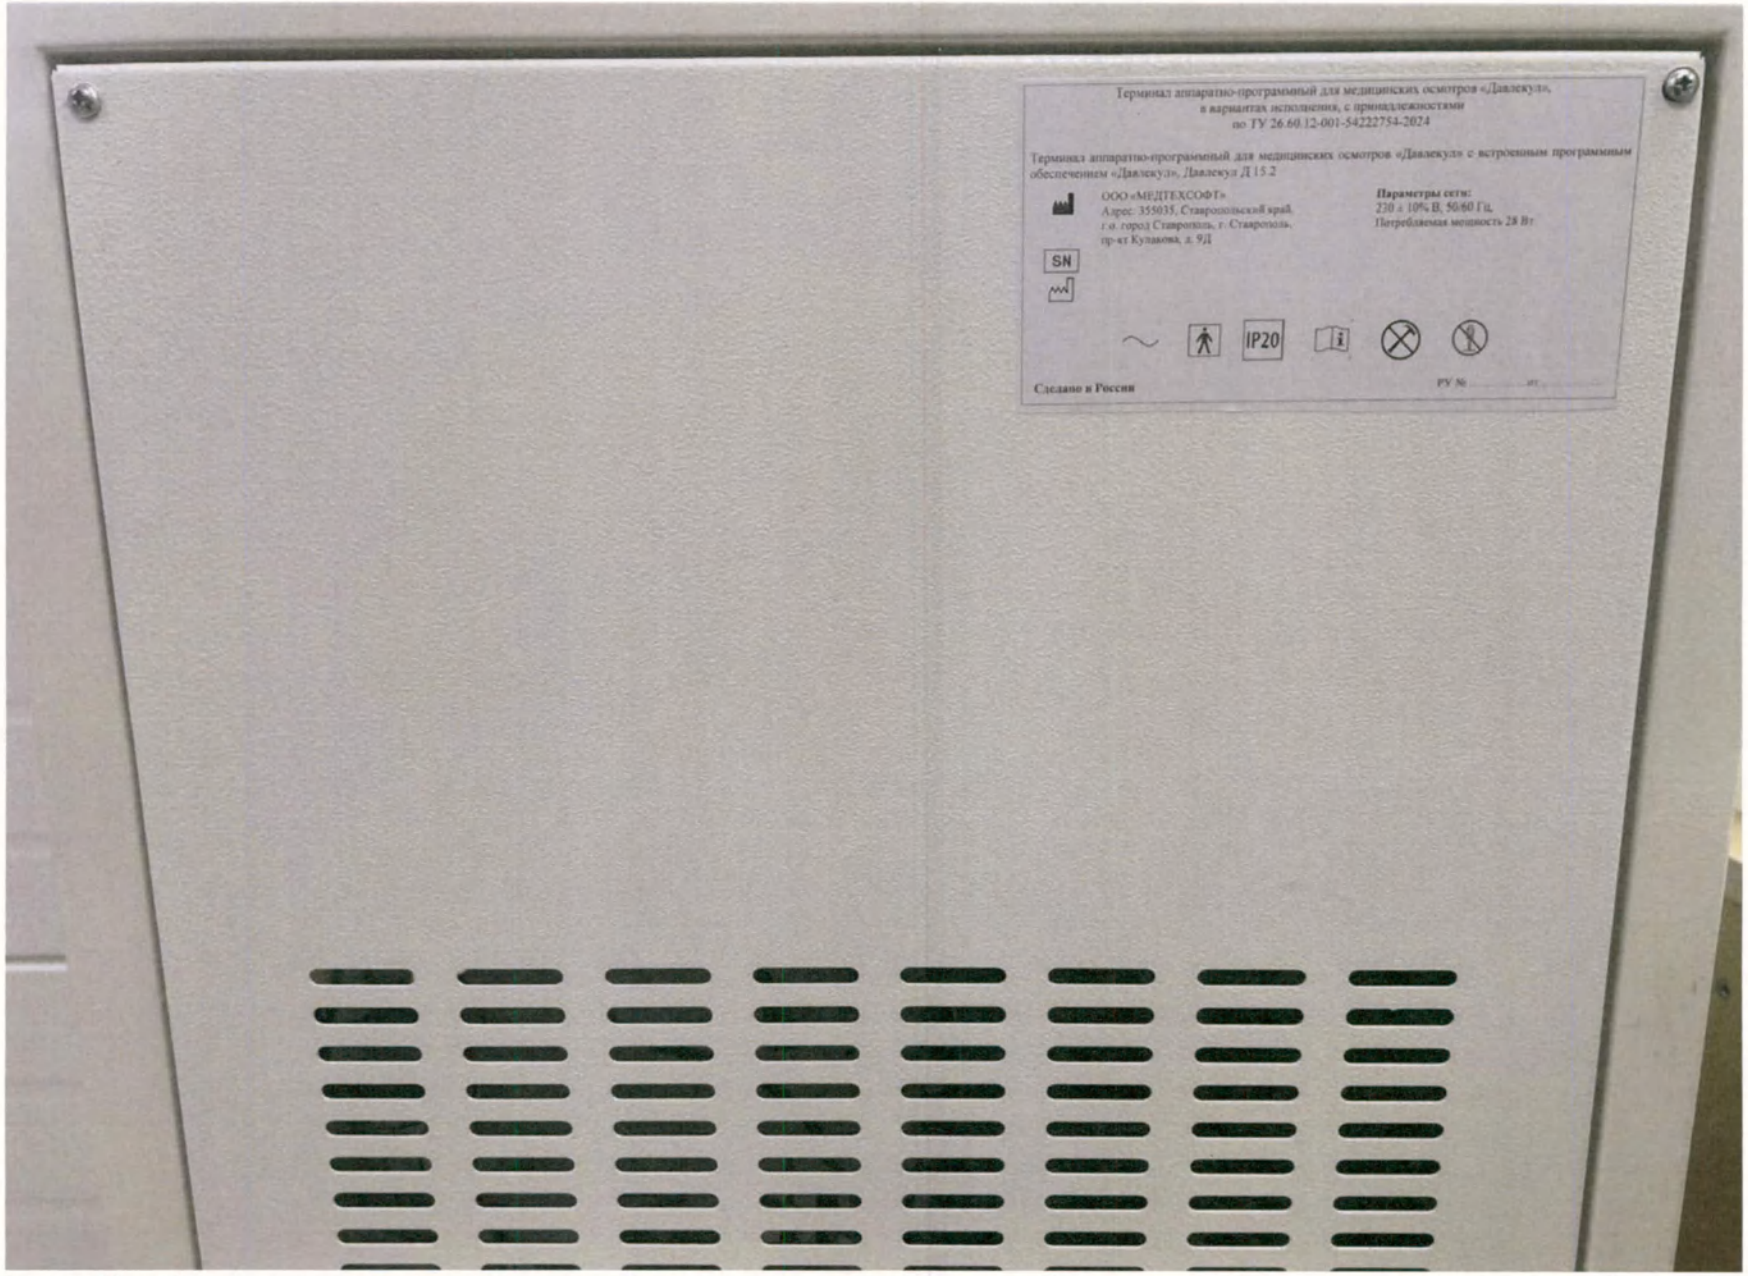


Рисунок 23 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


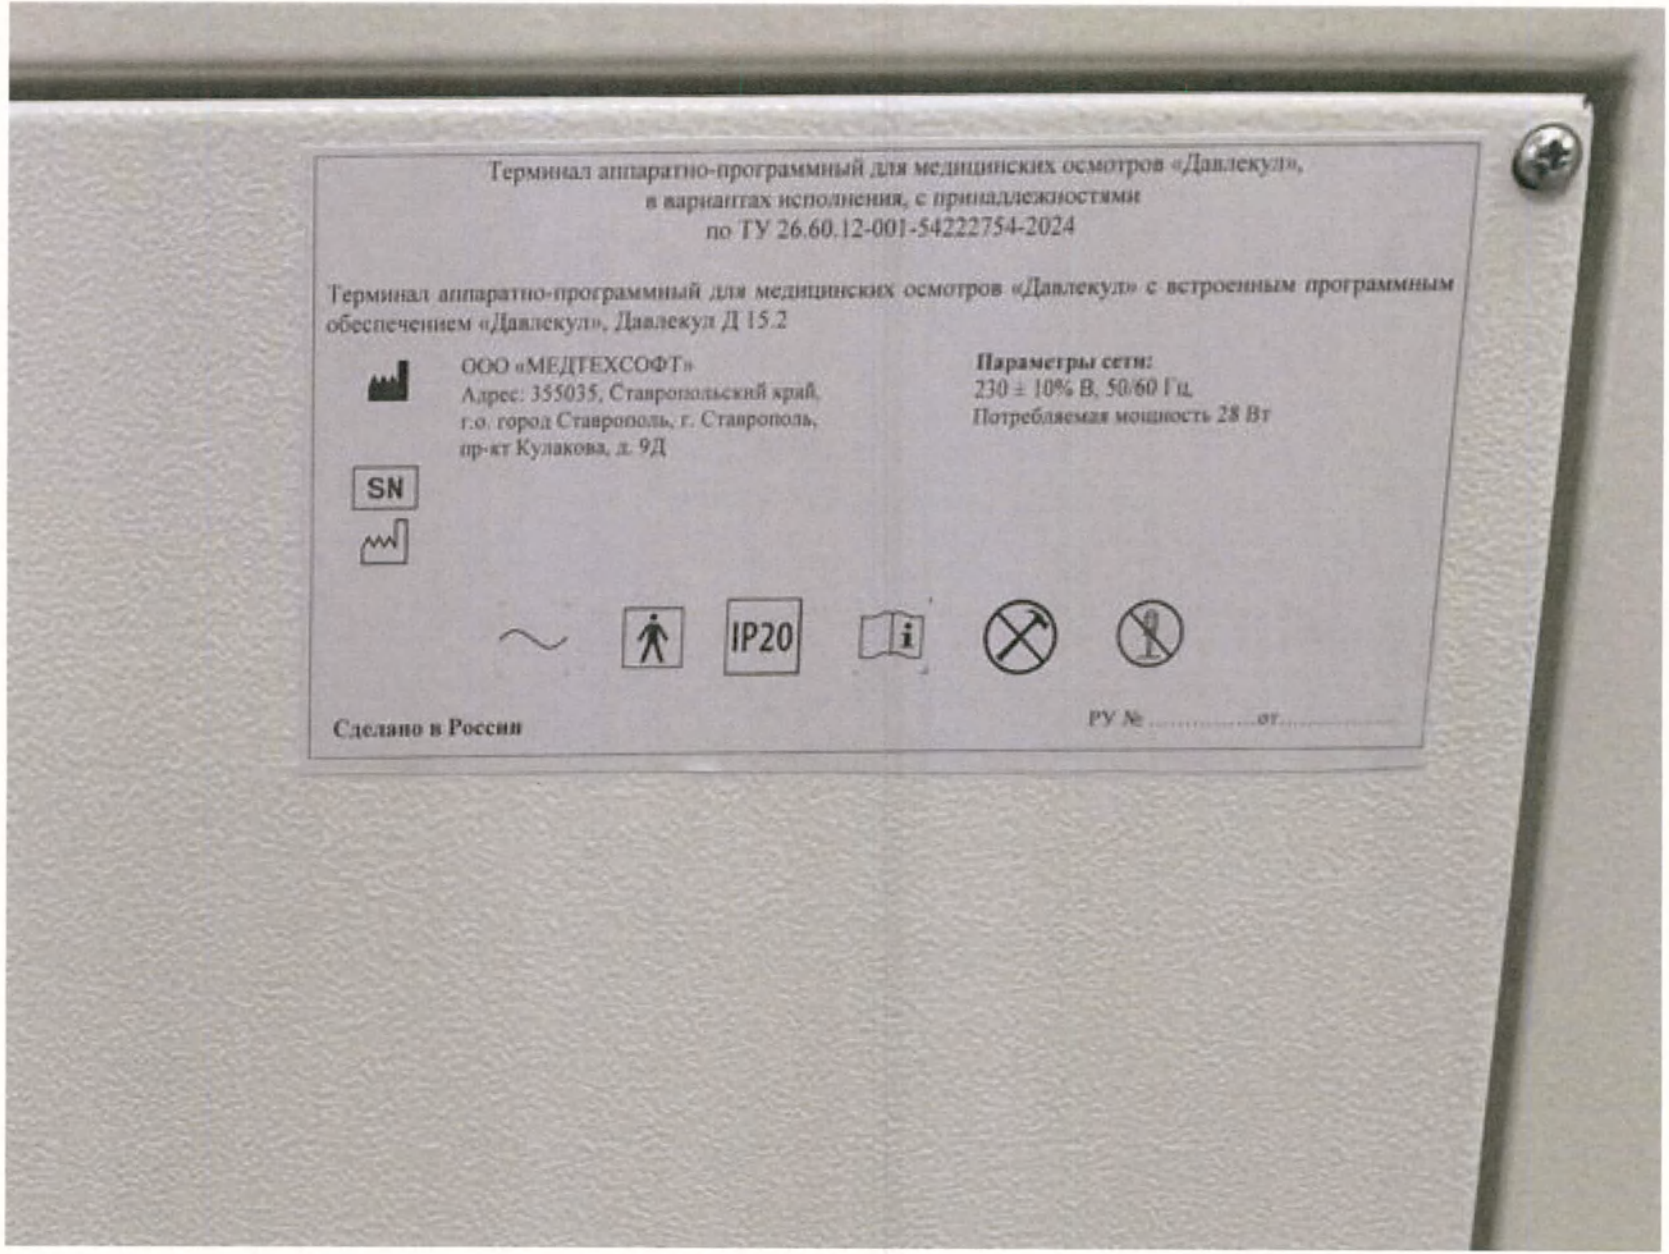


Рисунок 24 – Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

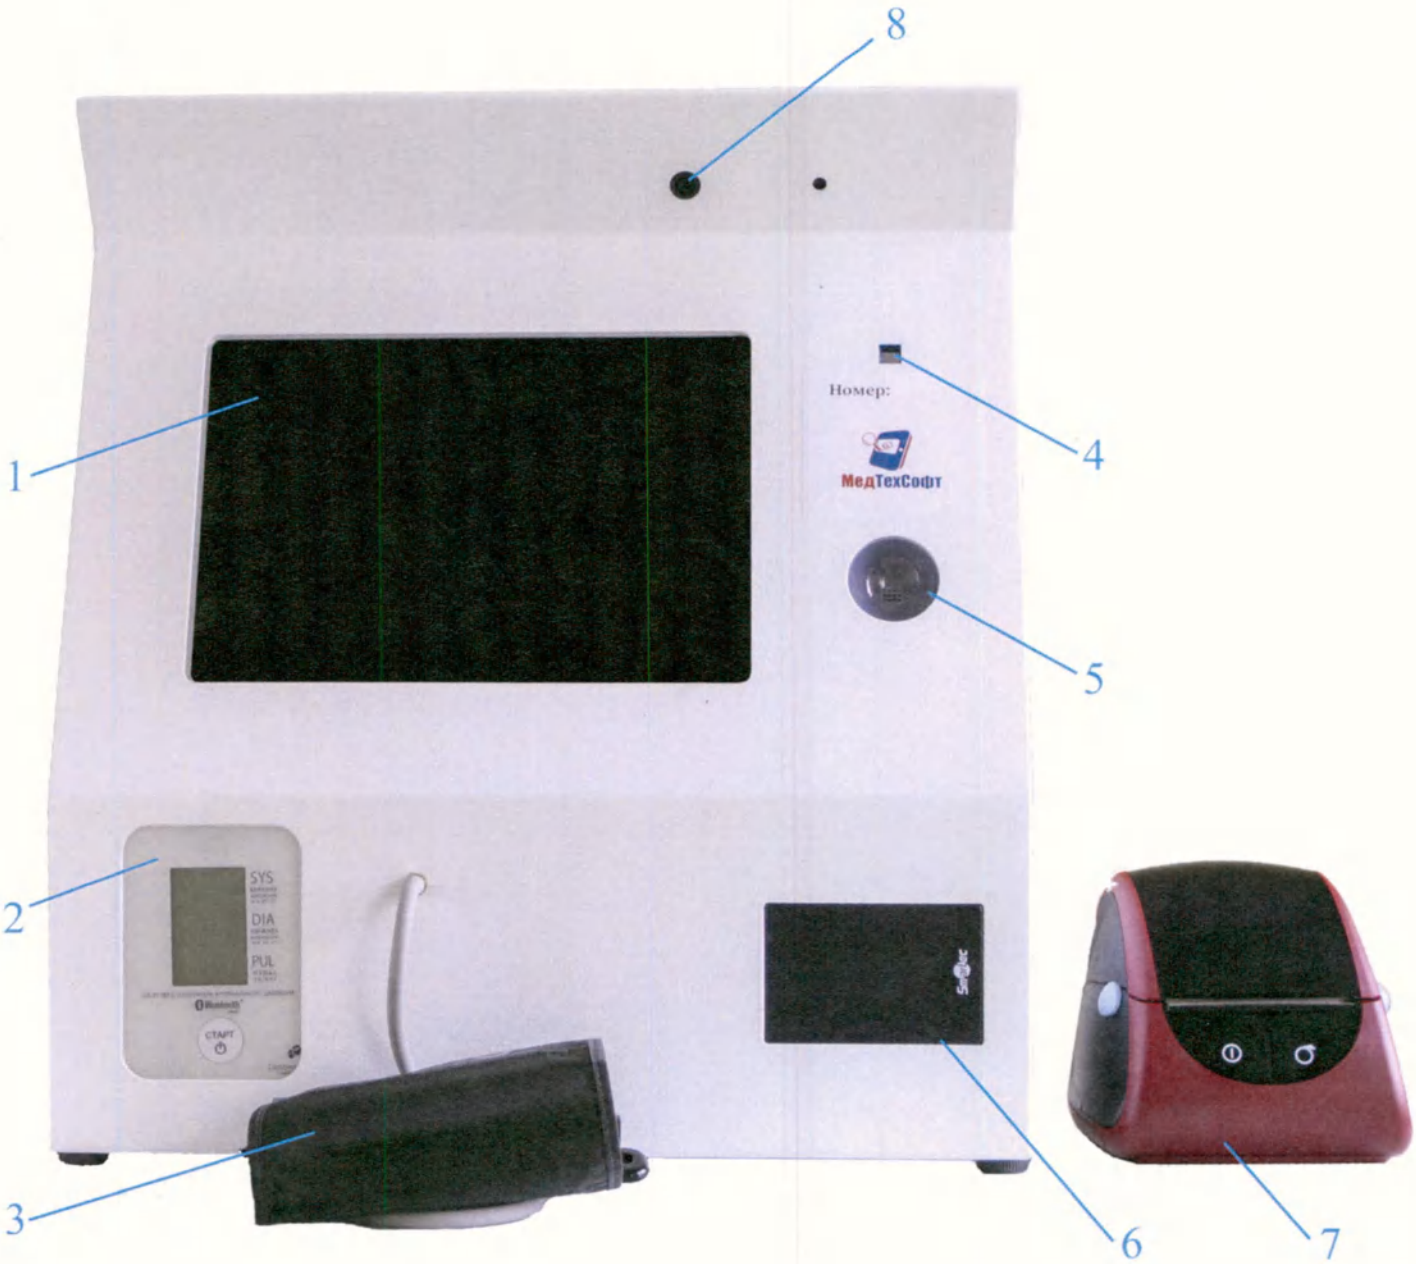

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 25 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5, вид спереди:

1 – Дисплей; *2* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *3* – Манжета компрессионная Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *4* – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *5* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *6* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *7* – Термопринтер этикеток HPRT LPQ58; *8* – Видеокамера RER-USB30W02M

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

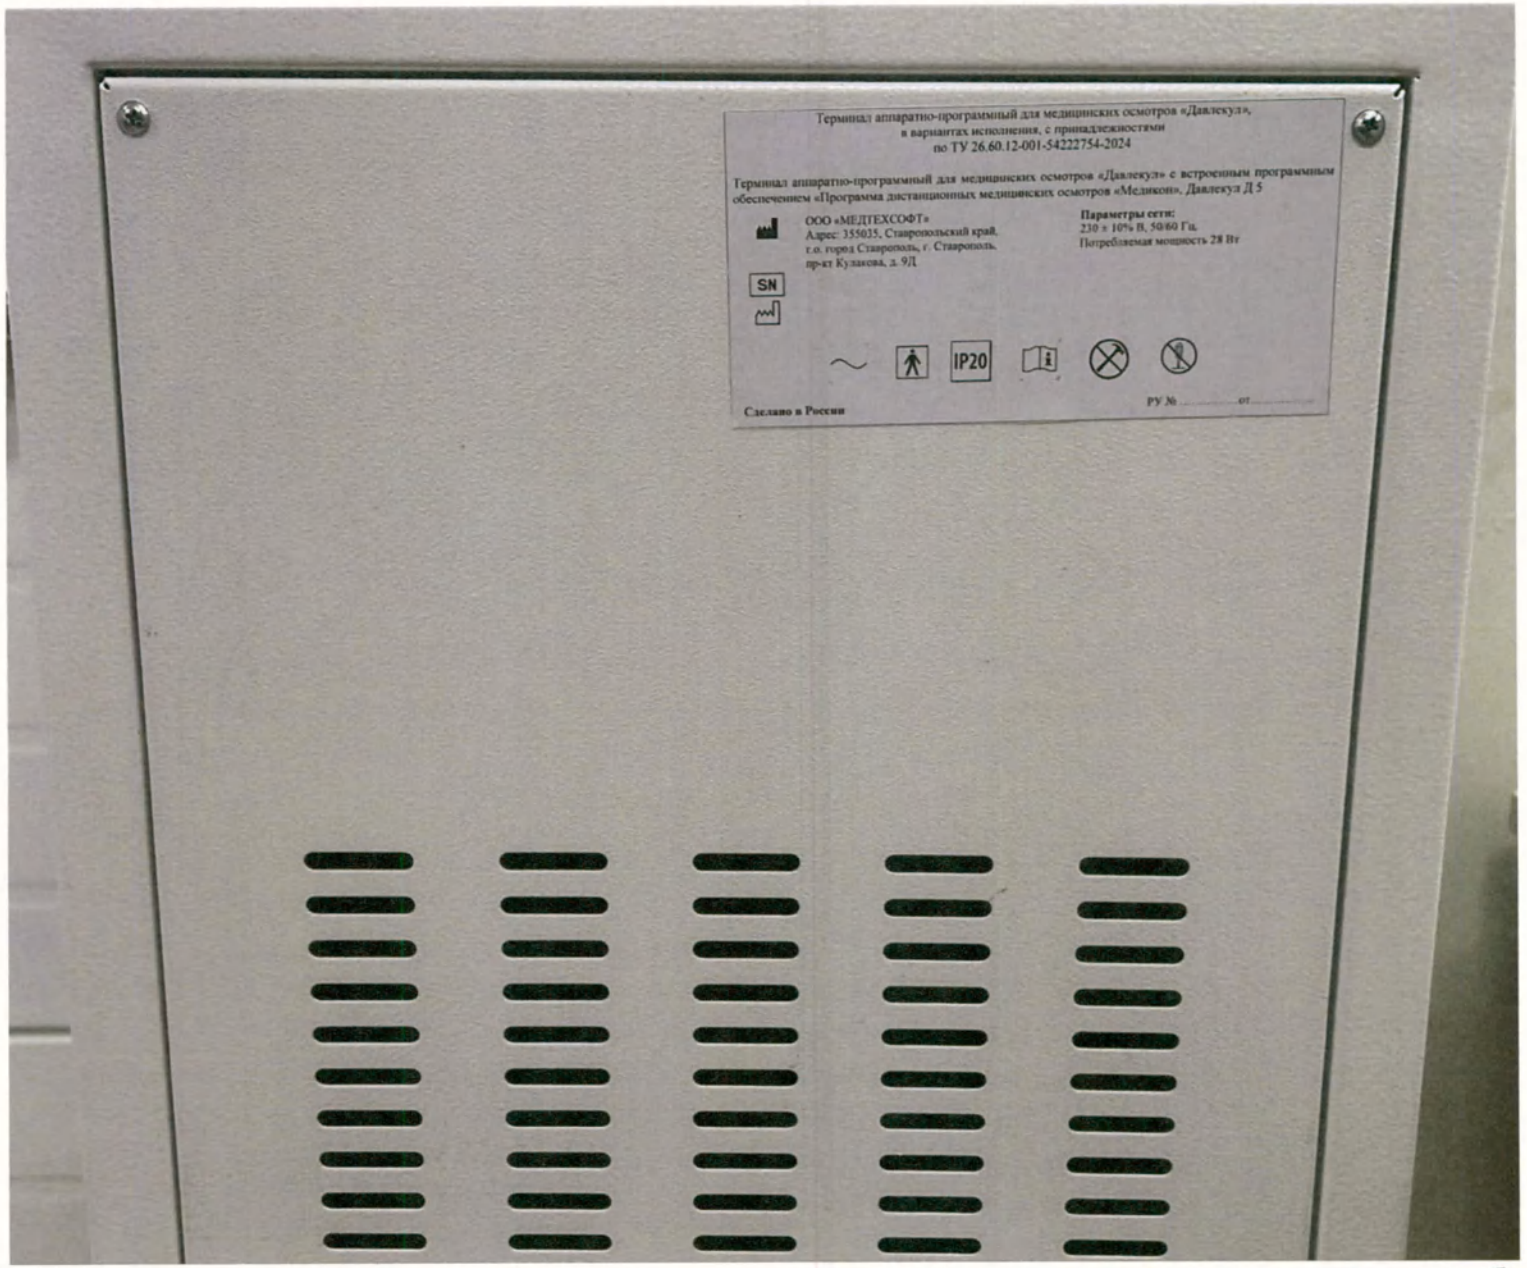


Рисунок 26 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

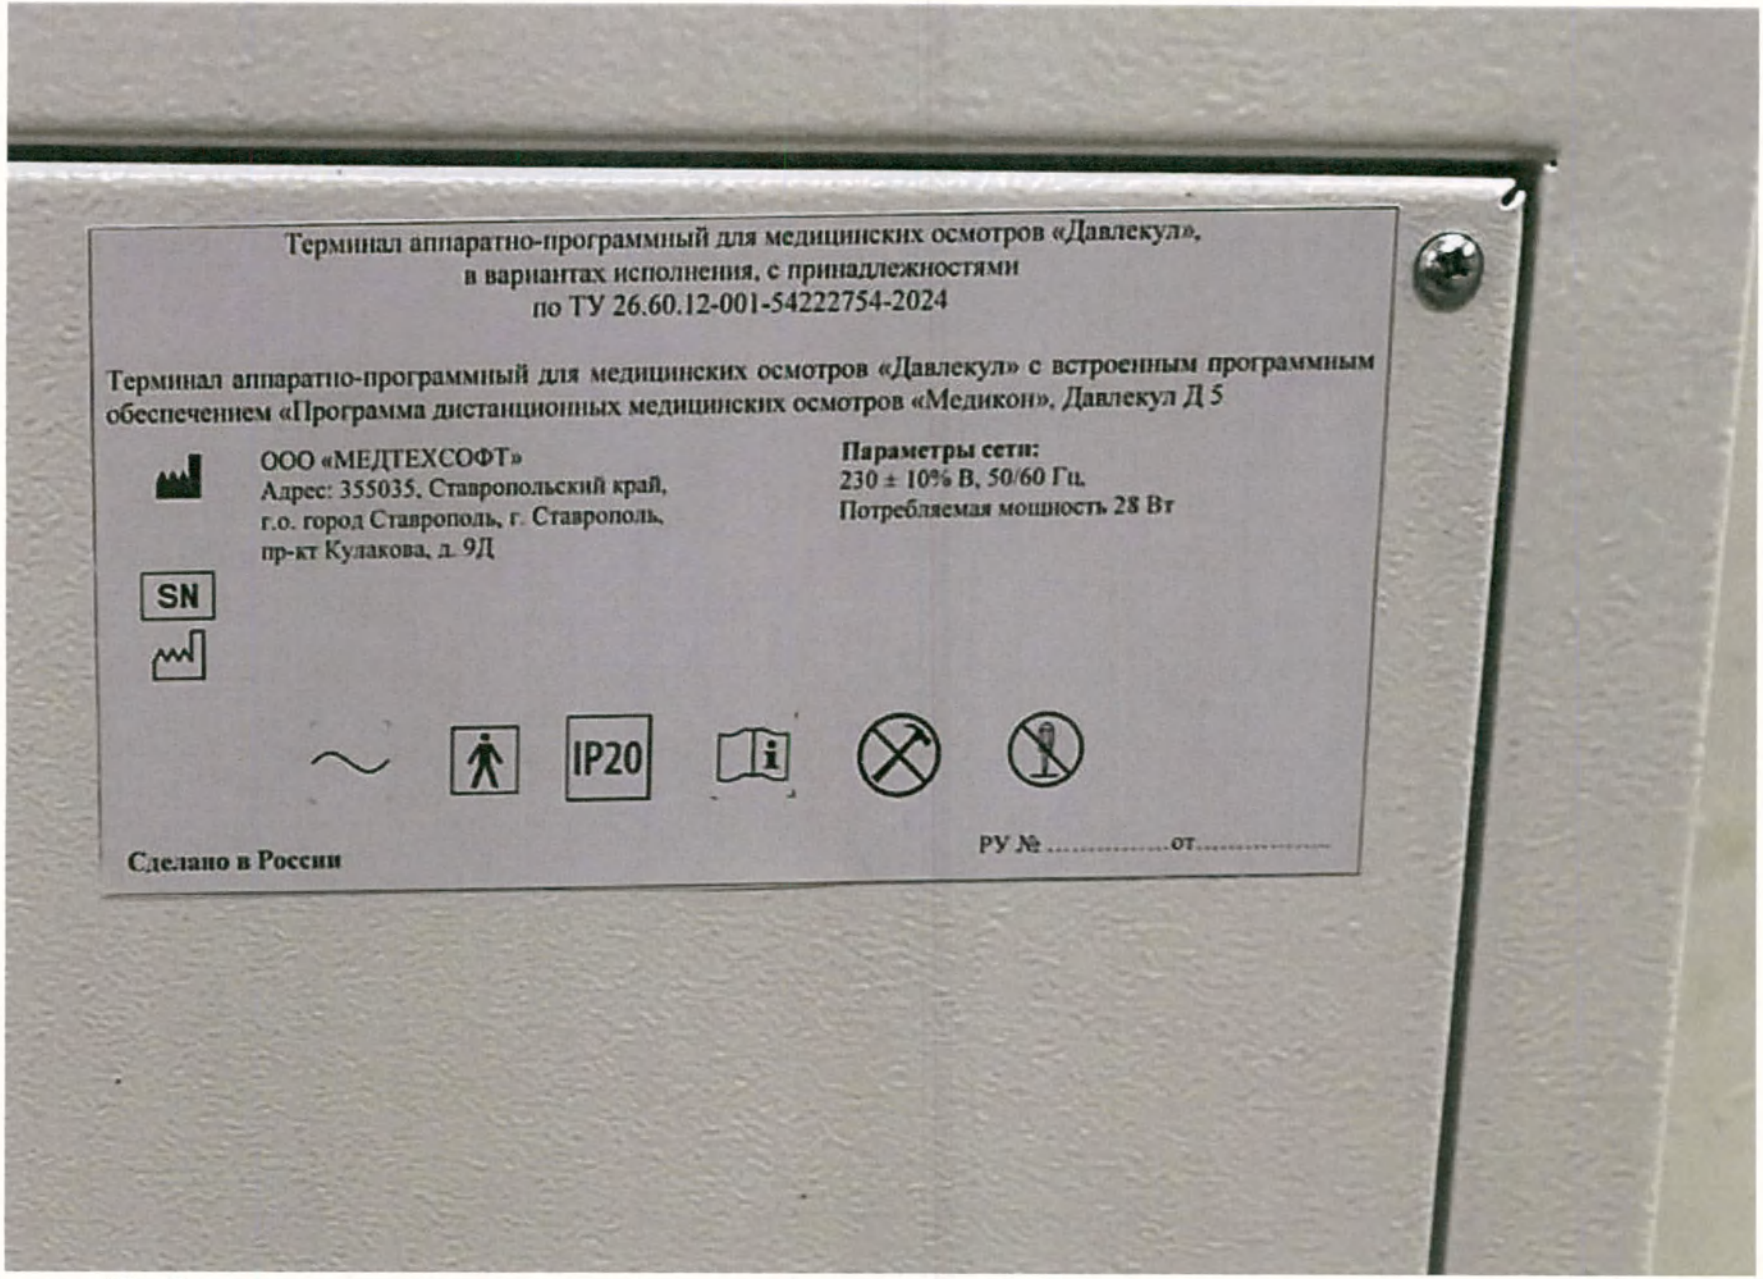


Рисунок 27 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

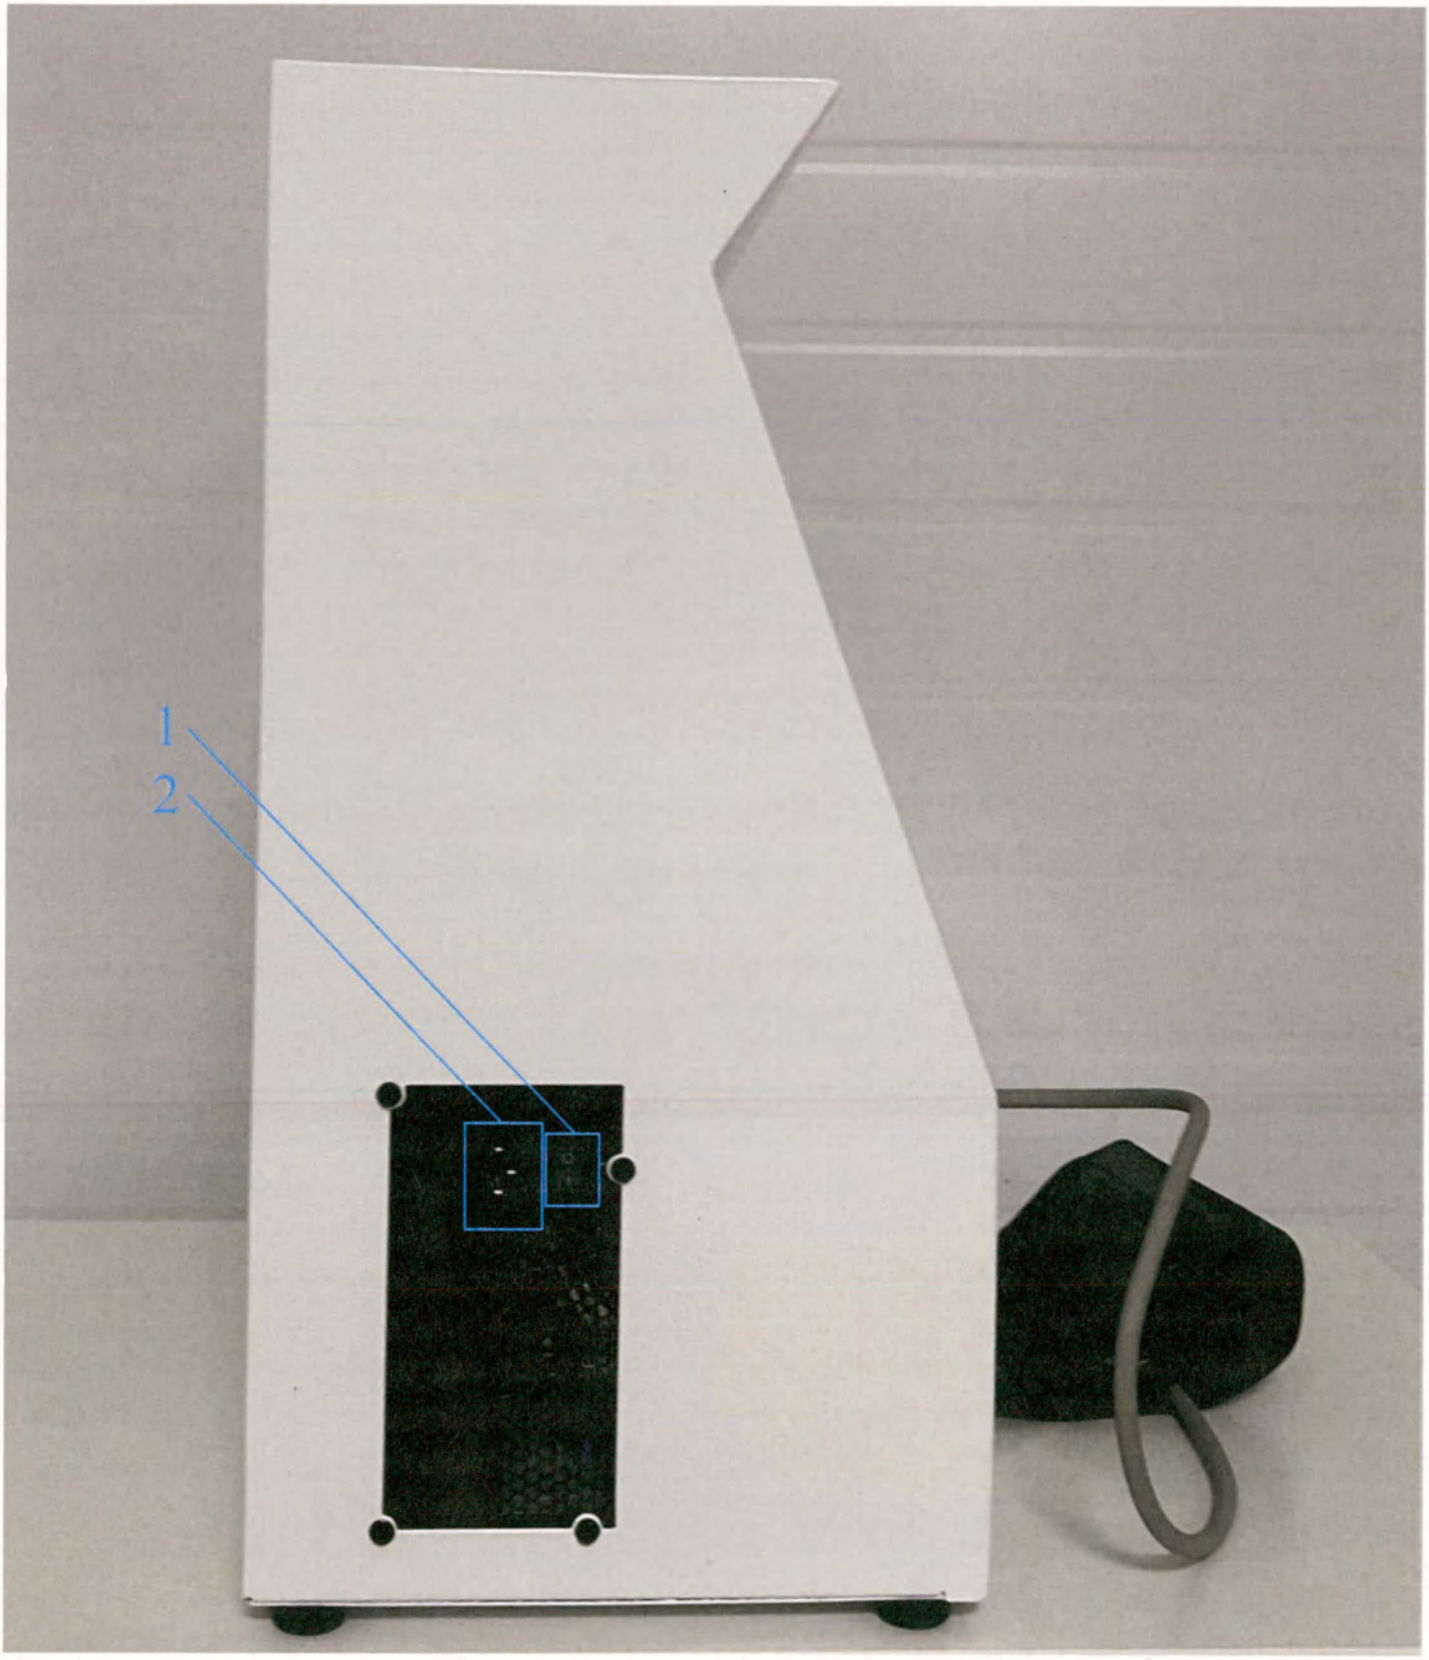


Рисунок 28 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5, вид слева: *1* – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


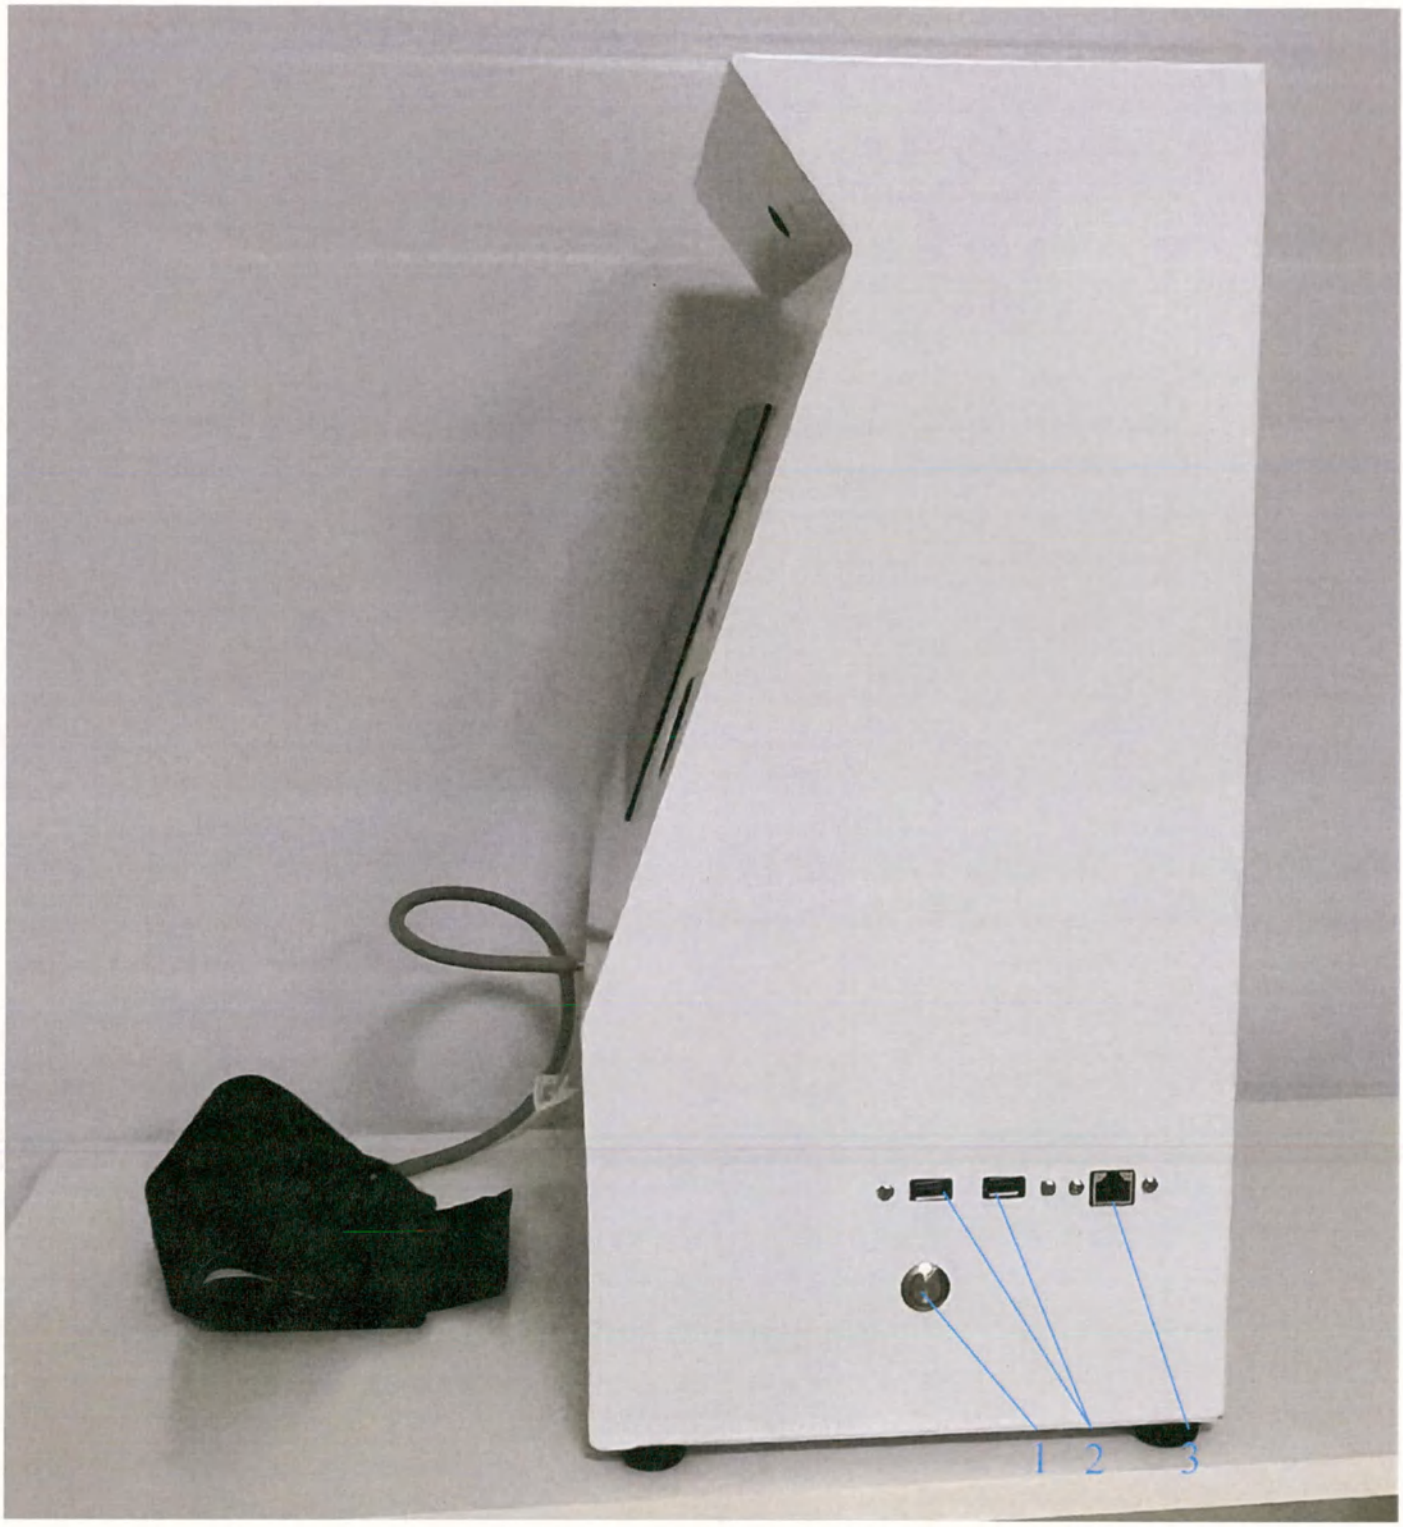


Рисунок 29 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5, вид справа:

1 – Кнопка питания терминала; *2, 3* – Разъем USB; *4* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

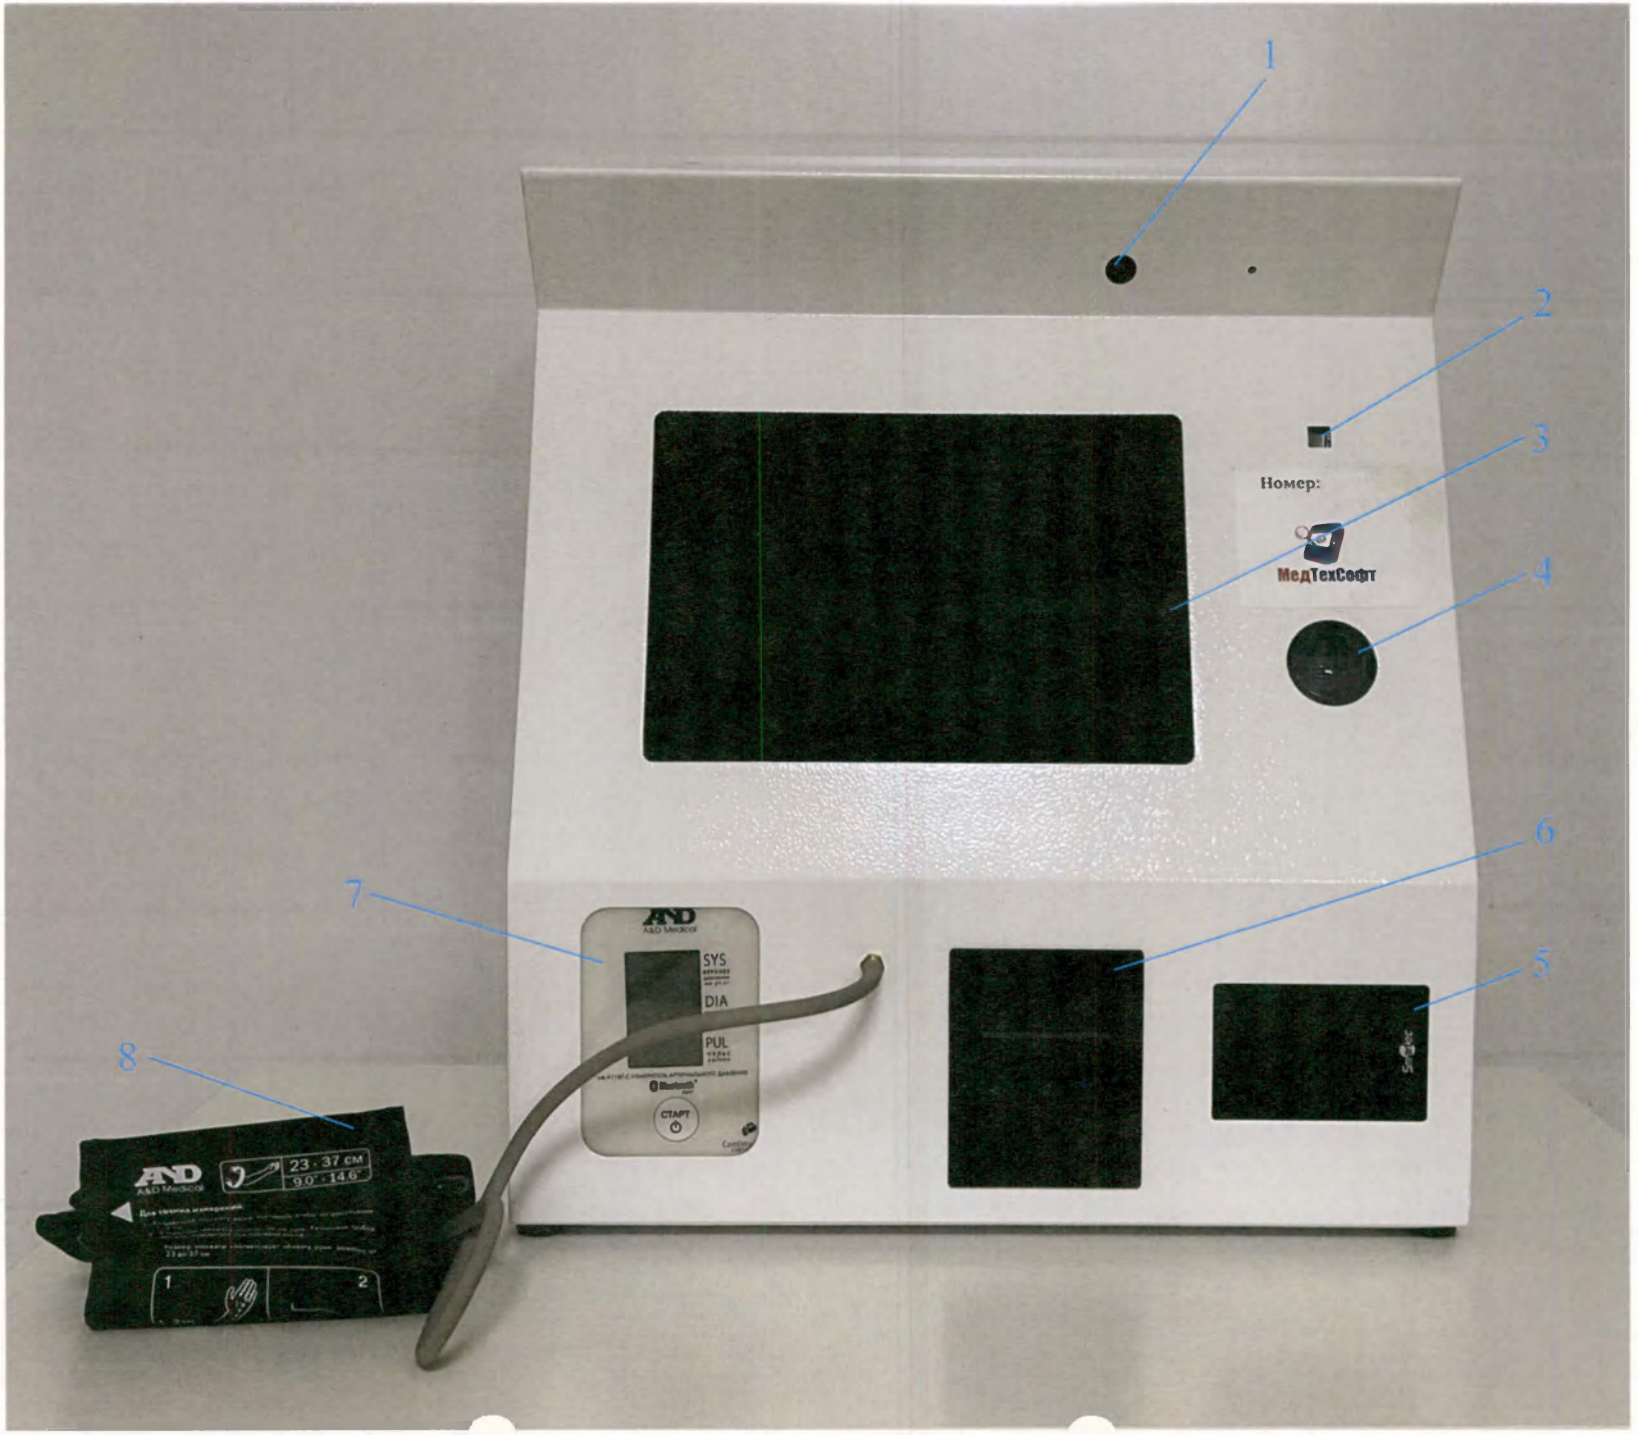

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 30 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1, вид спереди:

1 – Видеокамера RER-USB30W02M; *2* – Бесконтактный инфракрасный термометр Bertcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *3* – Дисплей; *4* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *5* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *6* – Термопринтер HSPOS XC-K23; *7* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *8* – Манжета компрессионная Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 31 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 32 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

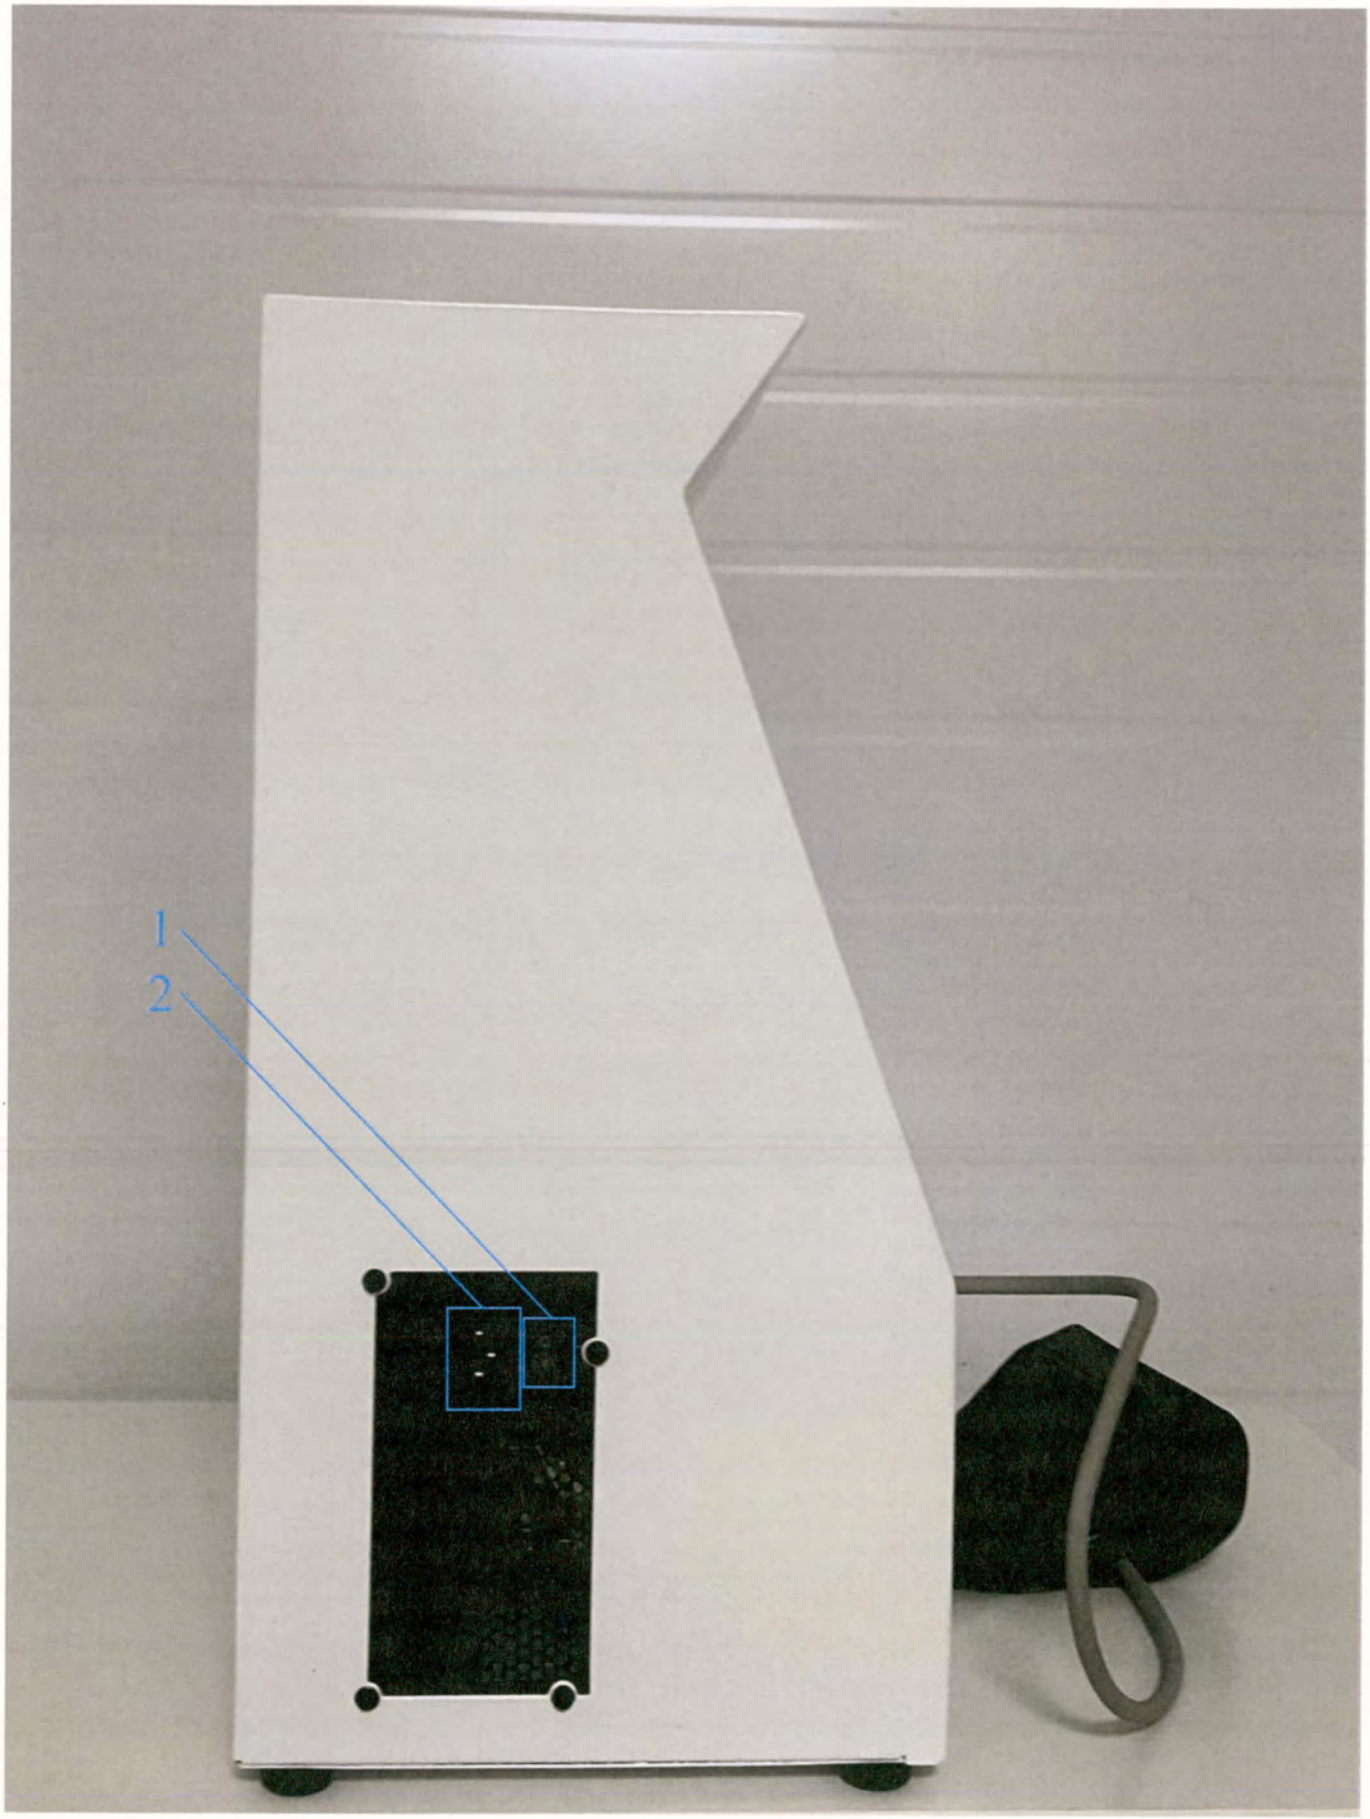


Рисунок 33 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1, вид слева:

1 – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


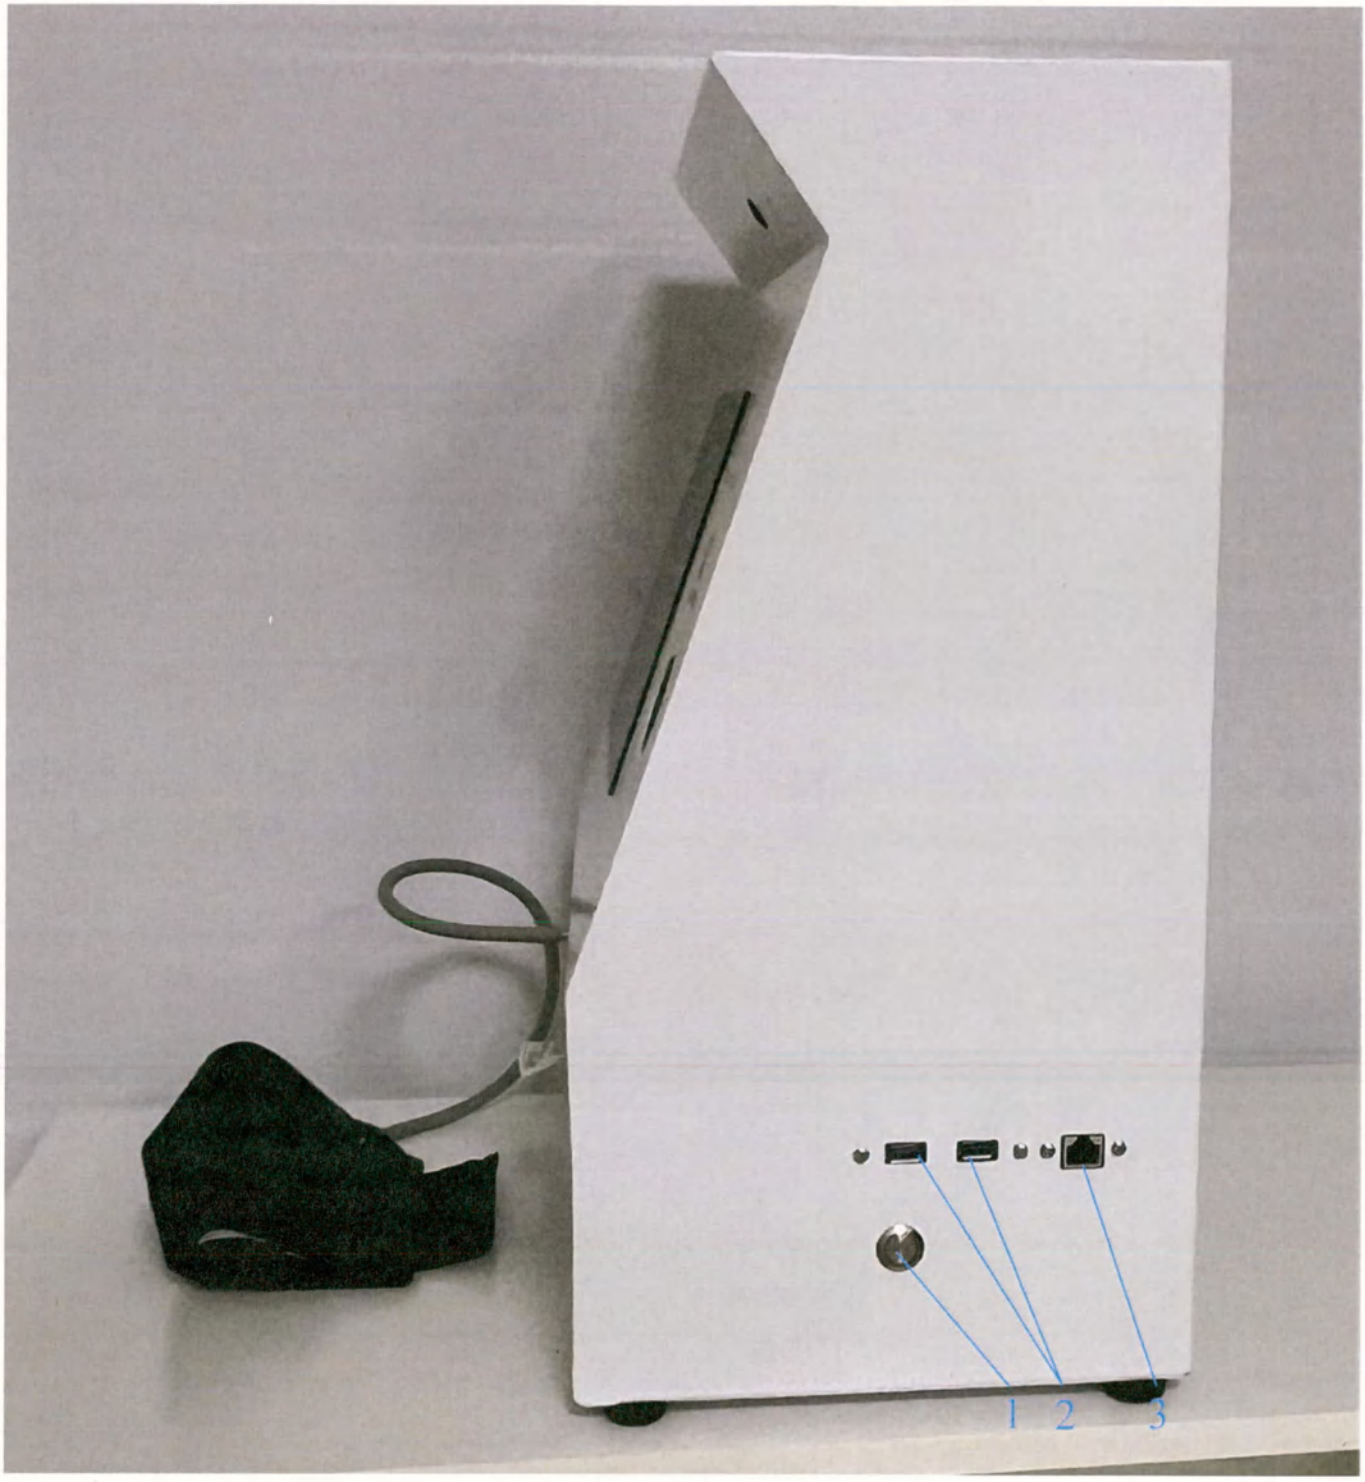


Рисунок 34 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1, вид справа:

1 – Кнопка питания терминала; *2* – Разъем USB; *3* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

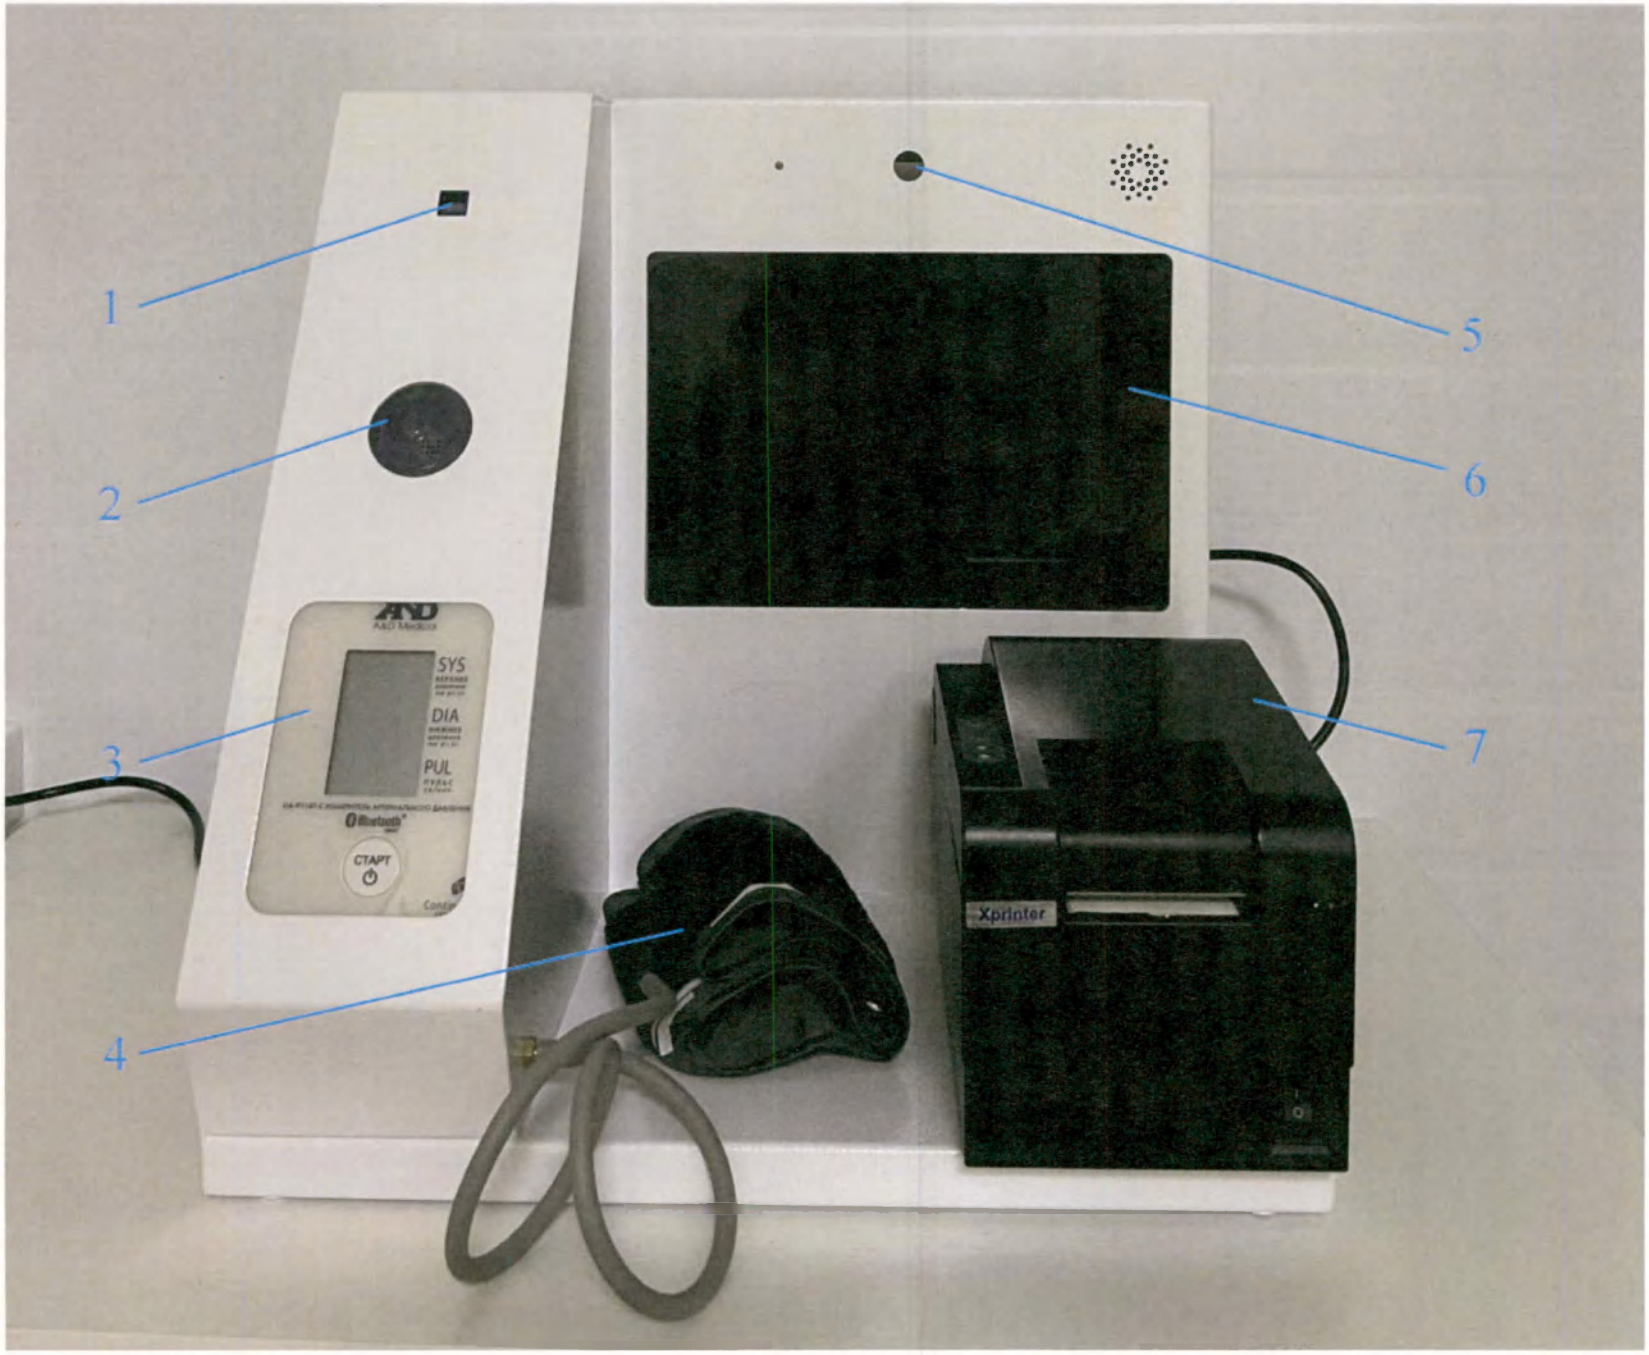

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 35 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 10, вид спереди:

1 – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *2* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *3* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); *4* – Видеокамера RER-USB30W02M; *5* – Дисплей; *6* – Термопринтер этикеток Xprinter XP – 235B; *7* – Настольный RFID считыватель ST-CE011EM USB; *8* – Манжета компрессионная Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

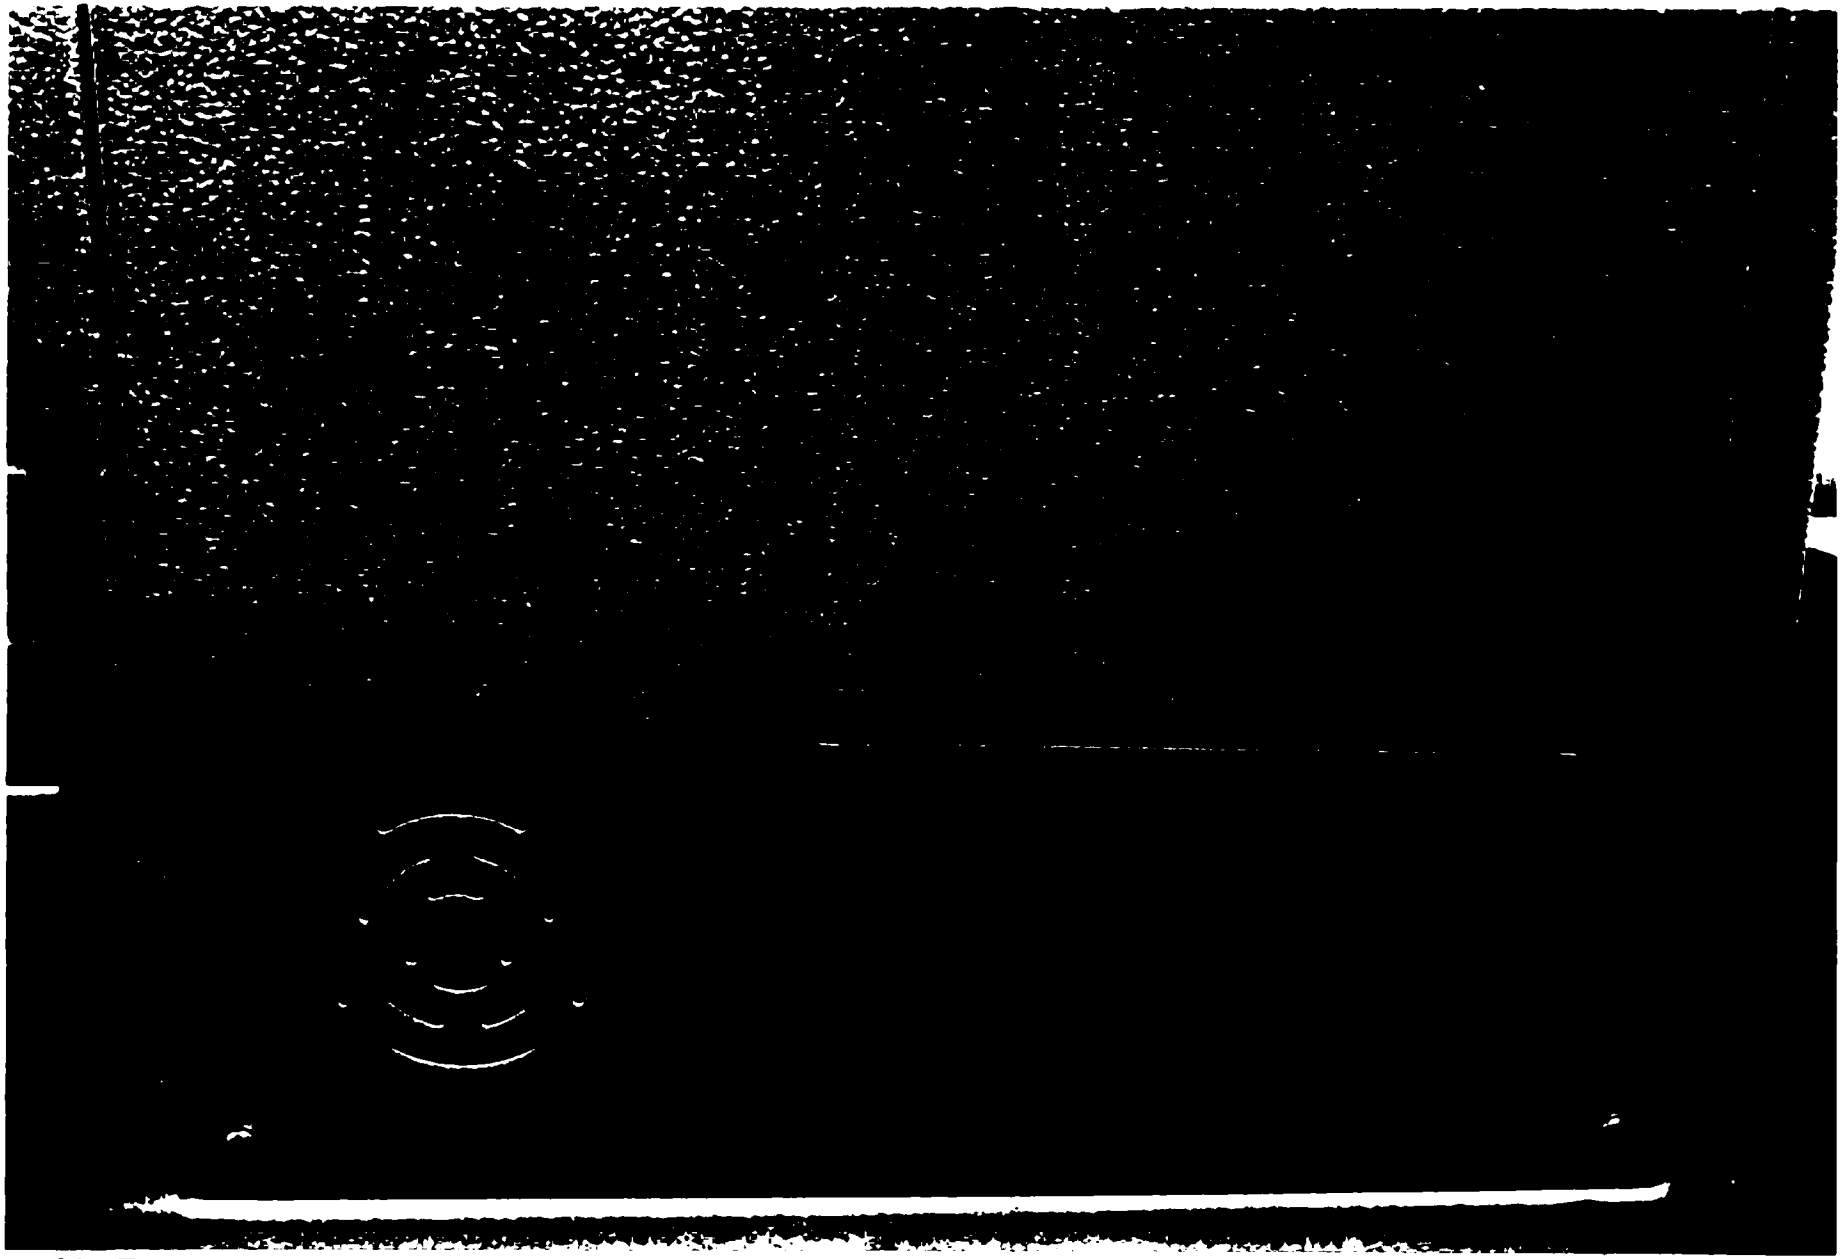


Рисунок 36 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 10, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 37 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 10, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 38 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 10, вид слева:

1 – Разъем RJ-45; *2* – Разъем USB

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

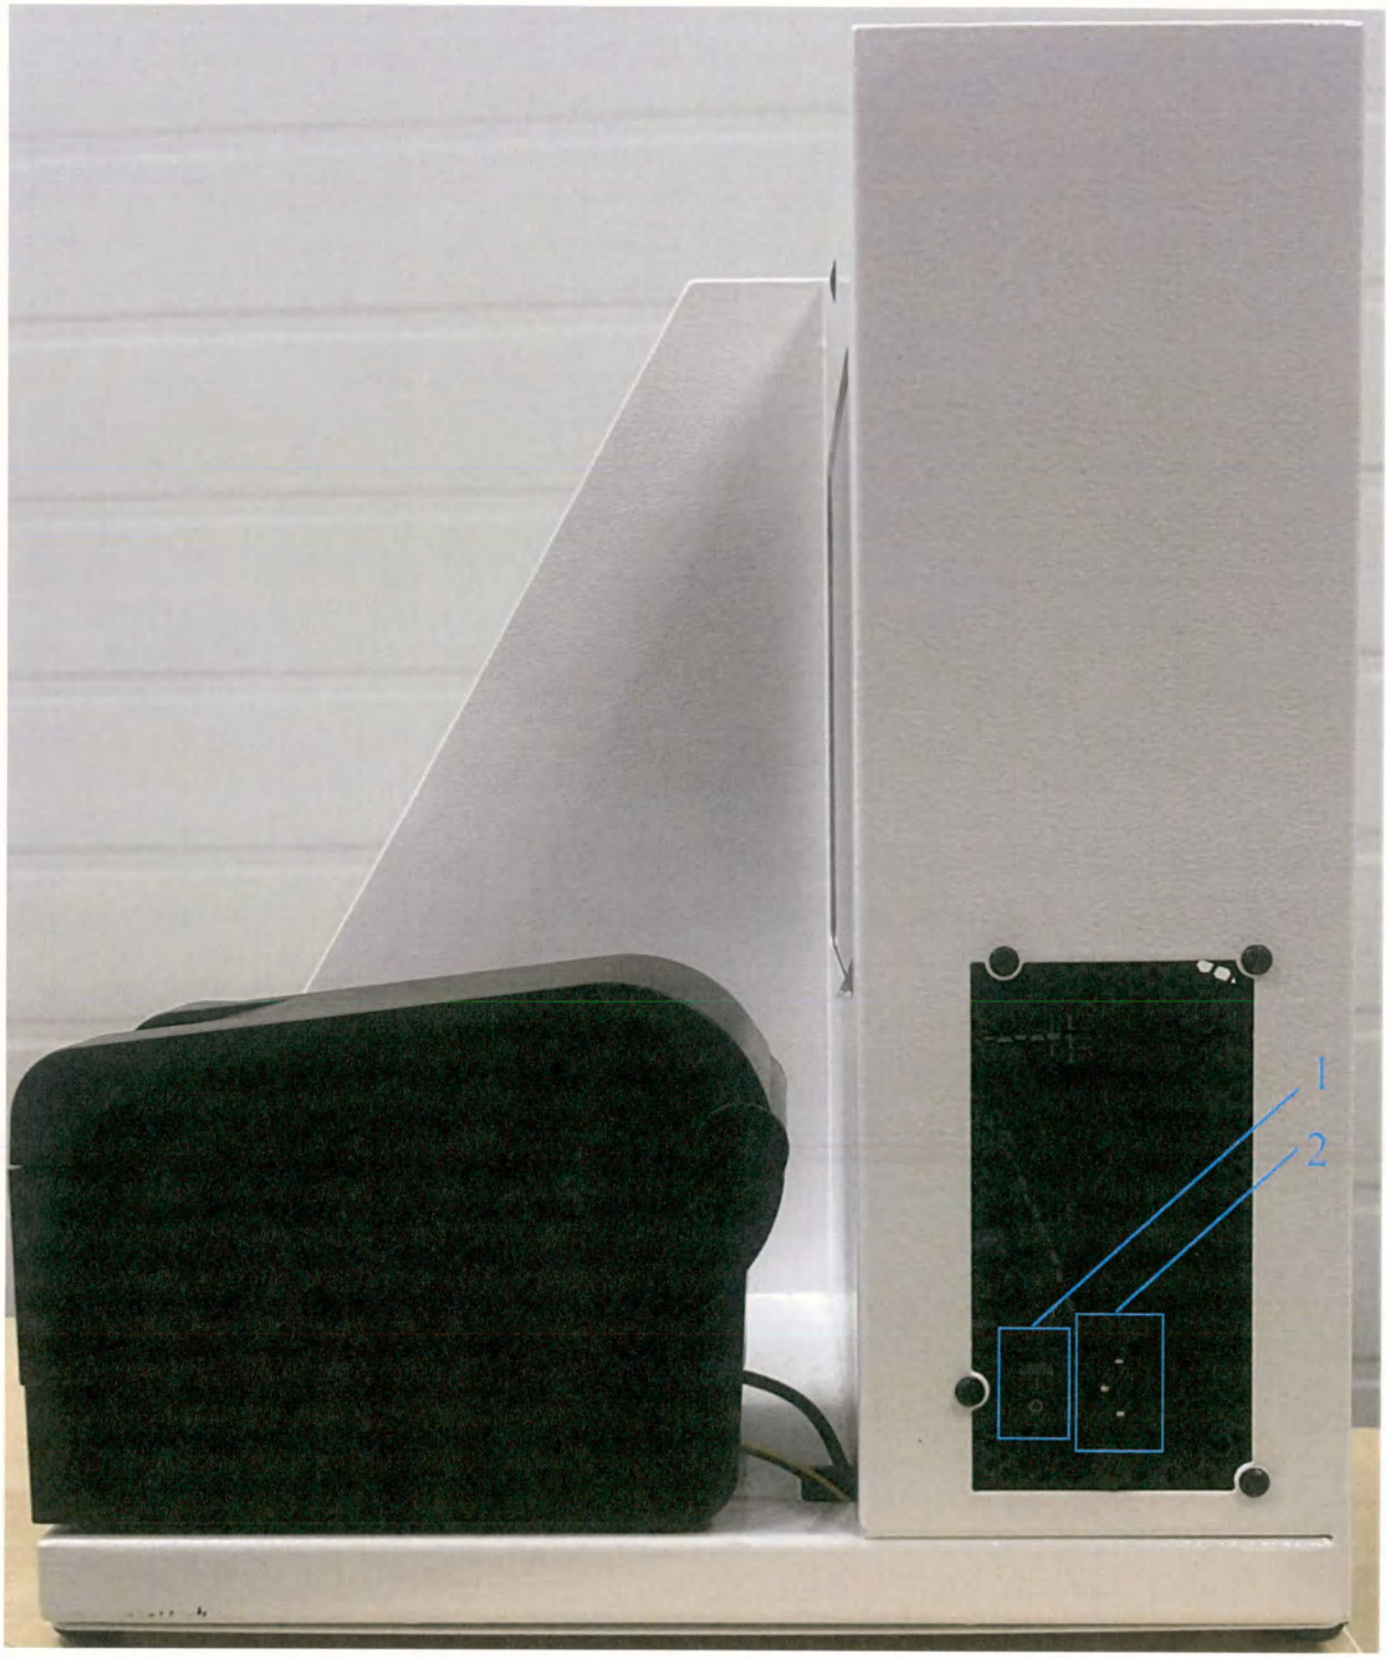


Рисунок 39 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 10, вид слева:

1 – Переключатель включения/выключения; *2* – Разъем для подключения кабеля питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

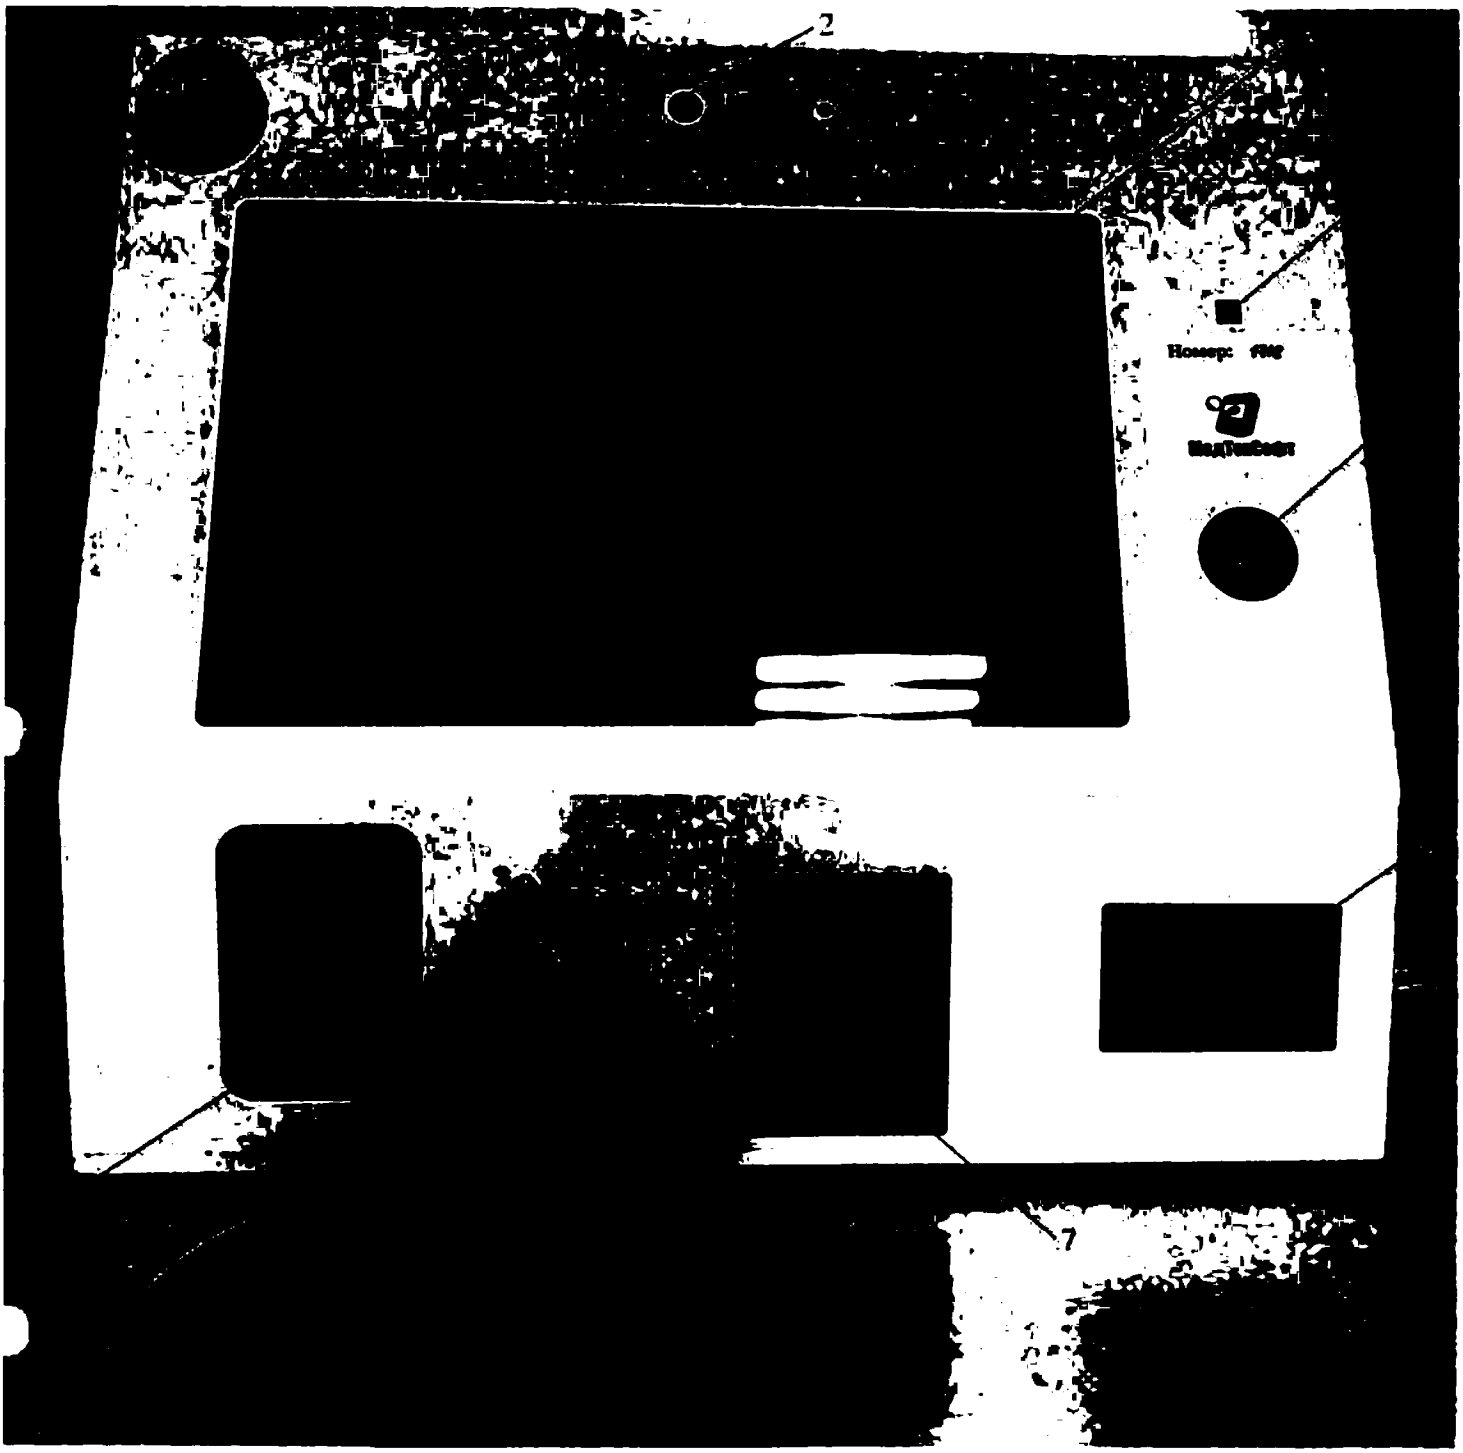


Рисунок 40 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1, вид спереди

1 – Видеокамера HBVCAM 1807; *2* – Видеокамера 2 RER-USB30W02M; *3* – Дисплей; *4* – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения: JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *5* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *6* – Настольный RFID считыватель Smartec ST-CE011MF; *7* – Термопринтер этикеток HSPOS HS-K23; *8* – Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.); 9 – Манжета компрессионная Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой с передачей данных по "Блютус" (Bluetooth) с принадлежностями, модель UA-911BT-C (РУ № ФСЗ 2010/07276 от 08.09.2022 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

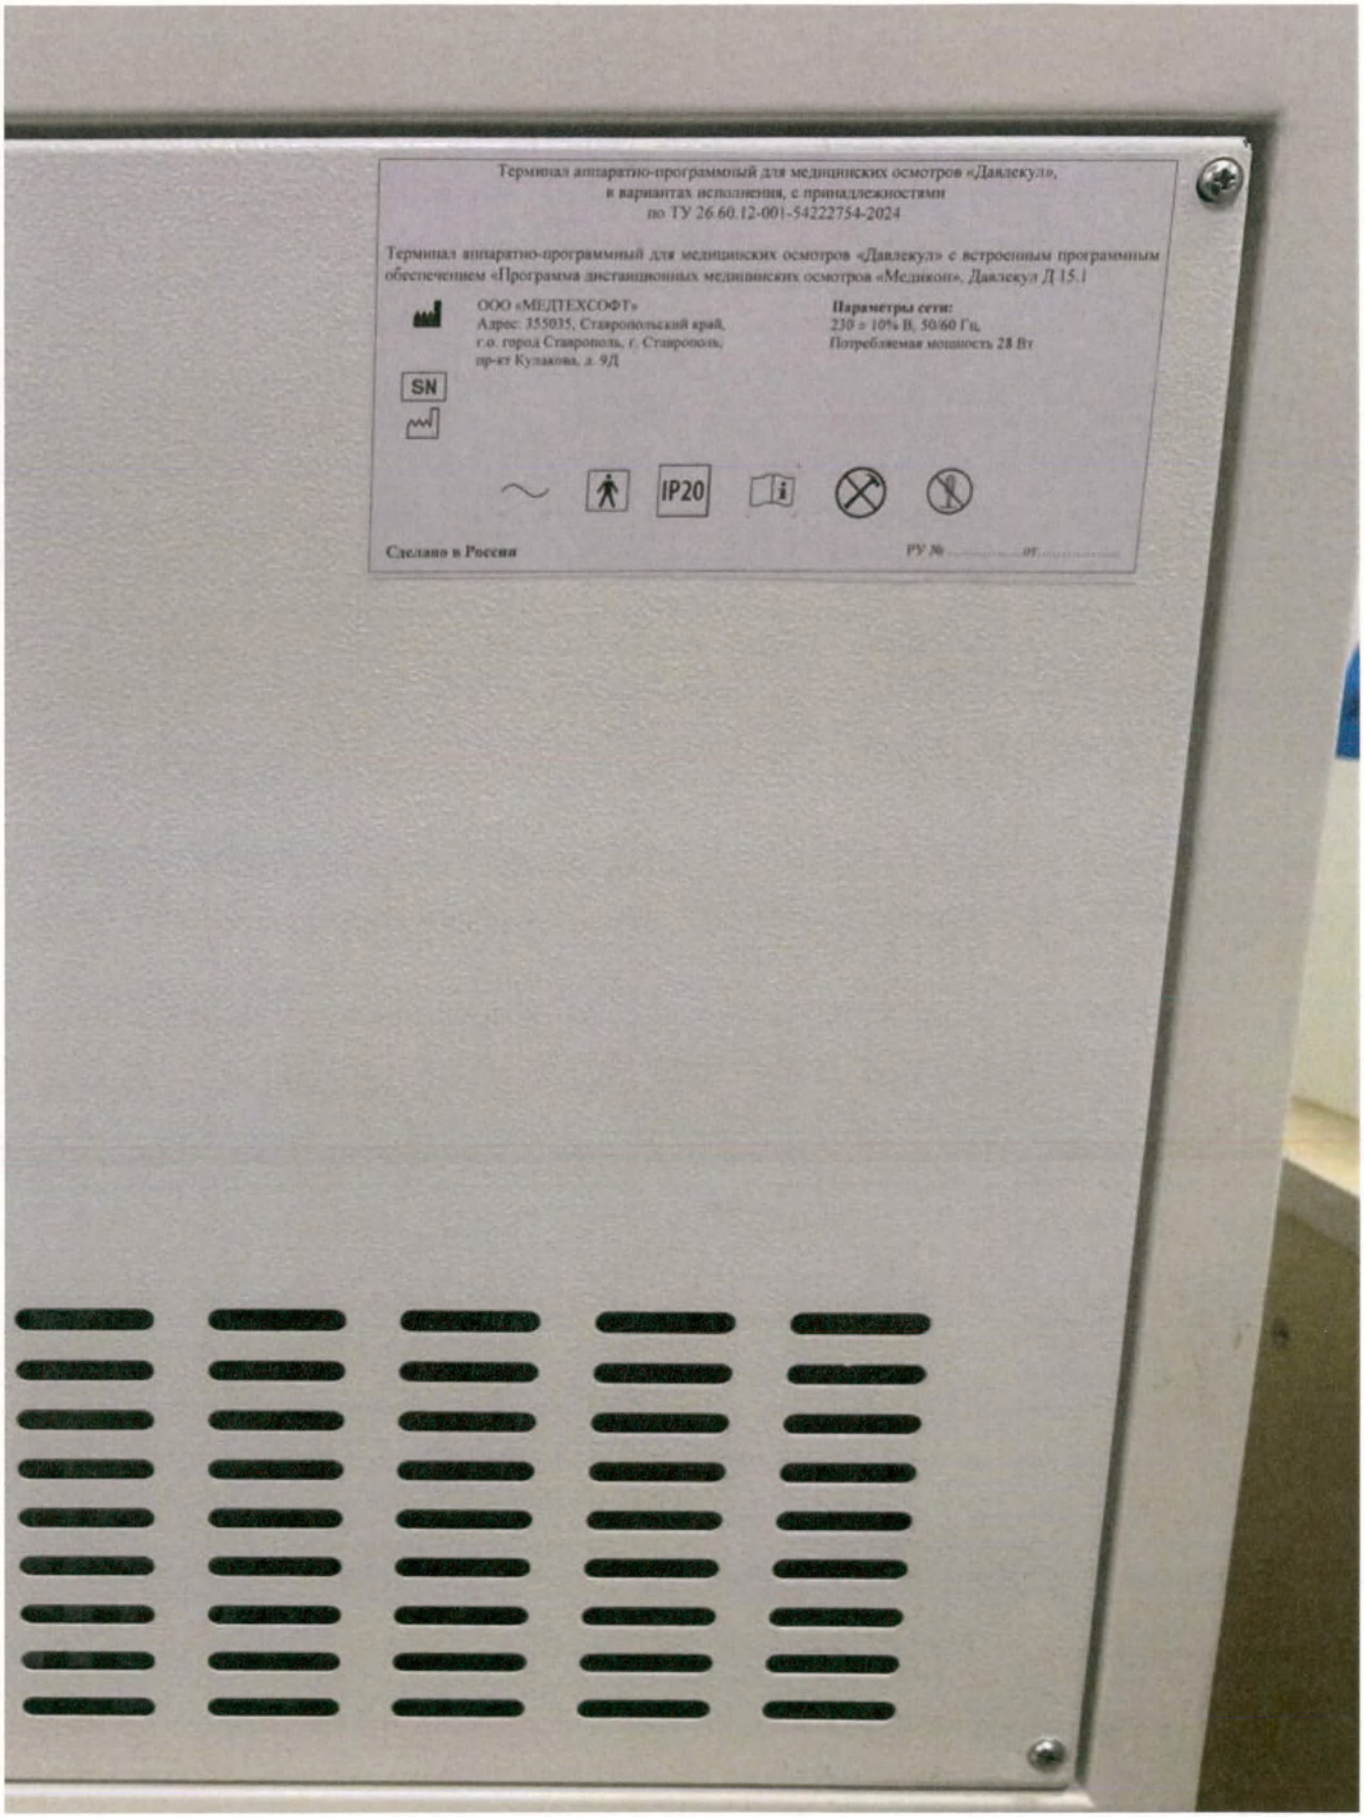


Рисунок 41 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

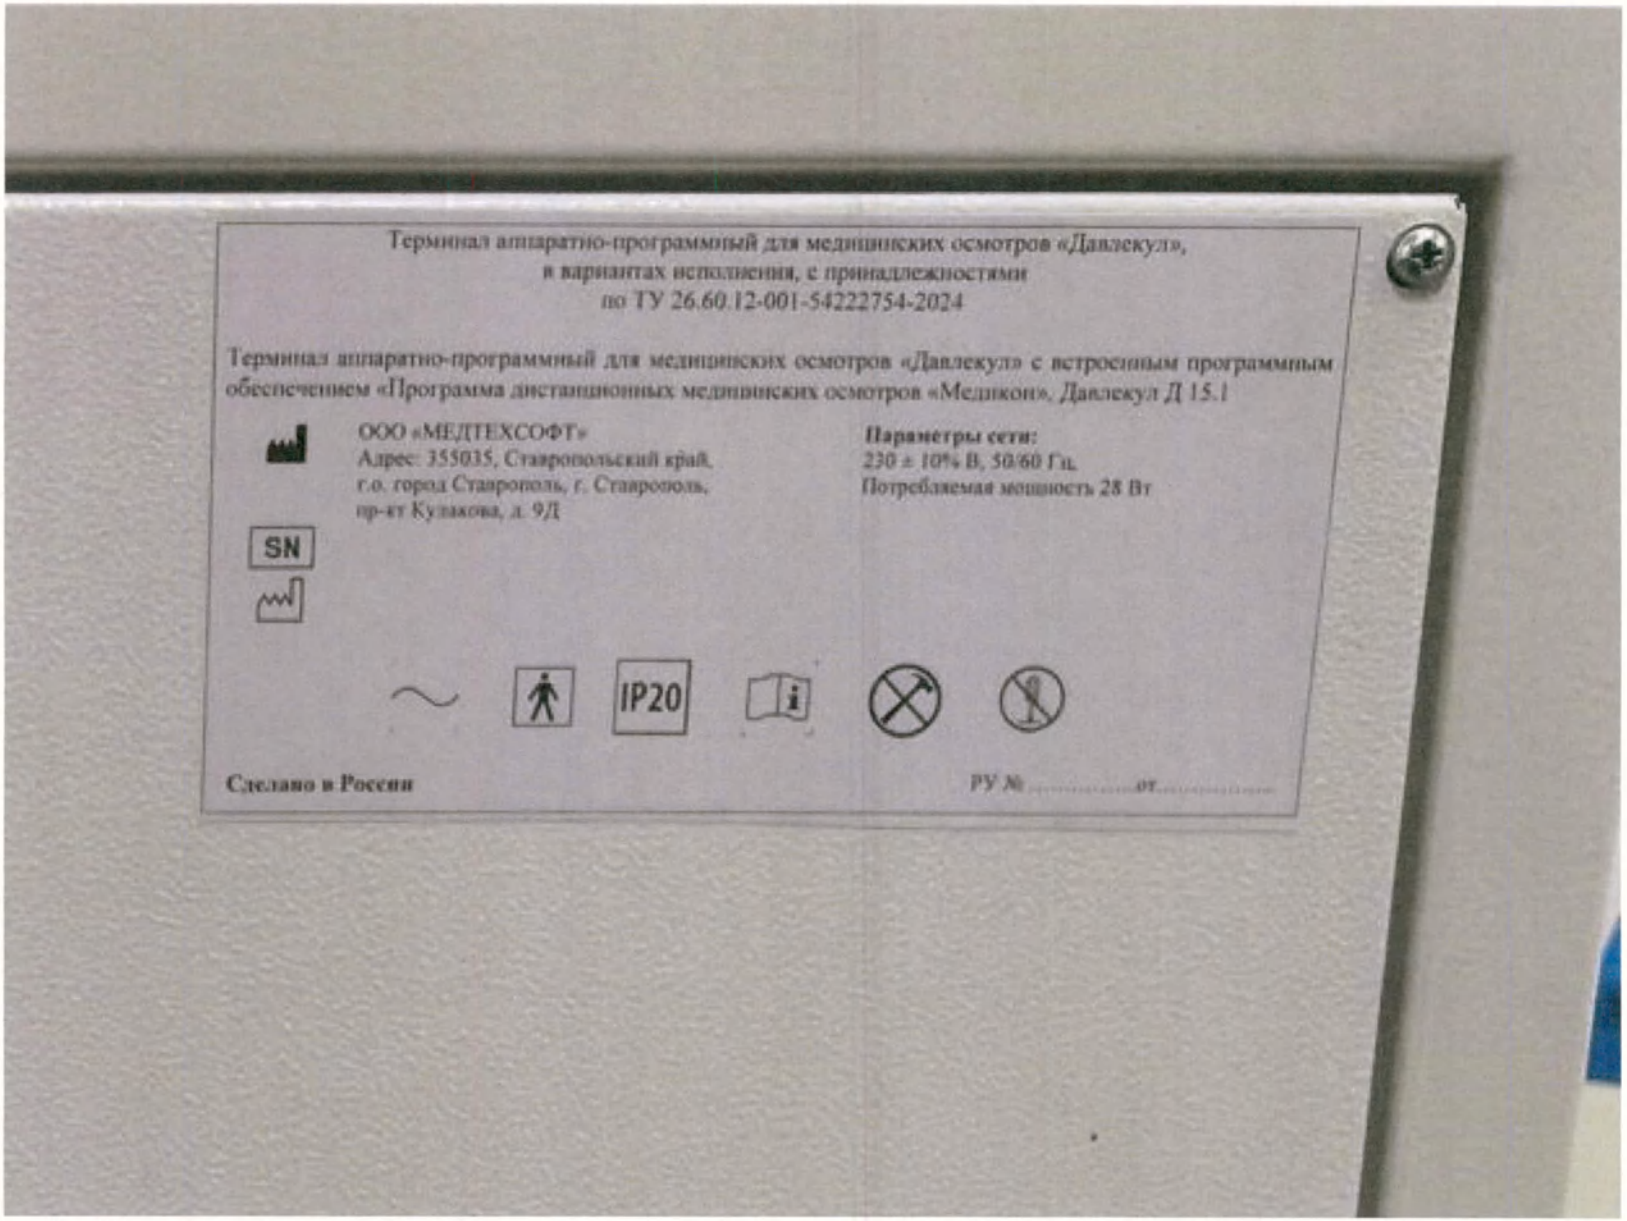


Рисунок 42 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

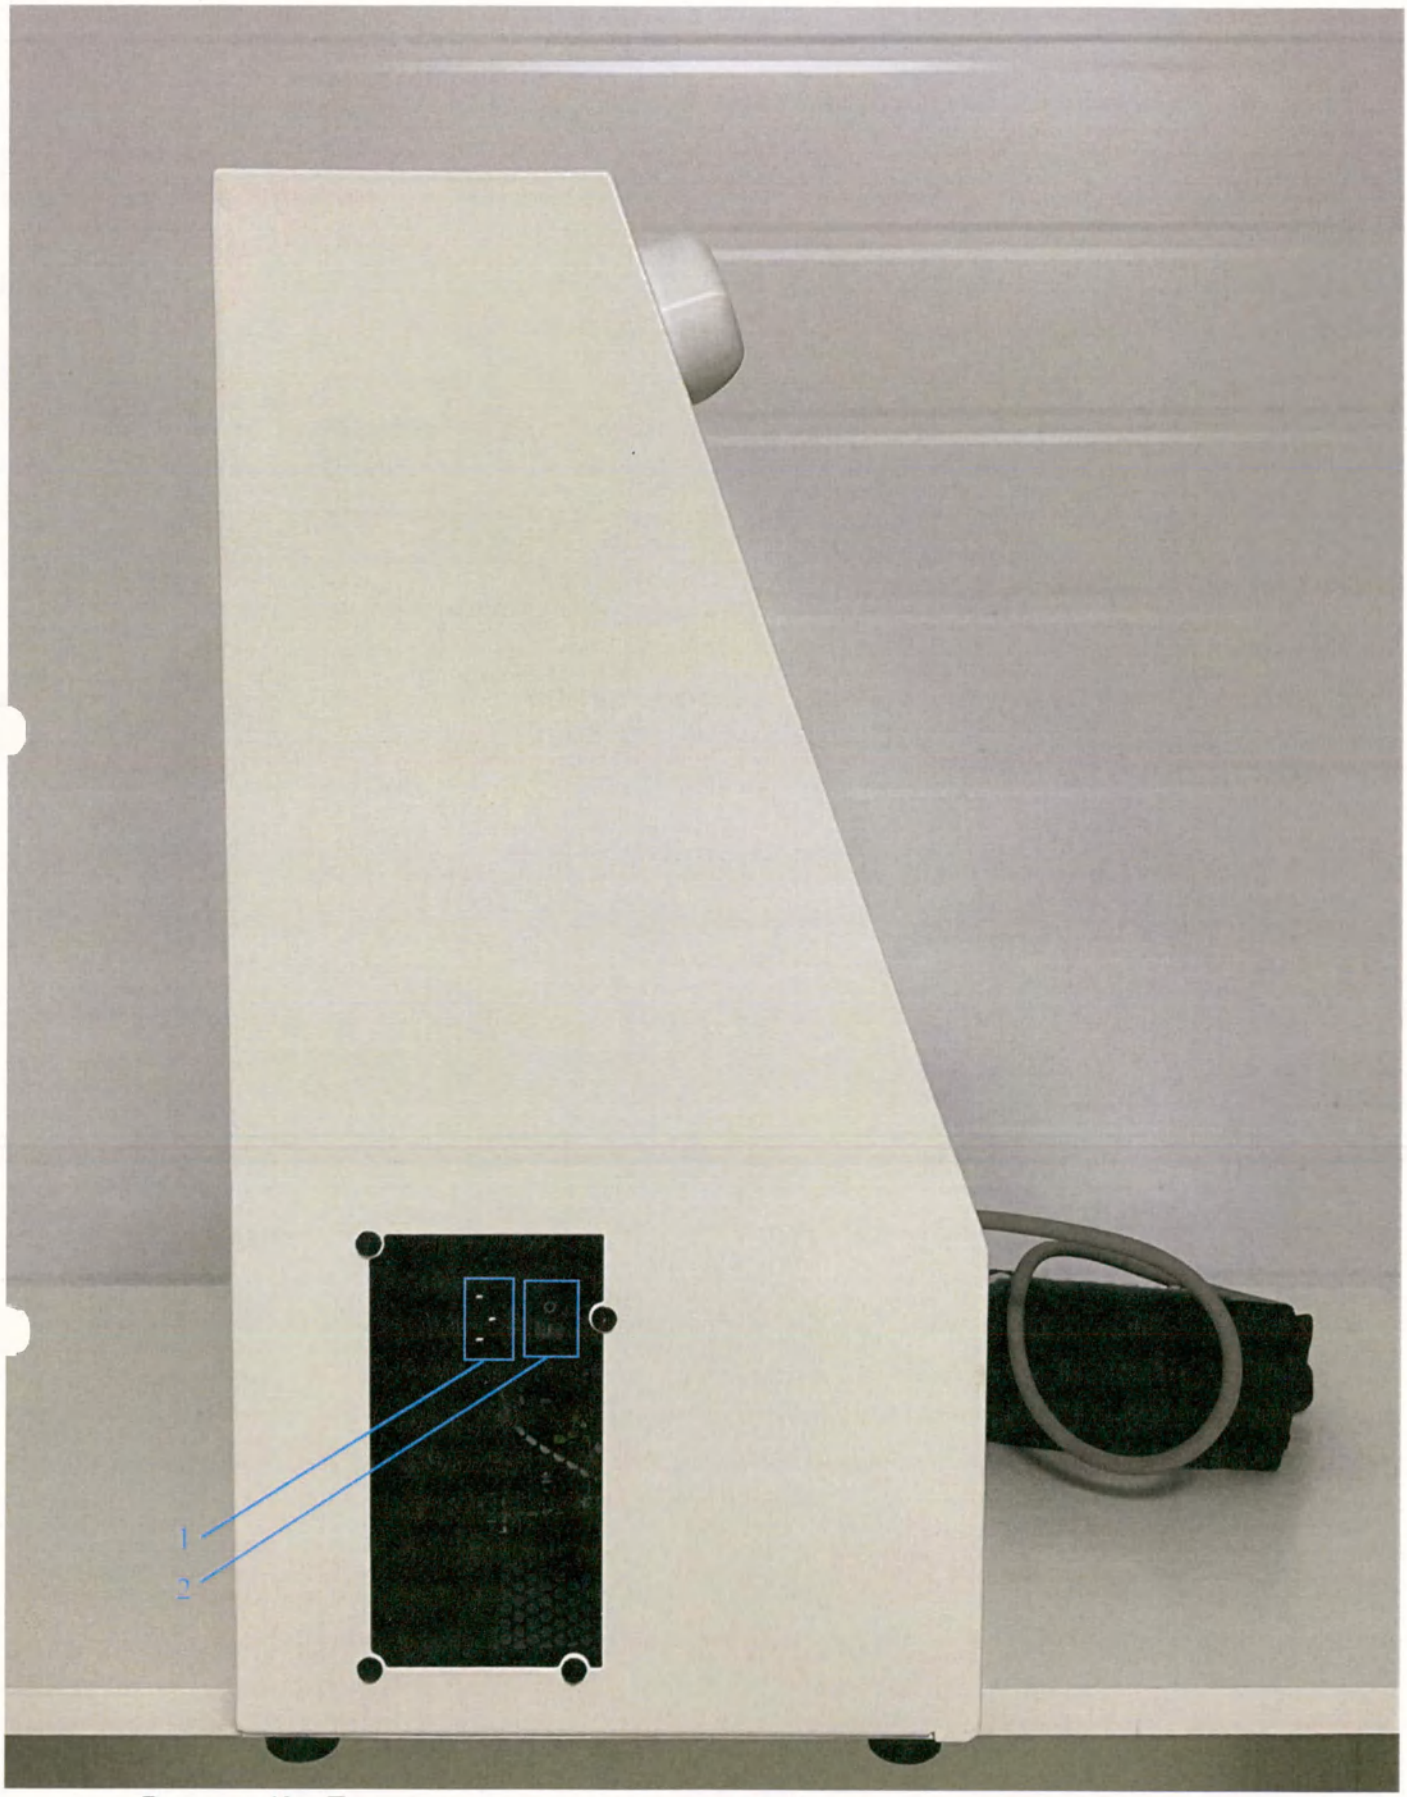


Рисунок 43 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1, вид слева:

1 – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

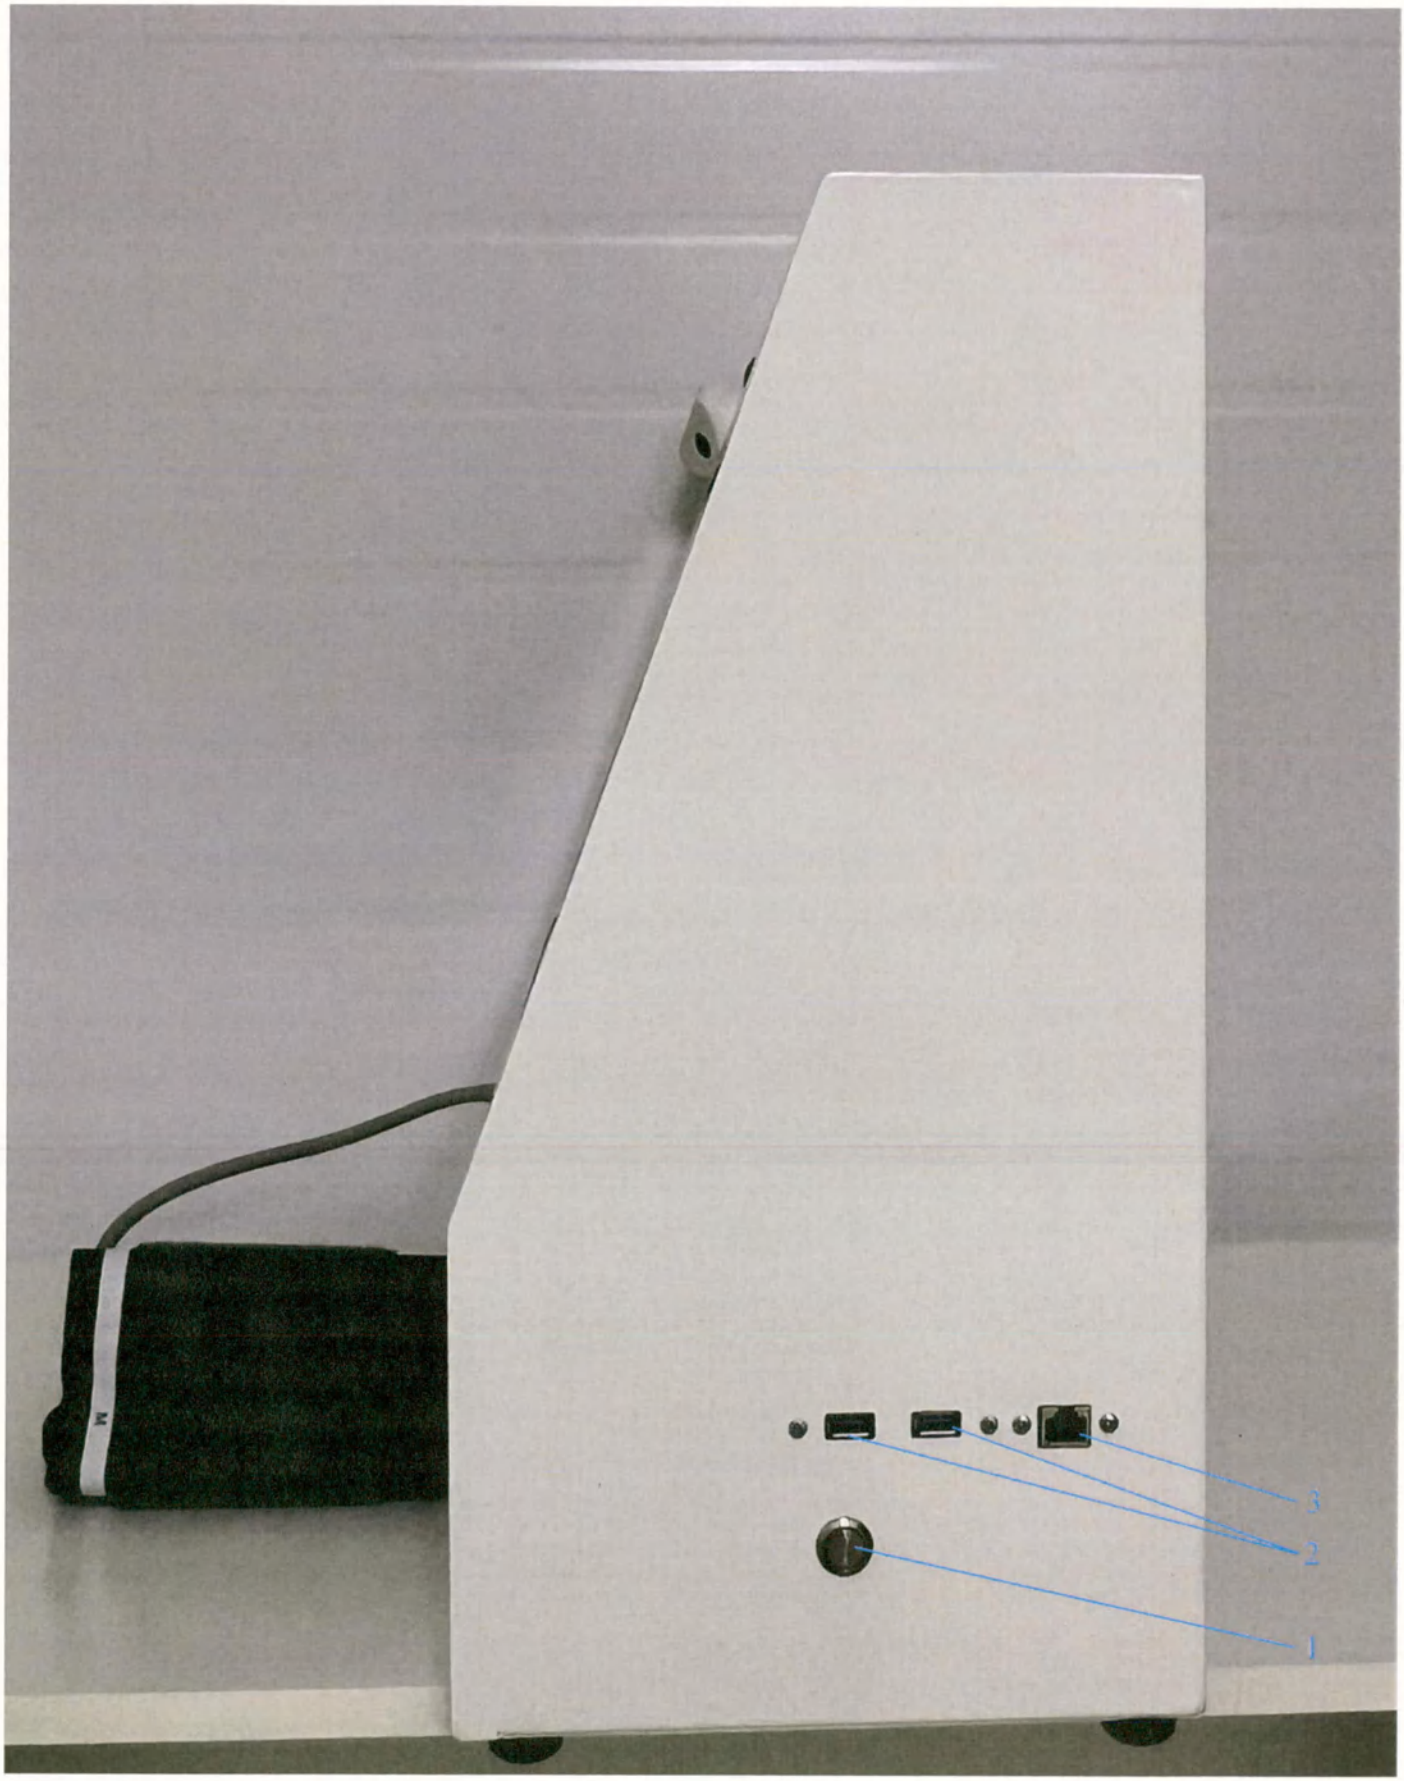


Рисунок 44 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1, вид справа:

1 – Разъем USB; *2* – Кнопка питания терминала; *3* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

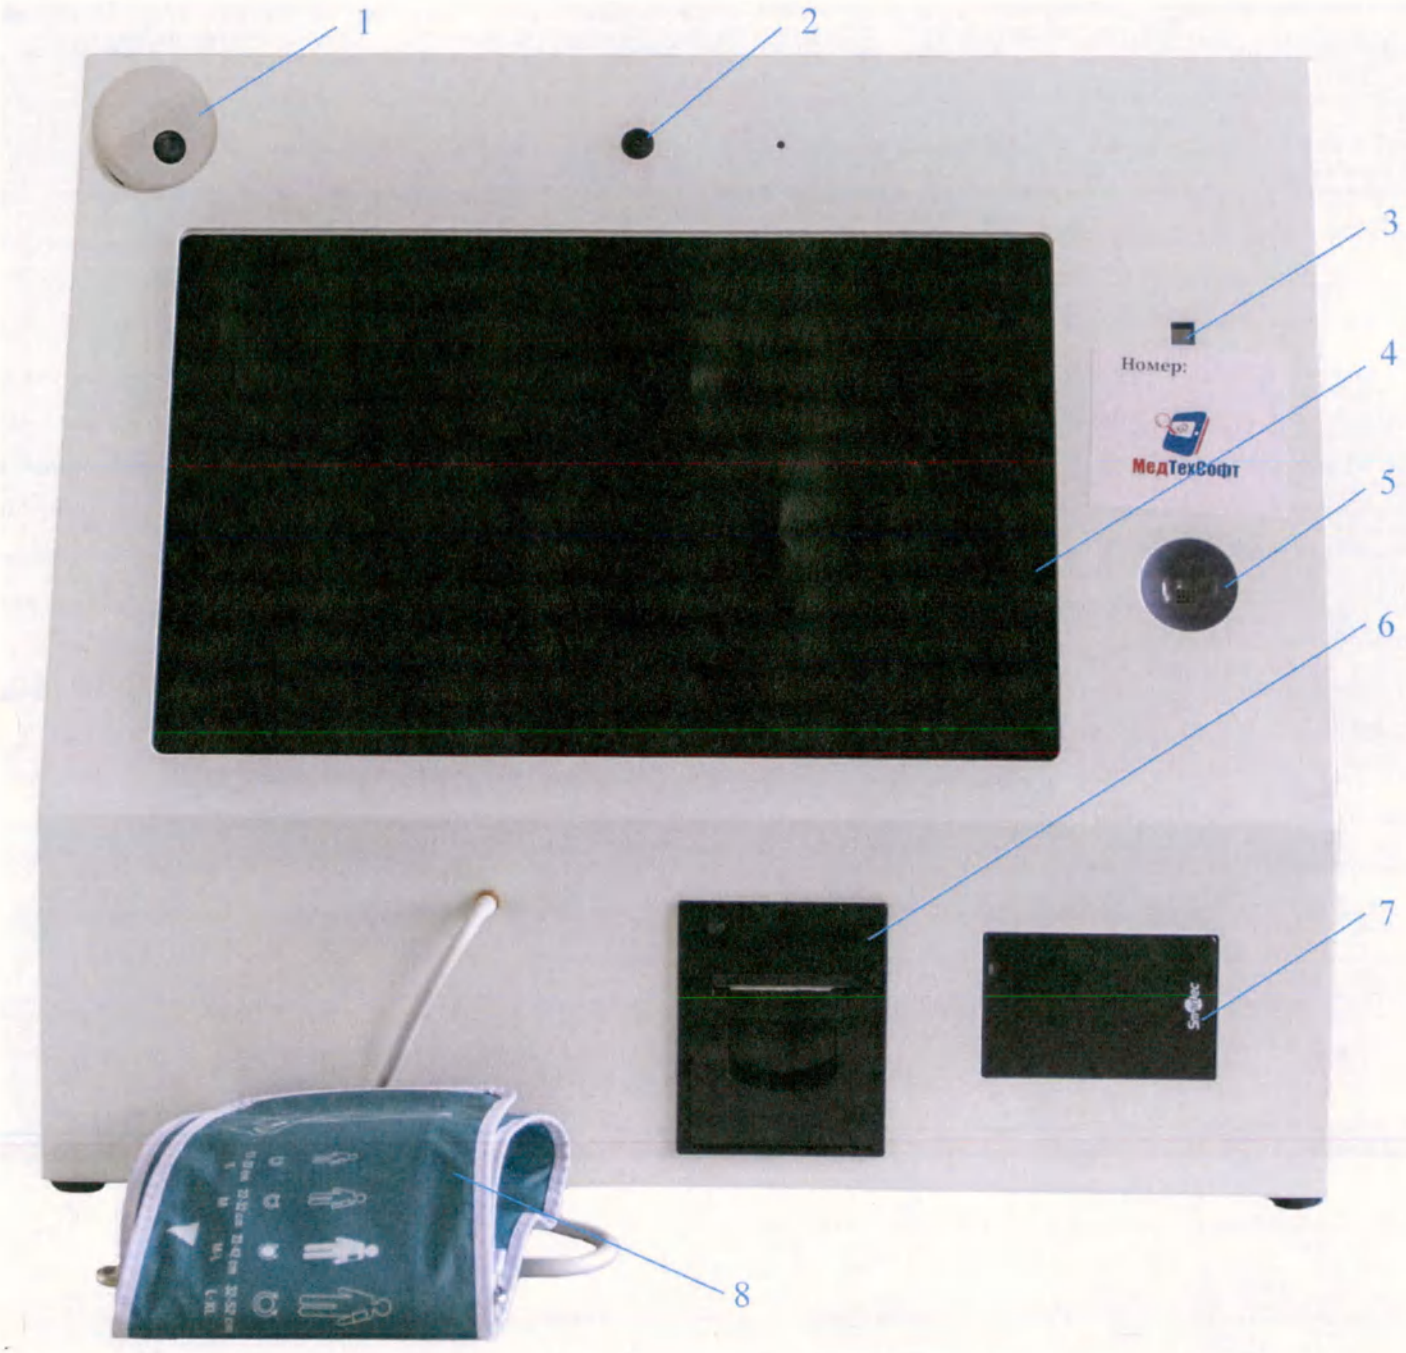


Рисунок 45 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2, вид спереди:

1 – Видеокамера HBVCAM 1807; *2* – Видеокамера 2 RER-USB30W02M; *3* – Бесконтактный инфракрасный термометр Berrcom, вариант исполнения: JXB-183 (РУ № РЗН 2013/737 от 21.06.2013 г.); *4* – Дисплей; *5* – Мундштук-воронка Анализатора концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, Алкотестер Динго Е-200 (РУ № РЗН 2014/1689 от 09.08.2023 г.); *6* – Термопринтер этикеток HSPOS HS-K23; *7* – Настольный RFID считыватель Smartec ST-CE011MF; *8* – Манжета Прибора для измерения артериального давления и частоты пульса серии Watch BP Office портативного с манжетой на одно плечо, Watch BP Office с функцией Central (РУ № РЗН 2023/21110 от 15.01.2024 г.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 46 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

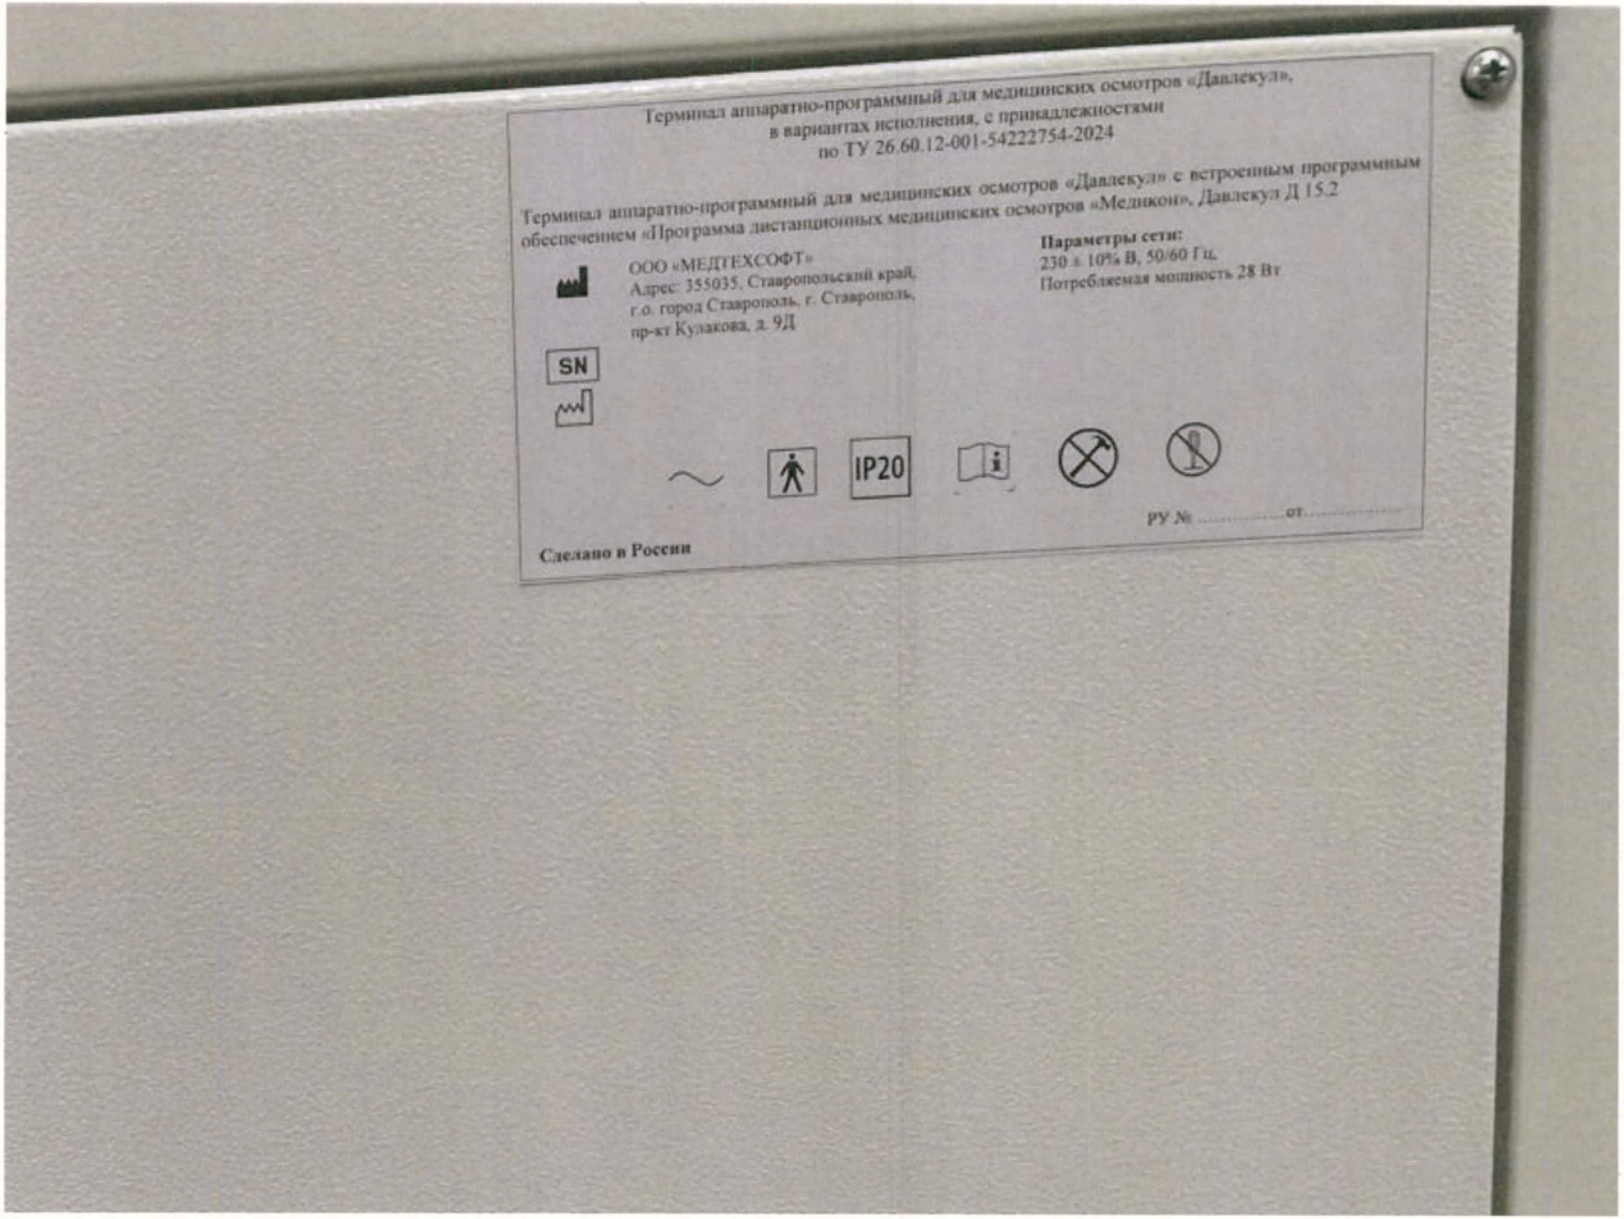


Рисунок 47 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2, маркировка терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

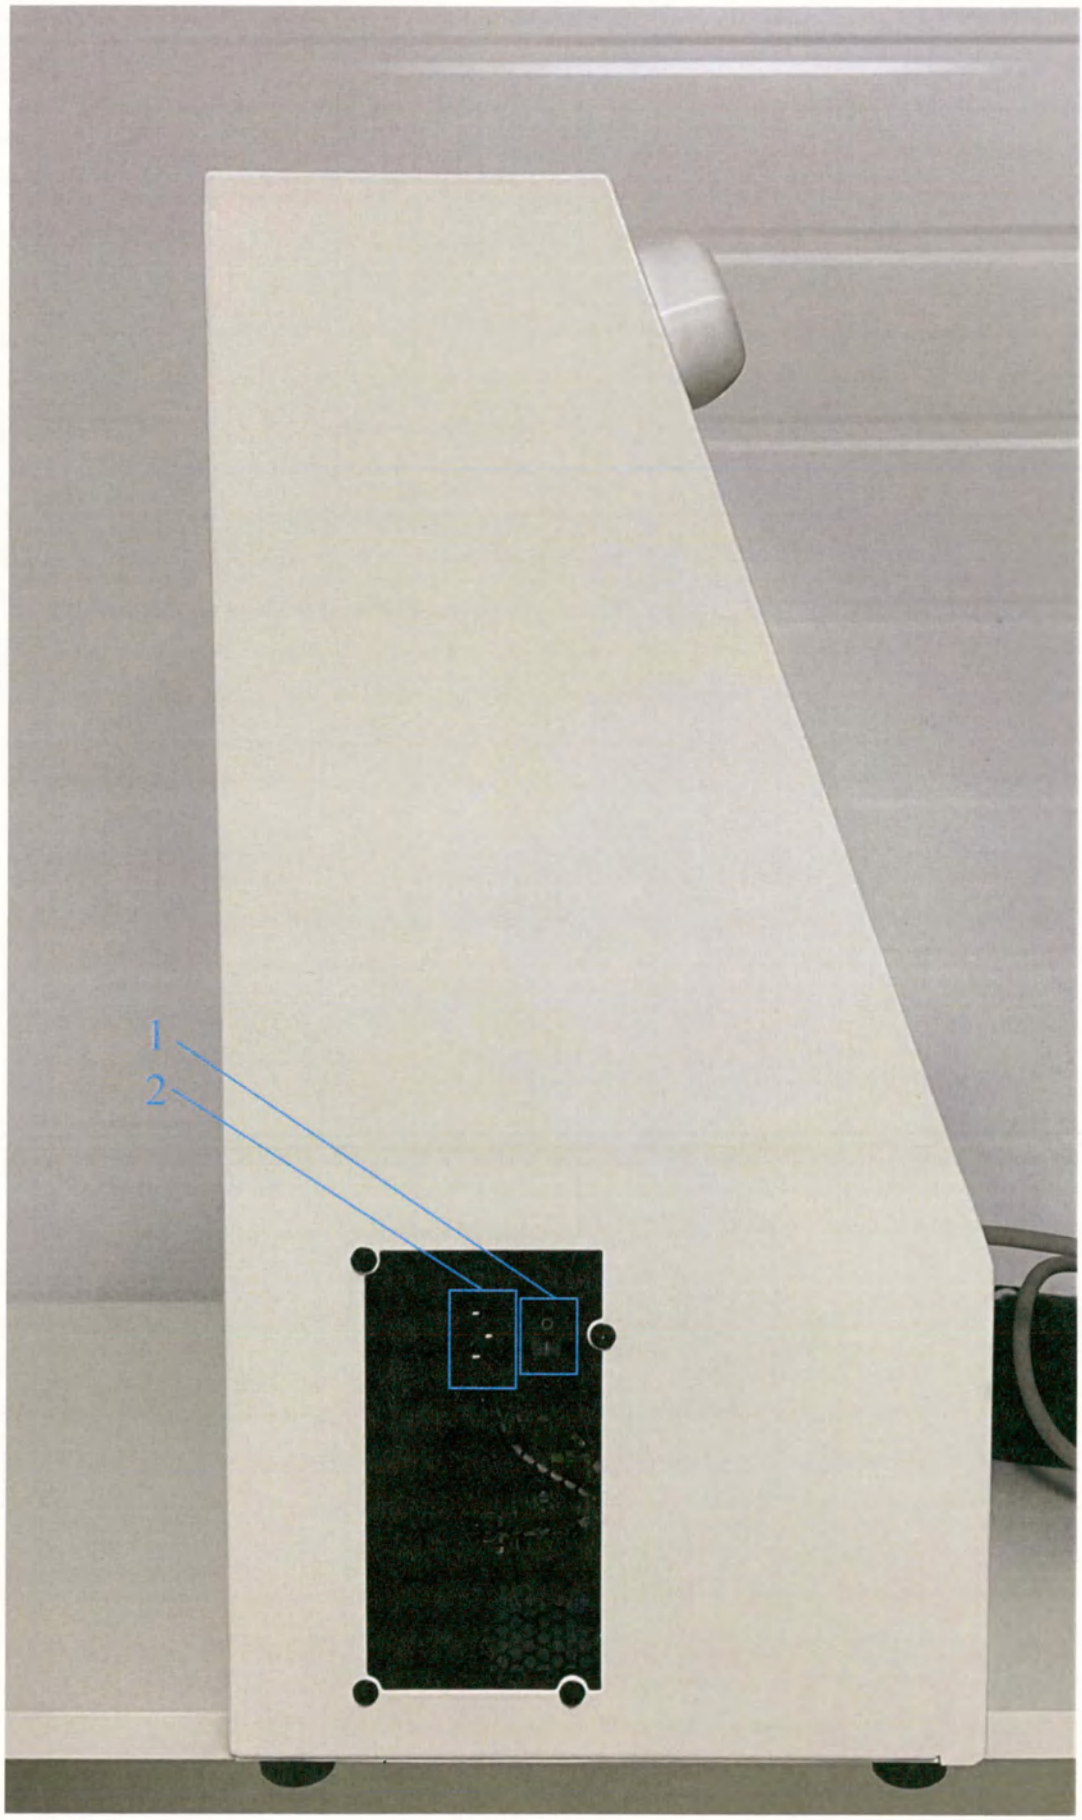


Рисунок 48 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2, вид слева:

1 – Разъем для подключения кабеля питания; *2* – Переключатель включения/выключения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

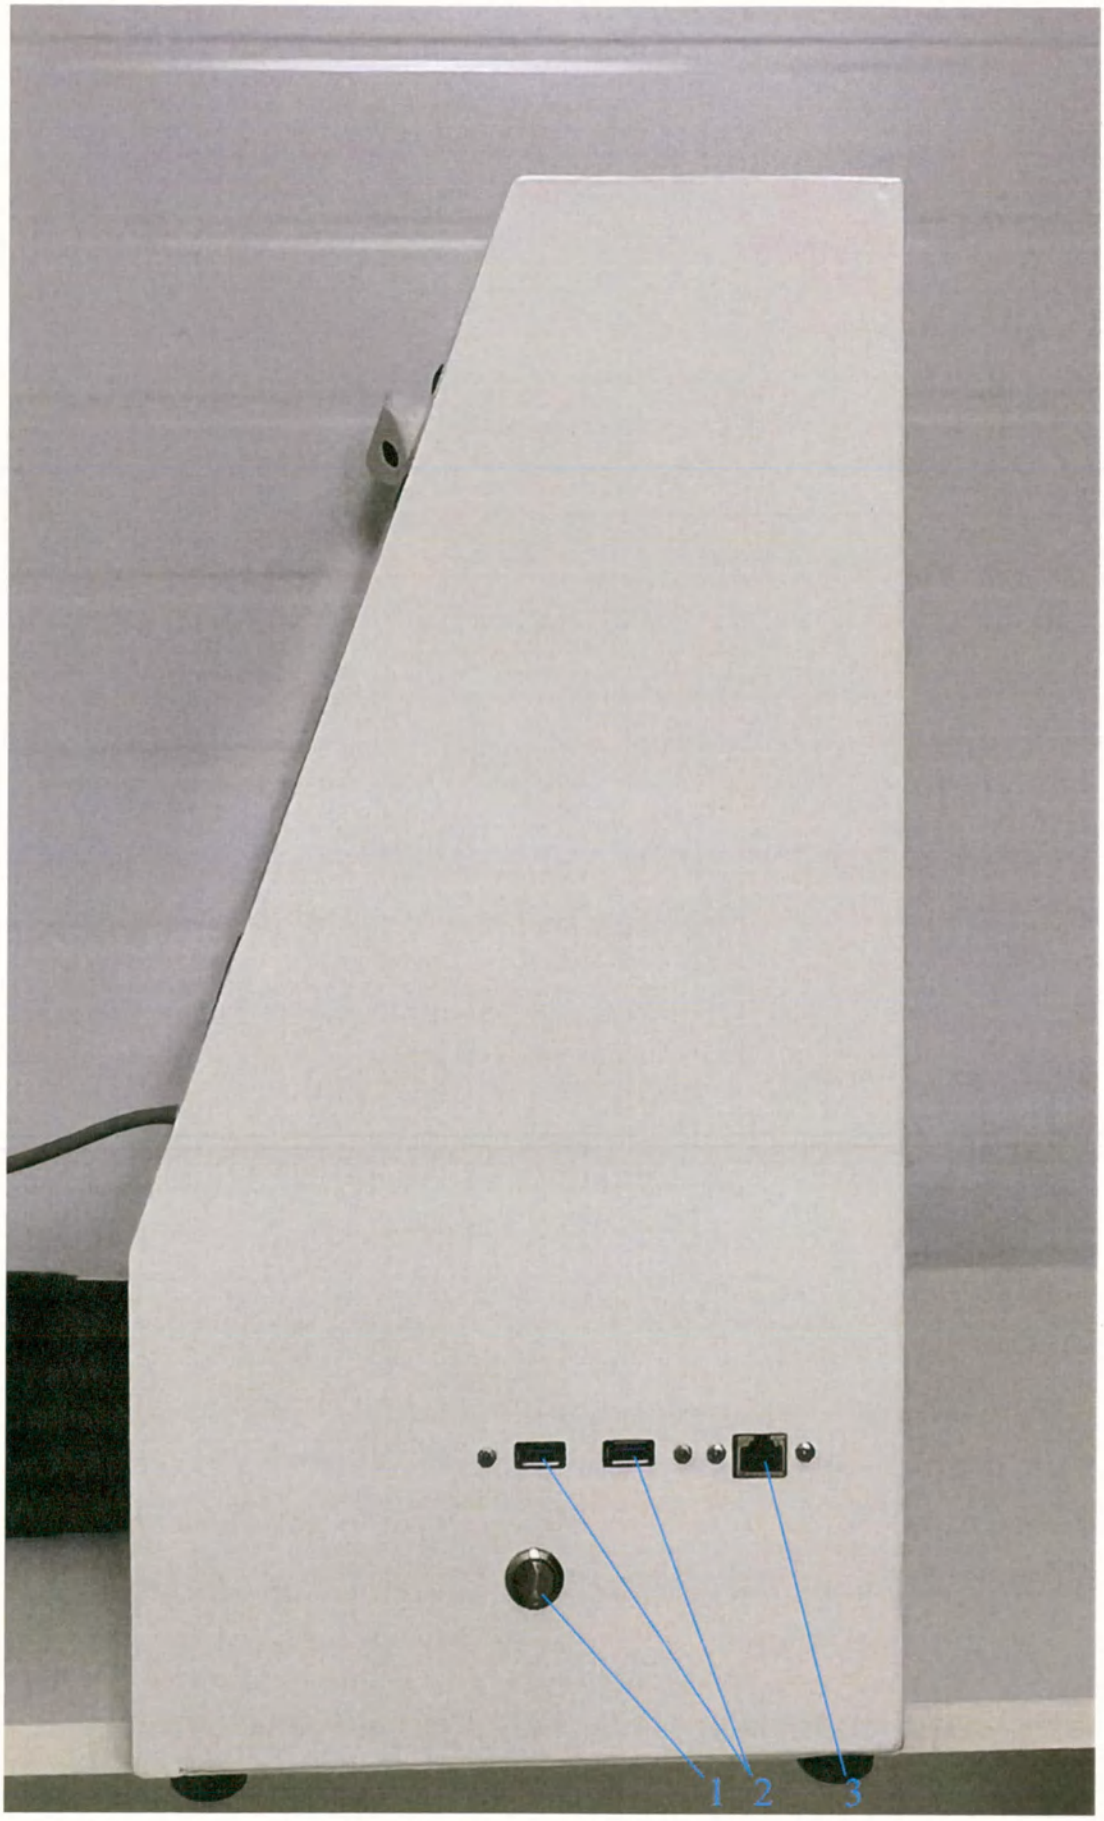


Рисунок 49 – Терминал аппаратно-программной для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.2, вид справа

1 – Разъем USB; *2* – Кнопка питания терминала; *3* – Разъем RJ-45

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 50 – Мундштук-воронка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 51 –Кабель питания терминала

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 52 – Упаковка медицинского изделия, в которой планируется поставлять его потребителю (транспортная тара)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 53 – Упаковка медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 54 – Упаковка медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рисунок 55 – Упаковка медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

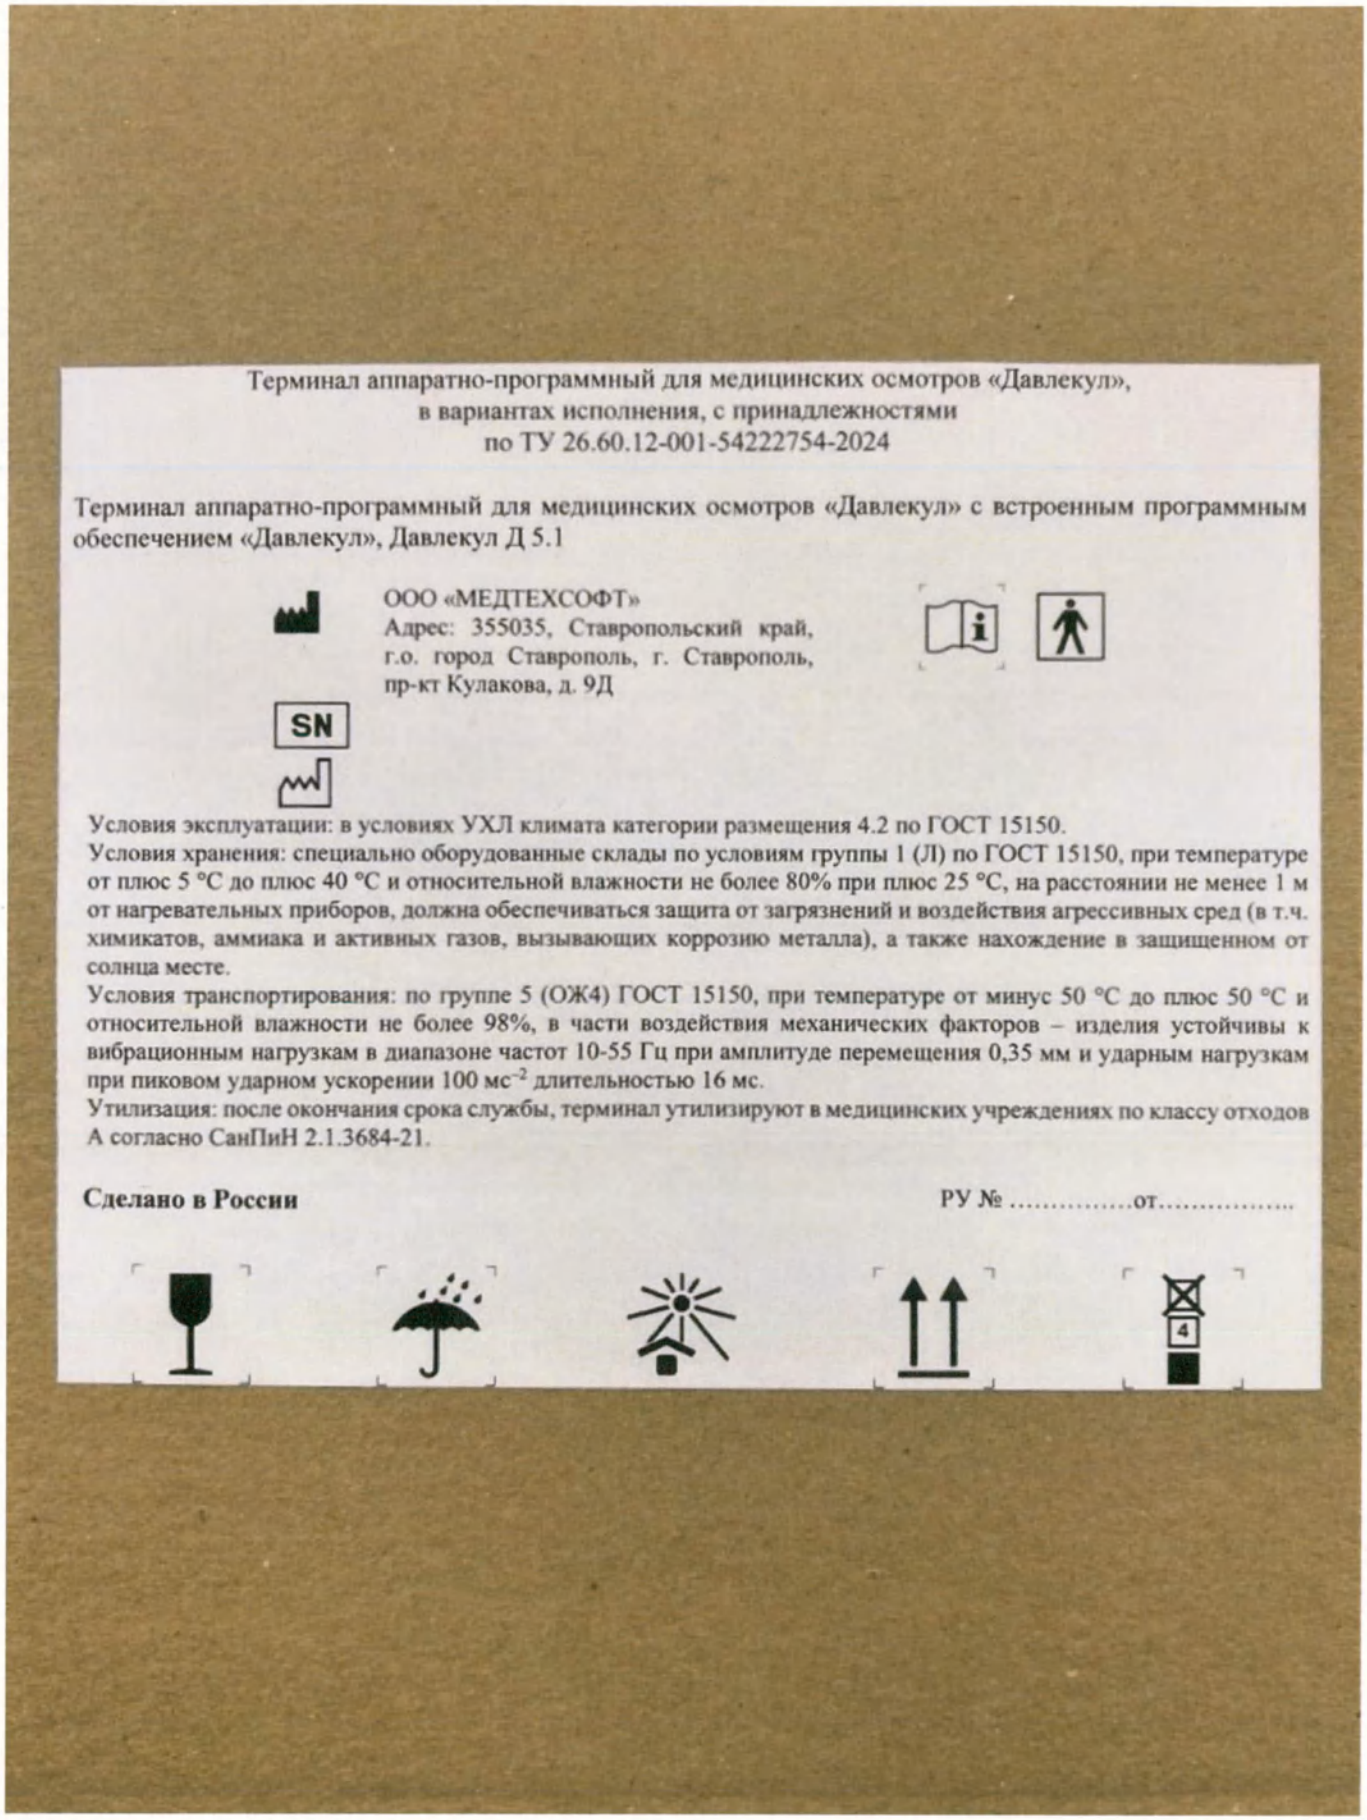


Рисунок 56 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

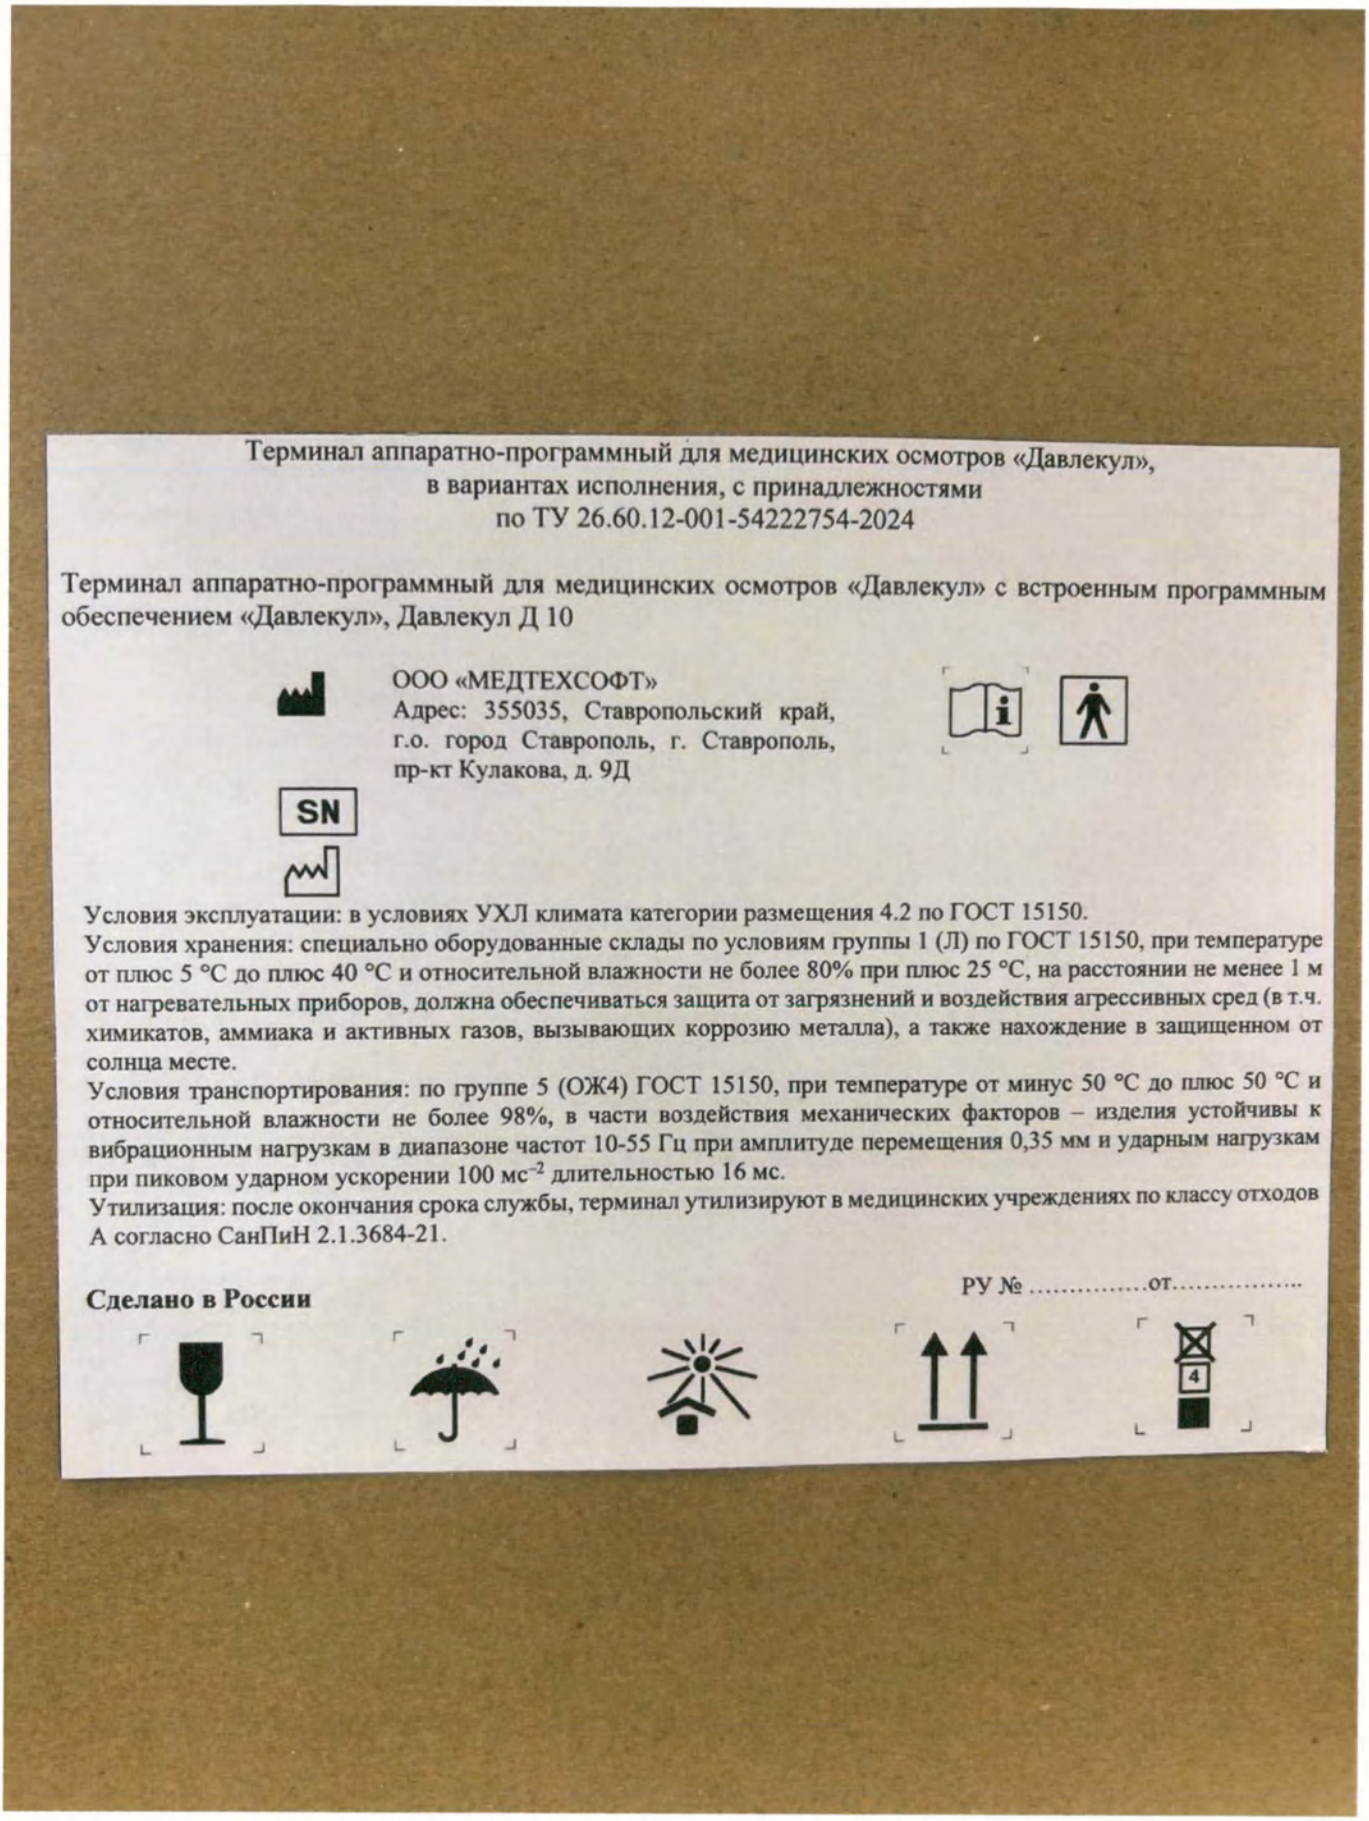


Рисунок 57 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

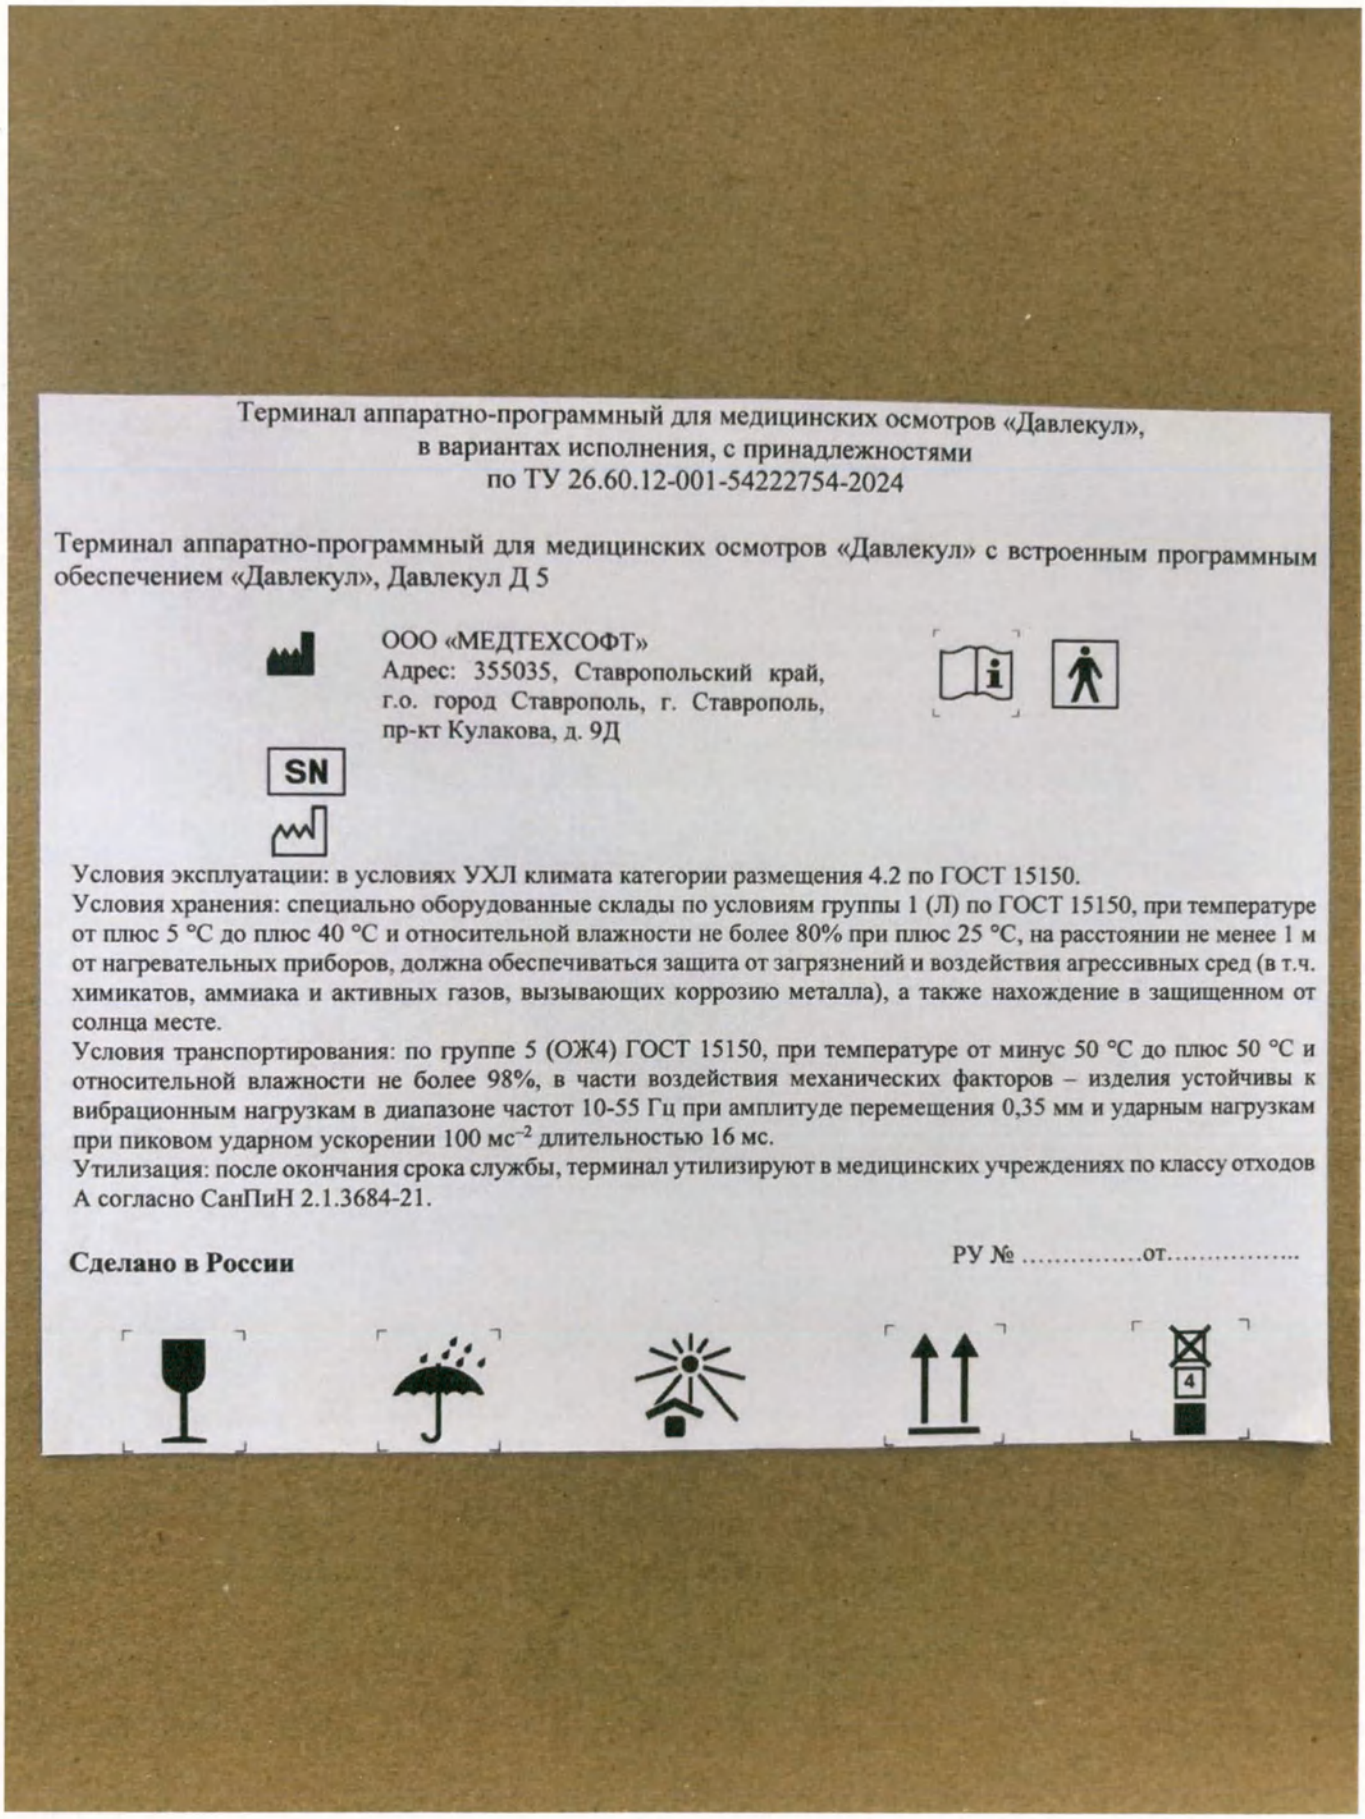


Рисунок 58 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д







Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 $мс^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....











Рисунок 59 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.1


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2



ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край,
г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь,
пр-кт Кулакова, д. 9Д





Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 $мс^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....



Рисунок 60 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

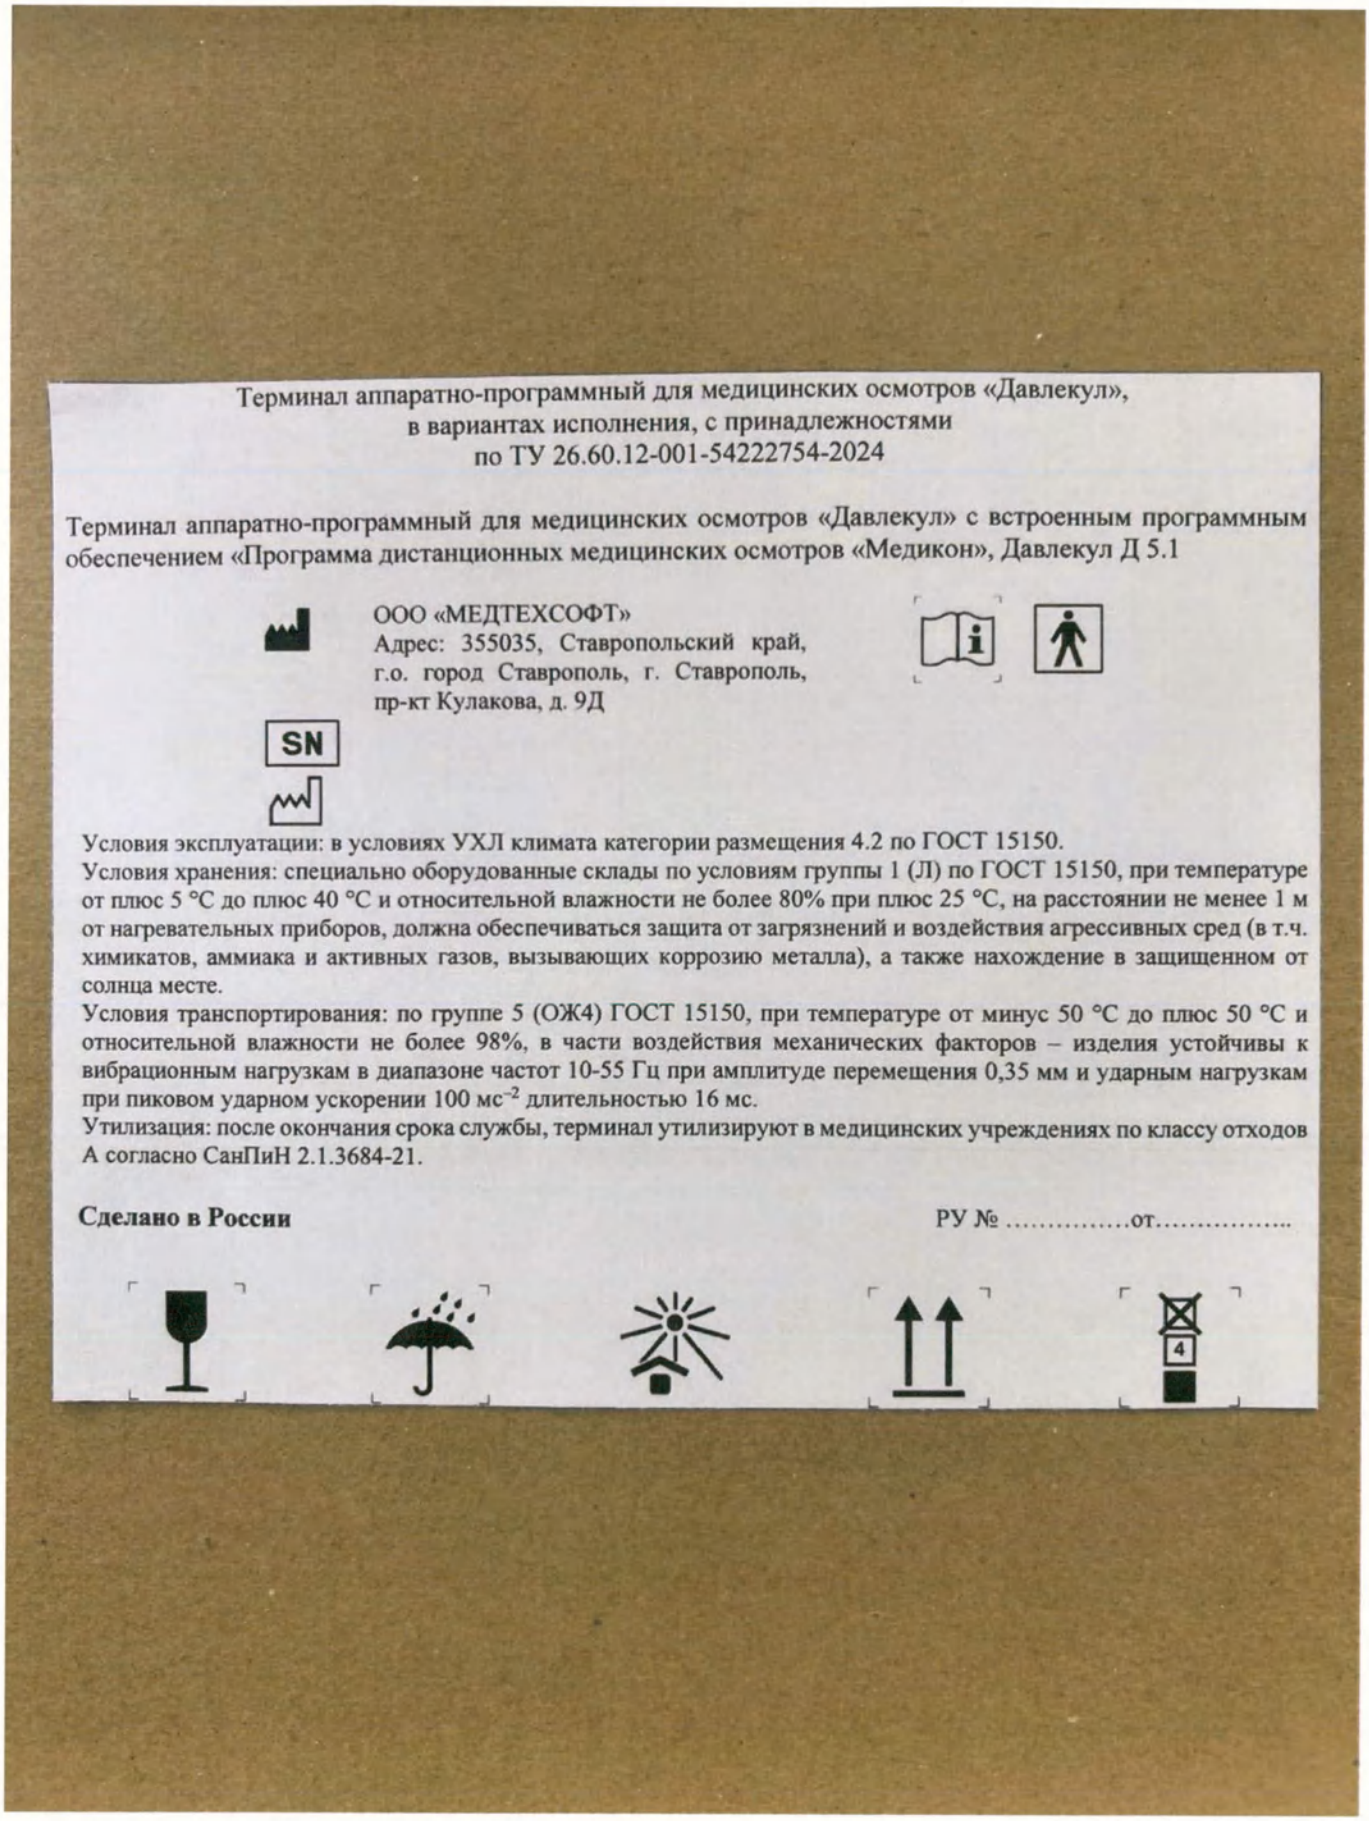


Рисунок 61 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 10

ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д

SN

Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....



Рисунок 62 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 10

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

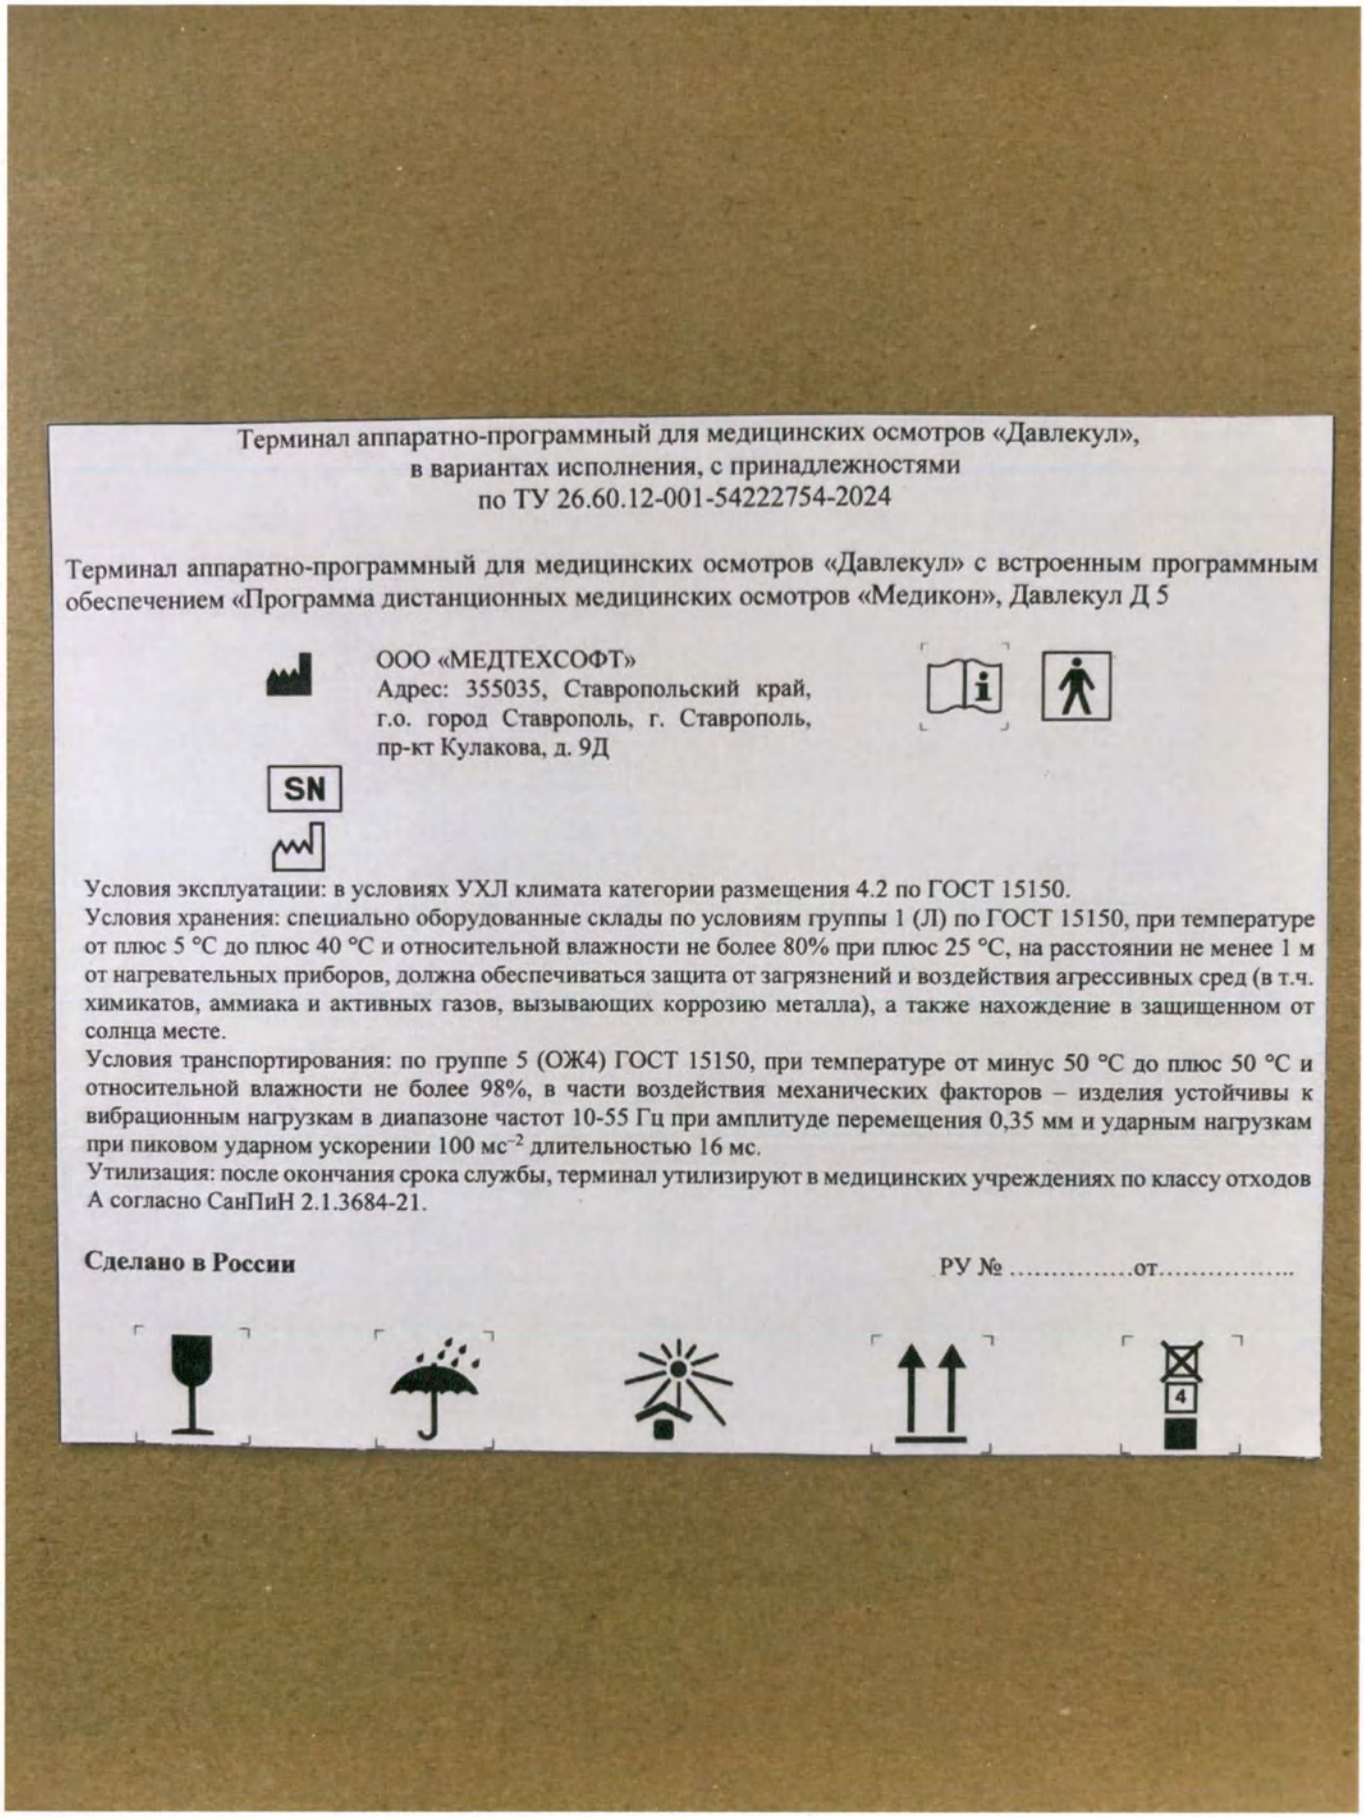


Рисунок 63 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 5

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул»,
в вариантах исполнения, с принадлежностями
по ТУ 26.60.12-001-54222754-2024

Терминал аппаратно-программный для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1

ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Адрес: 355035, Ставропольский край, г.о. город Ставрополь, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 9Д

SN

Условия эксплуатации: в условиях УХЛ климата категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.
Условия хранения: специально оборудованные склады по условиям группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80% при плюс 25 °С, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, должна обеспечиваться защита от загрязнений и воздействия агрессивных сред (в т.ч. химикатов, аммиака и активных газов, вызывающих коррозию металла), а также нахождение в защищенном от солнца месте.
Условия транспортирования: по группе 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150, при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 98%, в части воздействия механических факторов – изделия устойчивы к вибрационным нагрузкам в диапазоне частот 10-55 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм и ударным нагрузкам при пиковом ударном ускорении 100 мс$^{-2}$ длительностью 16 мс.
Утилизация: после окончания срока службы, терминал утилизируют в медицинских учреждениях по классу отходов А согласно СанПиН 2.1.3684-21.

Сделано в России

РУ № .....от.....

4

Рисунок 64 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Давлекул» с встроенным программным обеспечением «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон», Давлекул Д 15.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

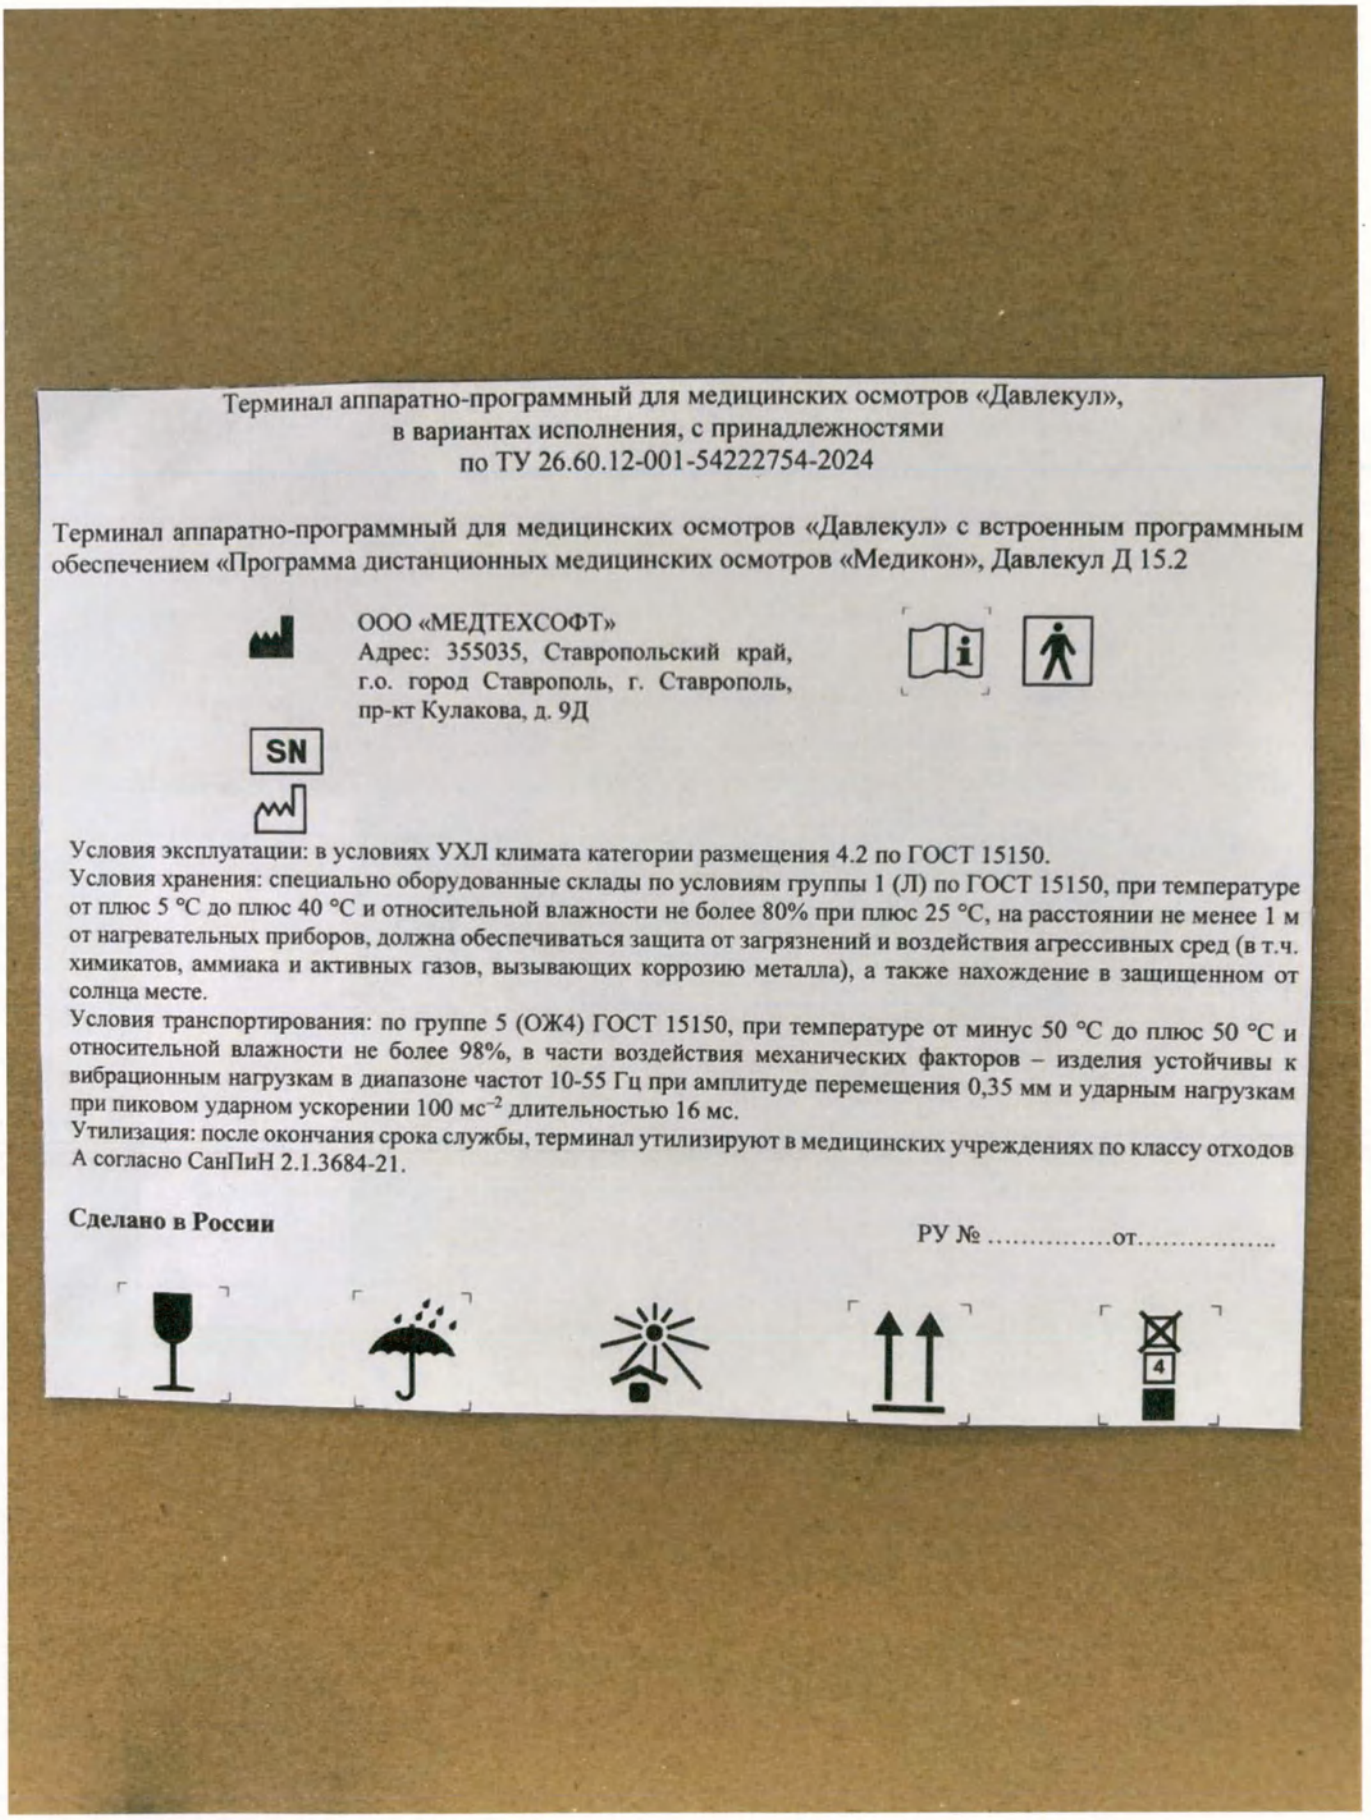


Рисунок 65 – Маркировка транспортной тары Терминала аппаратно-программного для медицинских осмотров «Программа дистанционных медицинских осмотров «Медикон» с встроенным программным обеспечением «Давлекул», Давлекул Д 15.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Прошито, пронумеровано и
скреплено 13 листов
ООО «МЕДТЕХСОФТ»
Генеральный директор
_____ / Л.Г.Задорожный
14 февраля 2025 г

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU