
Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

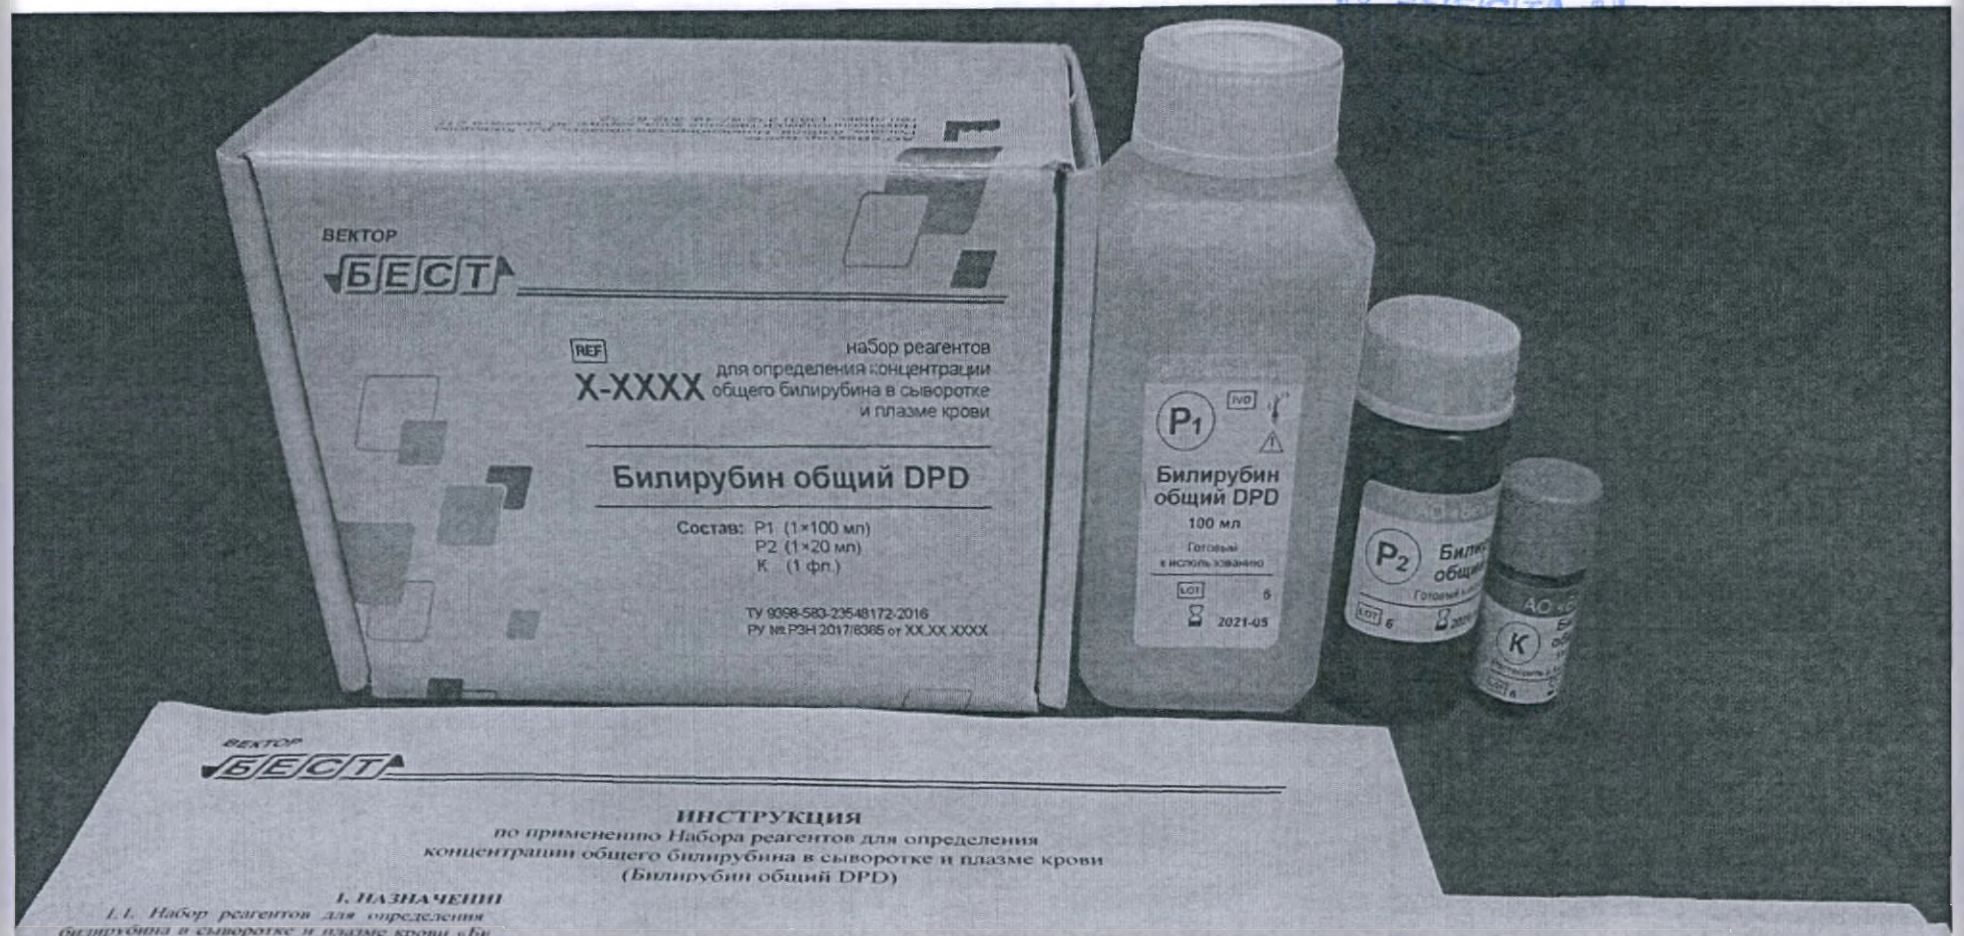

ВЕКТОР БЕСТ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Набора реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови (Билирубин общий DPD)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов для определения билирубина в сыворотке и плазме крови «Би А» (далее по тексту – набор) предназначен определения концентрации общего билиру плазме крови человека колориметрическим D

1.2. Набор выпускается в семи вариант

...нт	Количество определений	Расход P1 на одно определение, мл	Фасовка
	200	0,500	1×100 мл (P1); 1×20 мл (P2); 1 фл. (K);
	0	0,500	2×250 мл (P1); 2×50 мл (P2); 4 фл. (K);
		0,200	4×40 мл (P1); 2×20 мл (P2); 2 фл. (K);
	0,200		3×10 мл (P2)

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
www.vector-best.ru
vbobtk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 51-20 X-XXXX
Билирубин общий DPD

Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови

Номер серии 6

Хранить при температуре 2-8°С

Транспортировать при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток.

Дата изготовления 2020-05


Дата выдачи паспорта 2020-05-08

Срок годности наборов до 2021-05

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 1, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

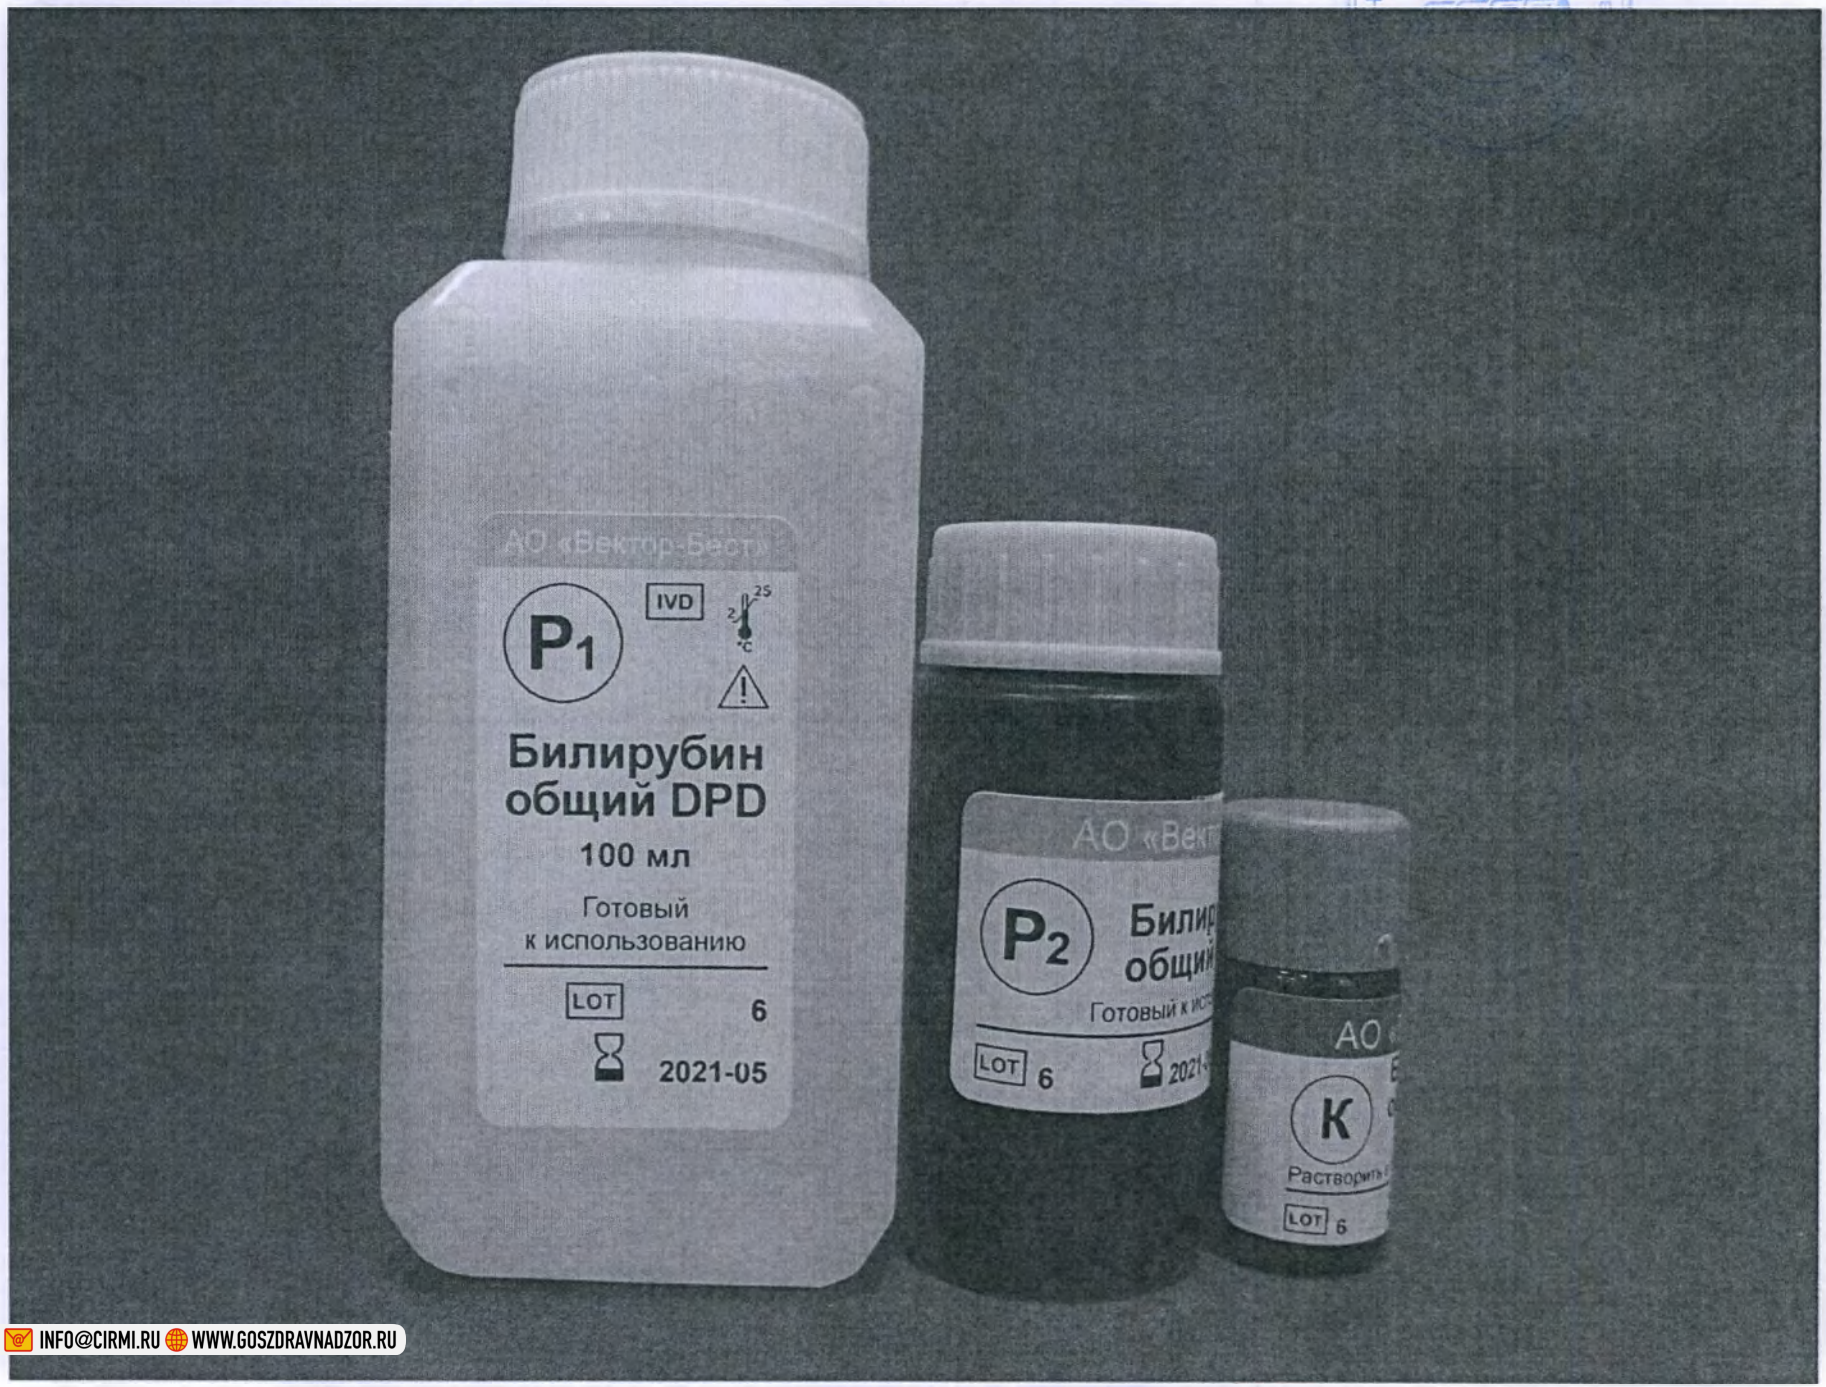

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 1, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

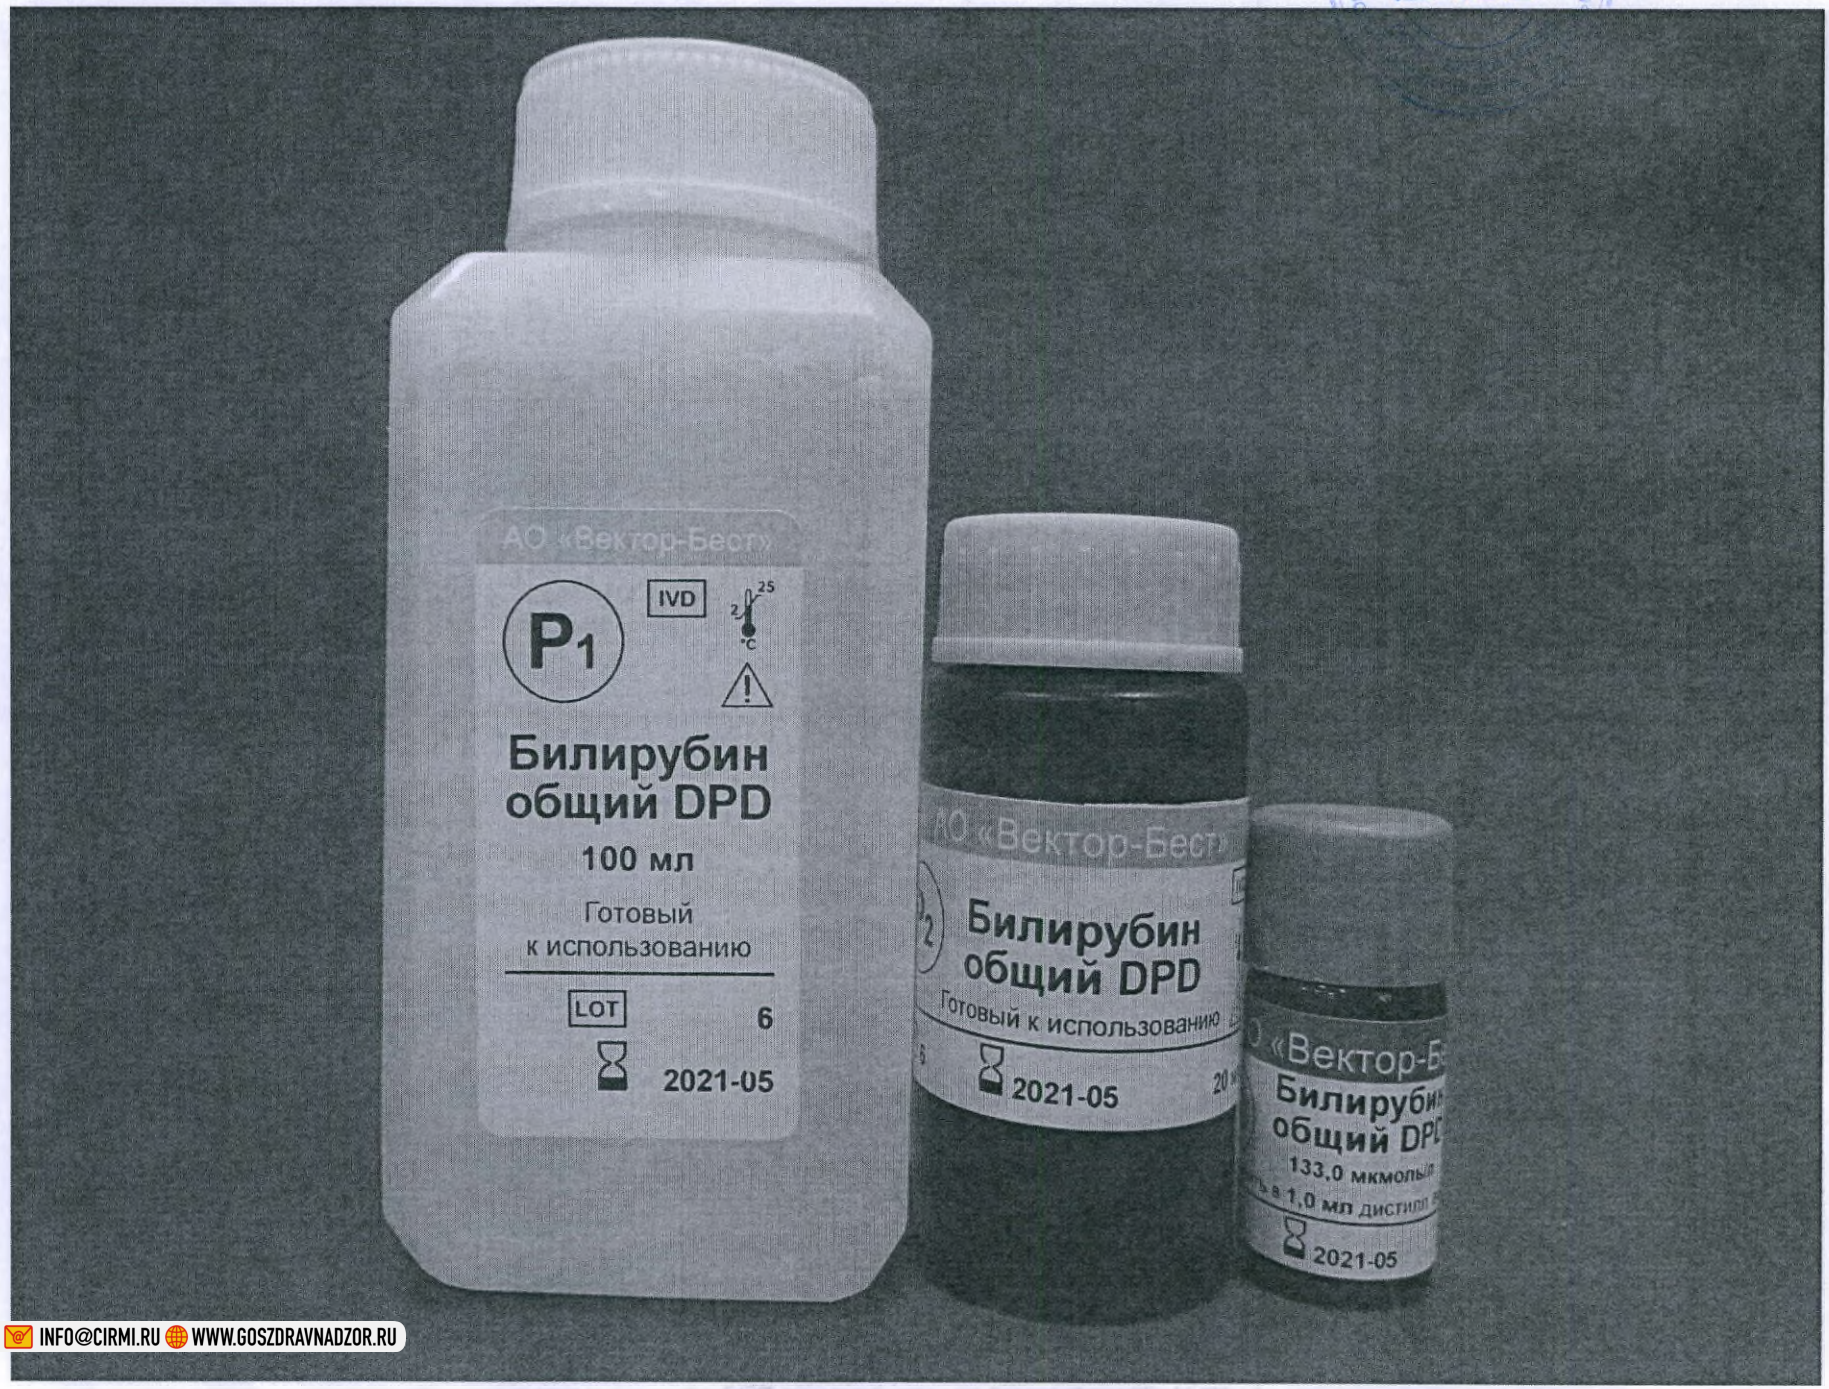

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 1, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 12 ” 11 2020 г.

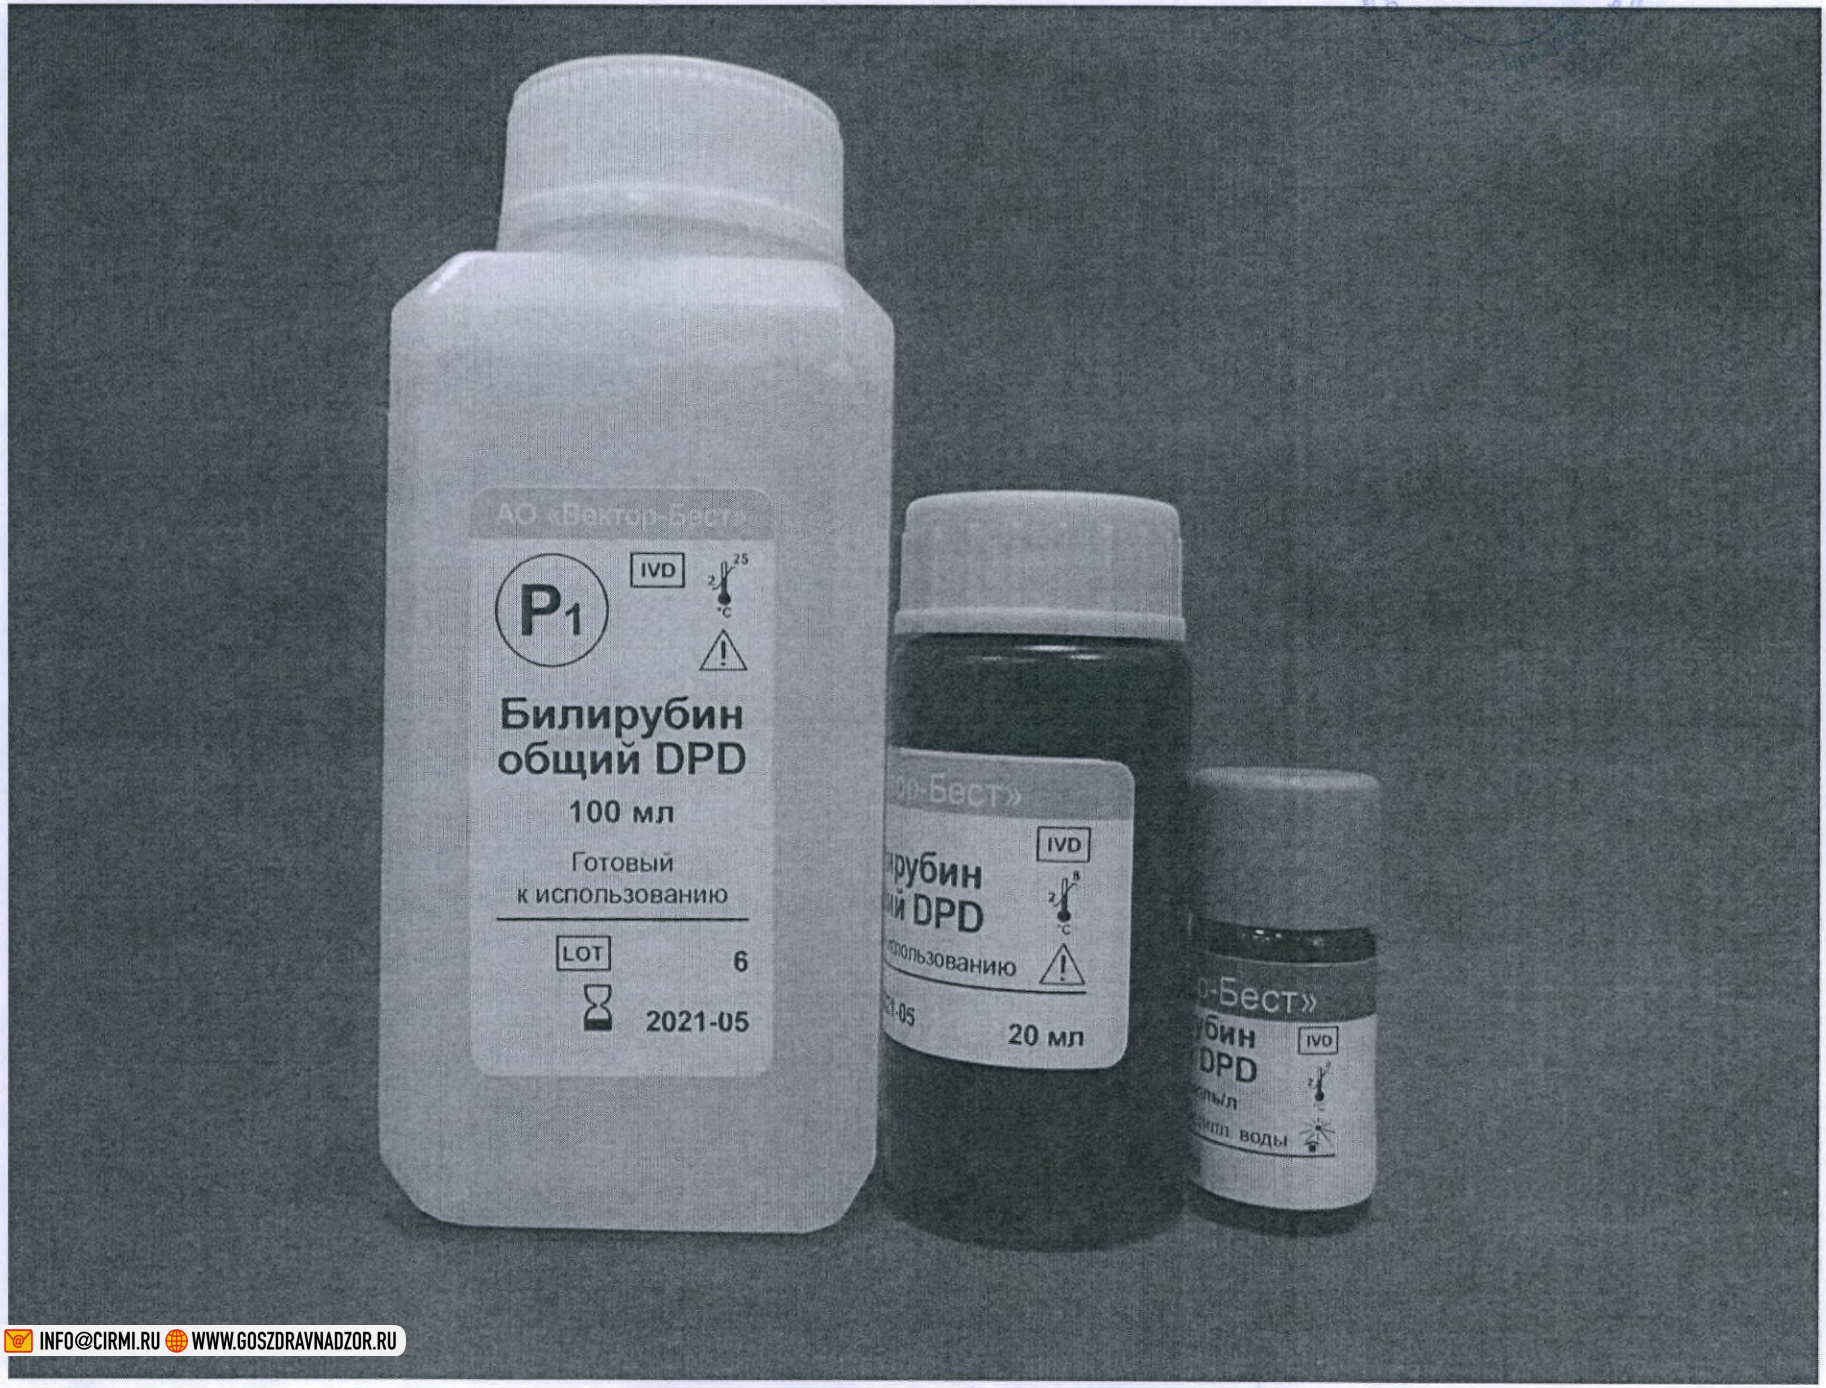

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11. 2020 г.

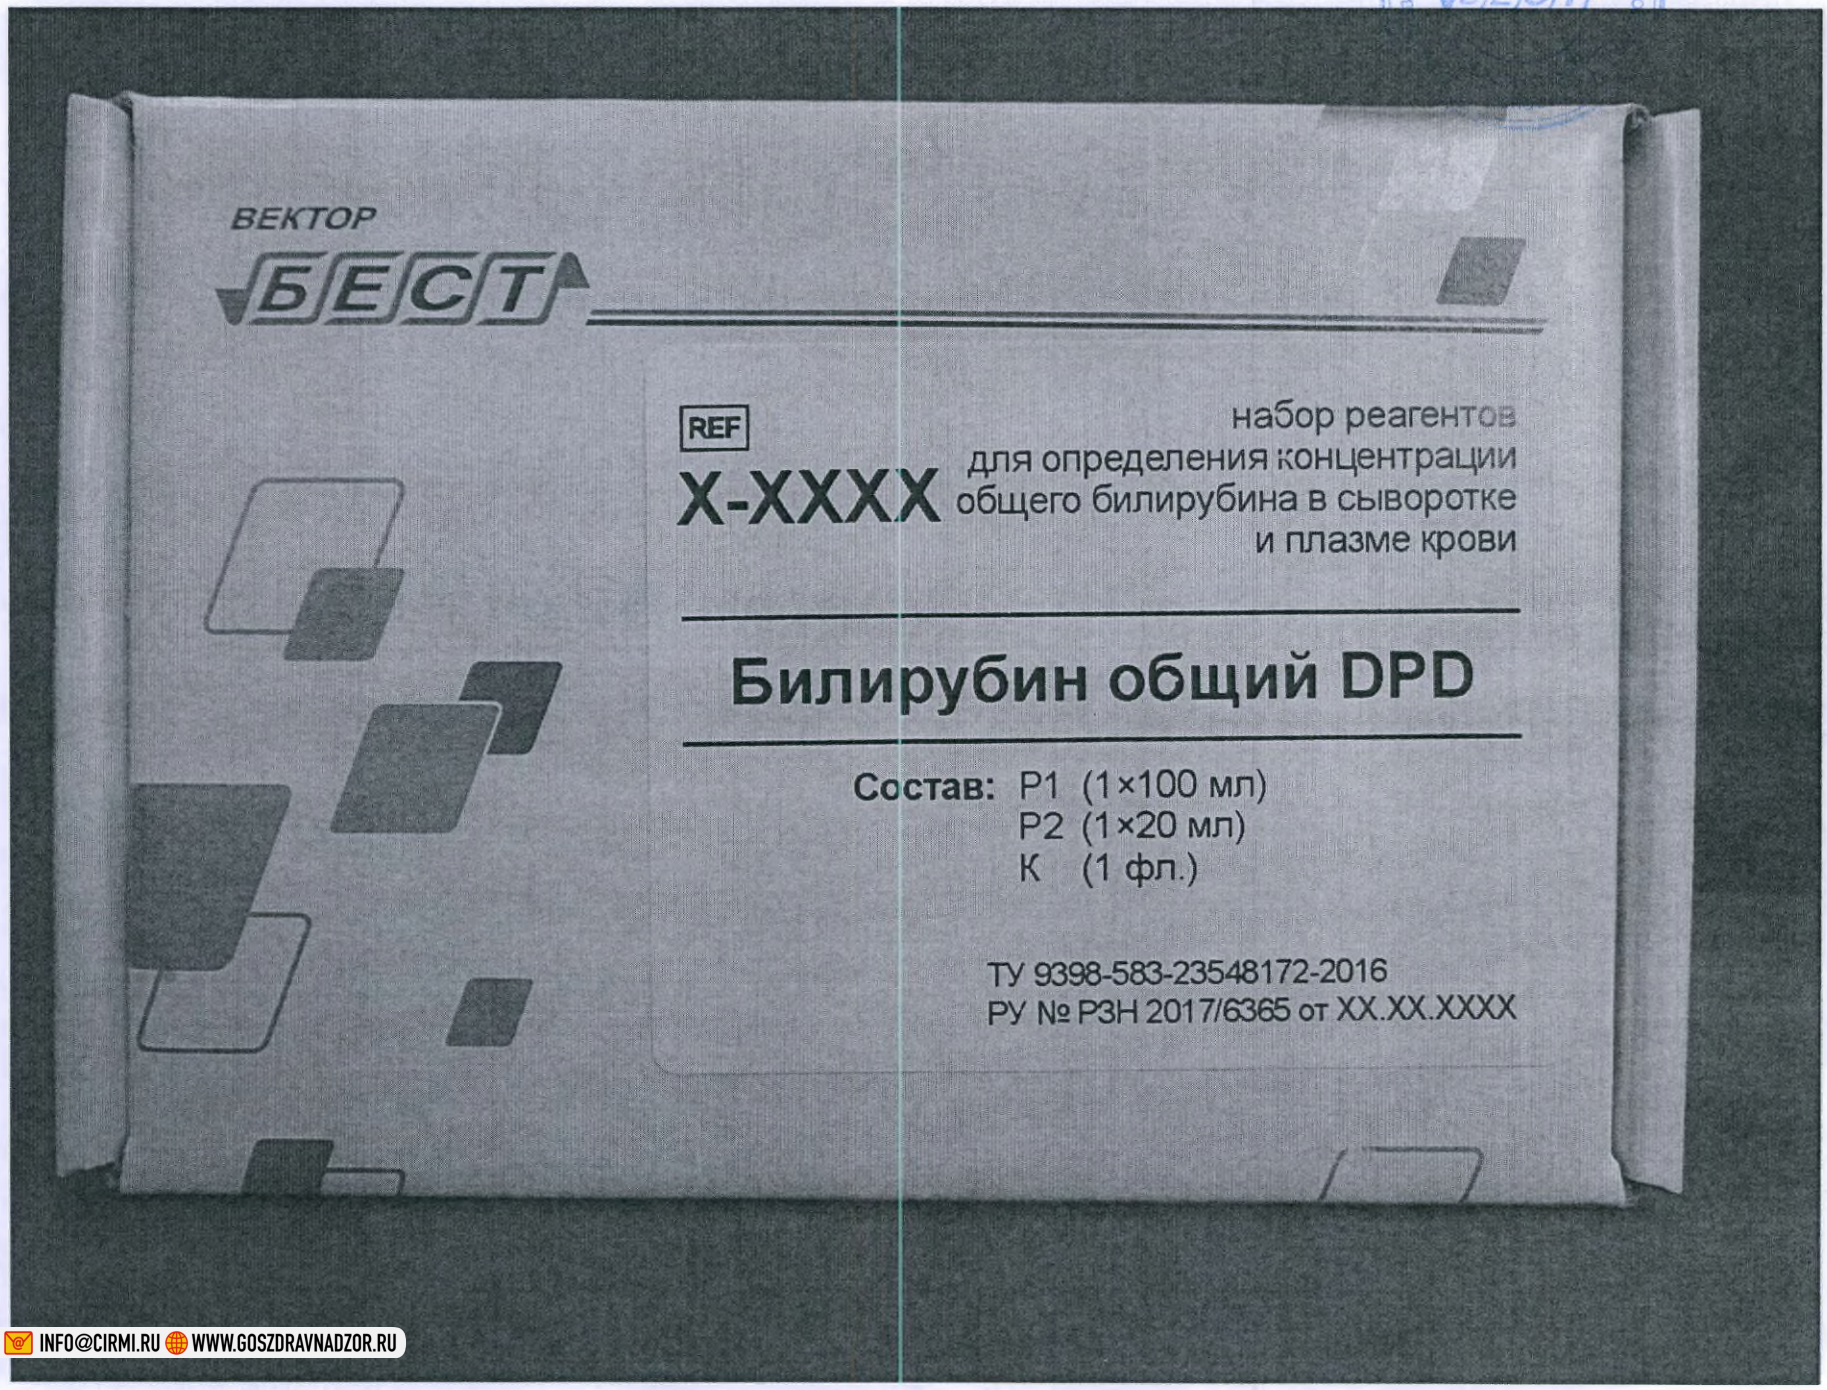

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 1, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 2, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 2, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

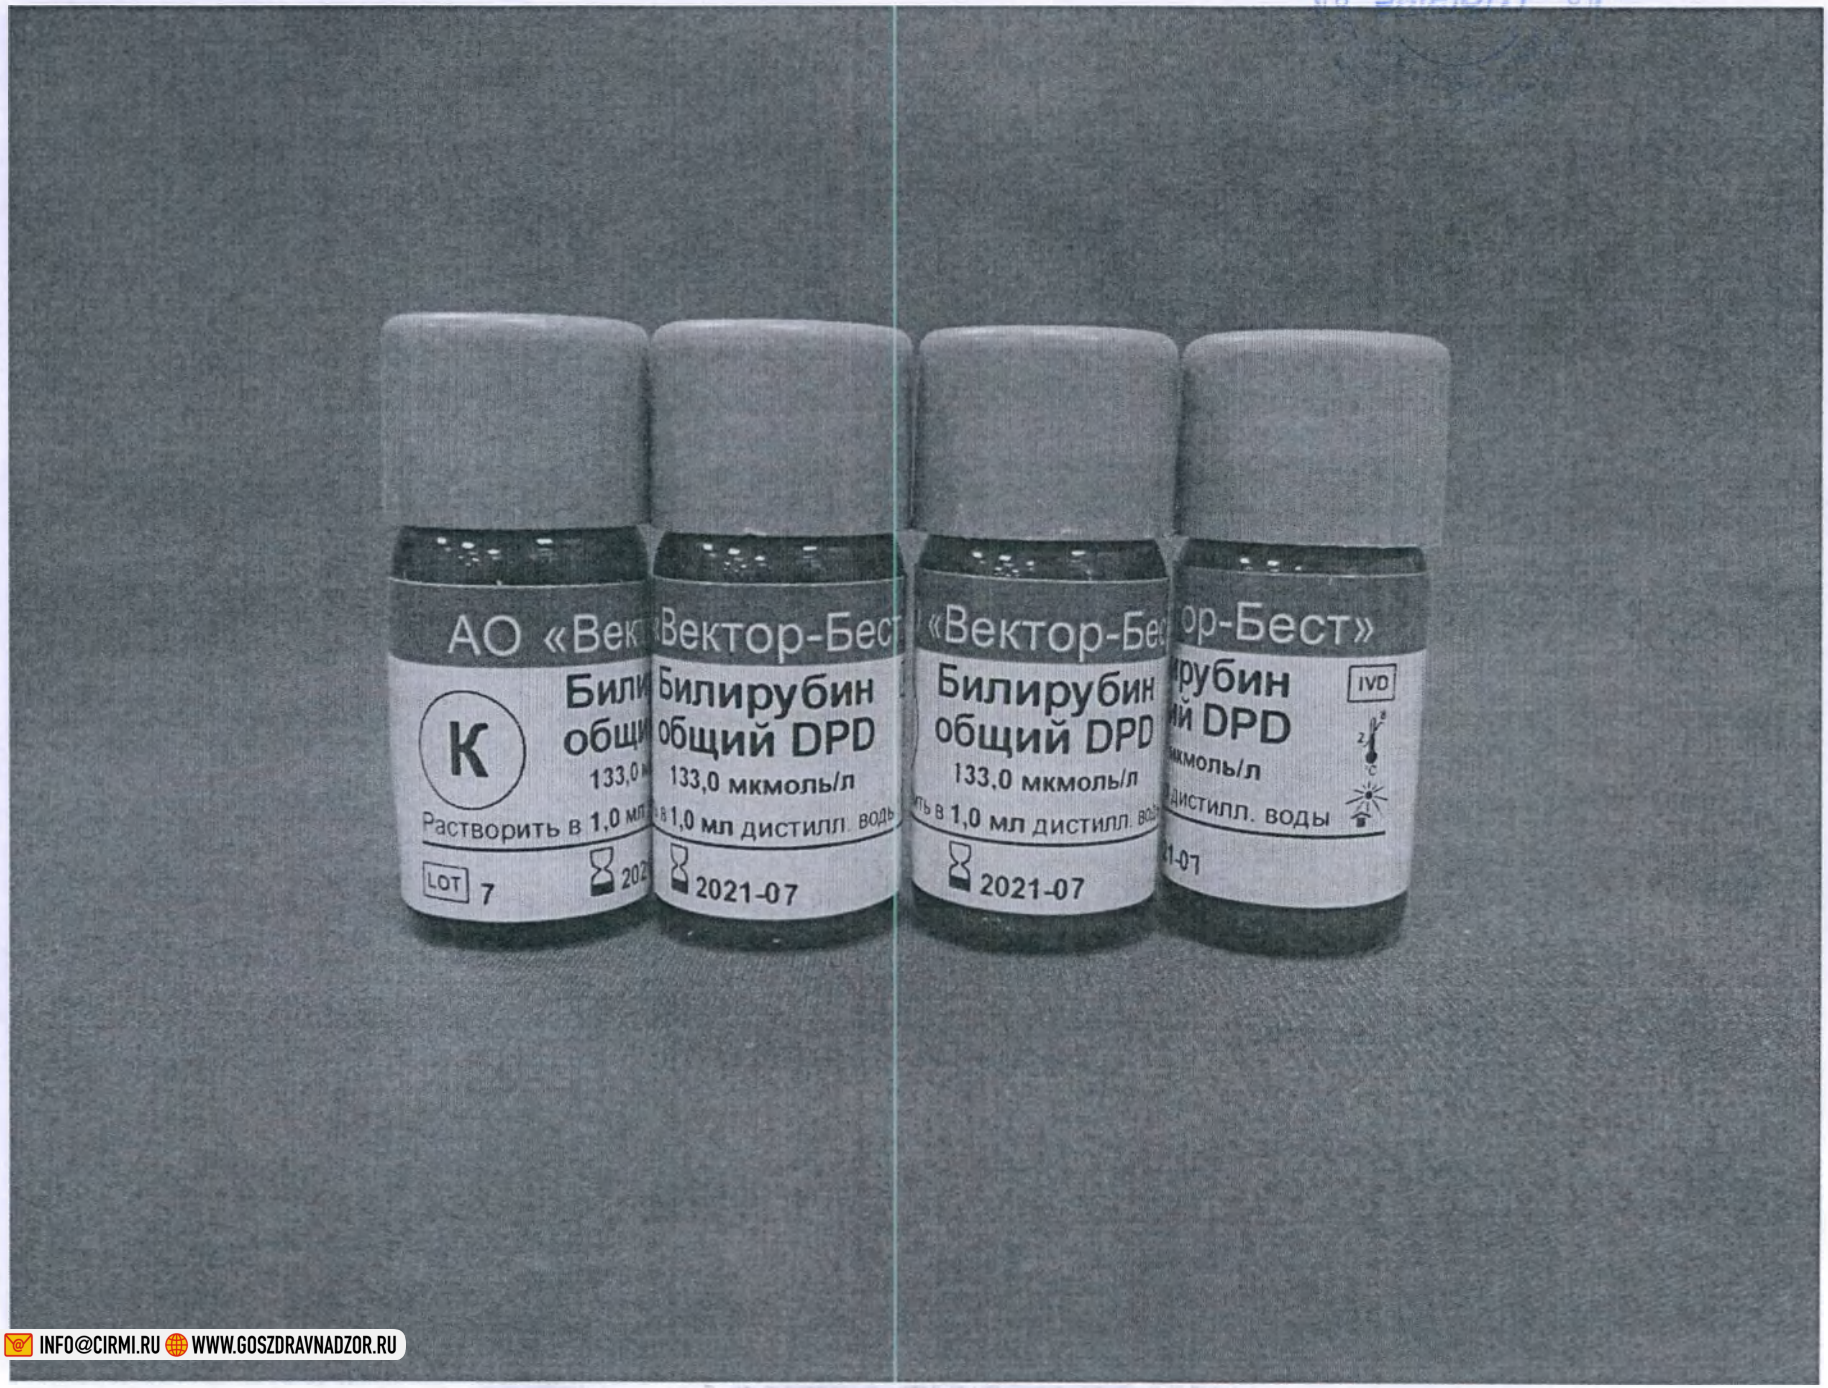

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 2, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

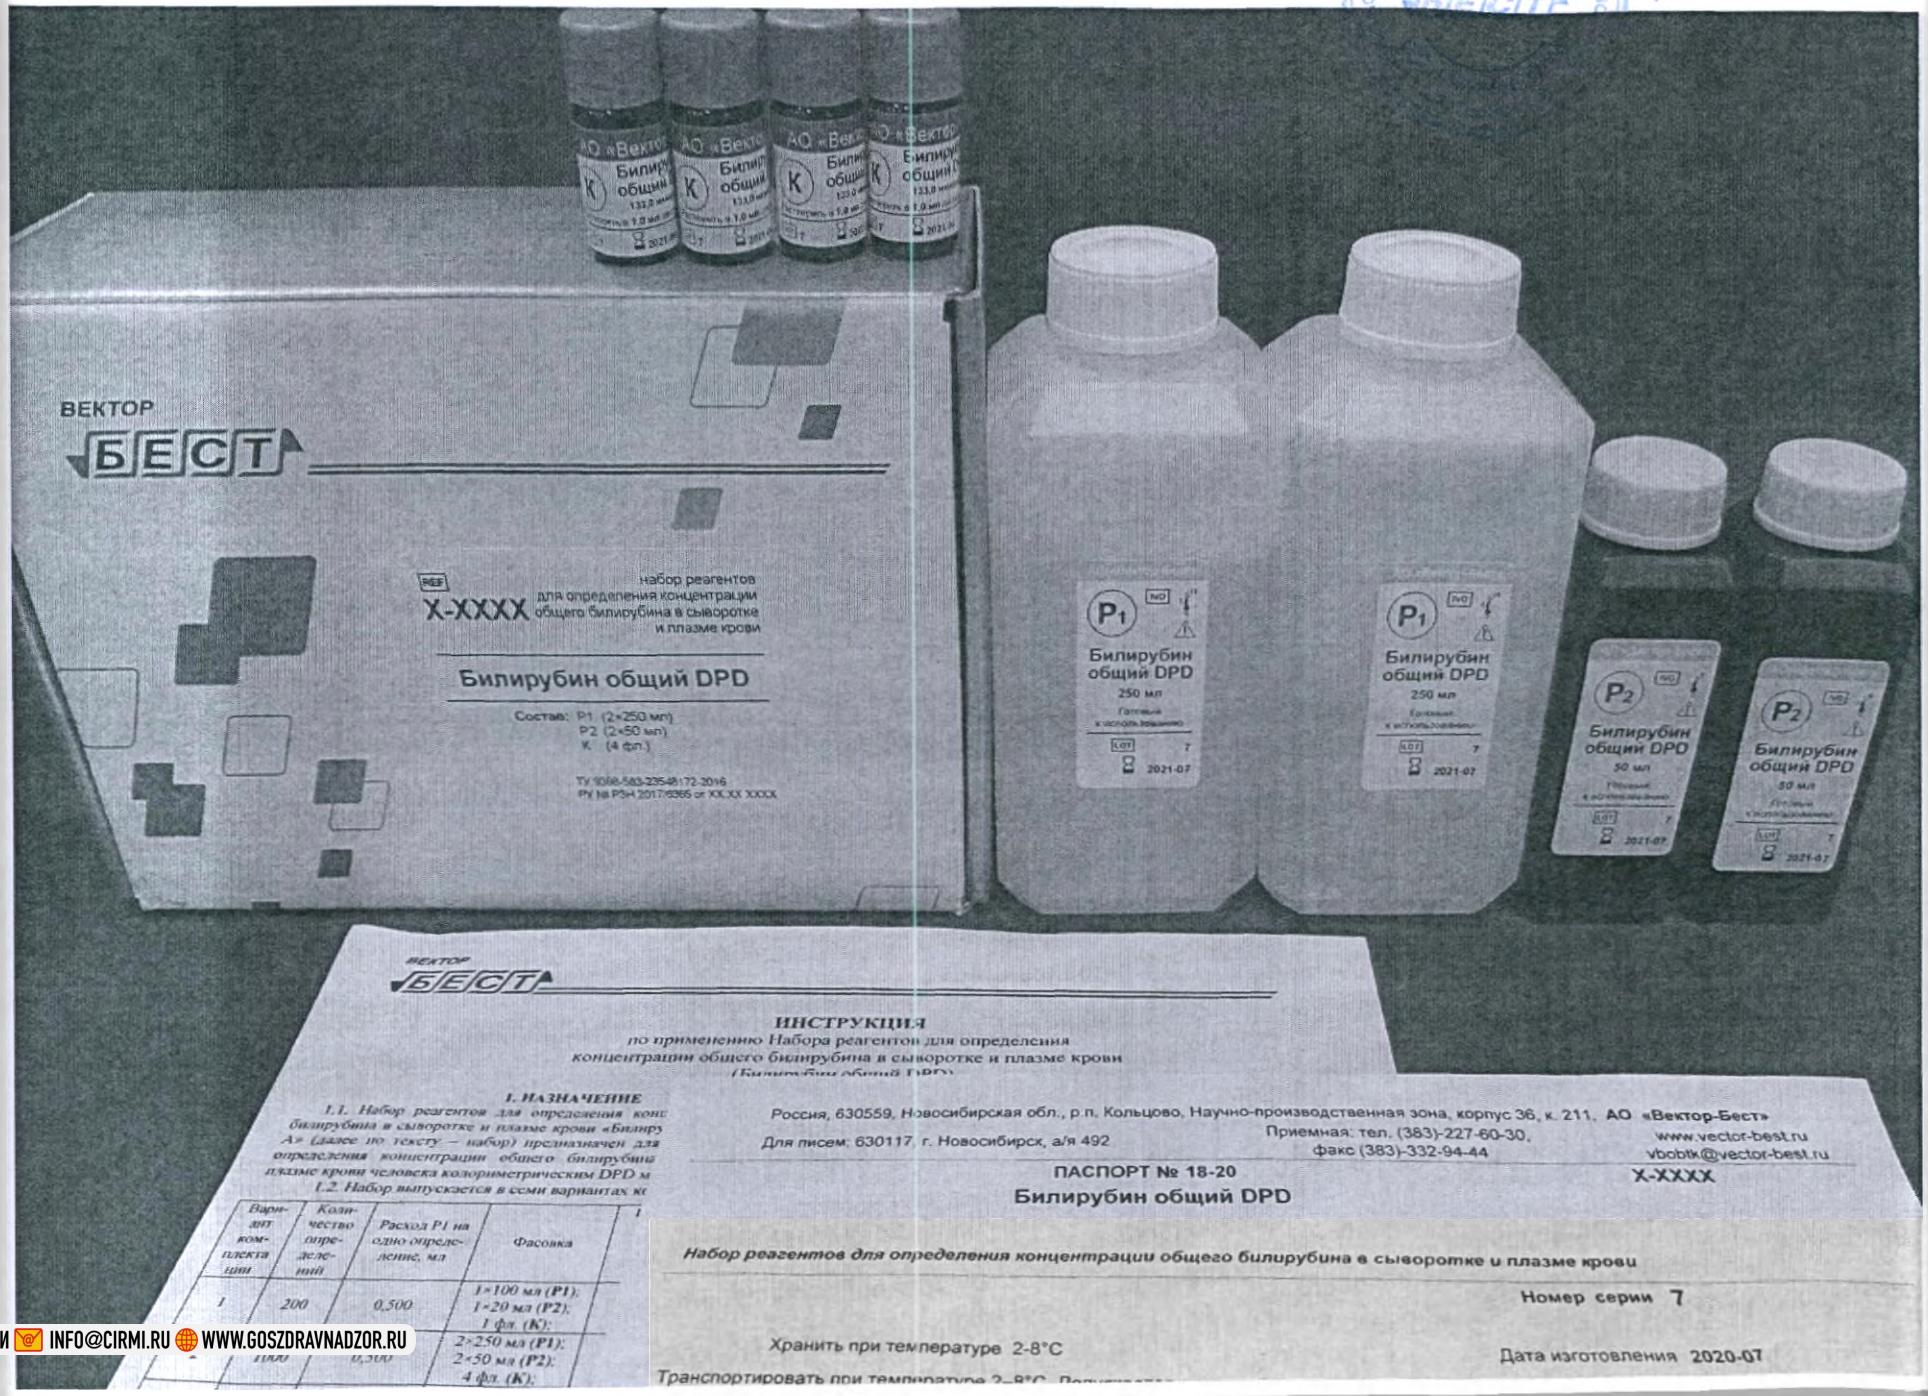

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 3, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” “12” 11 М.Д. Хусаинов
2020 г.

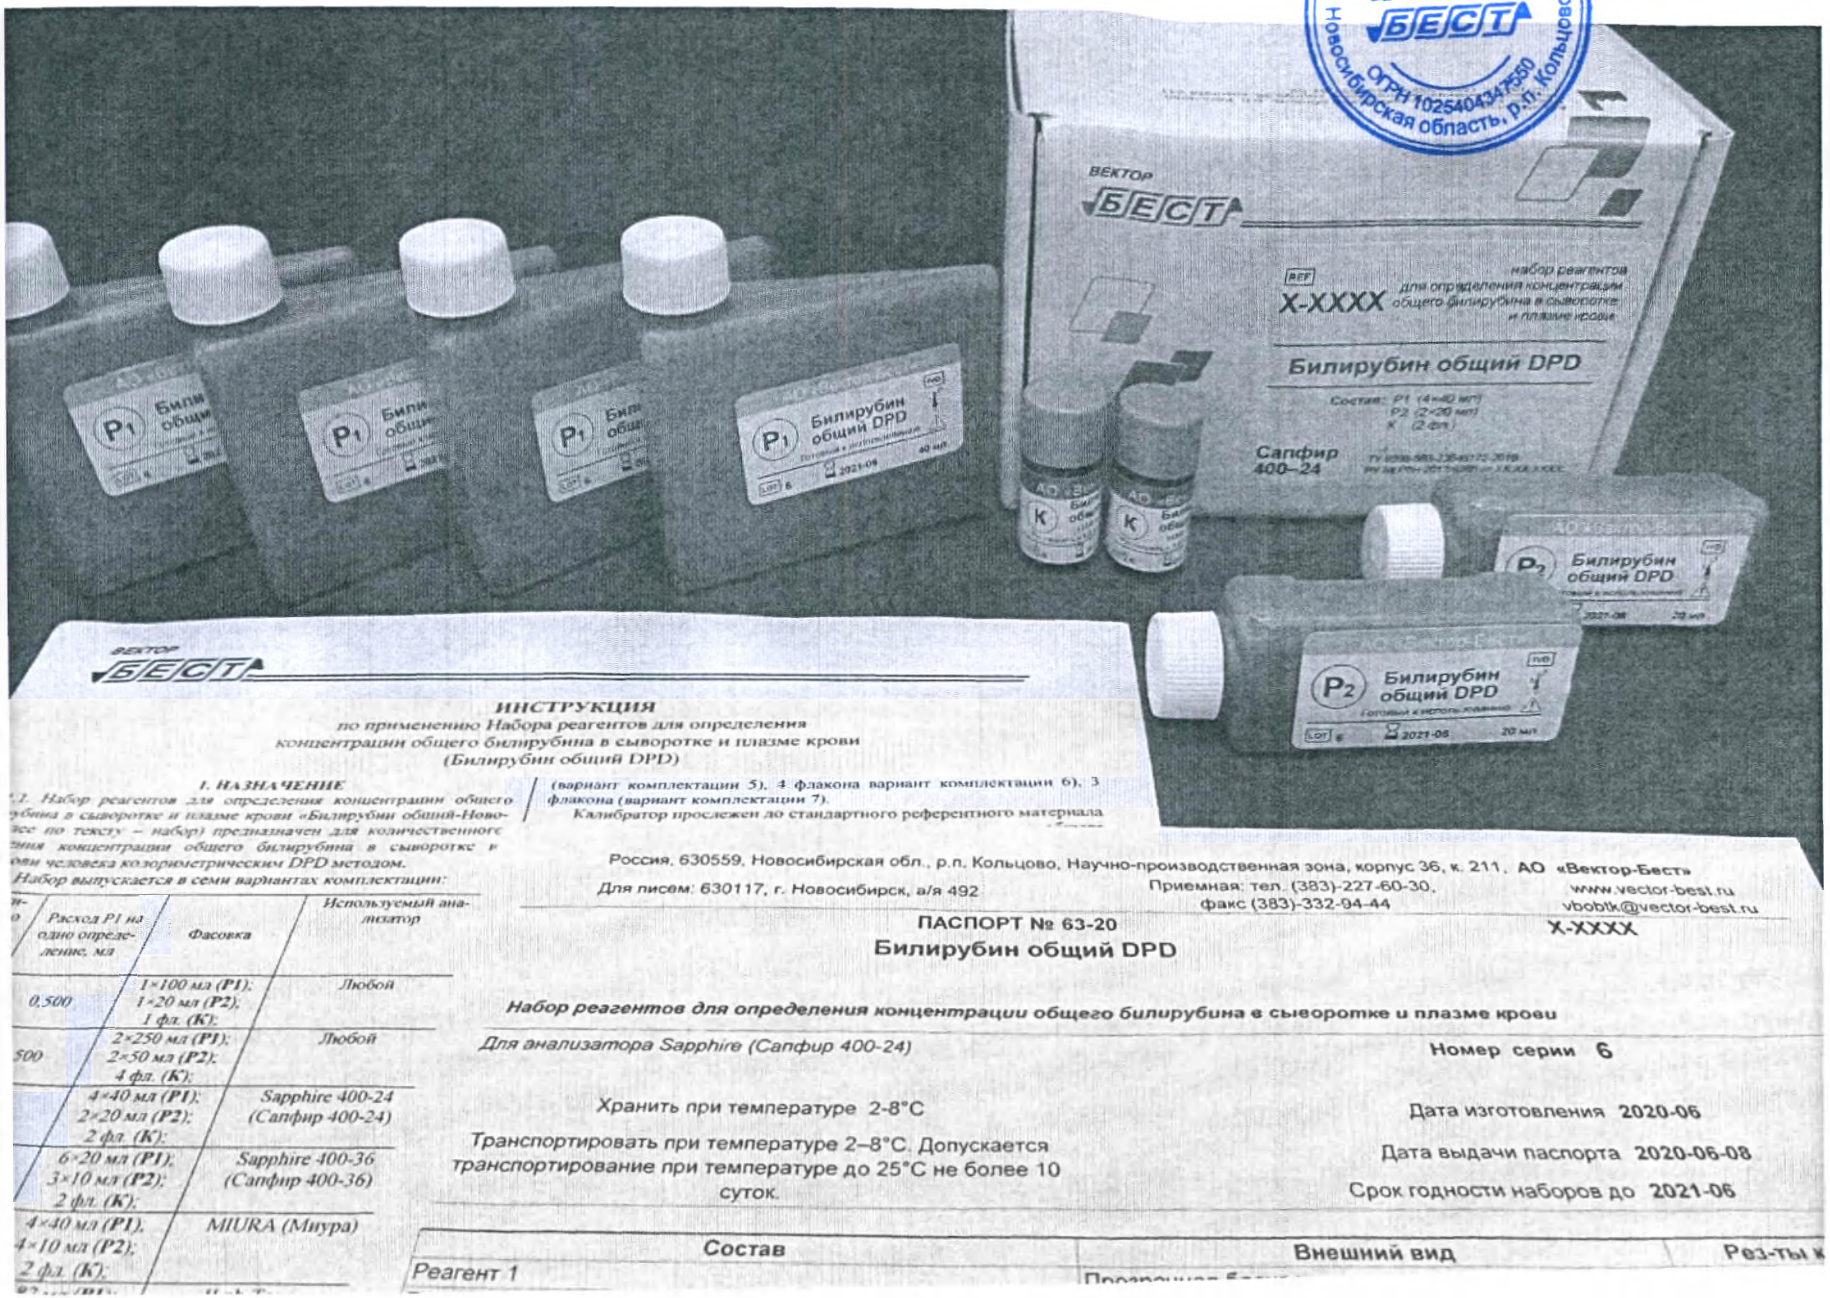

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 2, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 12 ” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 2, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

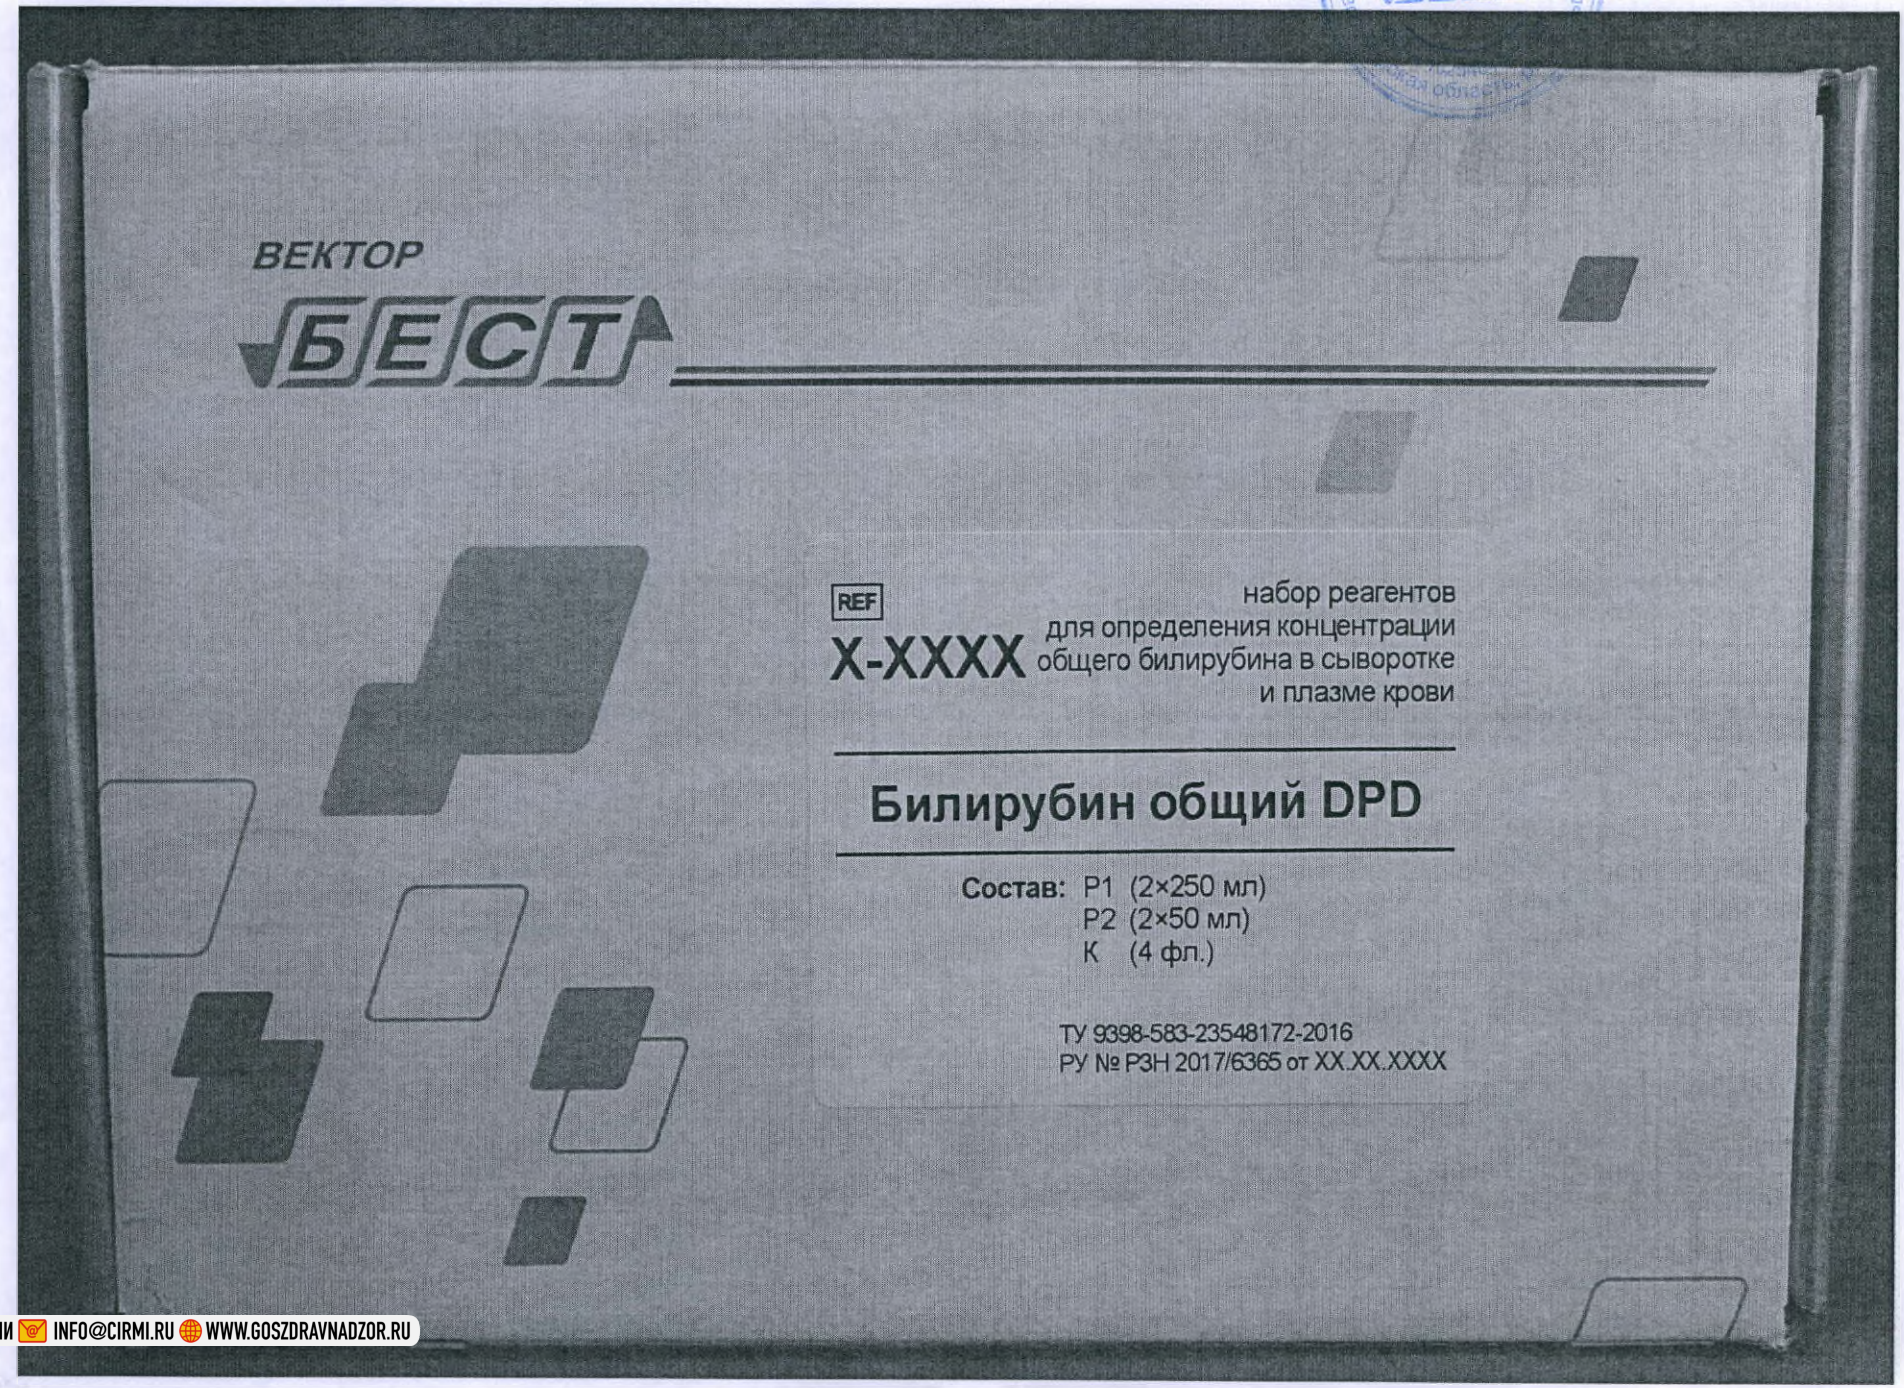

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 3, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“__” _____ 2020 г.

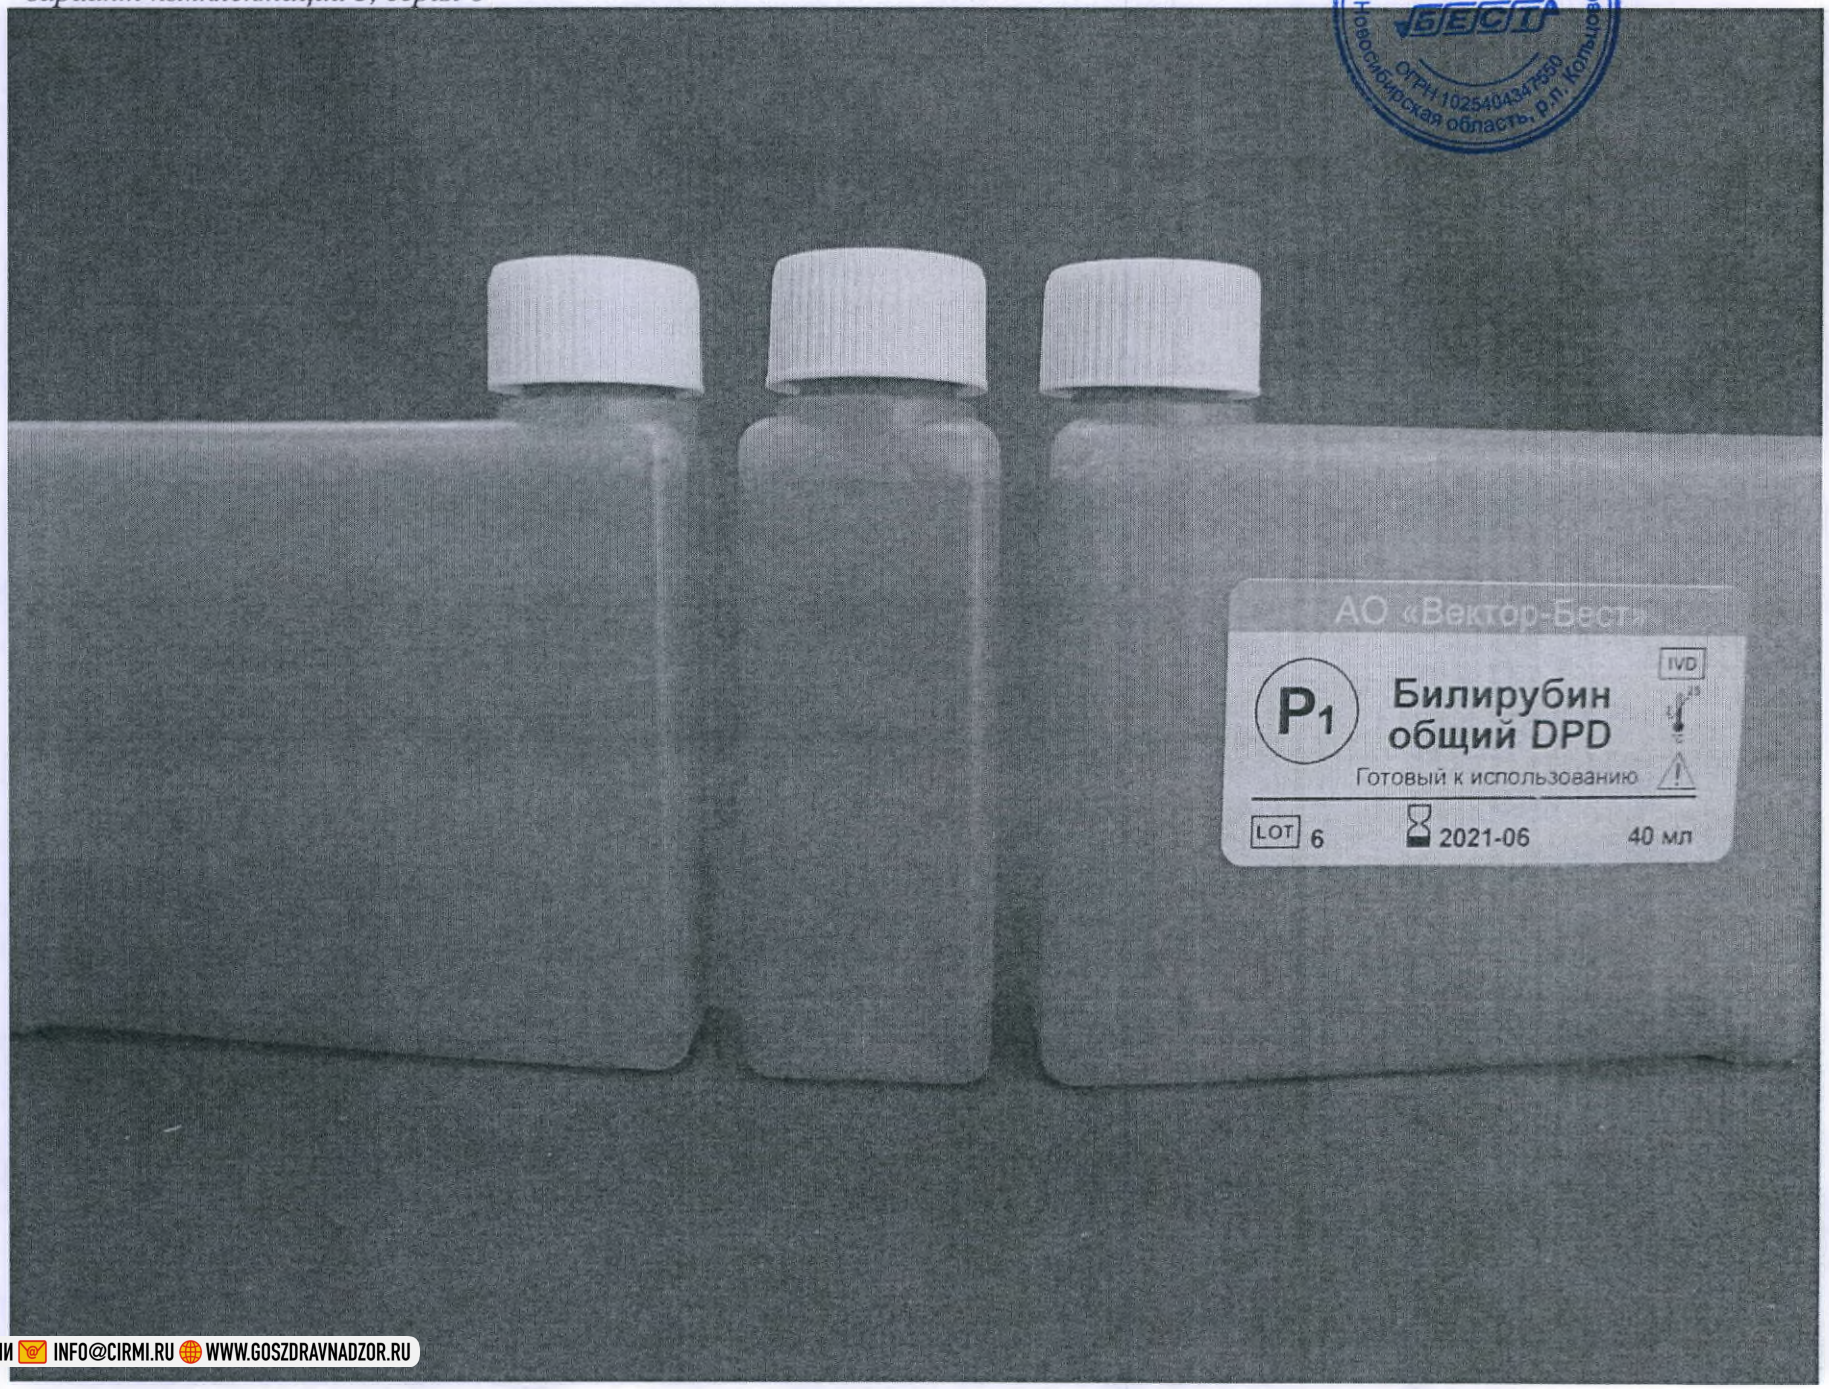

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 3, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 2 ” 11 2020 г.

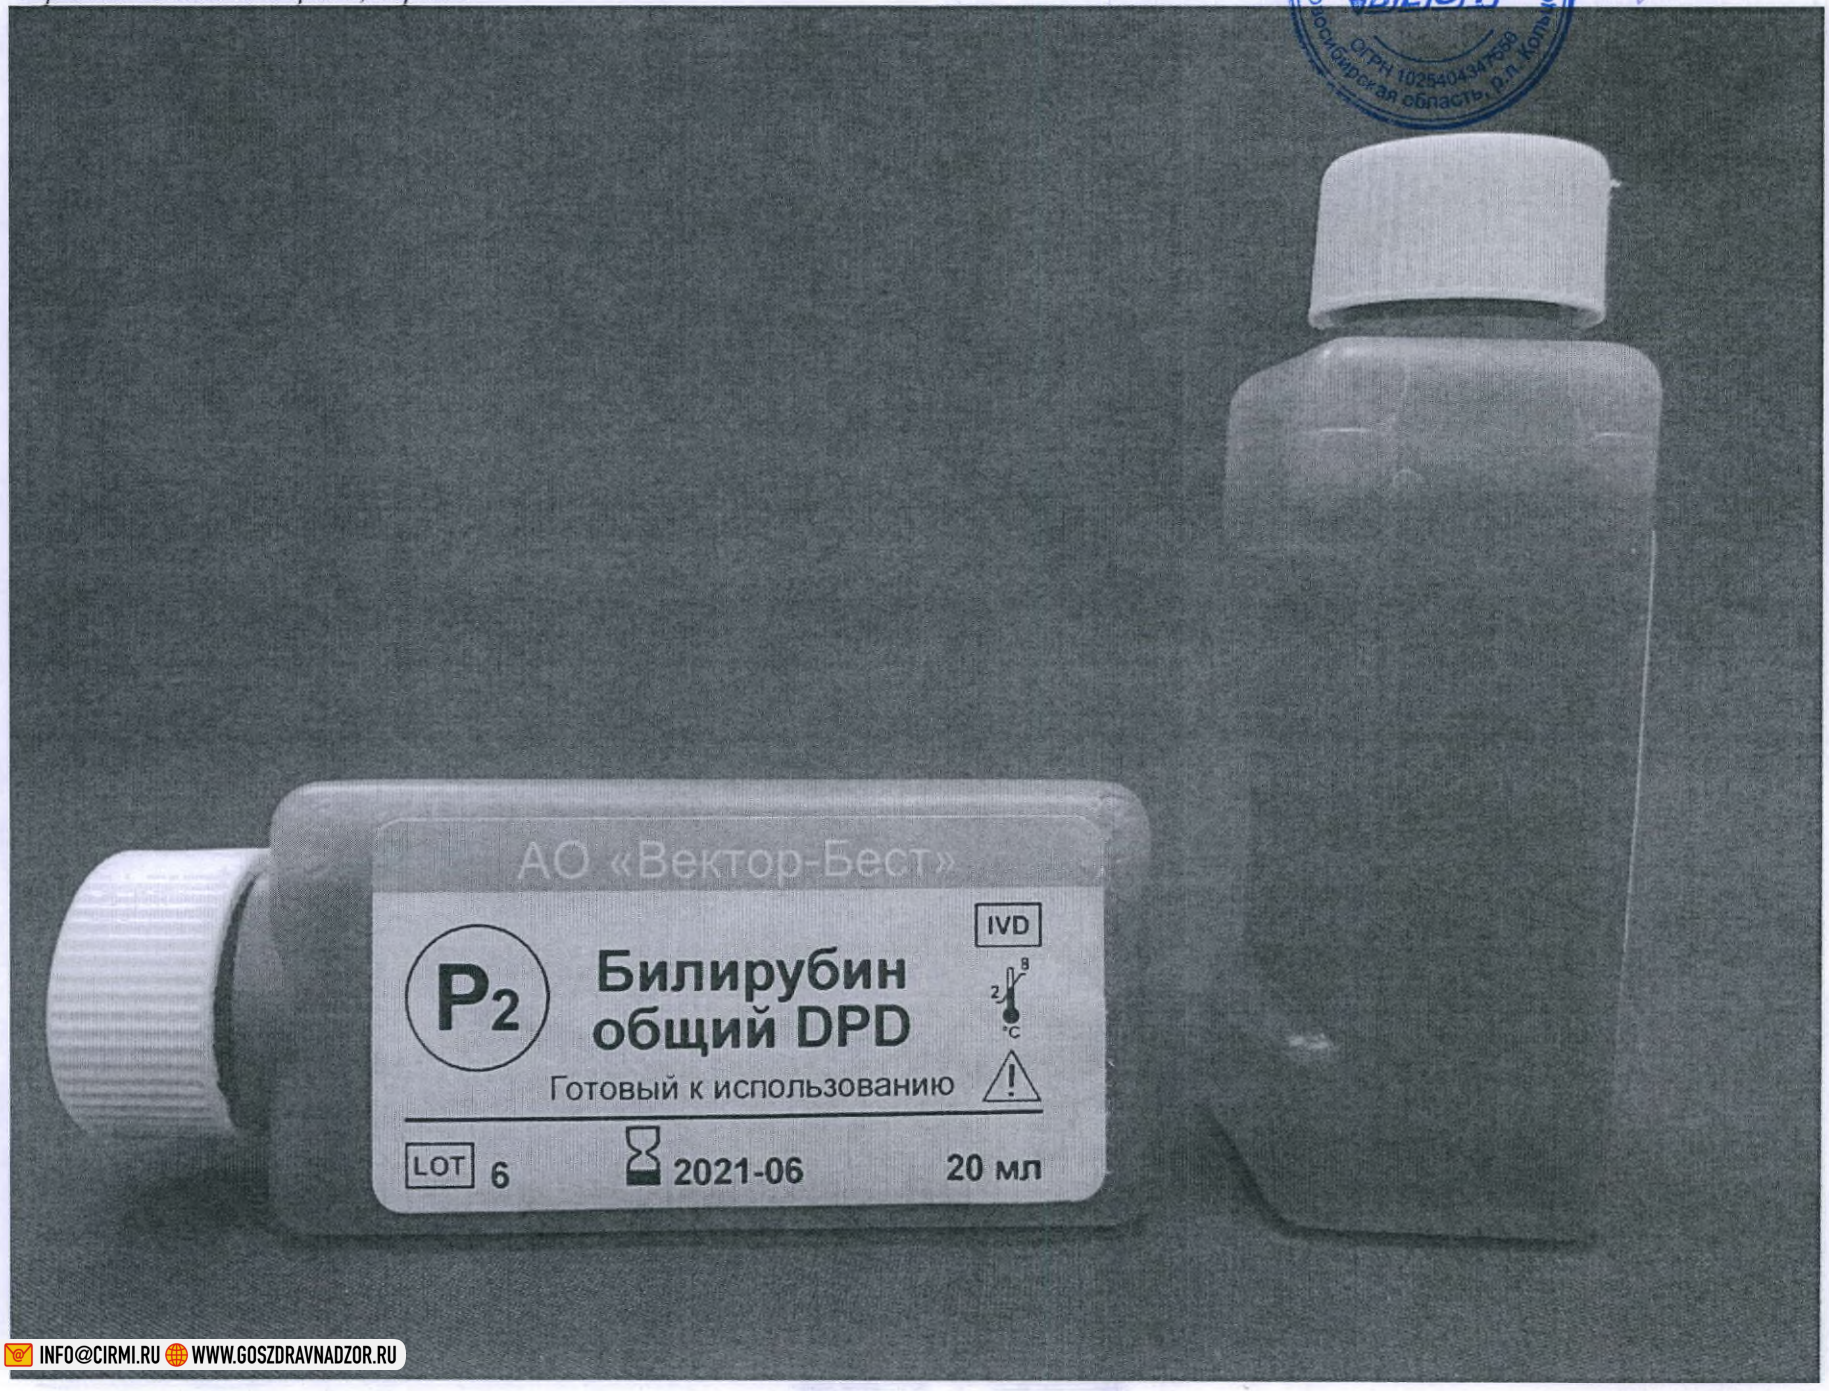

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 3, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” “12” 11 2020 г.


М.Д. Хусаинов



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №4
вариант комплектации 3, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” “12” 11 2020 г.
М.Д. Хусаинов

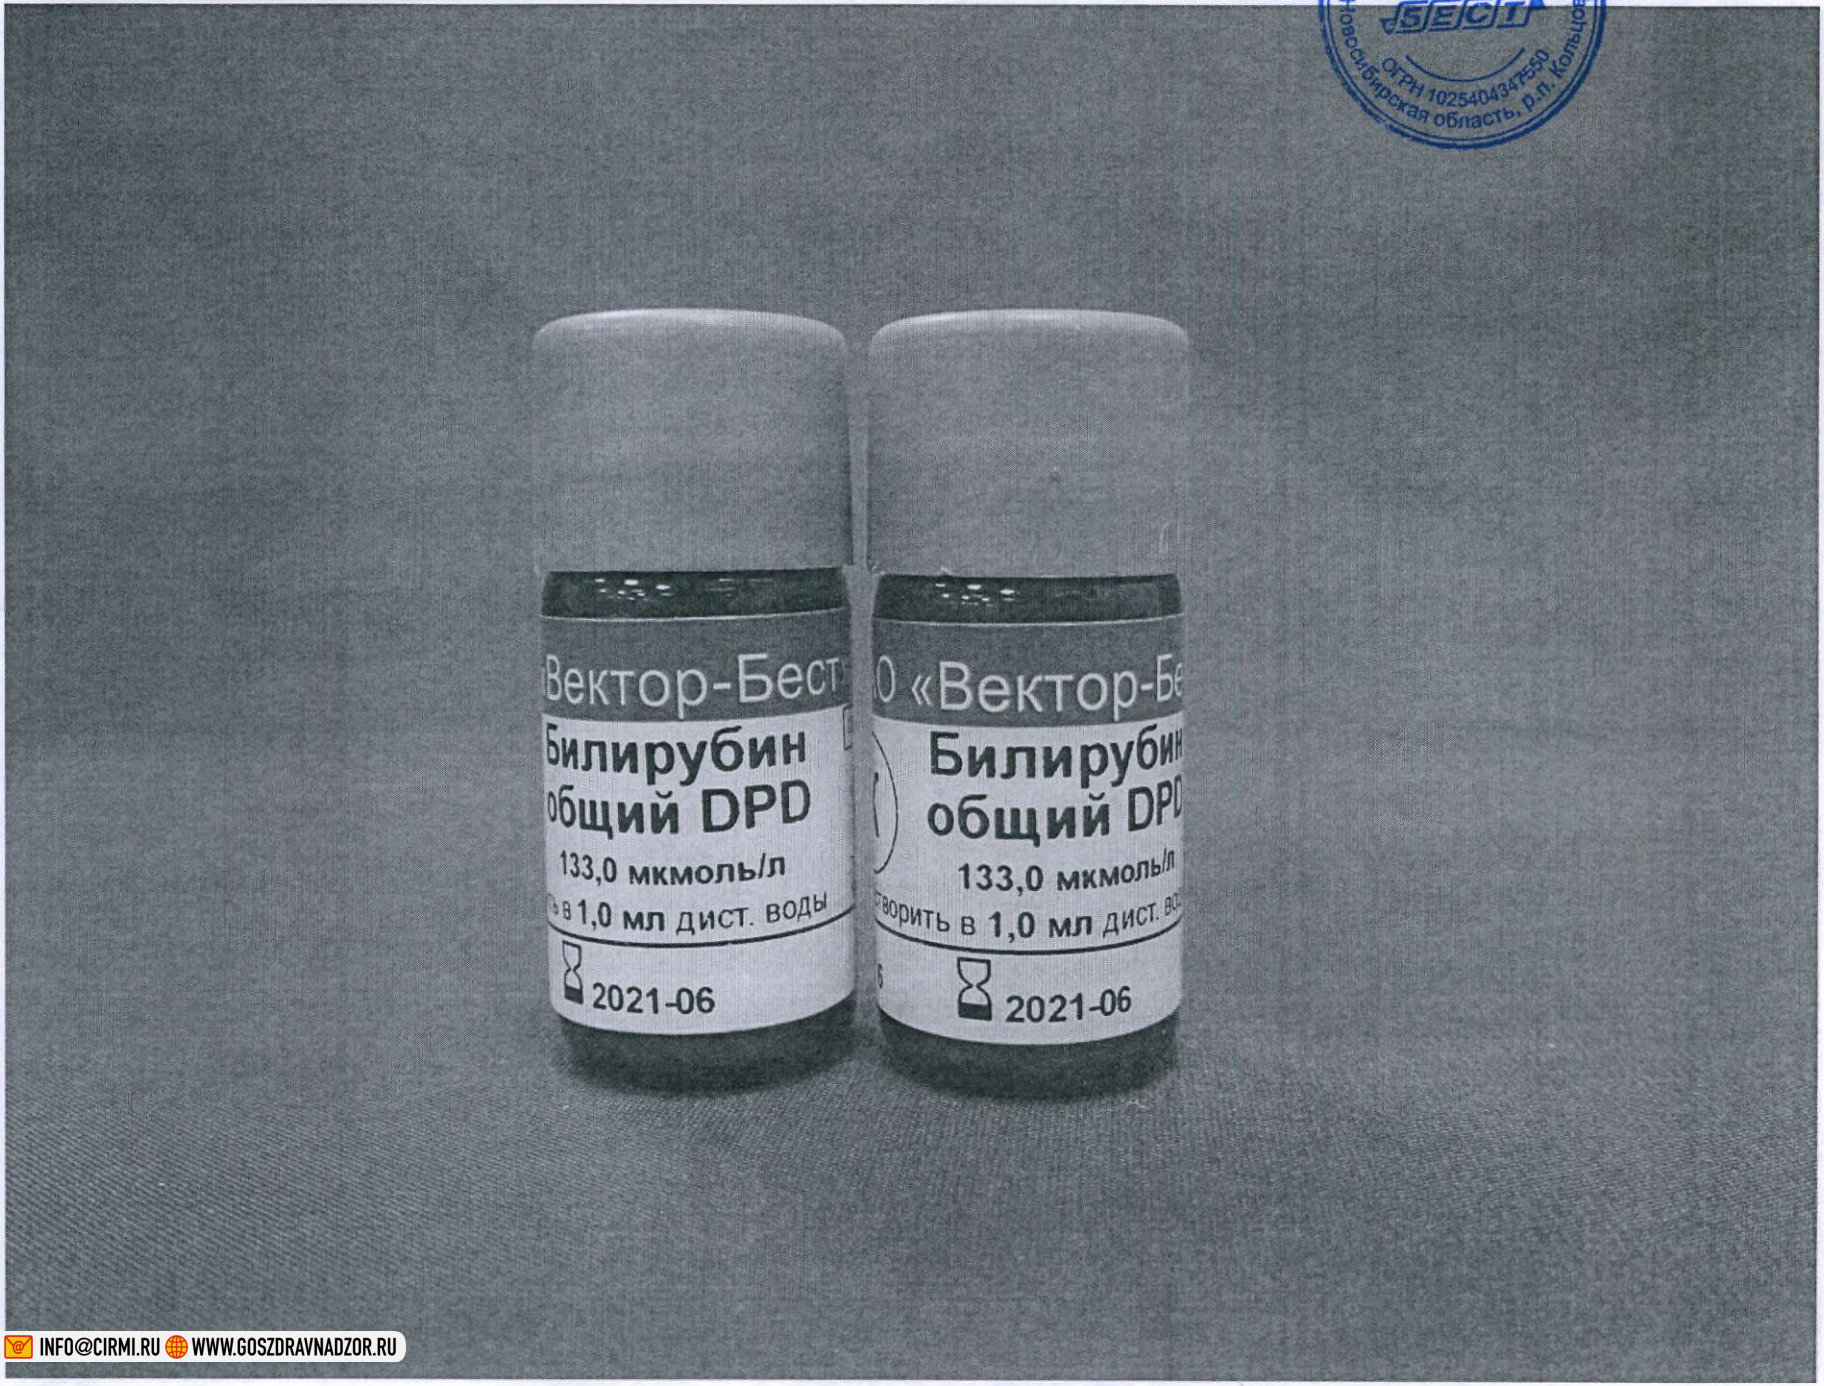

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №5
вариант комплектации 3, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” «12» 11 2020 г.
М.Д. Хусаинов

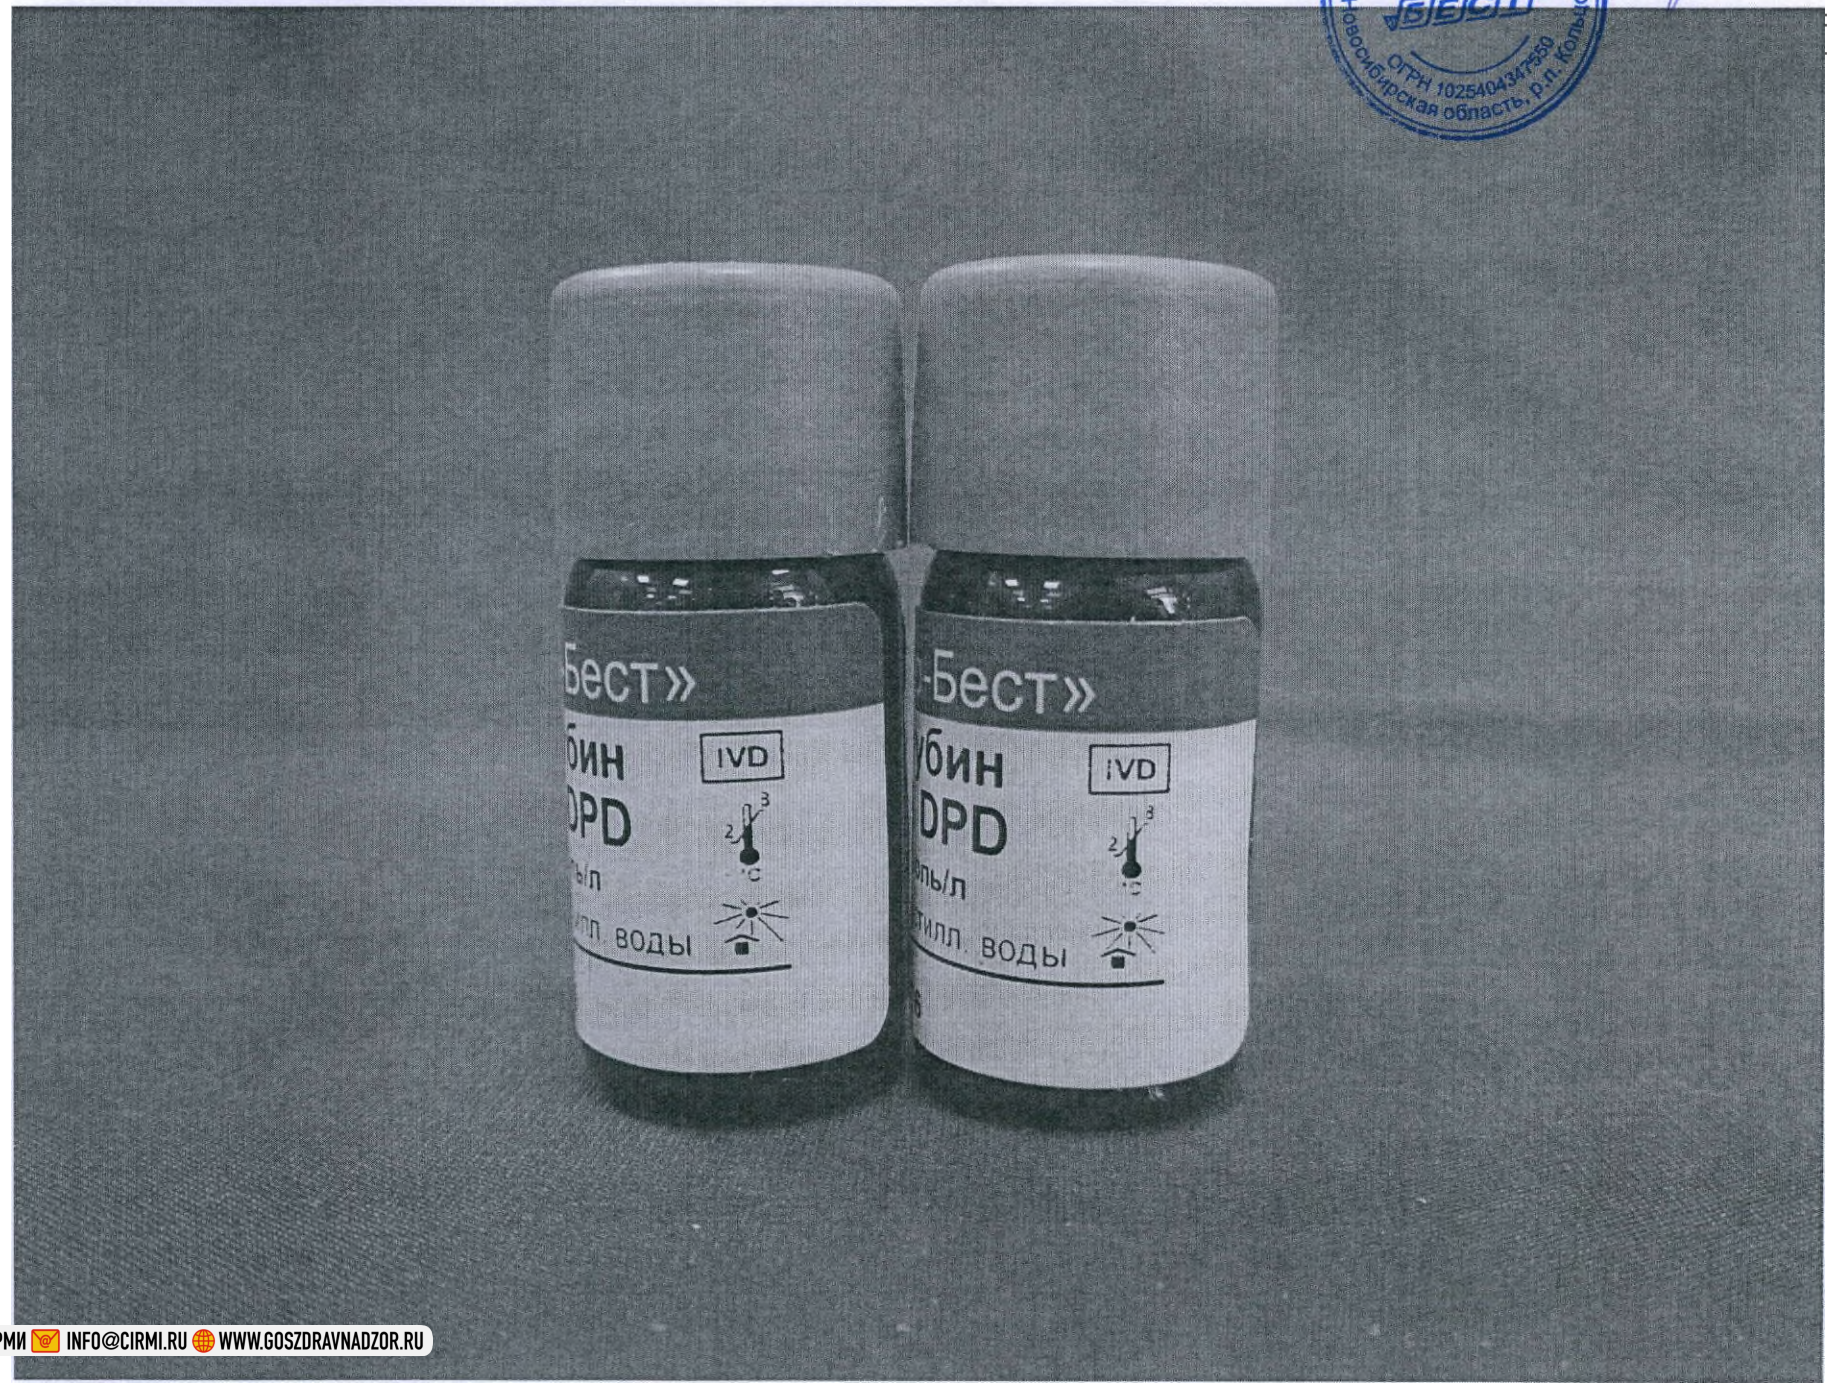

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 3, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

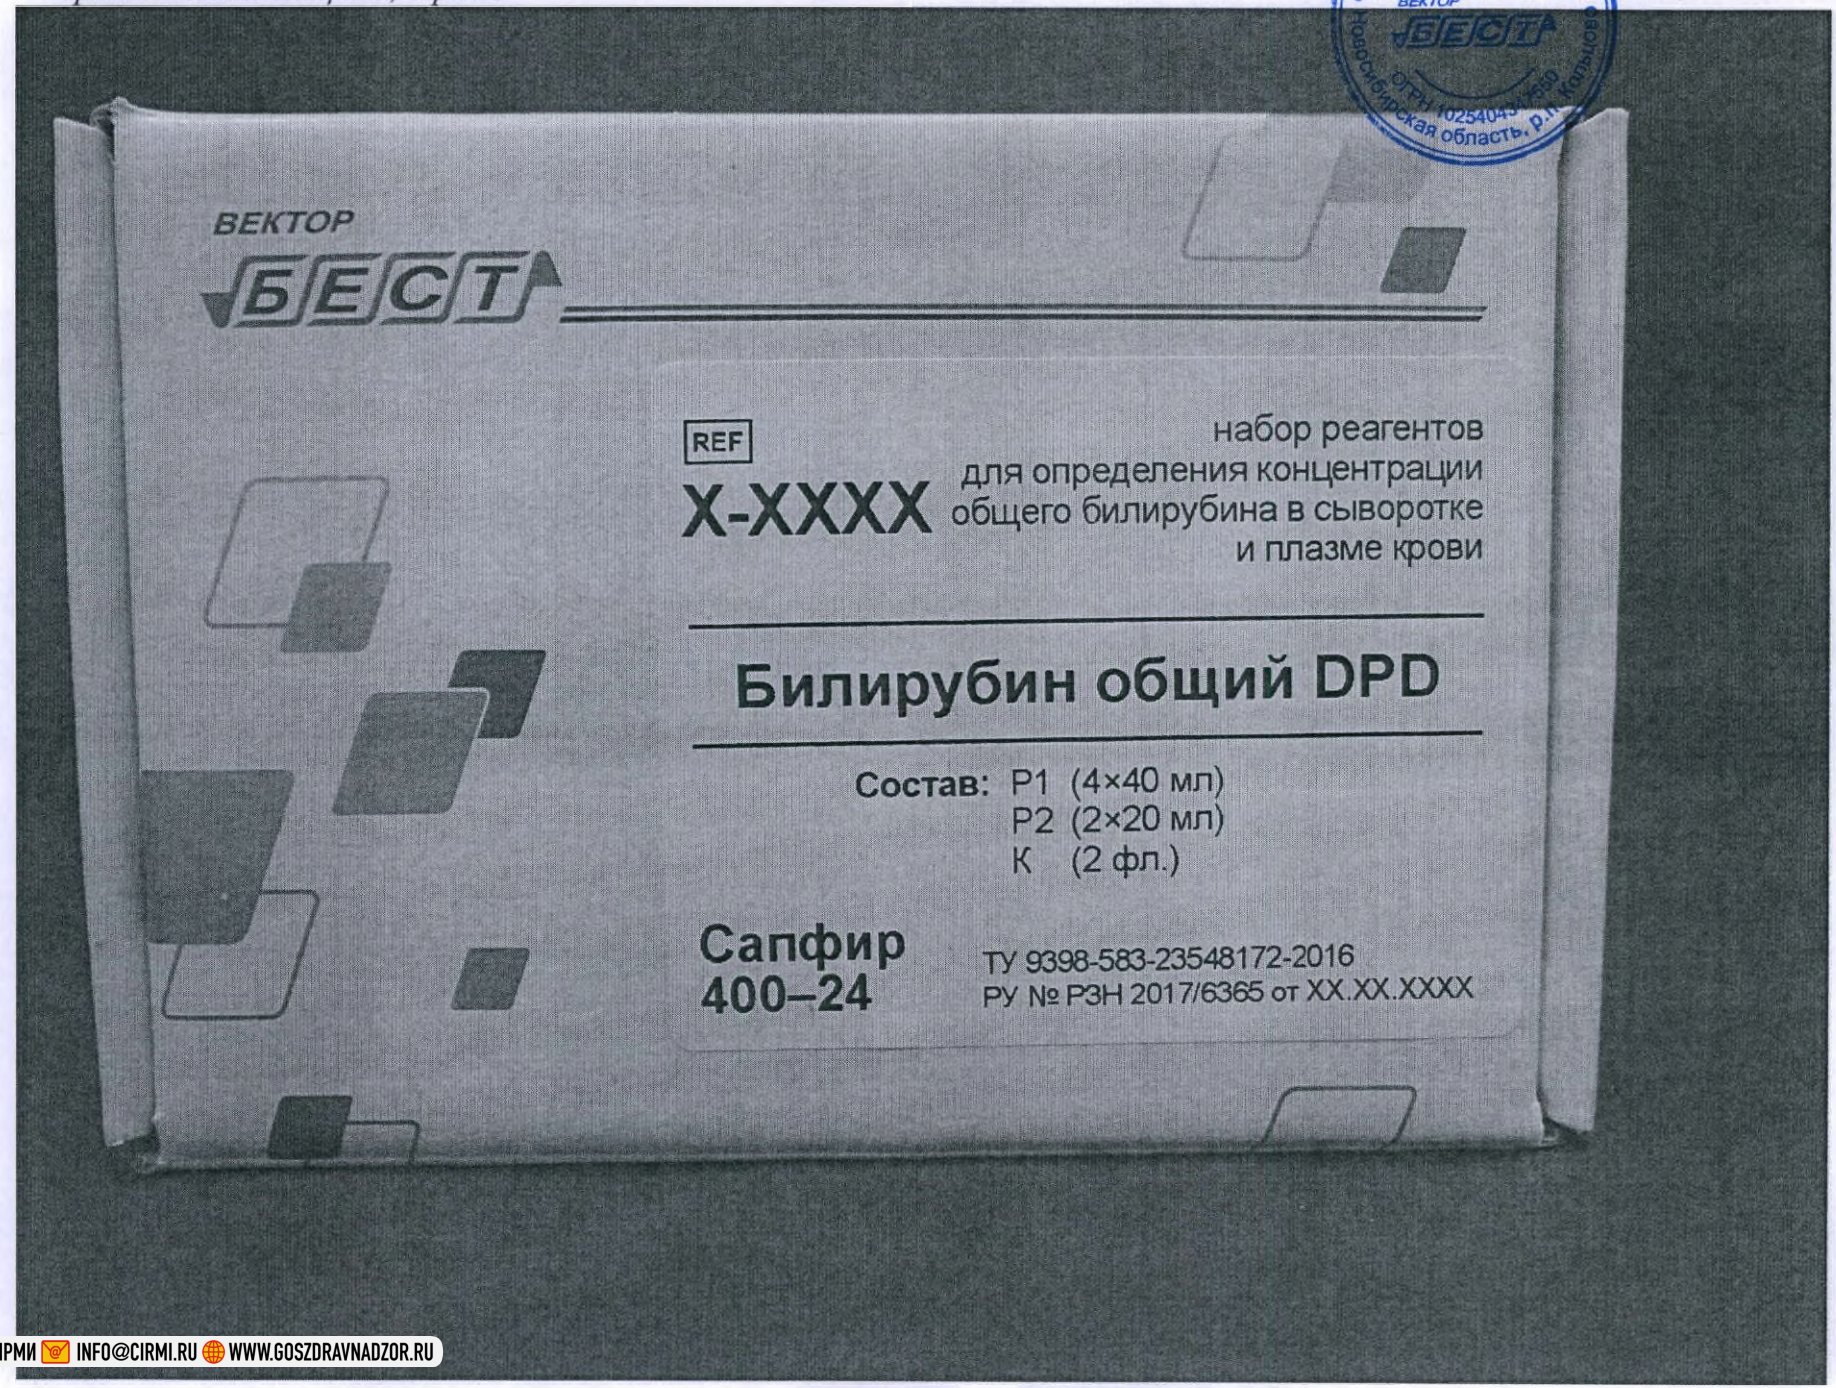

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 3, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 11 ” 11 2020 г.

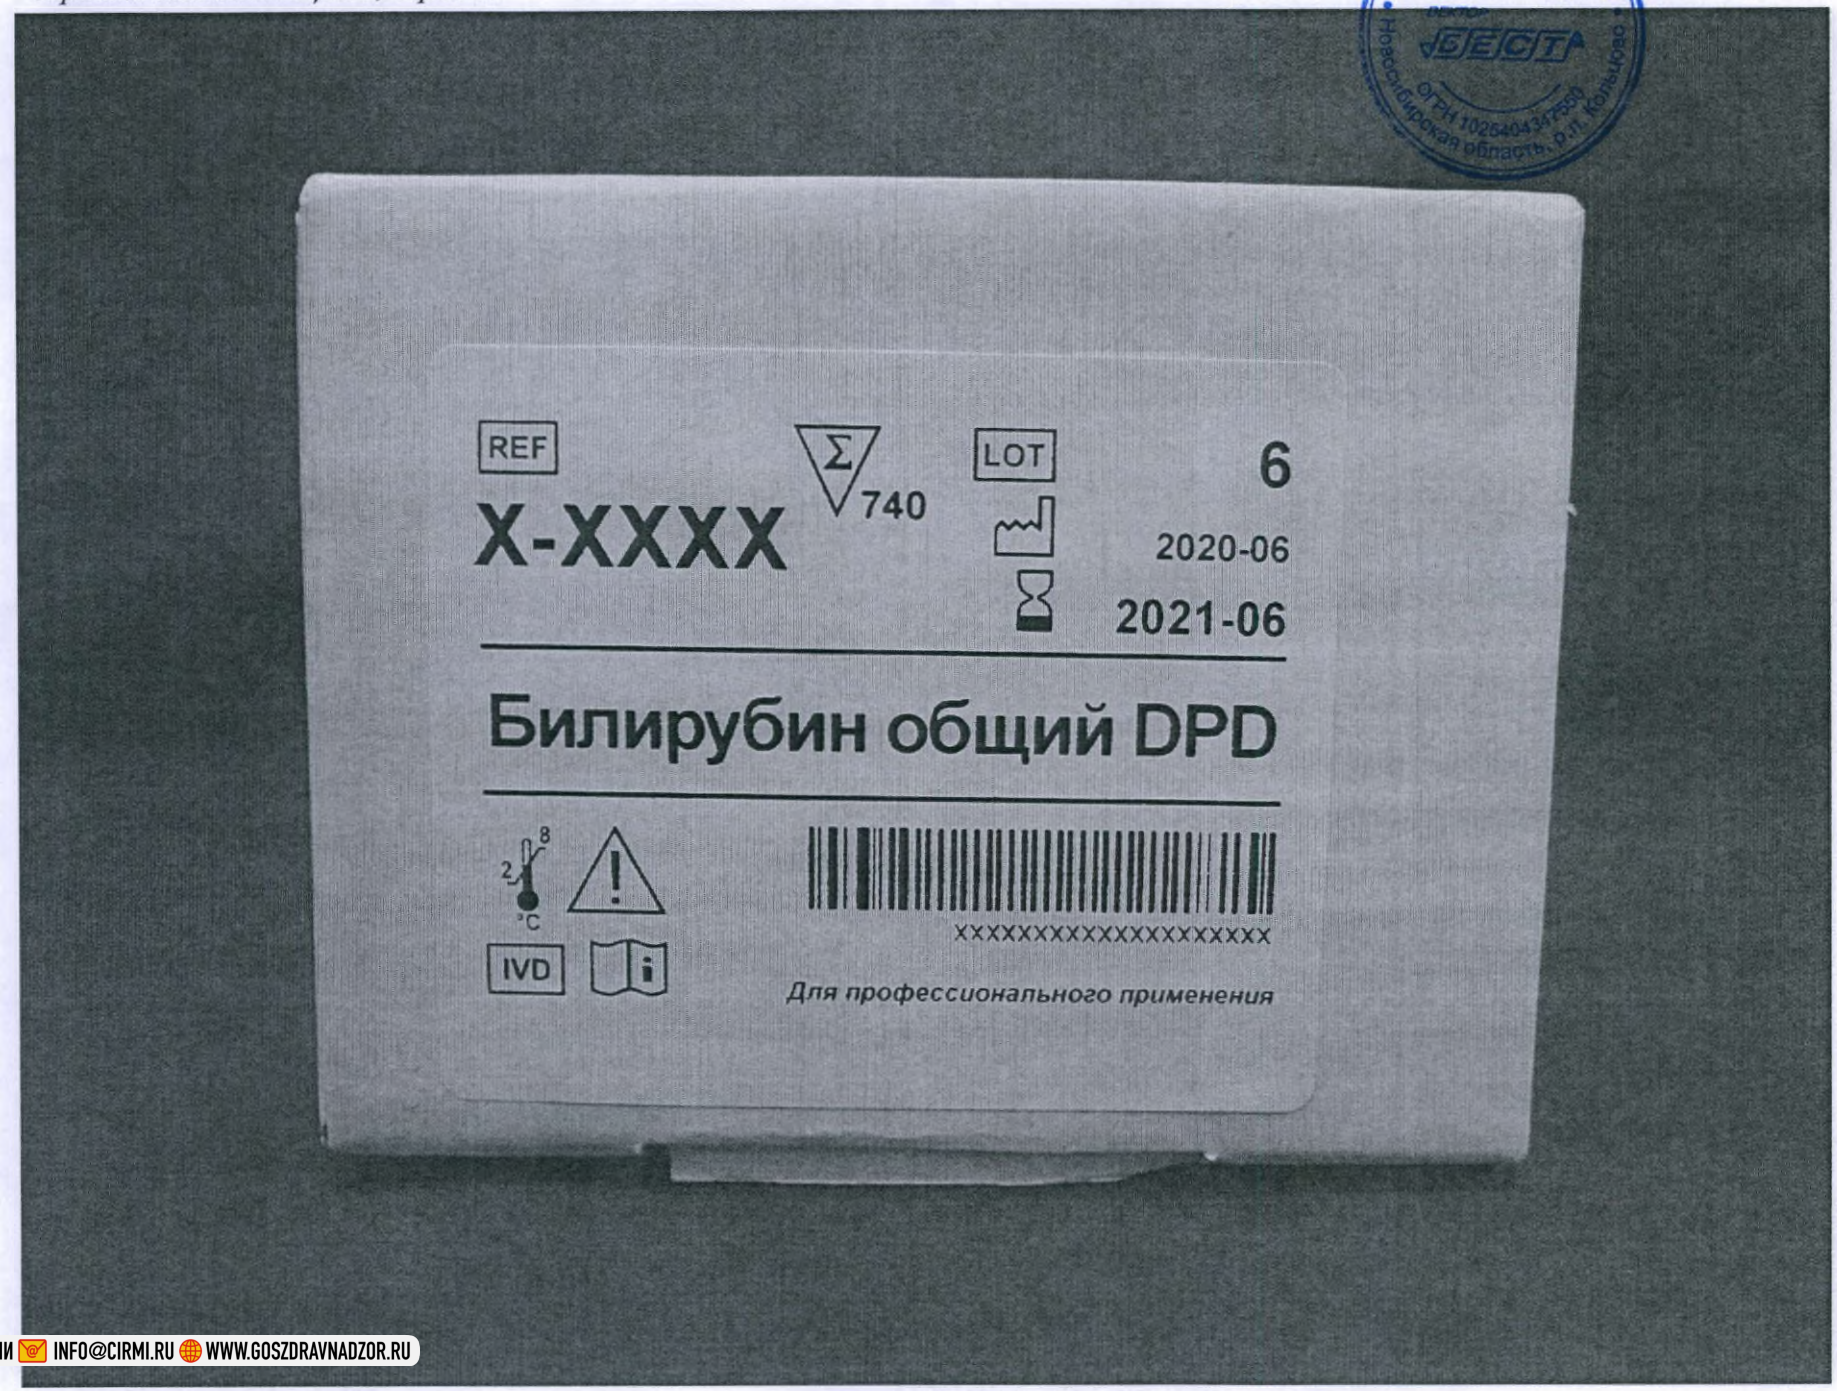

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 4, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 11 ” 11 2020 г.

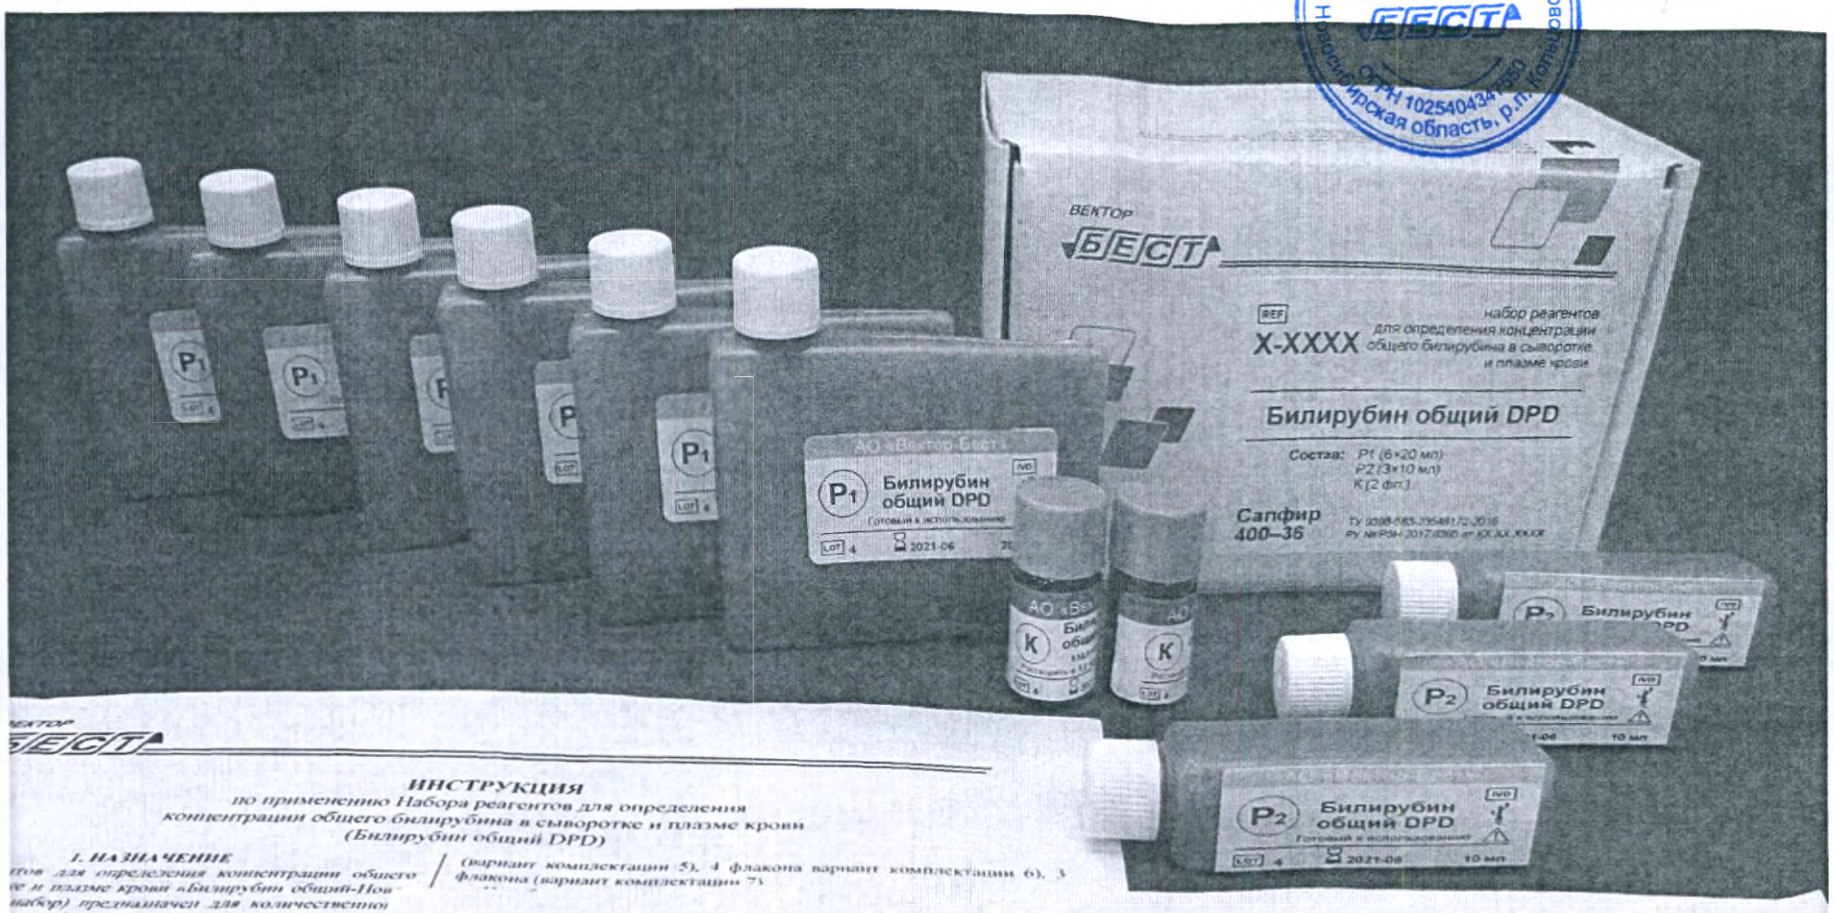

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Набора реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови (Билирубин общий DPD)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

...тов для определения концентрации общего ...е и плазме крови «Билирубин общий-Нов... ...набор) предназначен для количественно... ...ия общего билирубина в сыворотке ...тометрическим DPD методом.
...я в семи вариантах комплектации:

(вариант комплектации 5), 4 флакона вариант комплектации 6), 3 флакона (вариант комплектации 7)

Фасовка	Используемый анализатор
...0 мл (P1); ...мл (P2); (K)	Любой
(P1); ...2);	Любой
	Sapphire 400-24 (Сапфир 400-24)
	Sapphire 400-36 (Сапфир 400-36)
	...II/RA (Micros)

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
www.vector-best.ru
vbobik@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 74-20
Билирубин общий DPD
X-XXXX

Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови

Для анализатора Sapphire (Сапфир 400-36)

Номер серии 4

Хранить при температуре 2-8°С

Транспортировать при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток.

Дата изготовления 2020-06

Дата выдачи паспорта 2020-06-08


Срок годности наборов до 2021-06

Состав	Внешний вид	Ре
Реагент 1		

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 4, серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
12 11 2020 г.

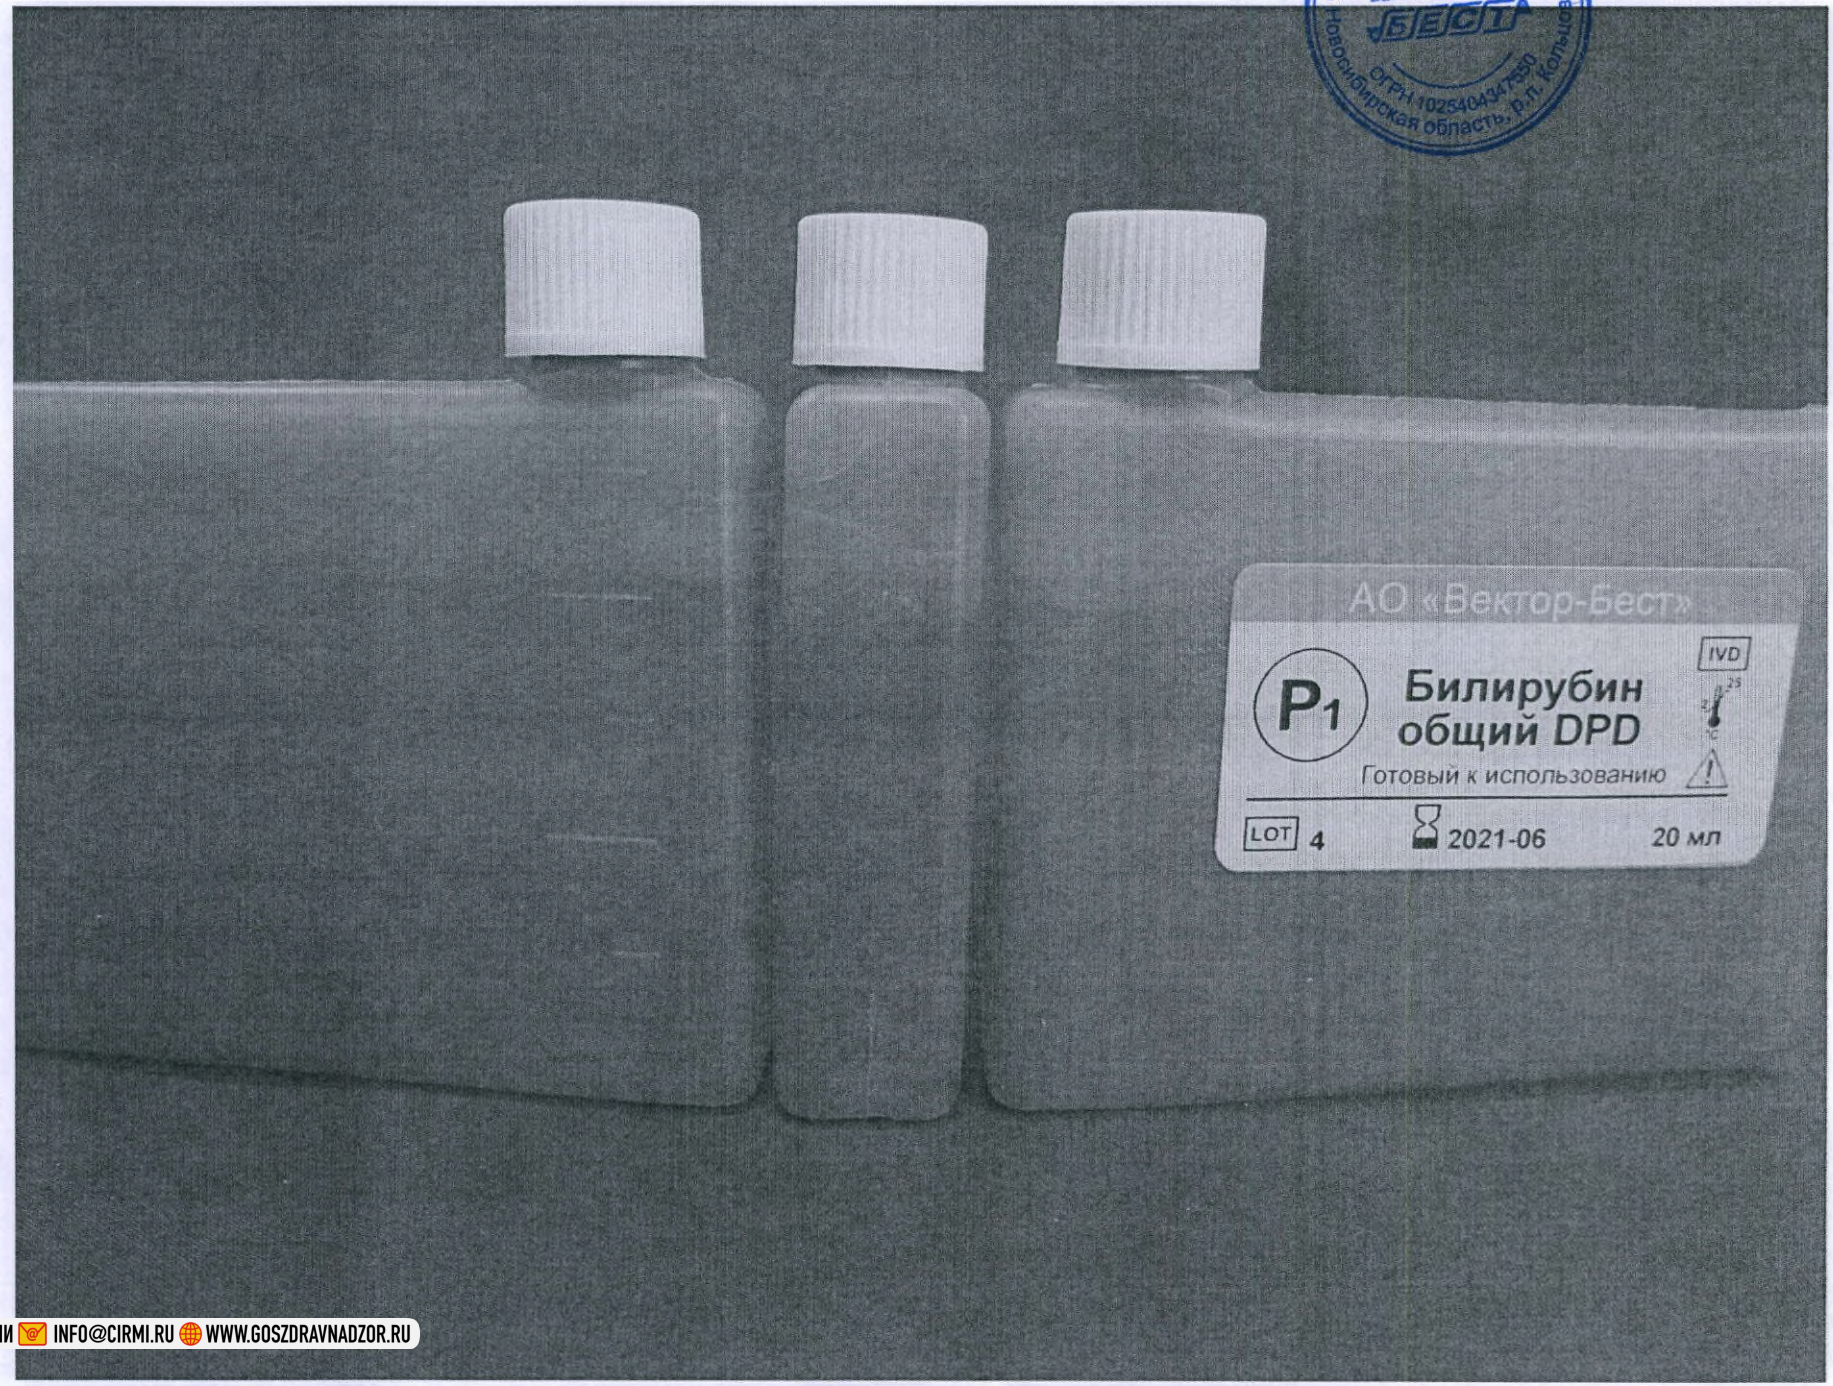

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 4, серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“ 12 ” _____ 2020 г.

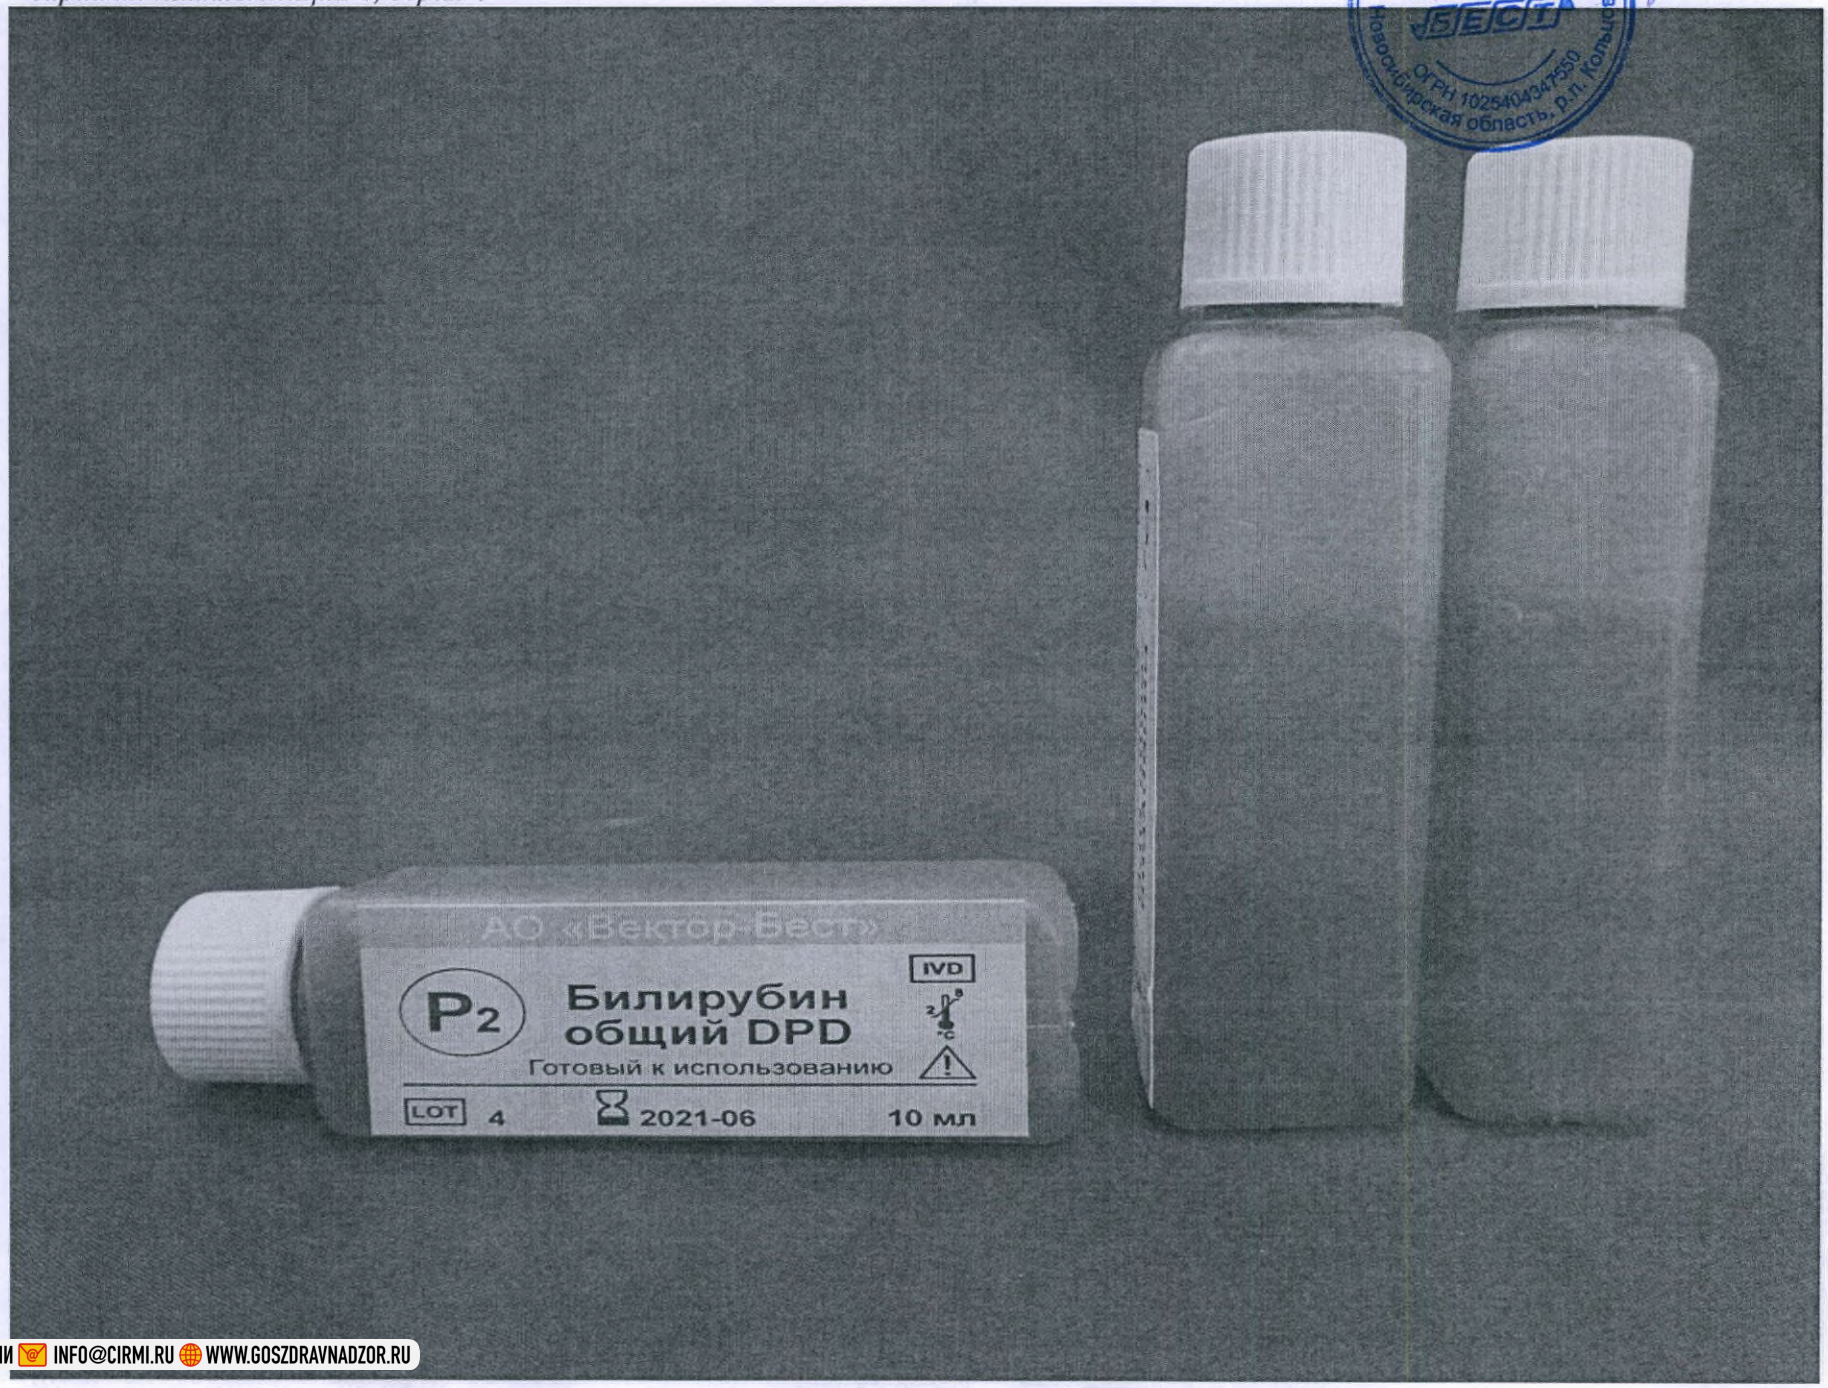

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 4, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Вест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

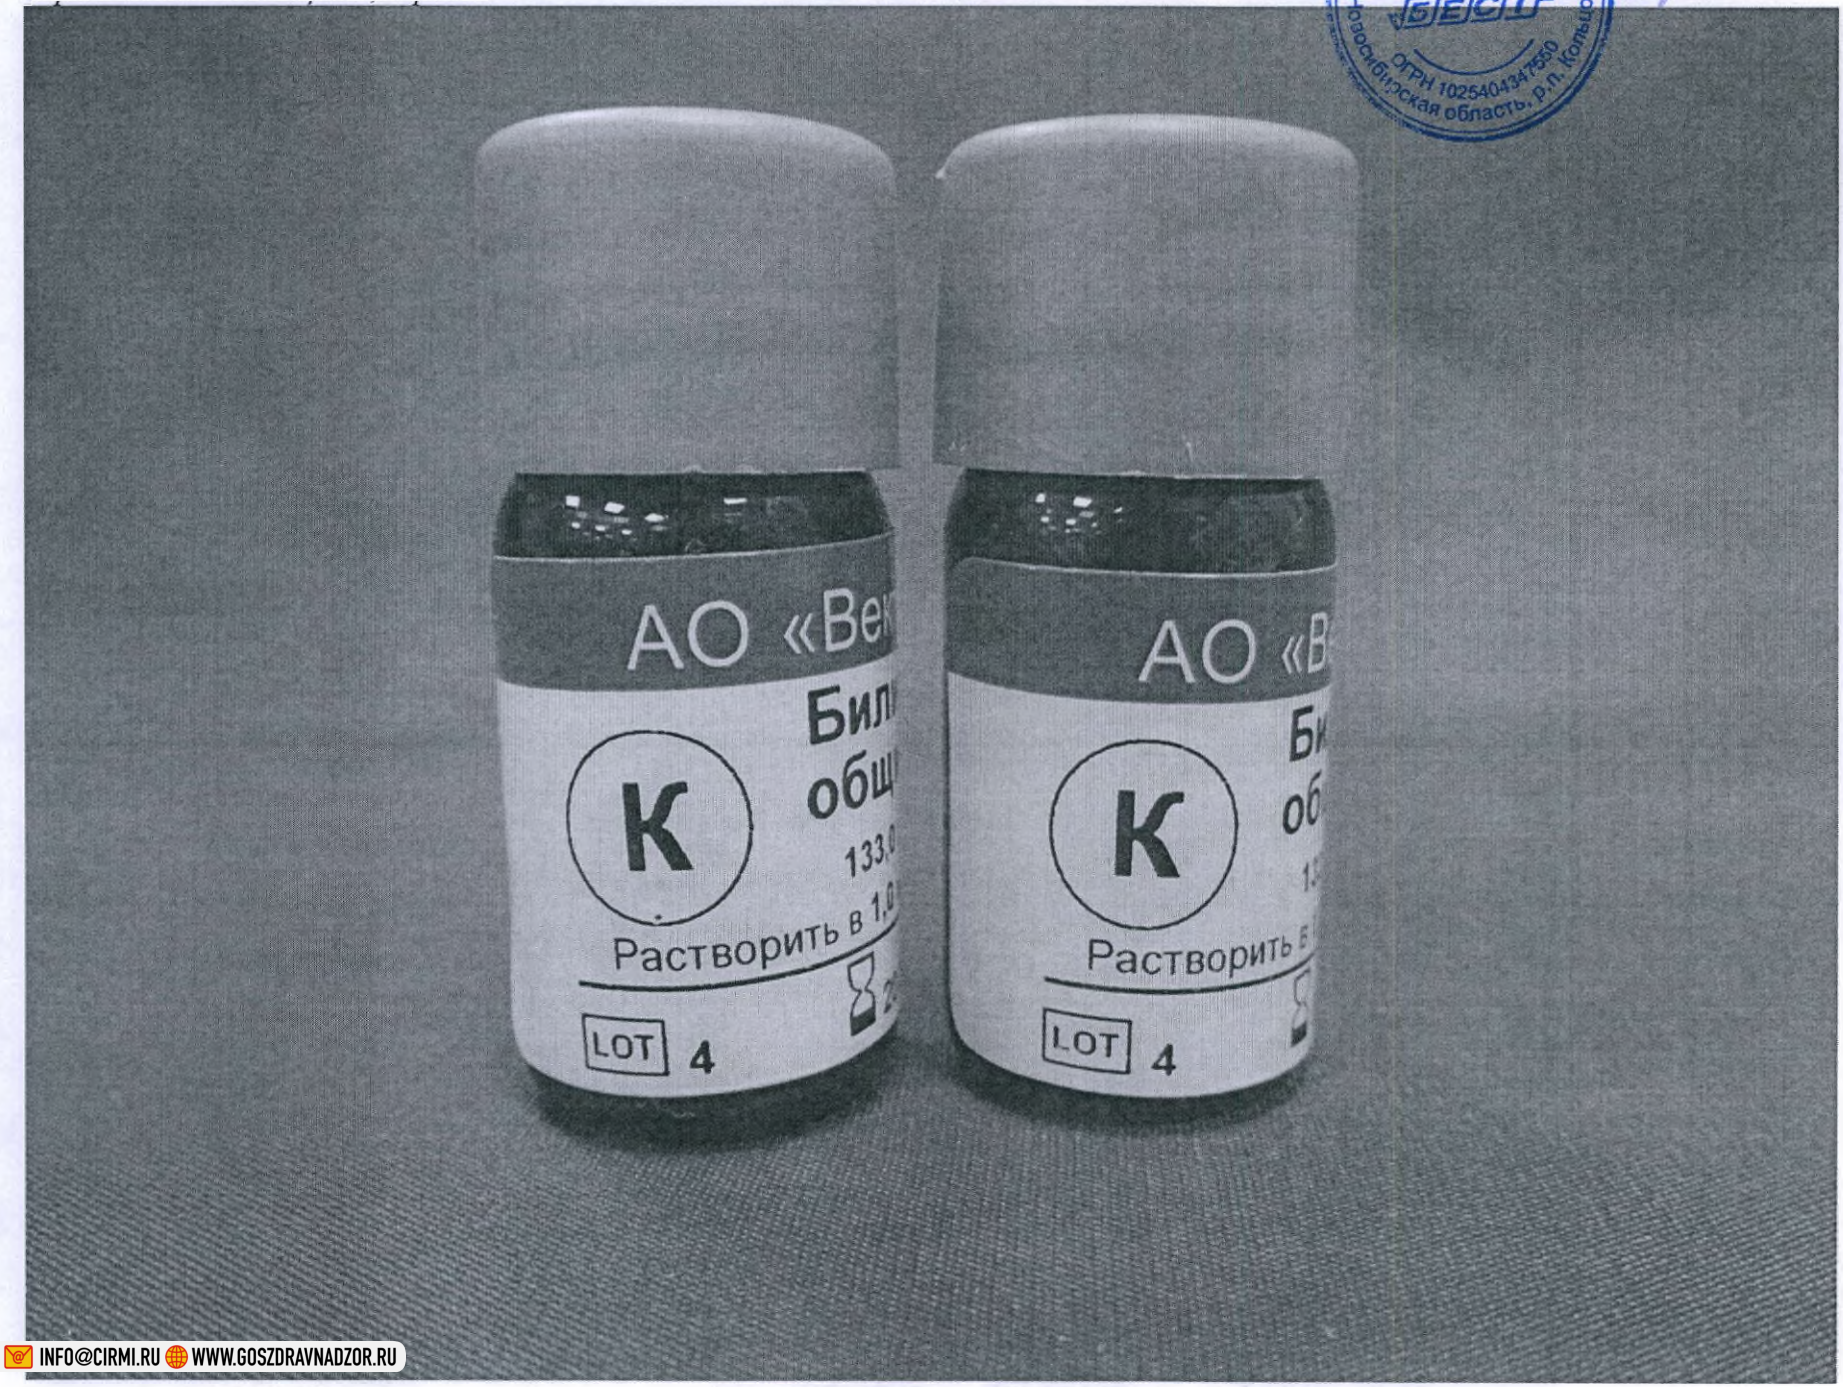

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №4
вариант комплектации 4, серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” _____ 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"12" 11 2020 г.


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Билирубин общий DPD" №5
вариант комплектации 4, серия 4

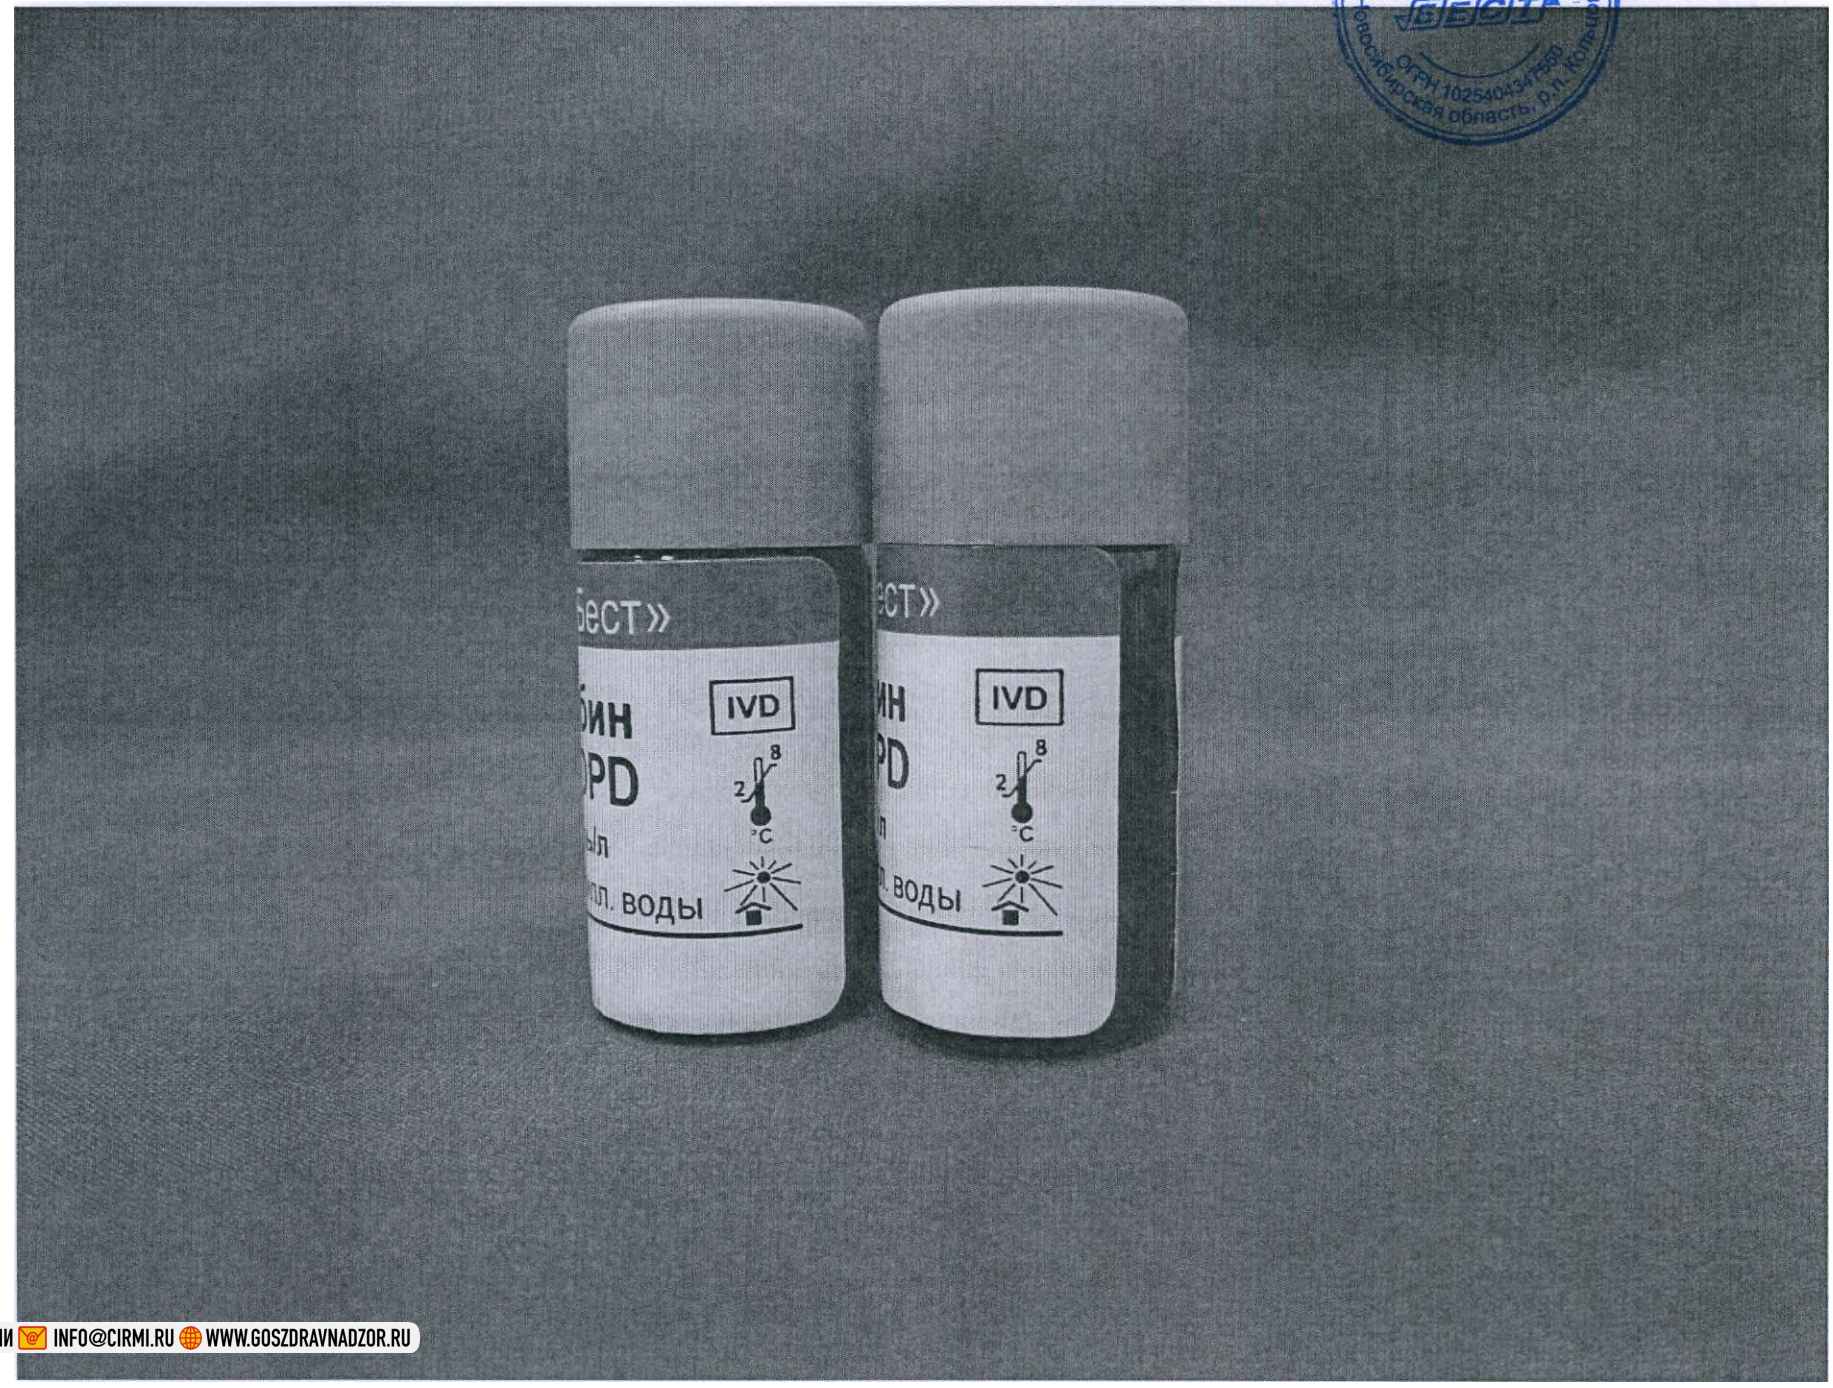

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 4, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” _____ 2020 г.

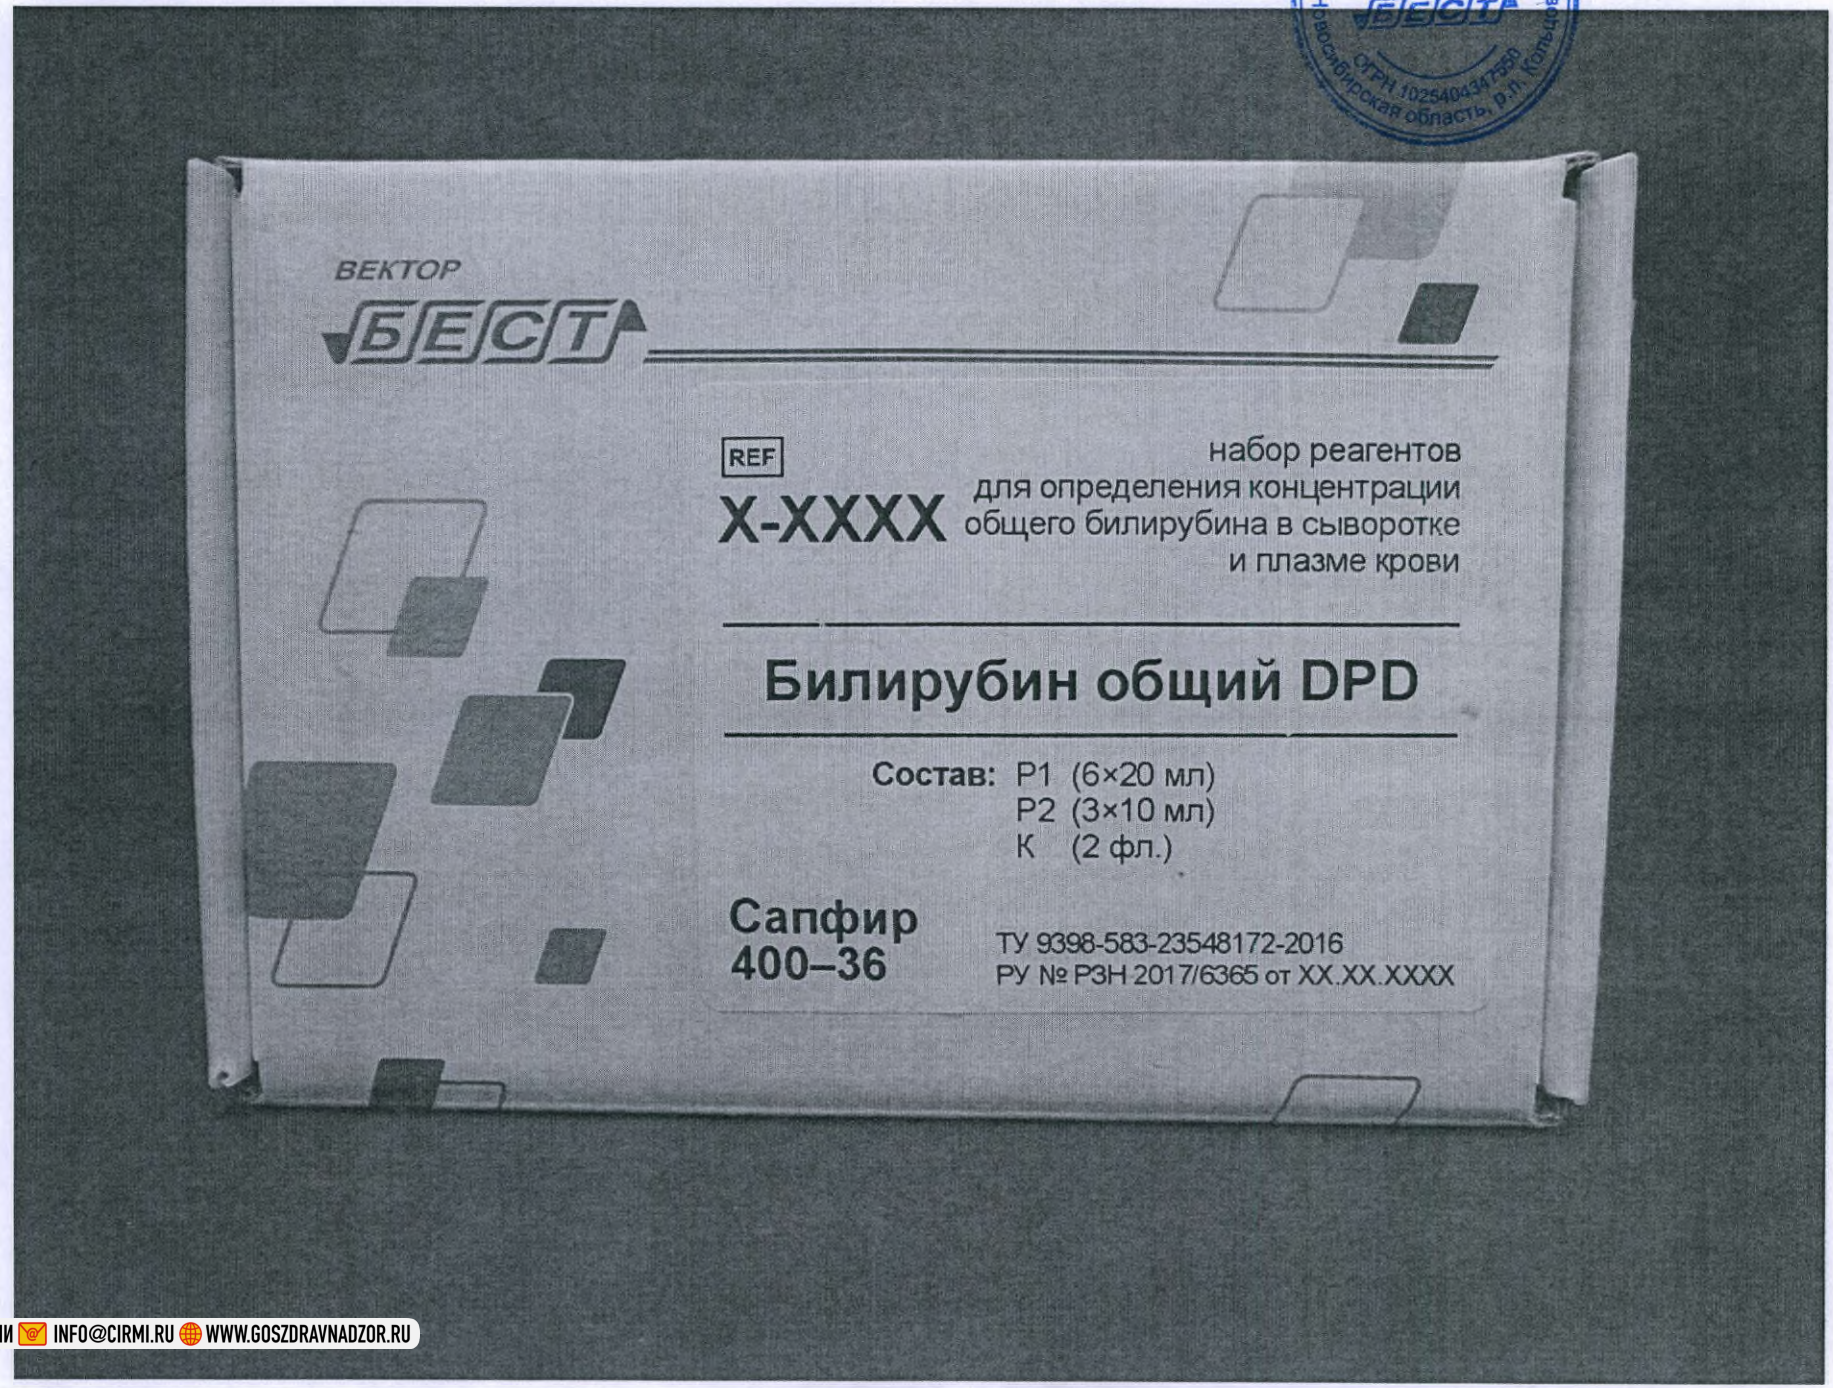

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 4, серия 4


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“__” ___11___ 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 24 ” 11 2020 г.

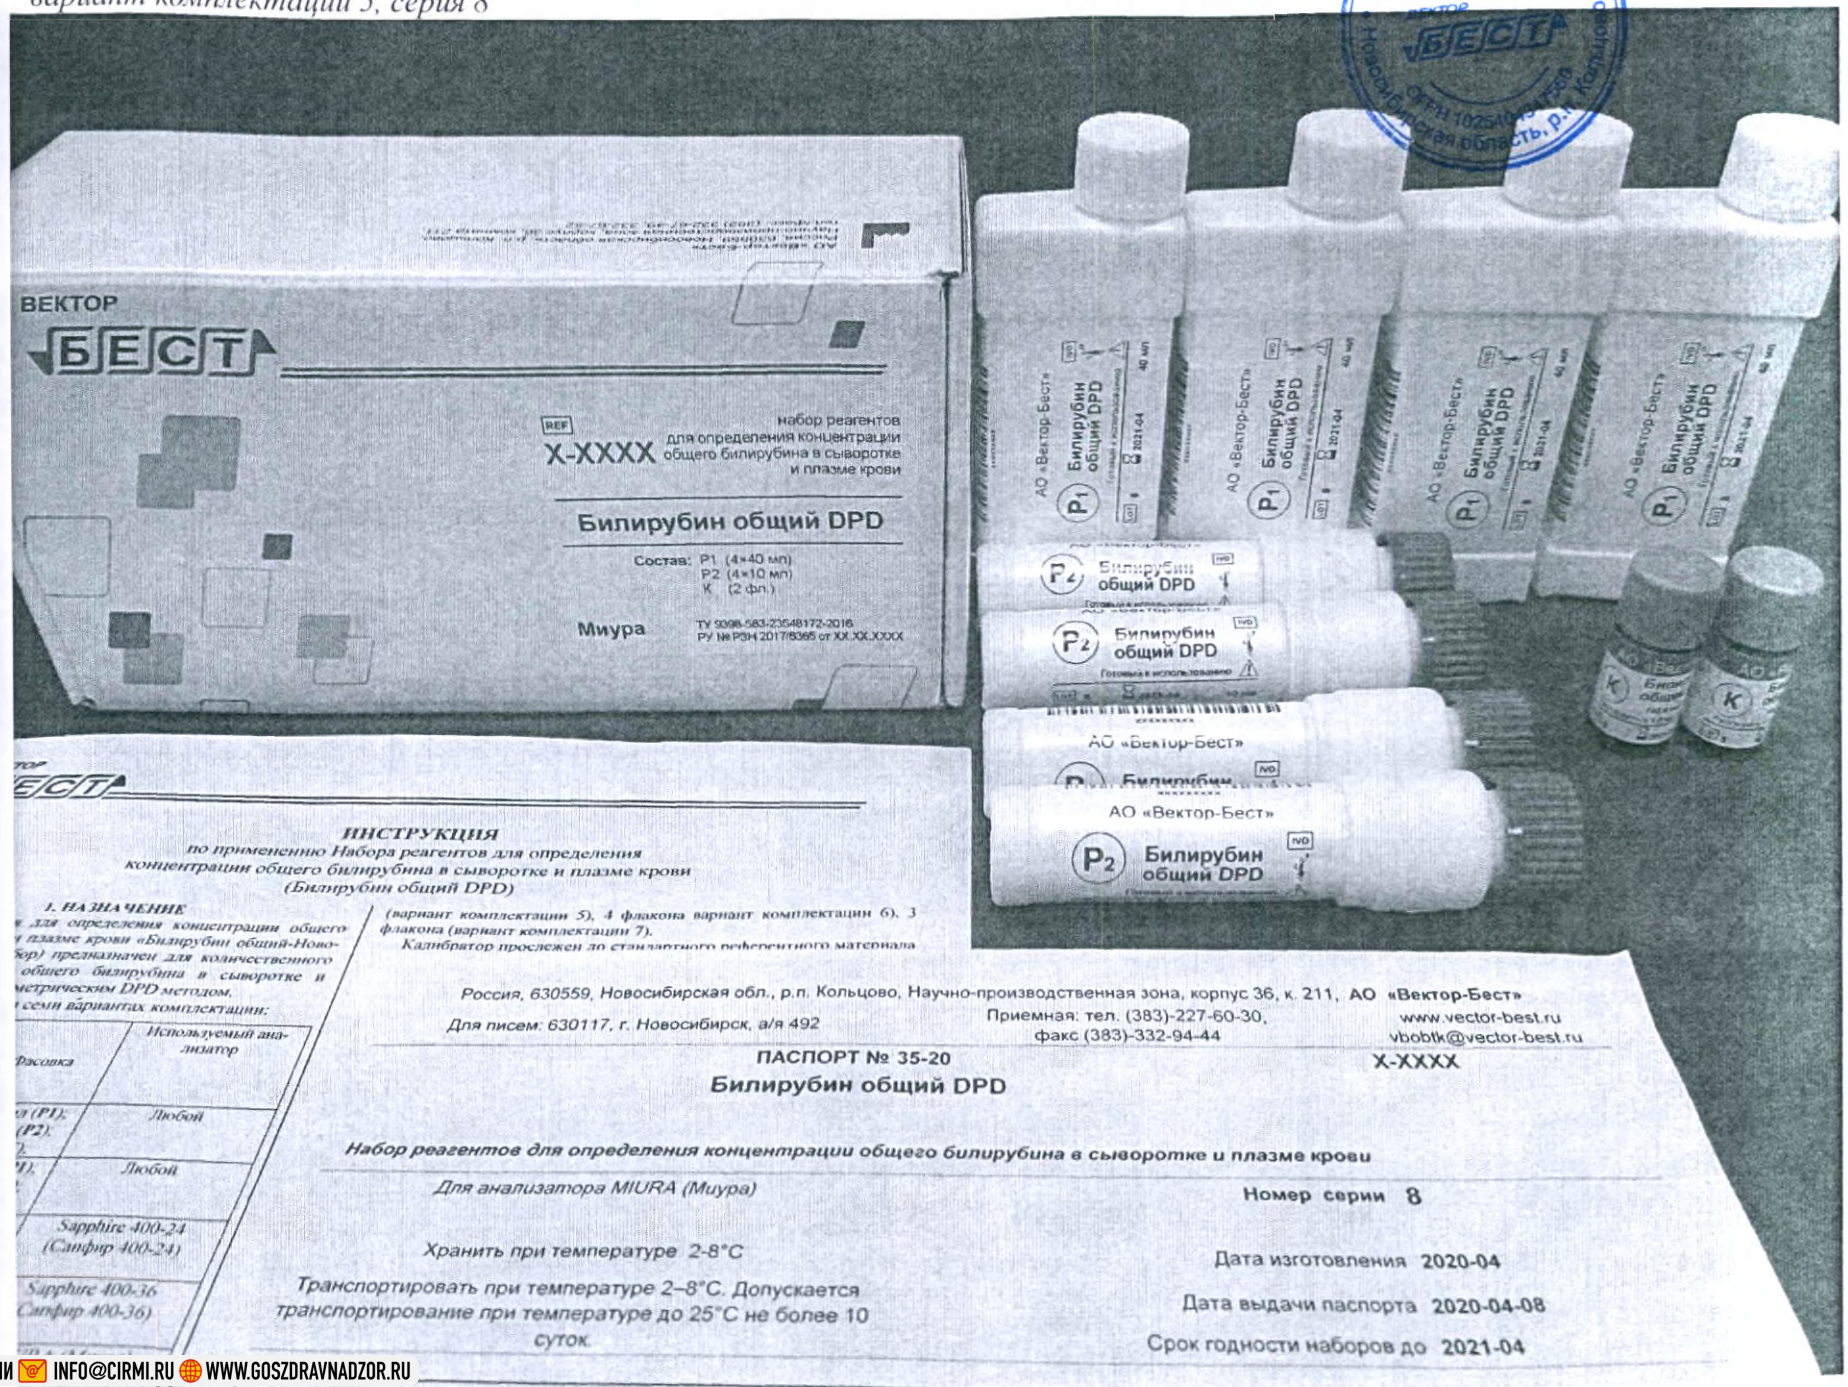

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Набора реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови (Билирубин общий DPD)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

...для определения концентрации общего ... плазме крови «Билирубин общий-Ново-...бор) предназначен для количественного ... общего билирубина в сыворотке и ...метрическим DPD методом.
...семи вариантах комплектации:

...фасовка	Используемый анализатор
...я (P1); ... (P2); ...2.	Любой
...P1);	Любой
	Sapphire 400-24 (Сапфир 400-24)
	Sapphire 400-36 (Сапфир 400-36)

(вариант комплектации 5), 4 флакона вариант комплектации 6), 3 флакона (вариант комплектации 7).
Калибратор прослежен до стандартного референтного материала

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
www.vector-best.ru
vbobtk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 35-20 **X-XXXX**

Билирубин общий DPD

Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови

Для анализатора MIURA (Миура)

Номер серии 8

Хранить при температуре 2-8°С

Транспортировать при температуре 2–8°С. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток.

Дата изготовления **2020-04**

Дата выдачи паспорта **2020-04-08**


Срок годности наборов до **2021-04**

Состав

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

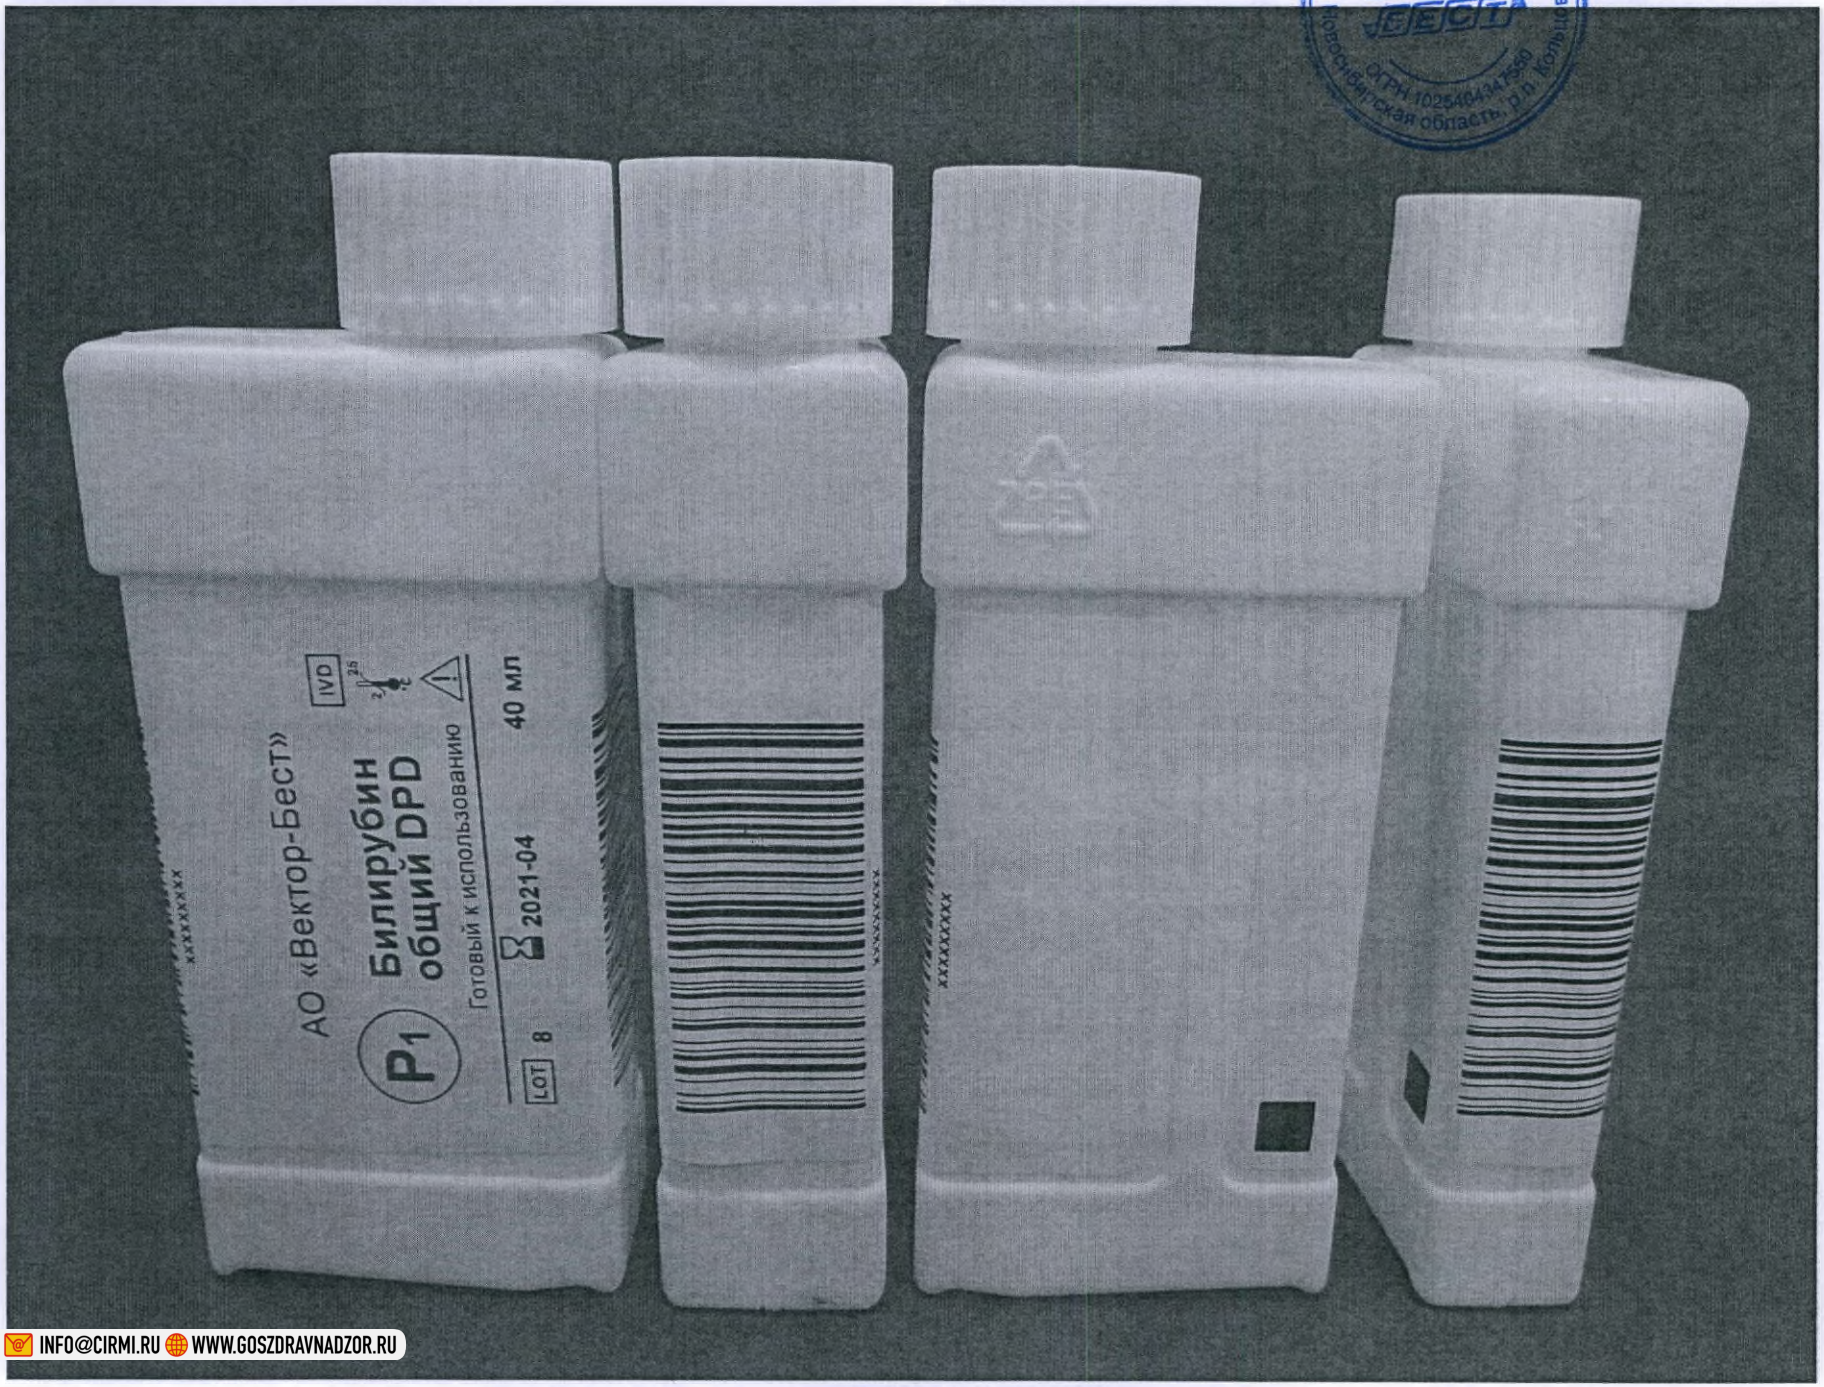

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

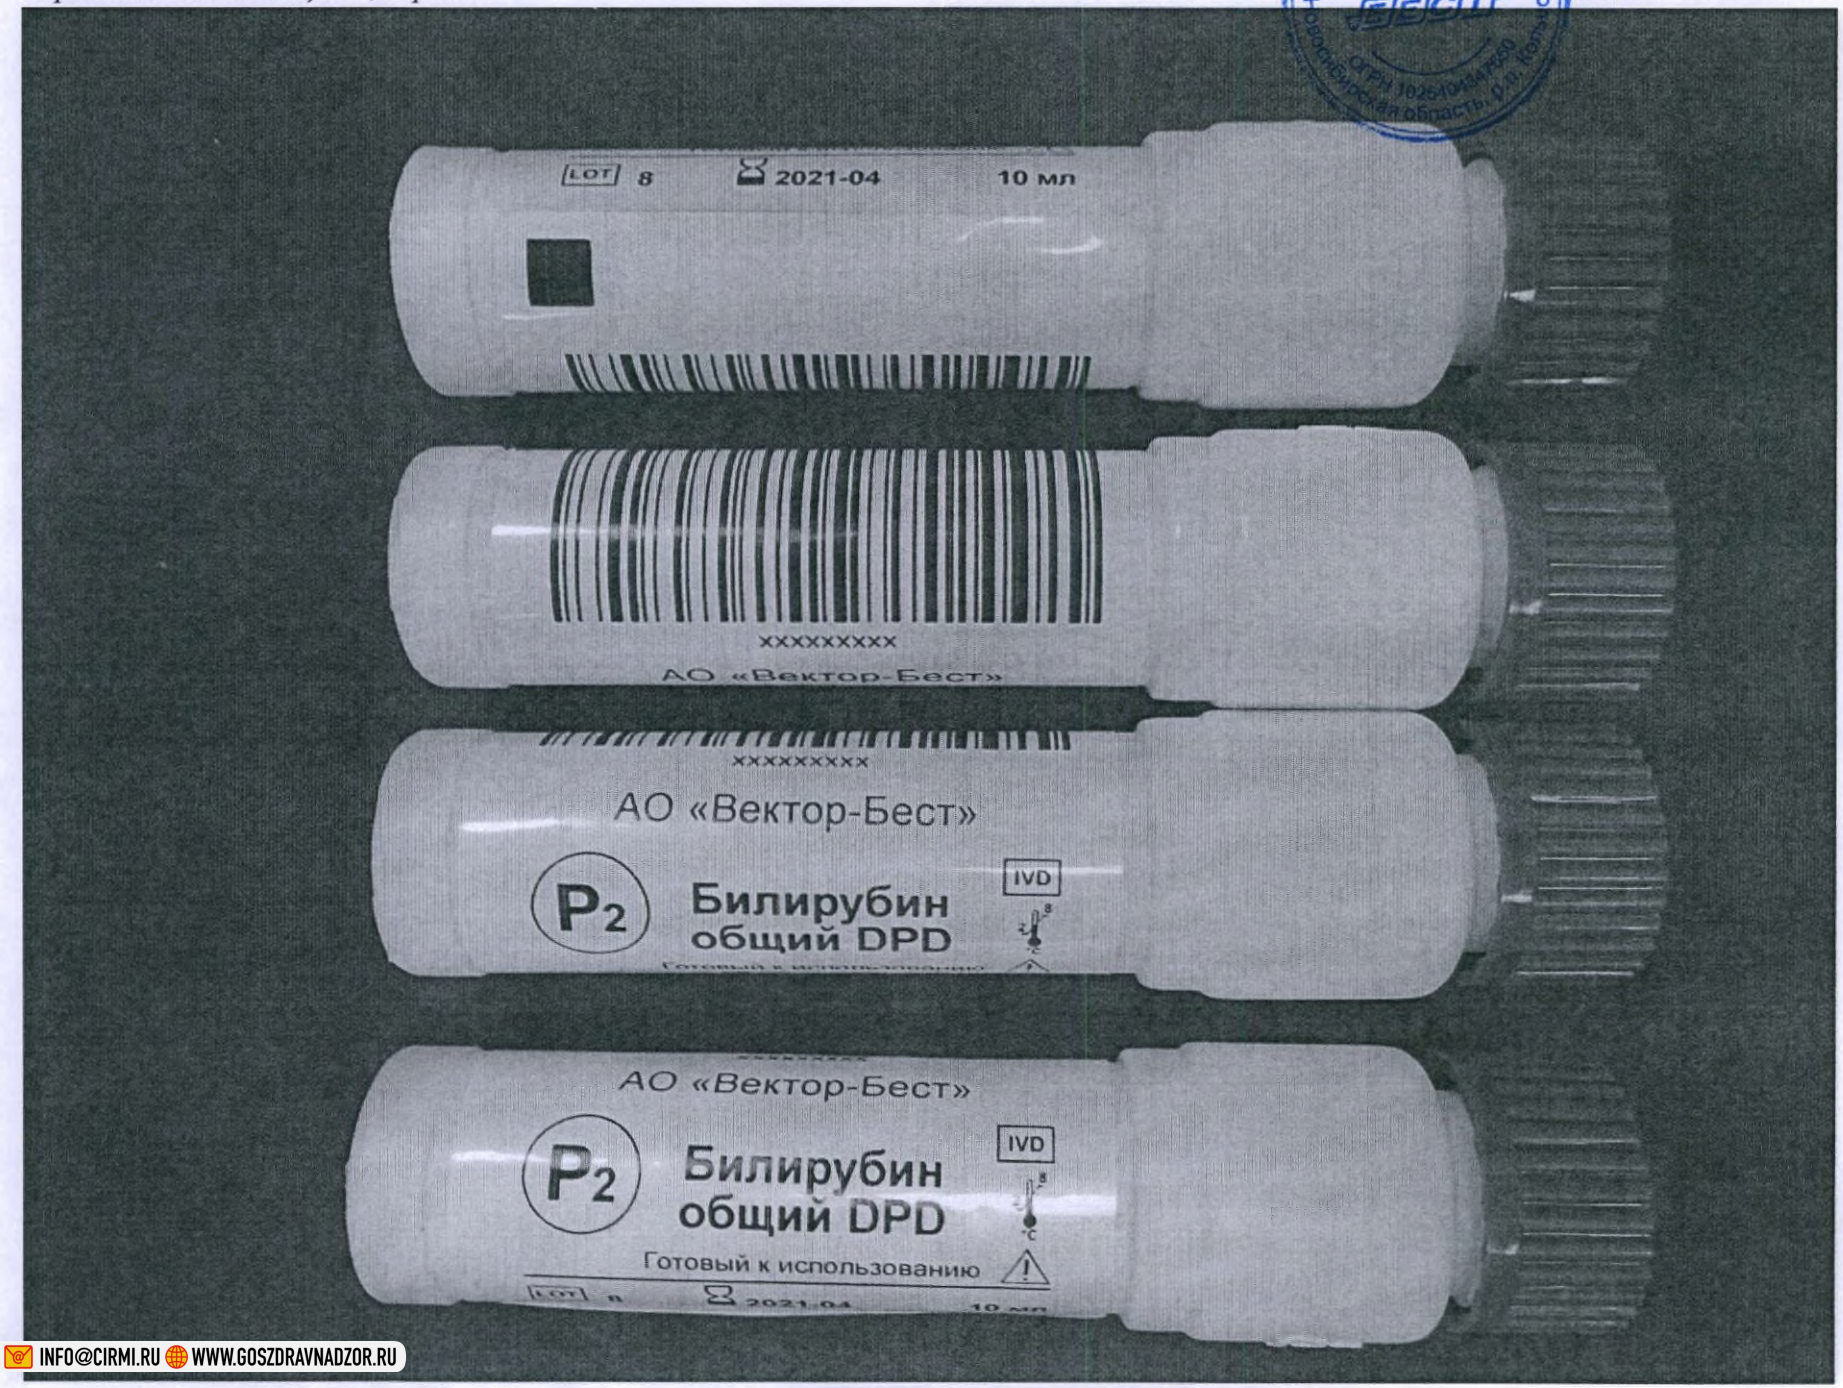

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 5, серия 8

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

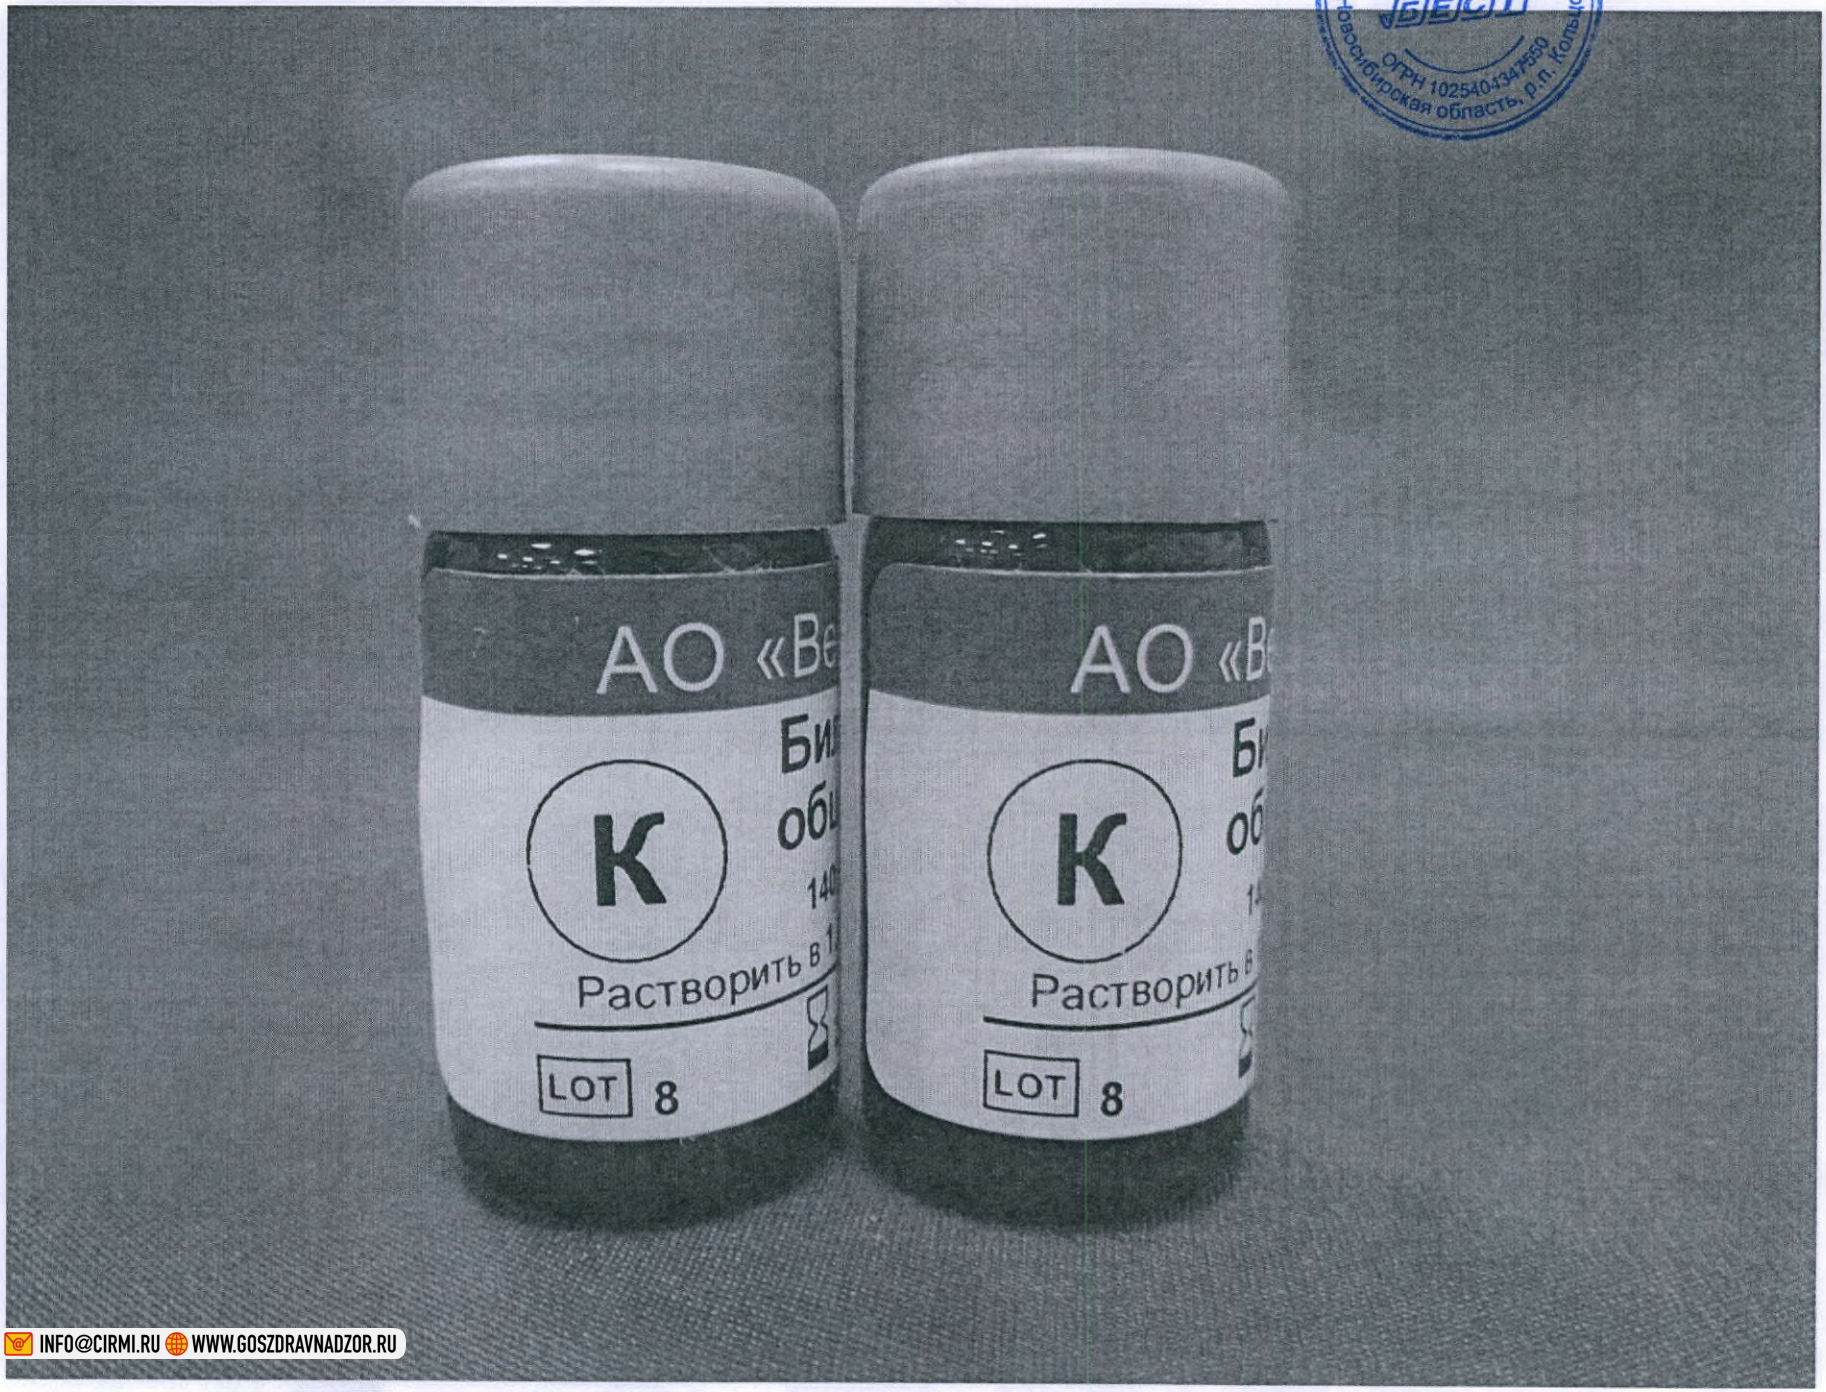

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №4
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №5
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“__” _____ 2020 г.

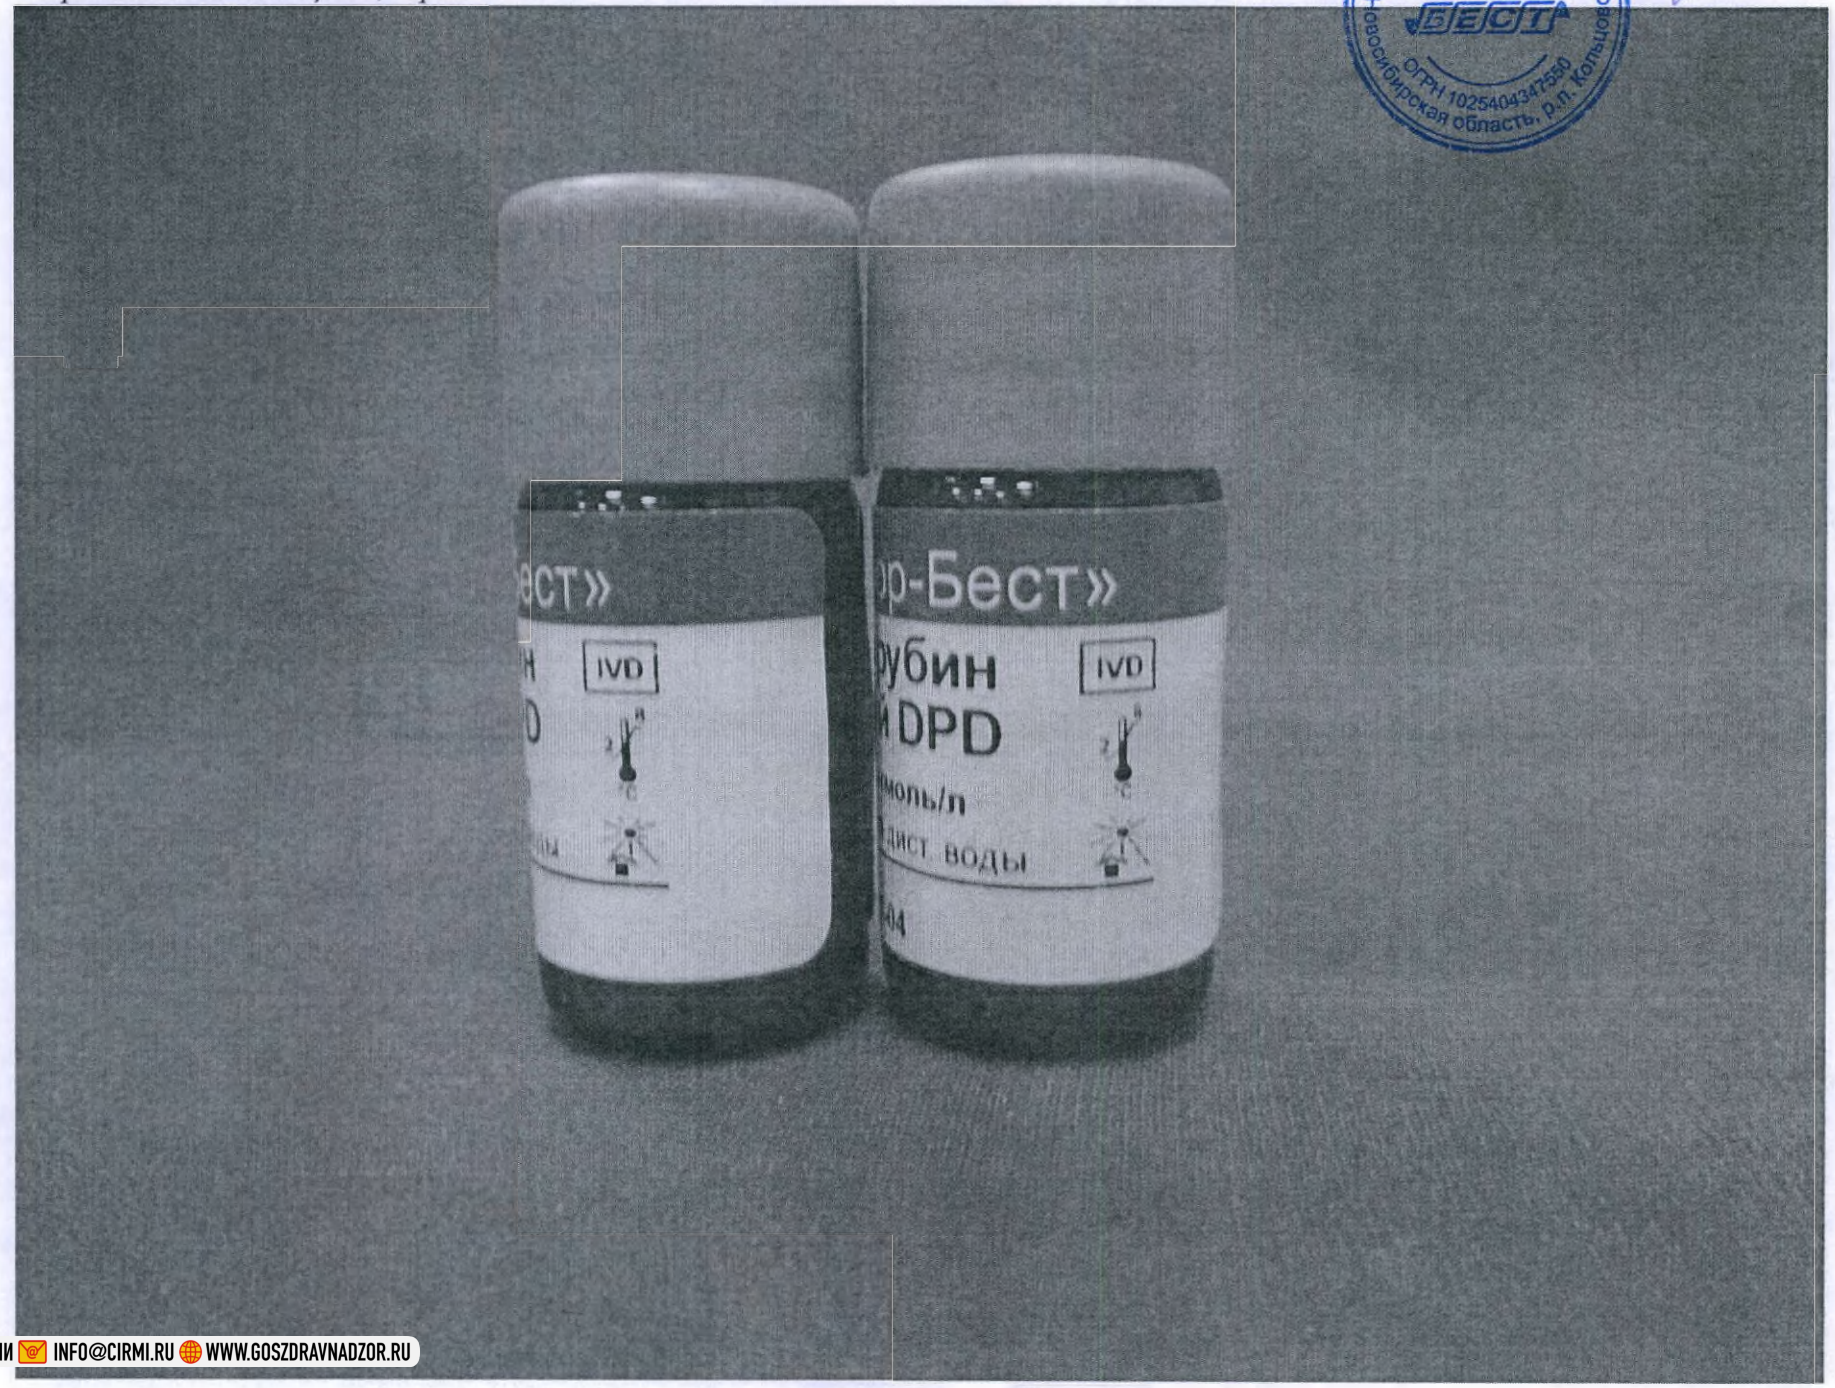

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.

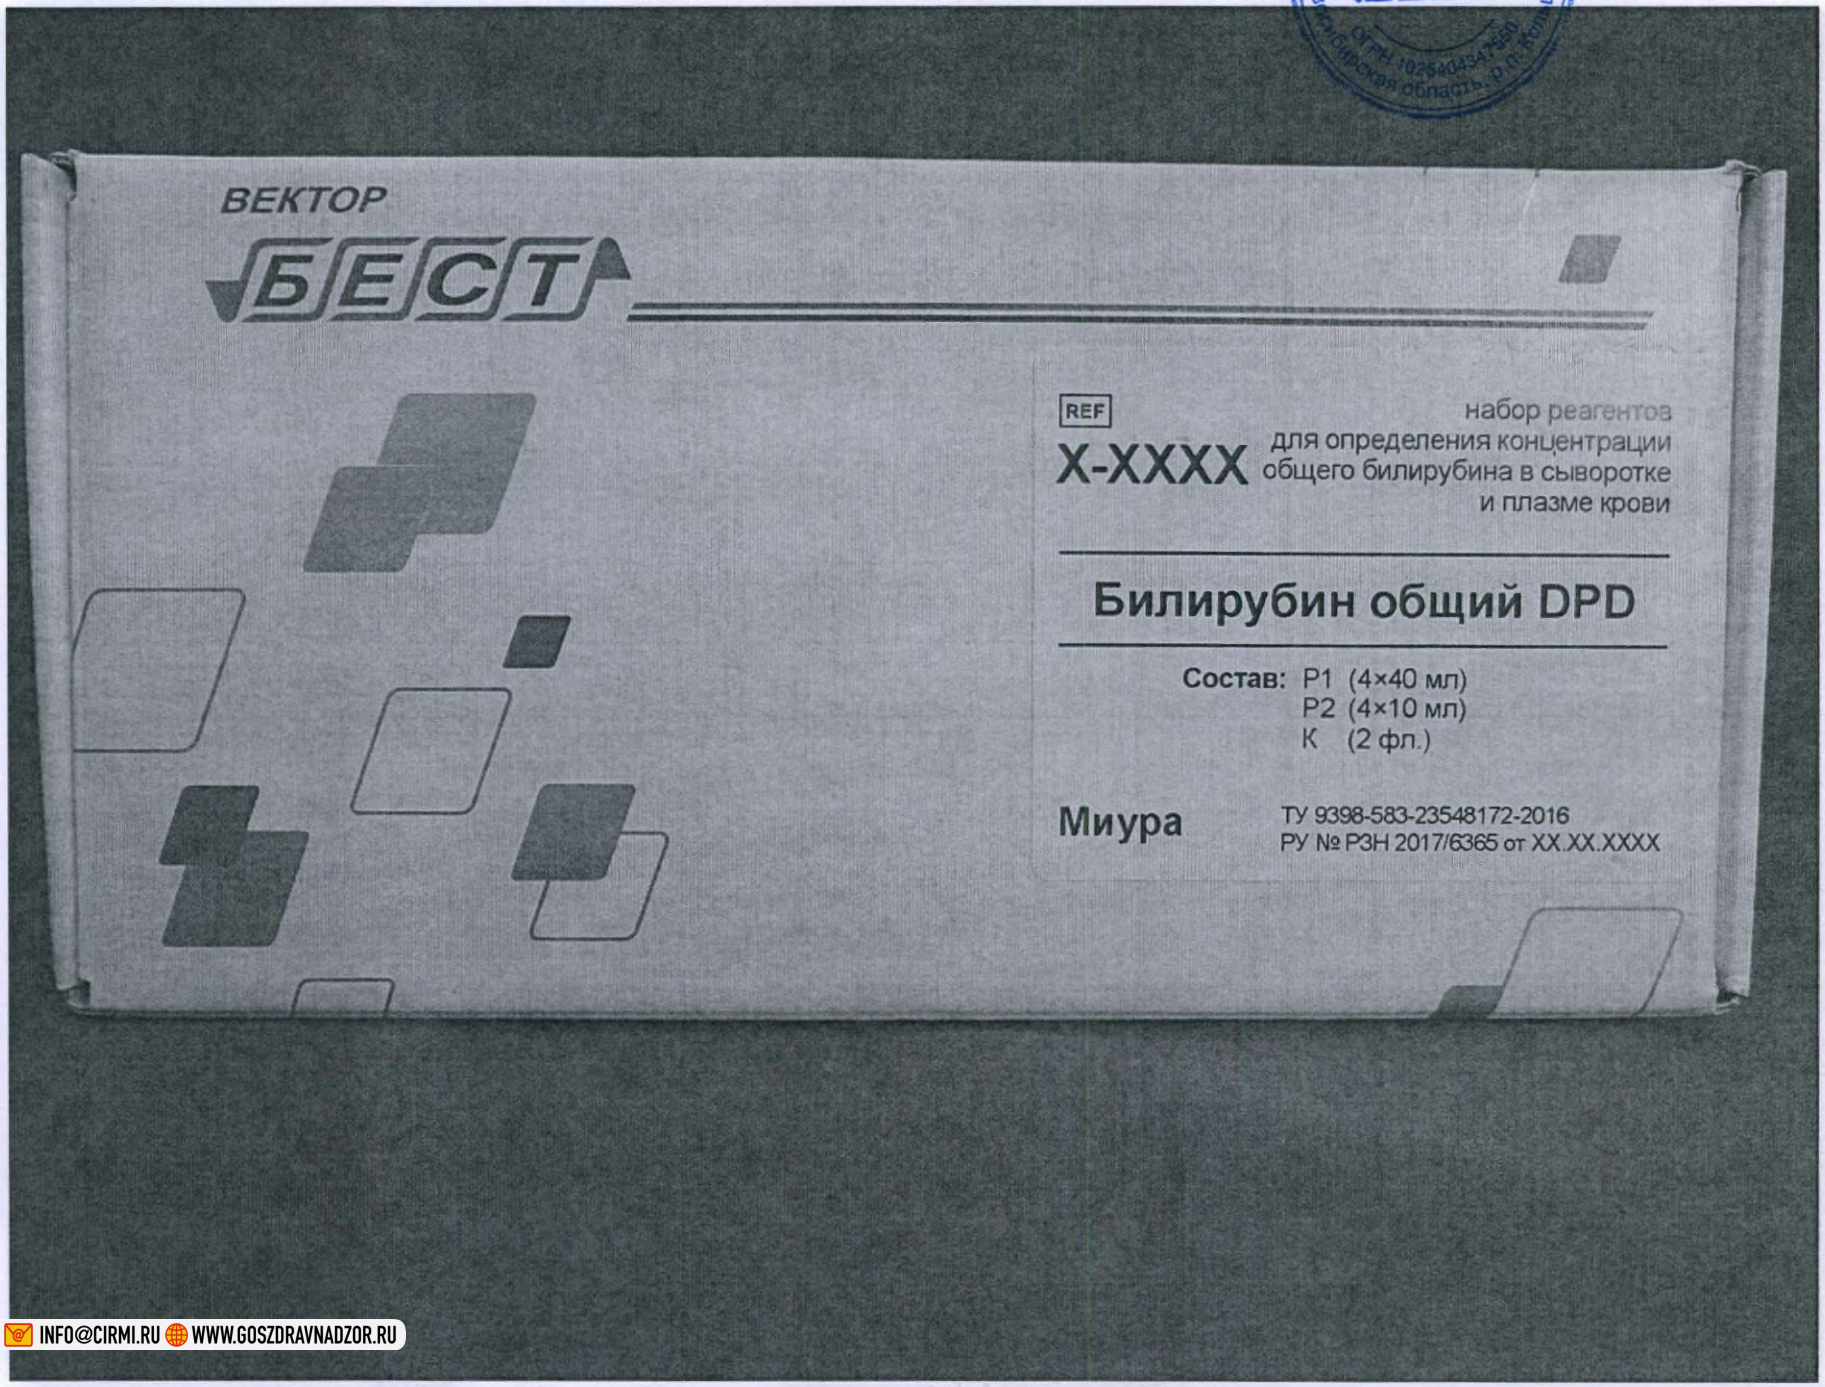

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 5, серия 8


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 12 ” 11 2020 г.

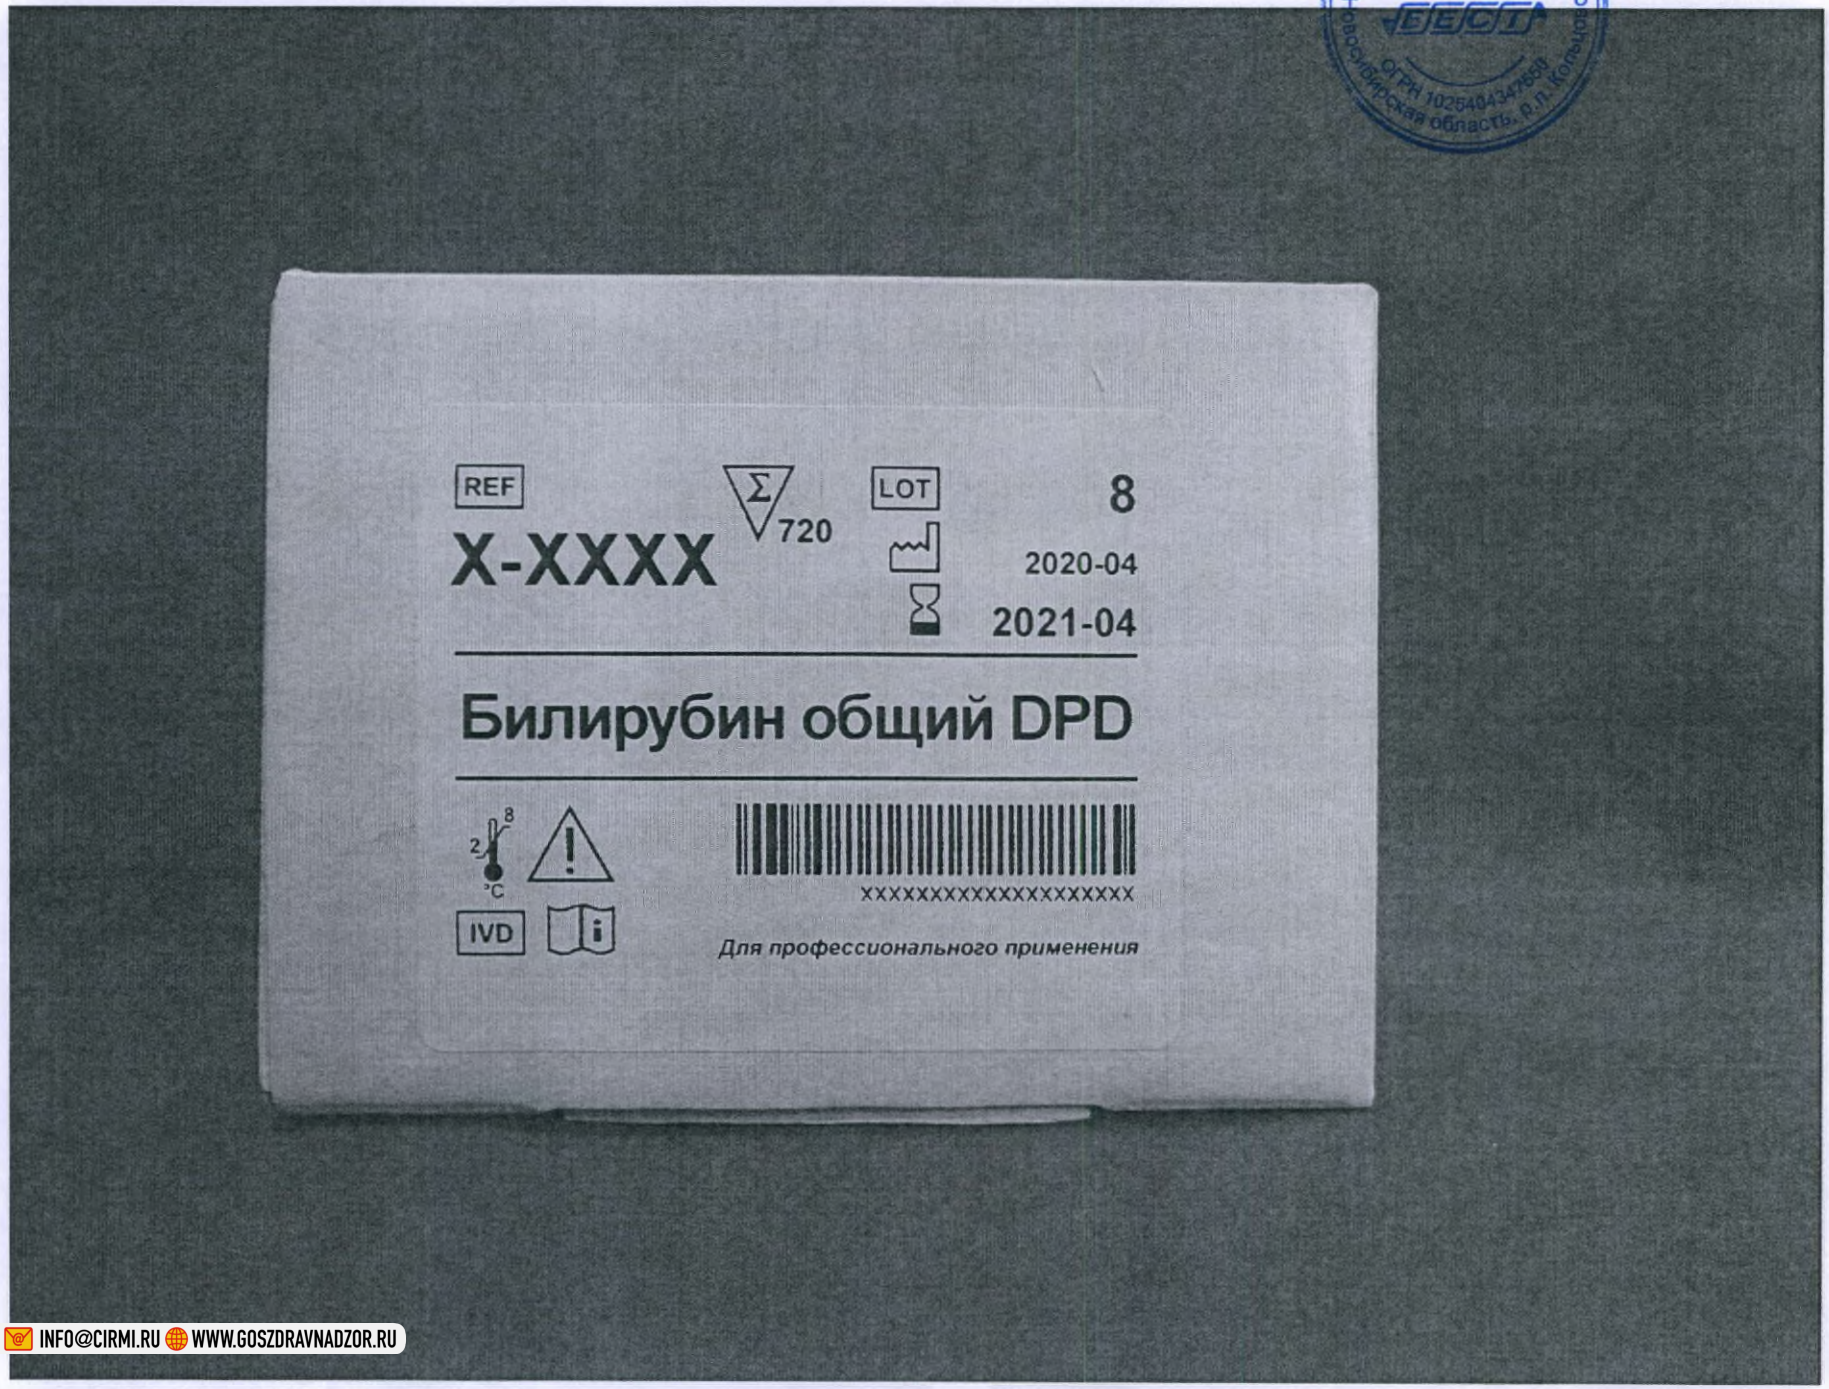

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 6, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” 11 2020 г.

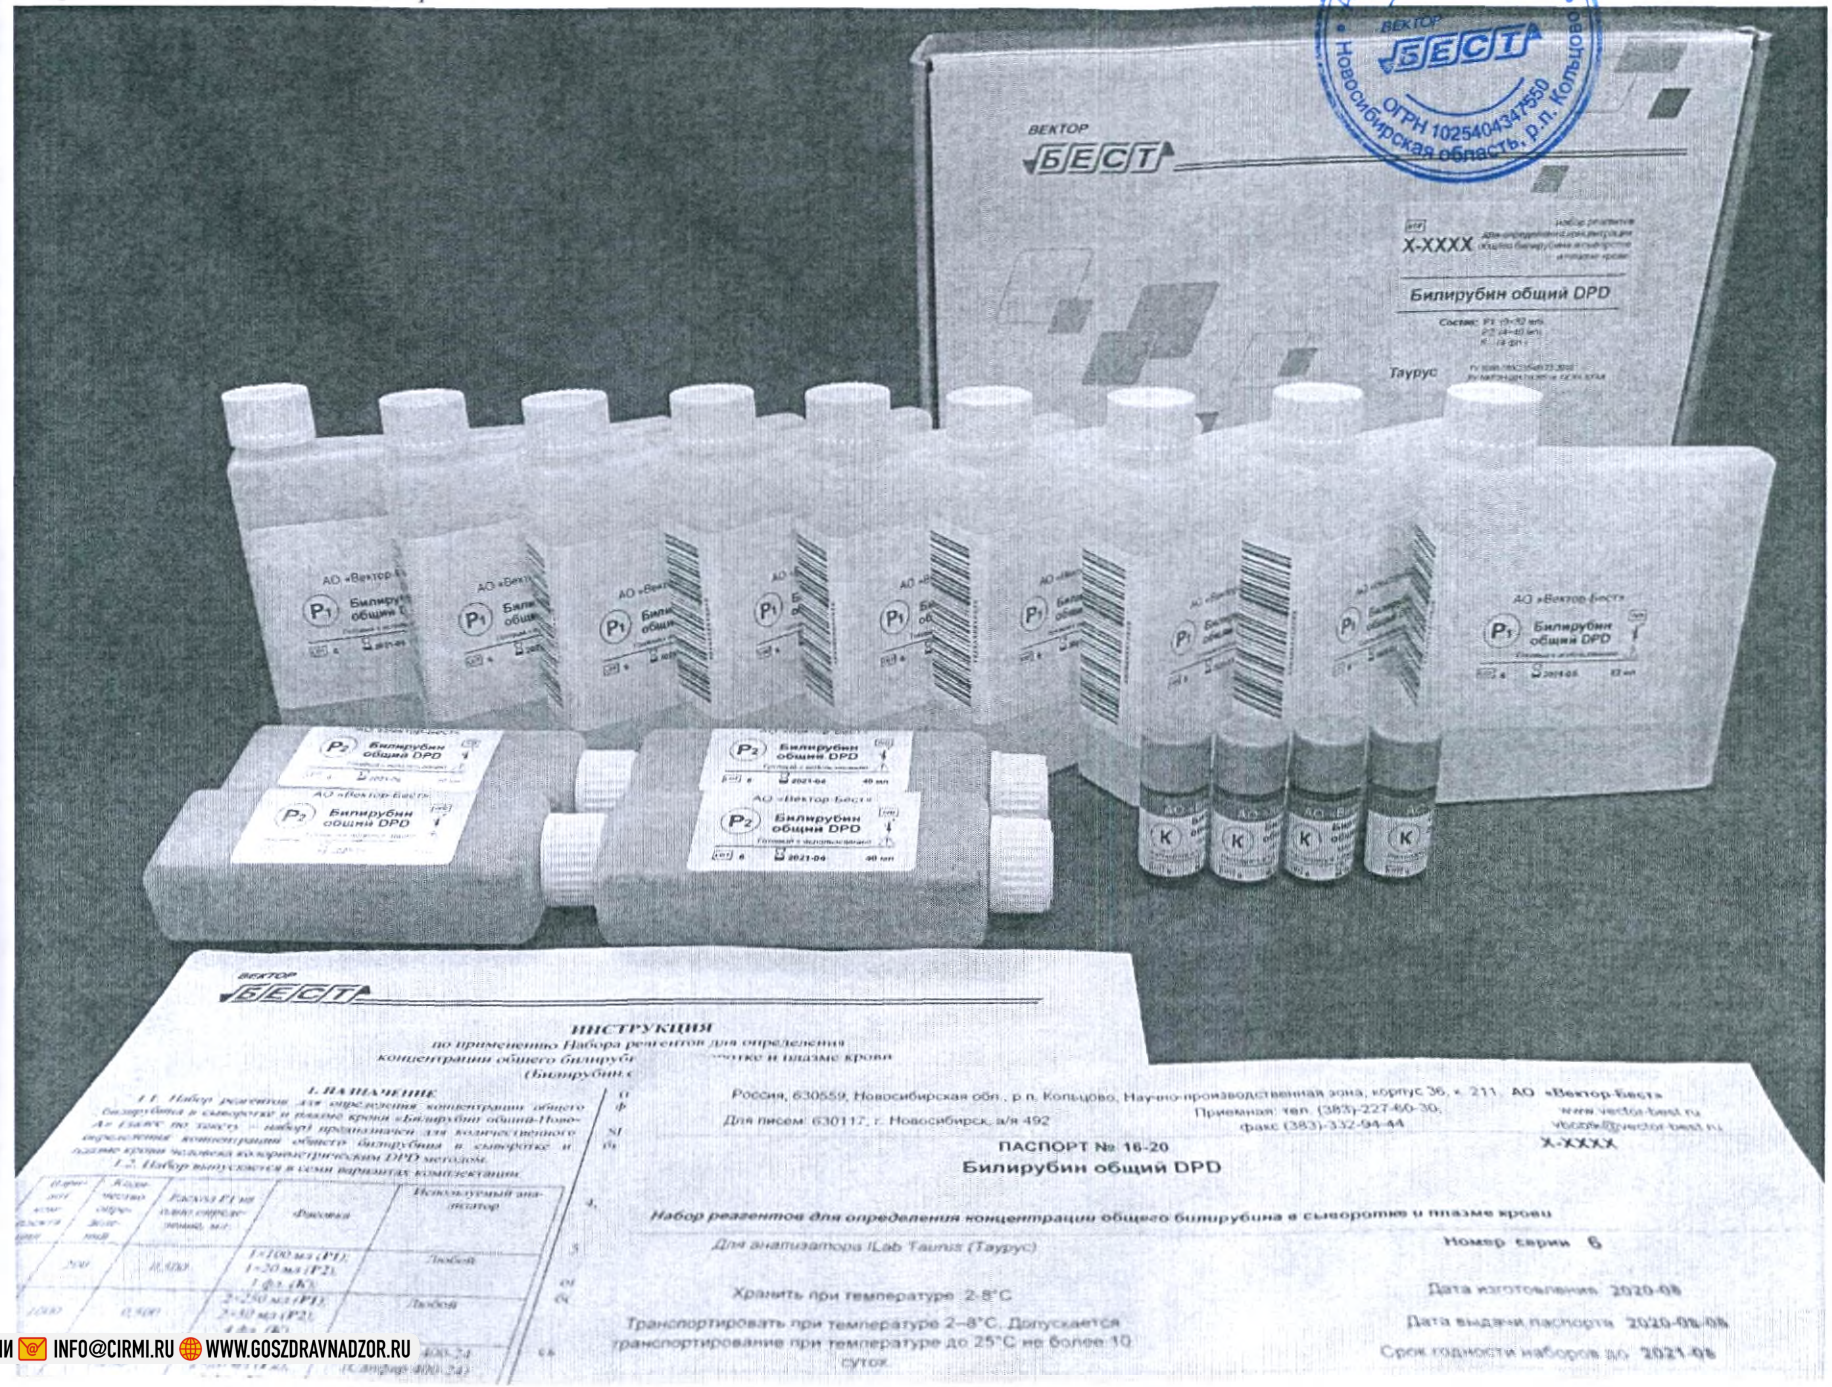

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 6, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” 11 2020 г.

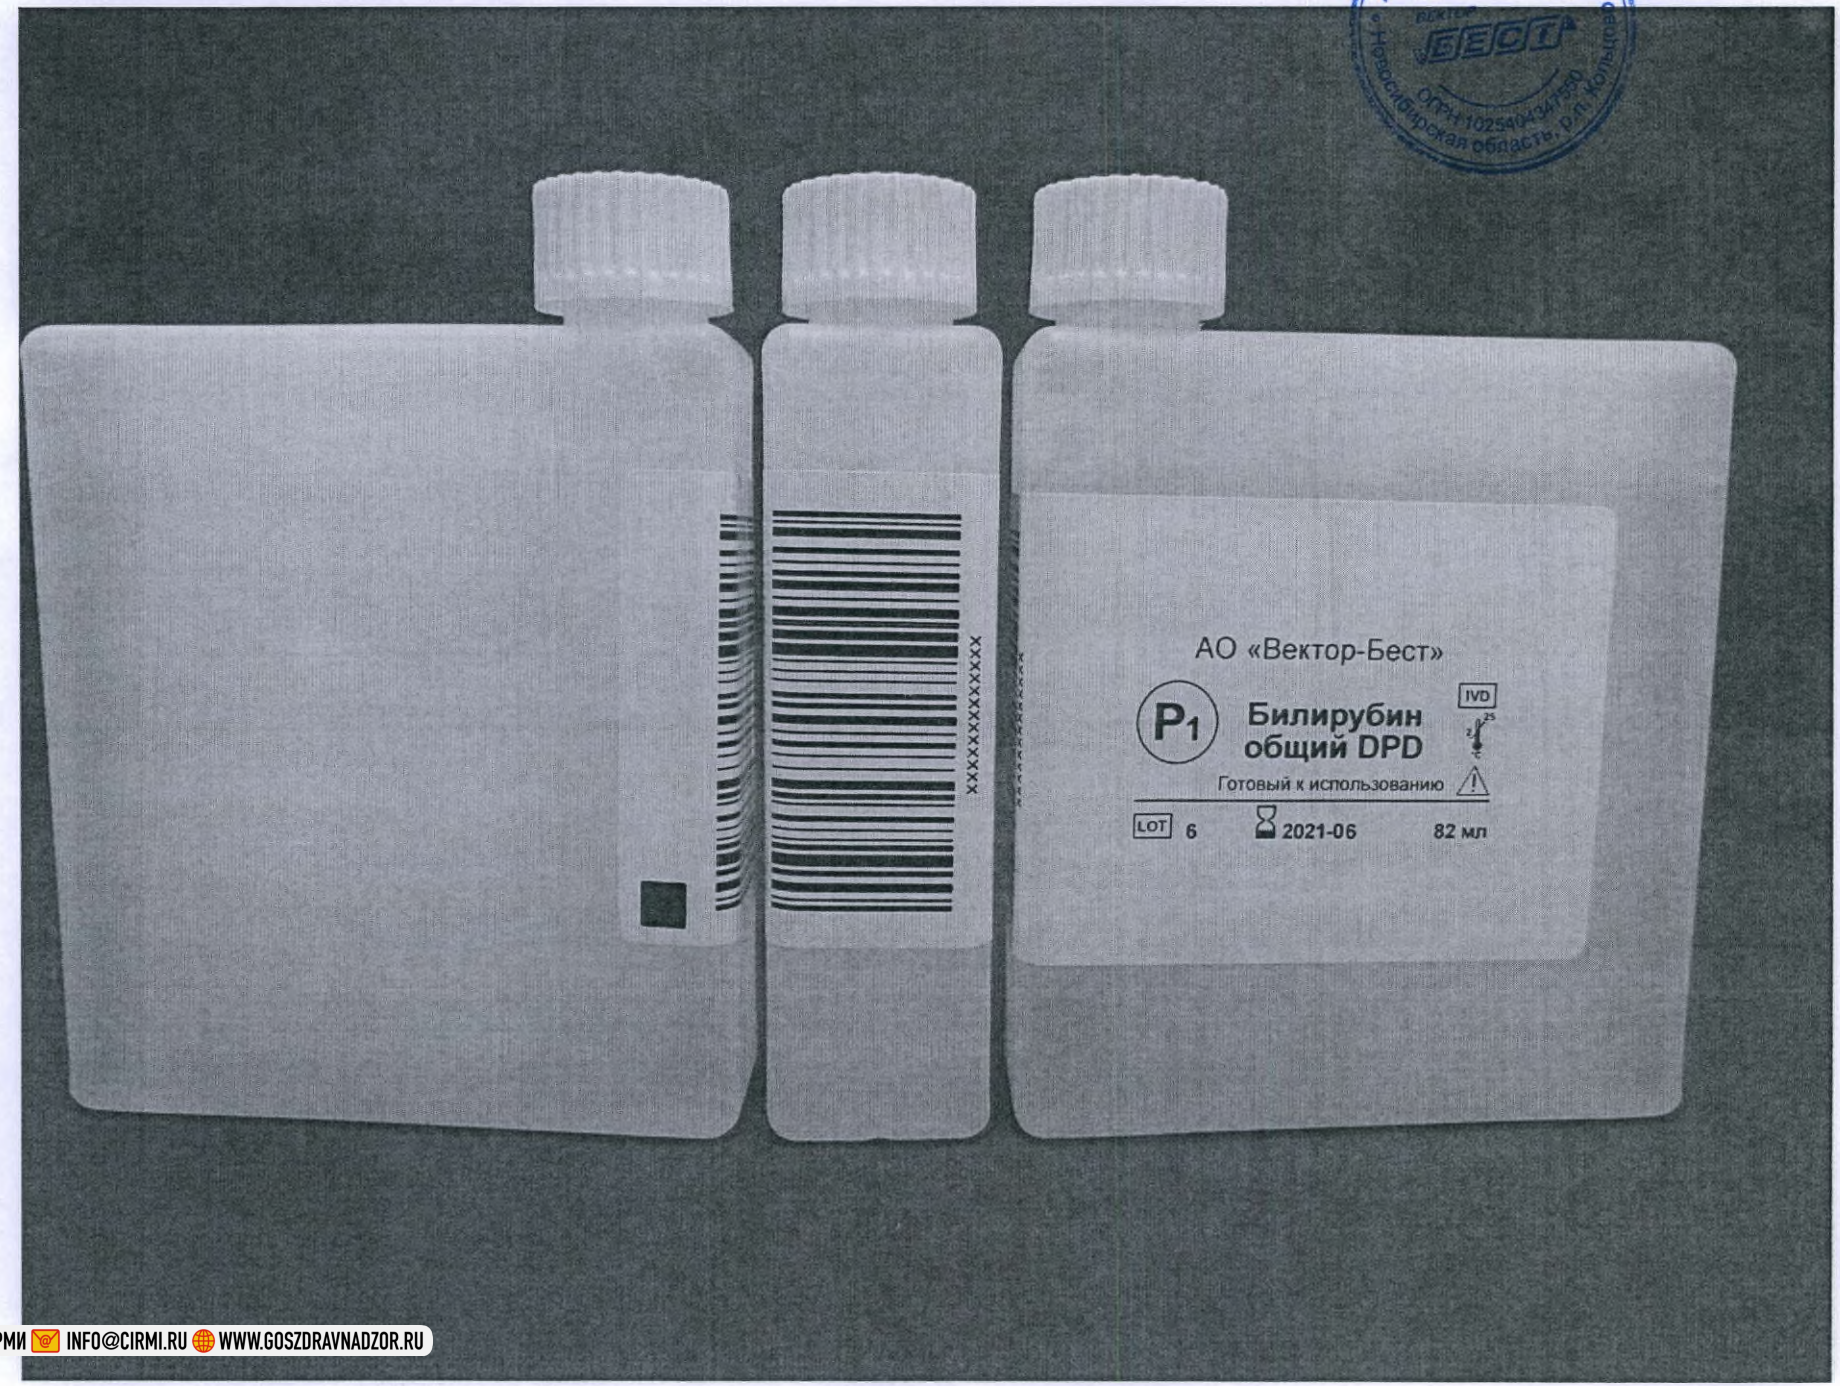

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 6, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” _____ 2020 г.

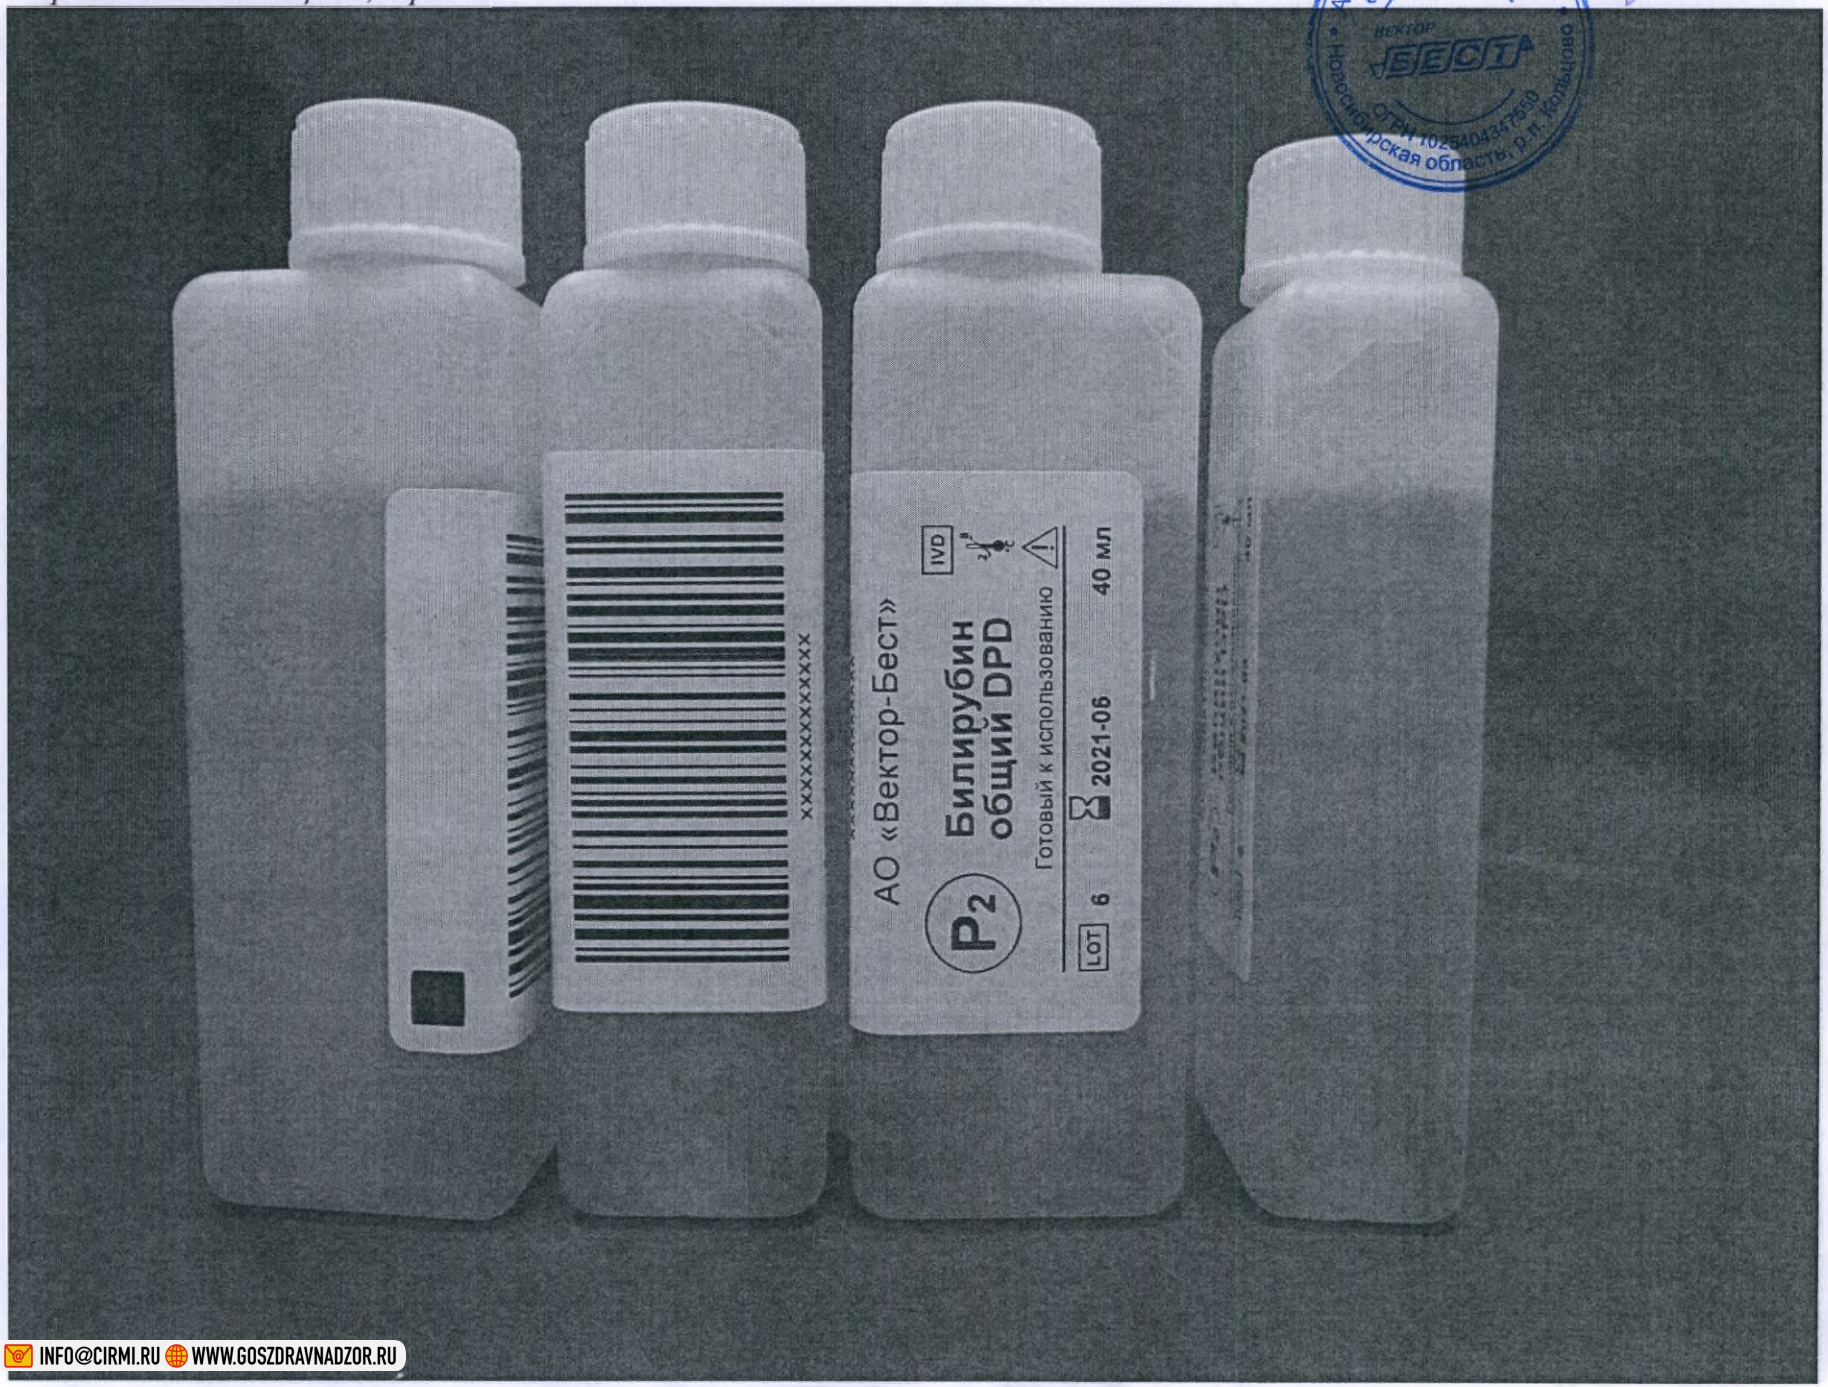

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 6, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 6, серия 6

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“11” 2020 г.

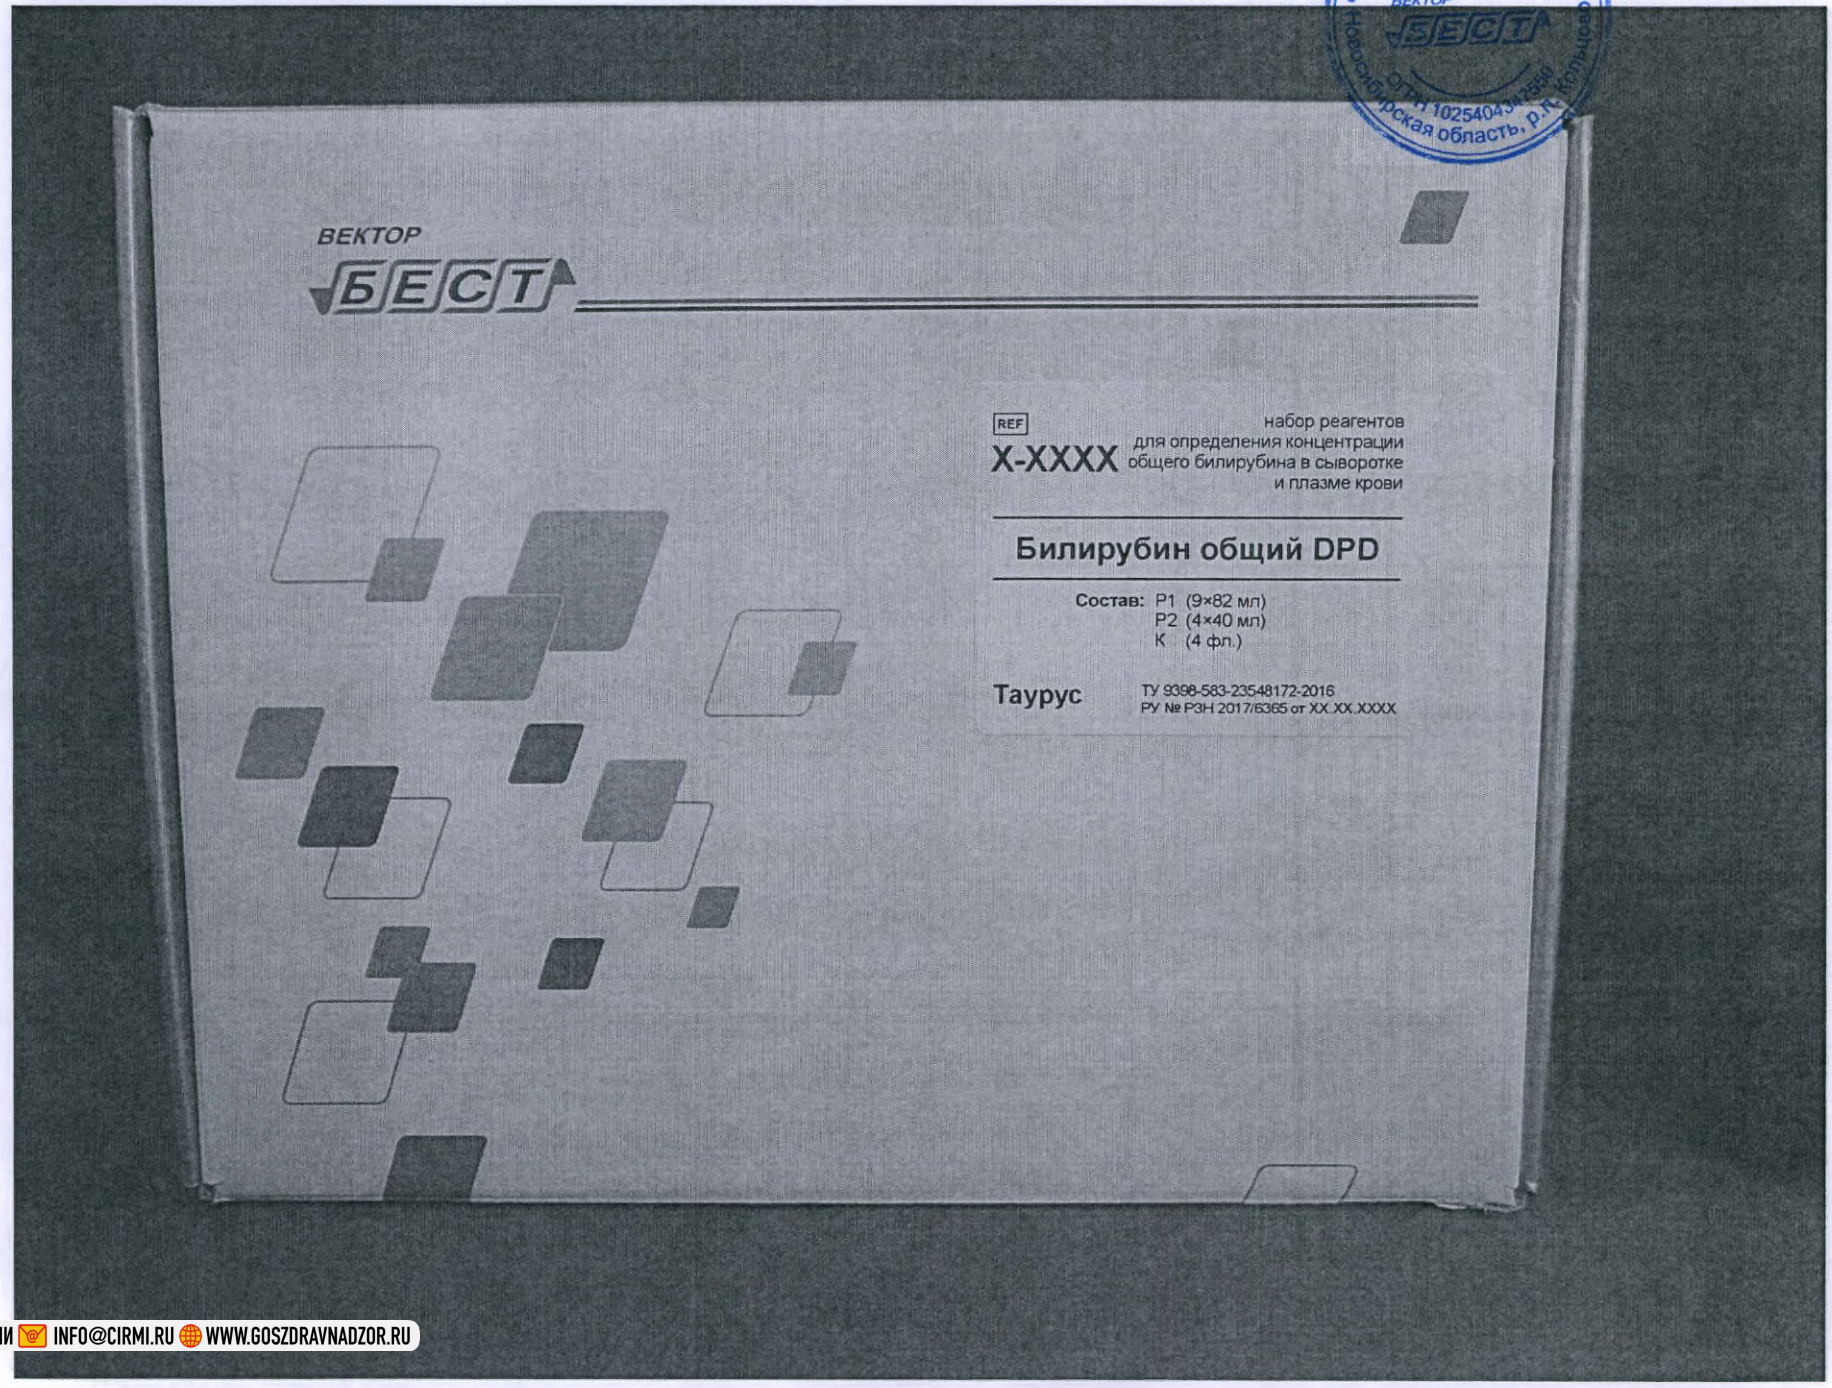

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 6, серия 6


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“12” 11 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий DPD”
вариант комплектации 7, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ 11 ” 2020 г.

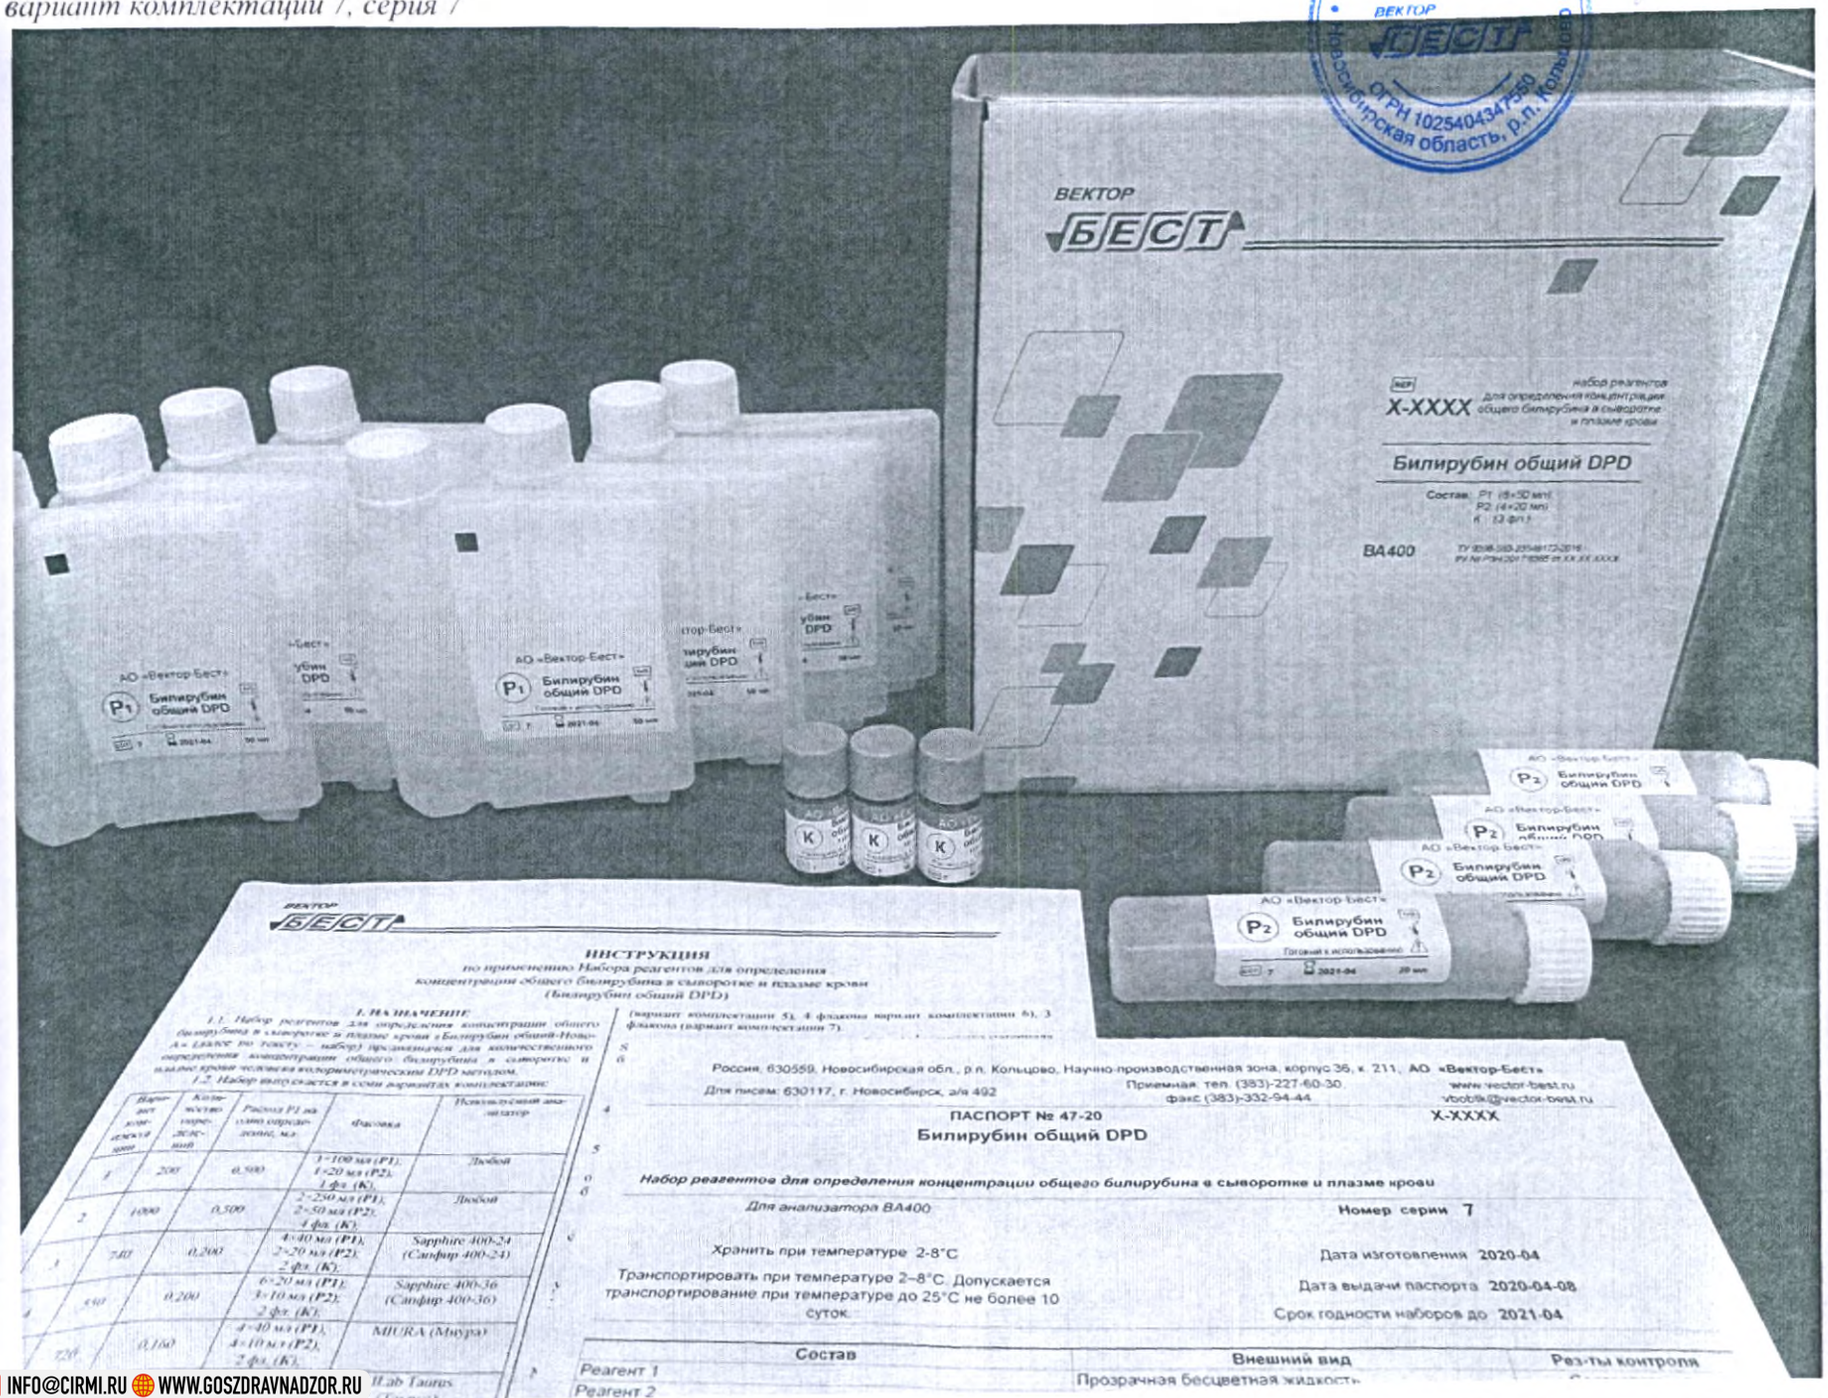

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 7, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“11” _____ 2020 г.

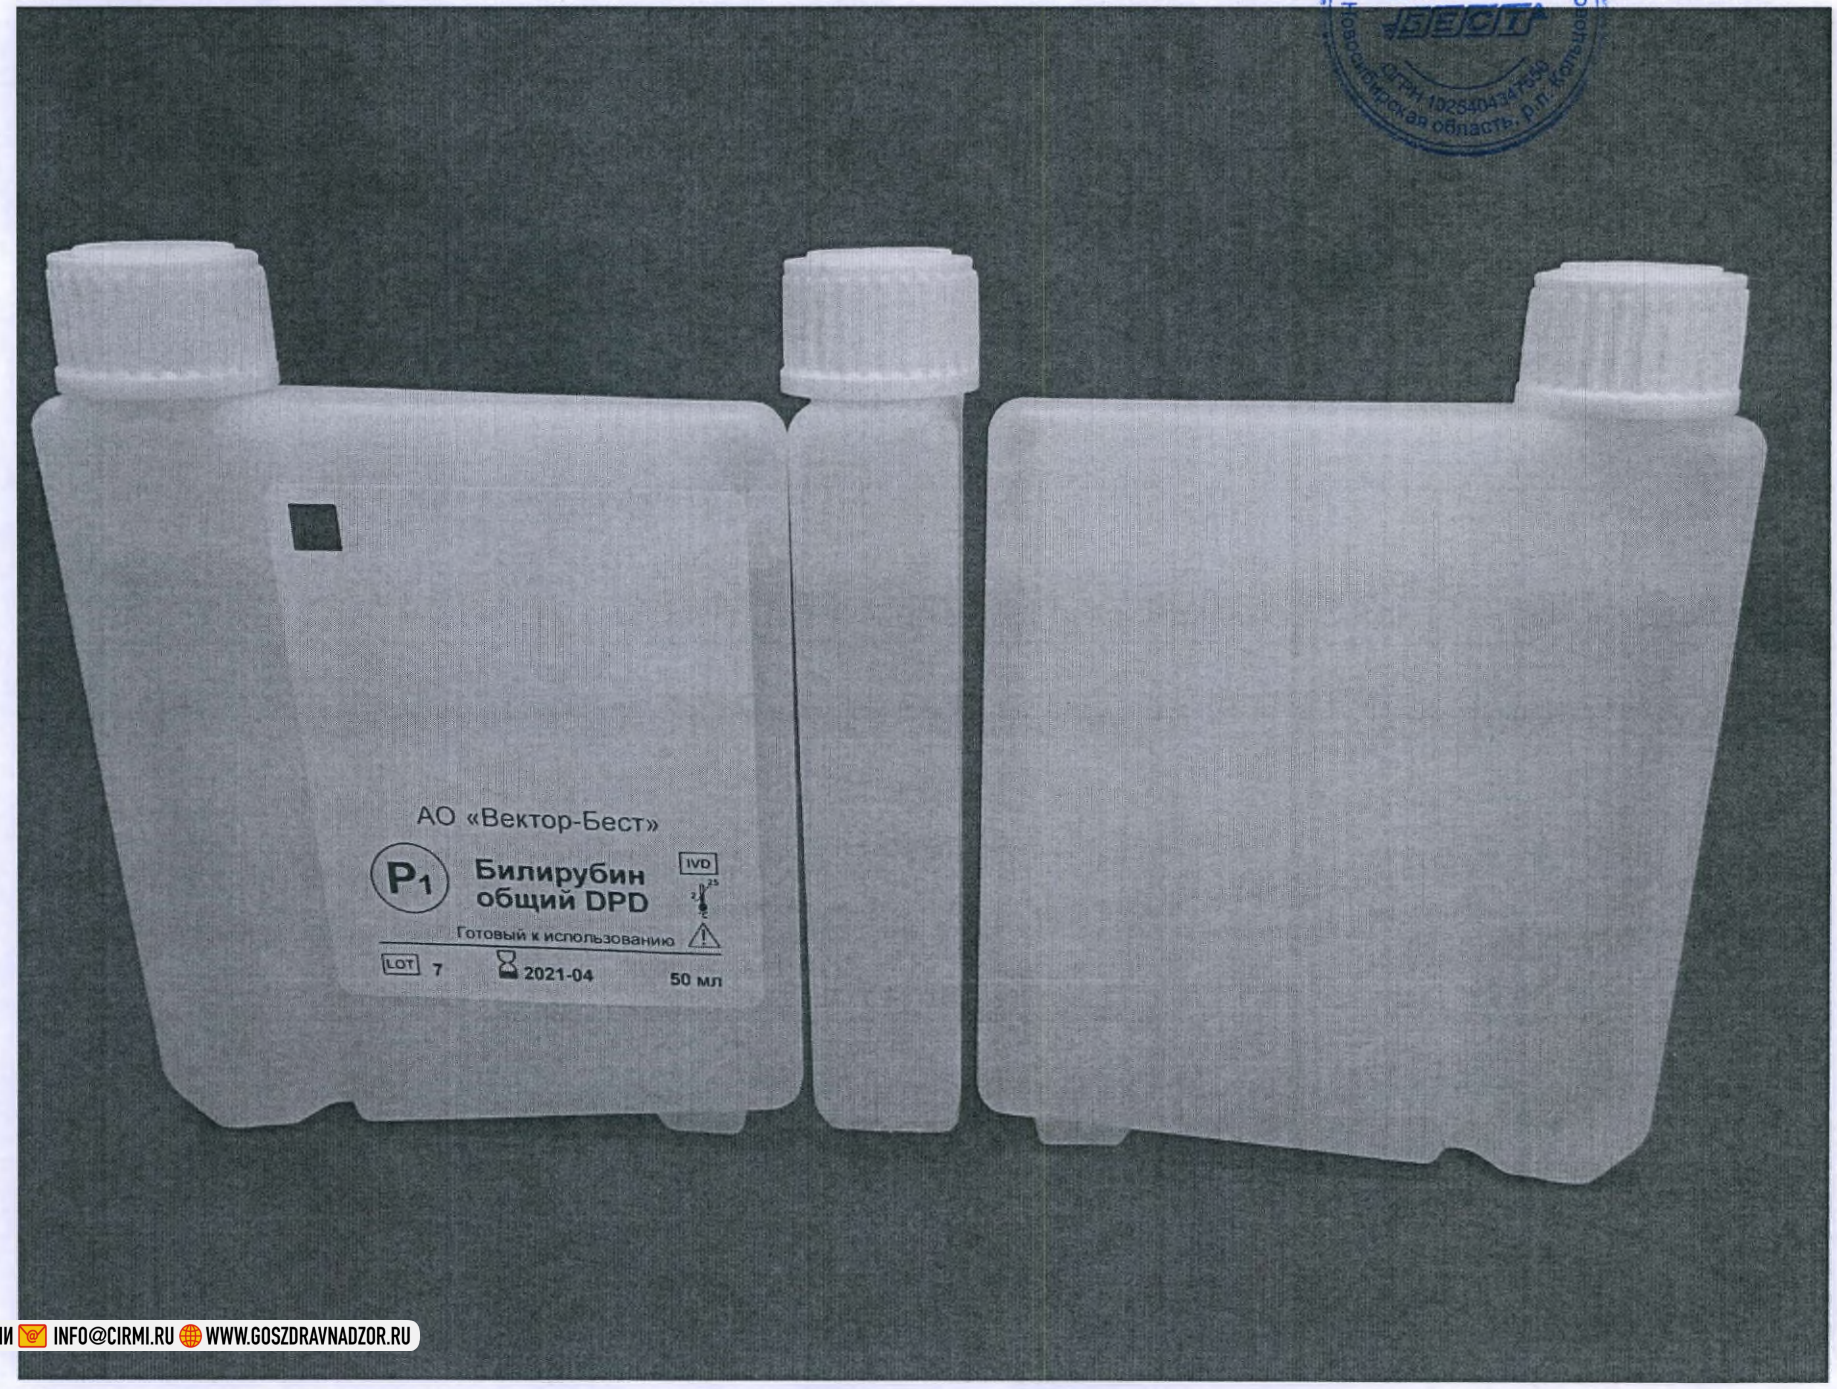

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“__” 11 2020 г.

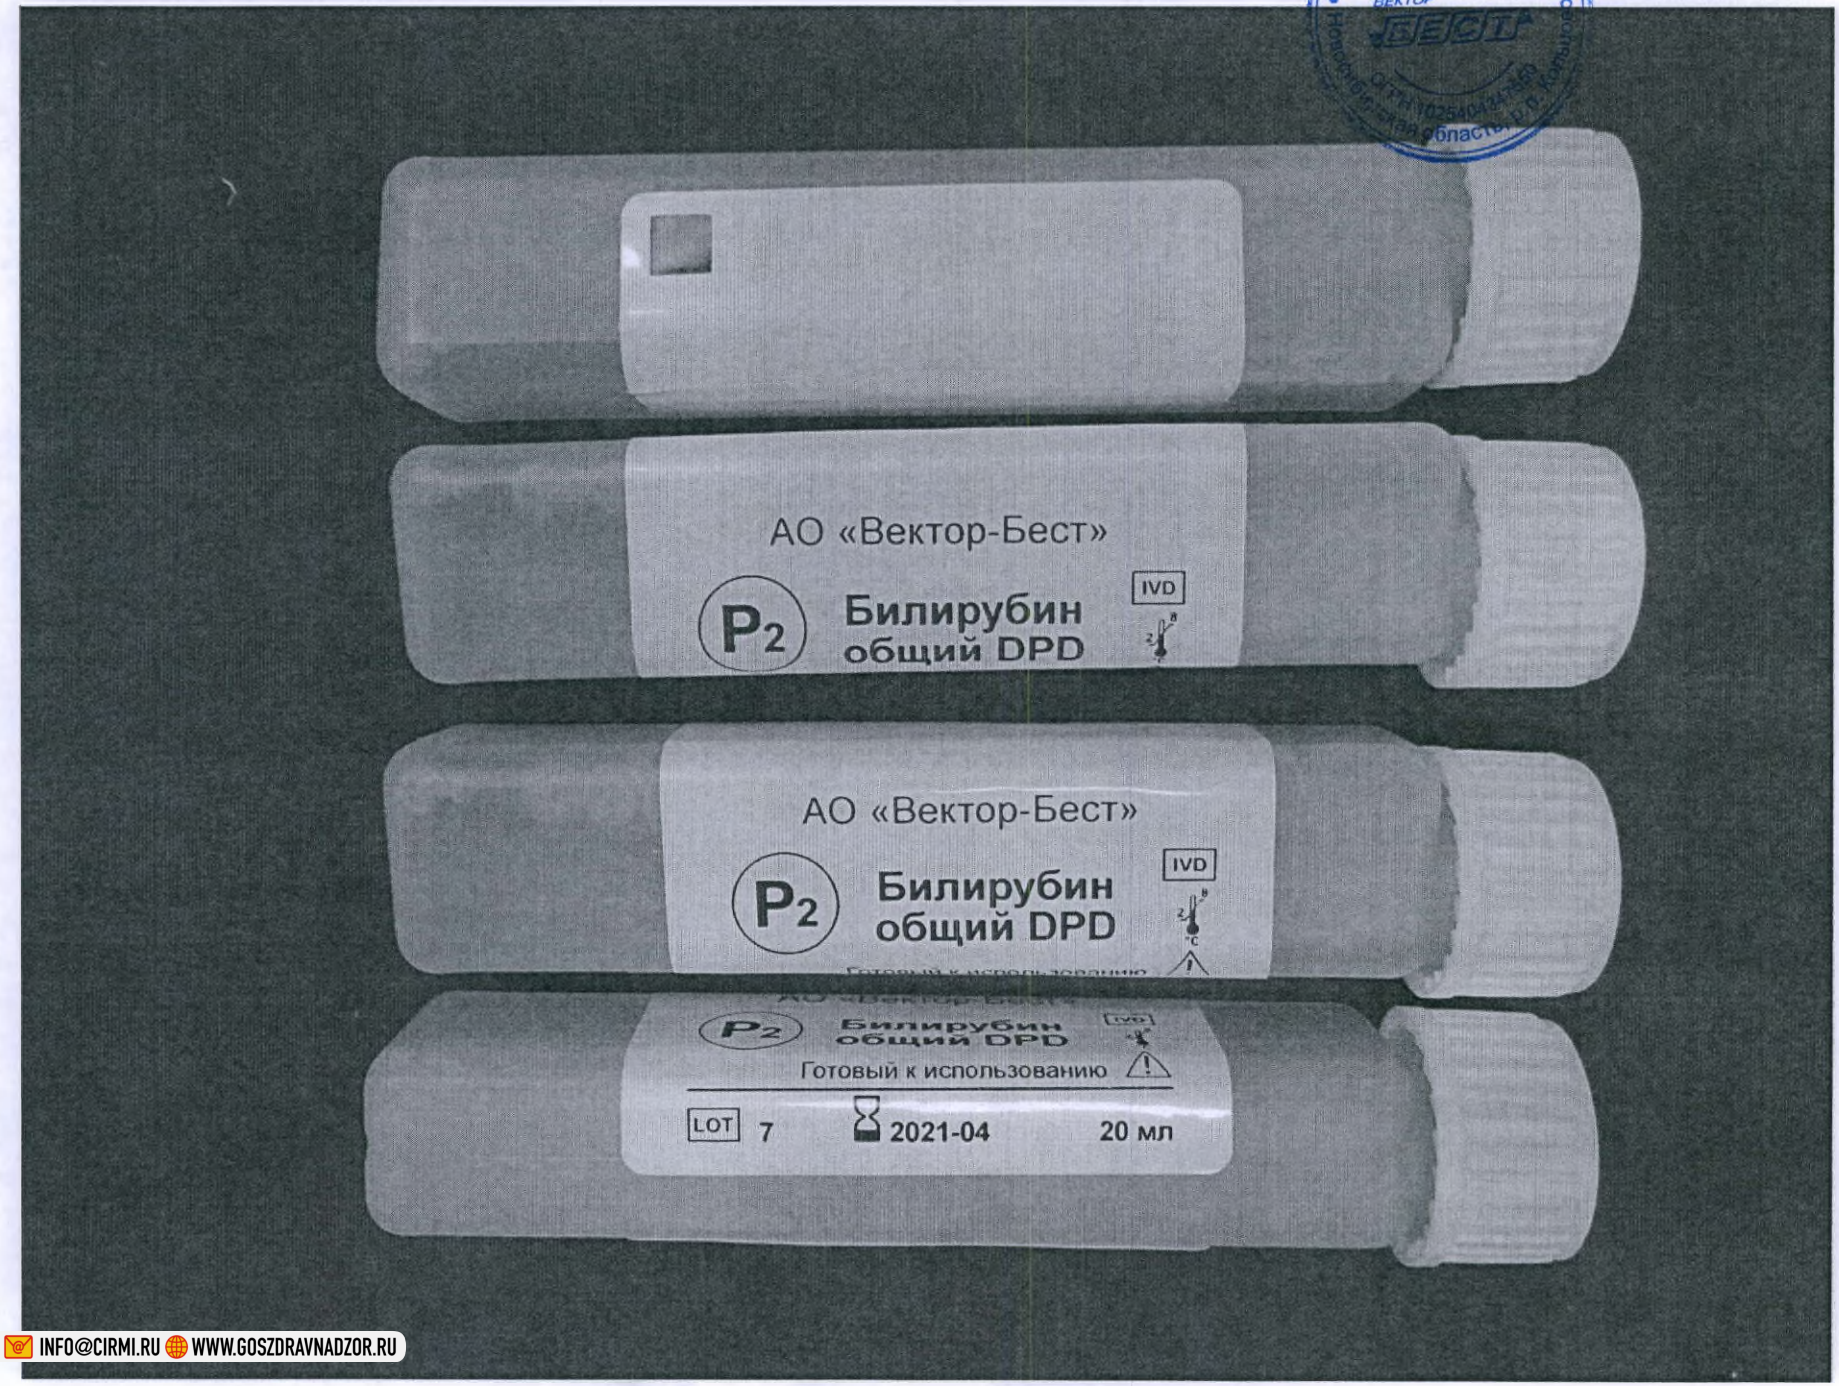

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №3
вариант комплектации 7, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“__” _____ 2020 г.



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №1
вариант комплектации 7, серия 7


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“11” 11 2020 г.

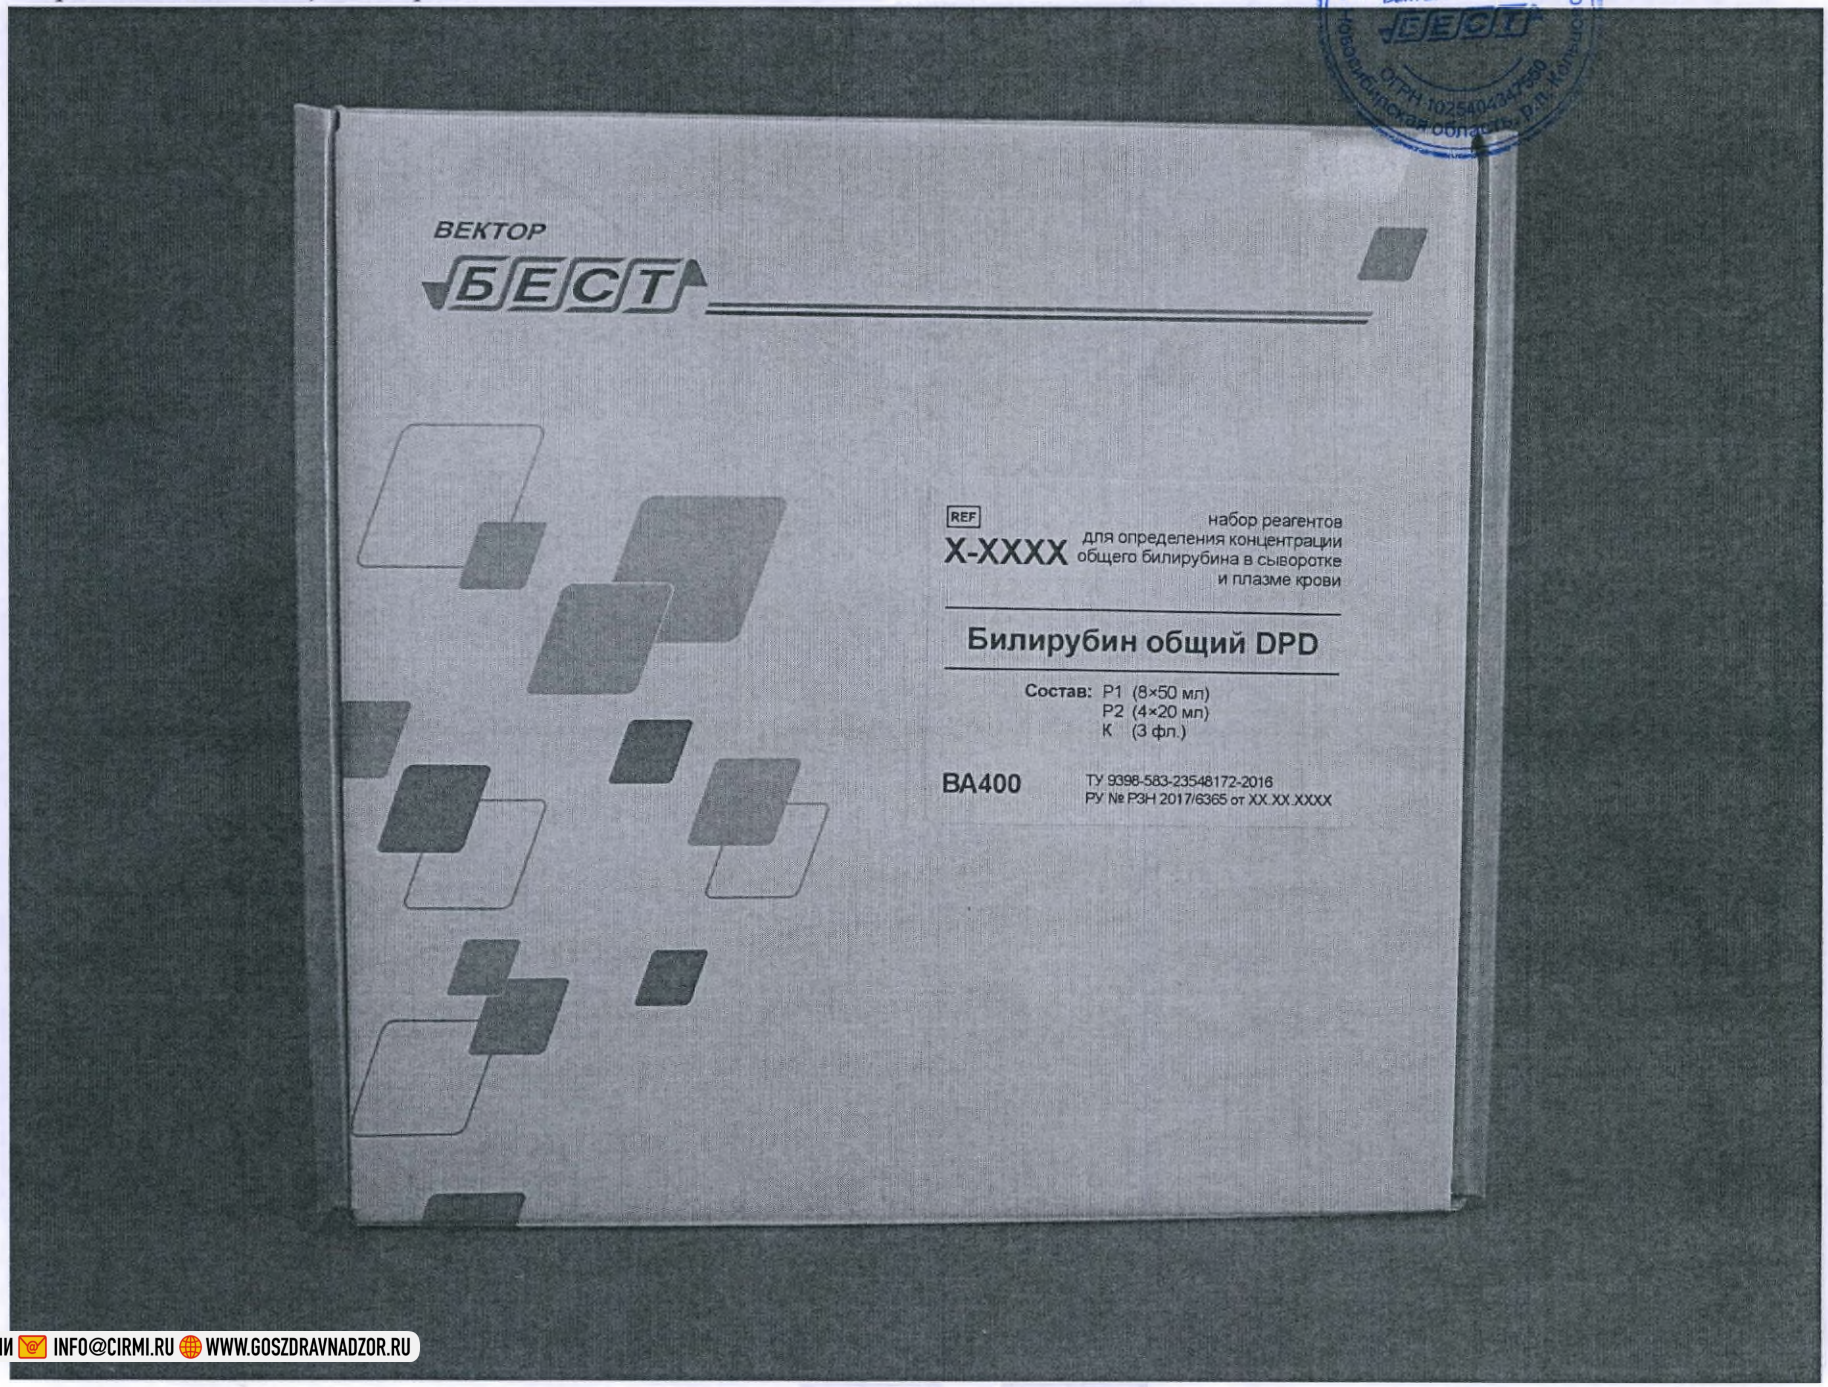

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий DPD” №2
вариант комплектации 7, серия 7

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
11 2020 г.

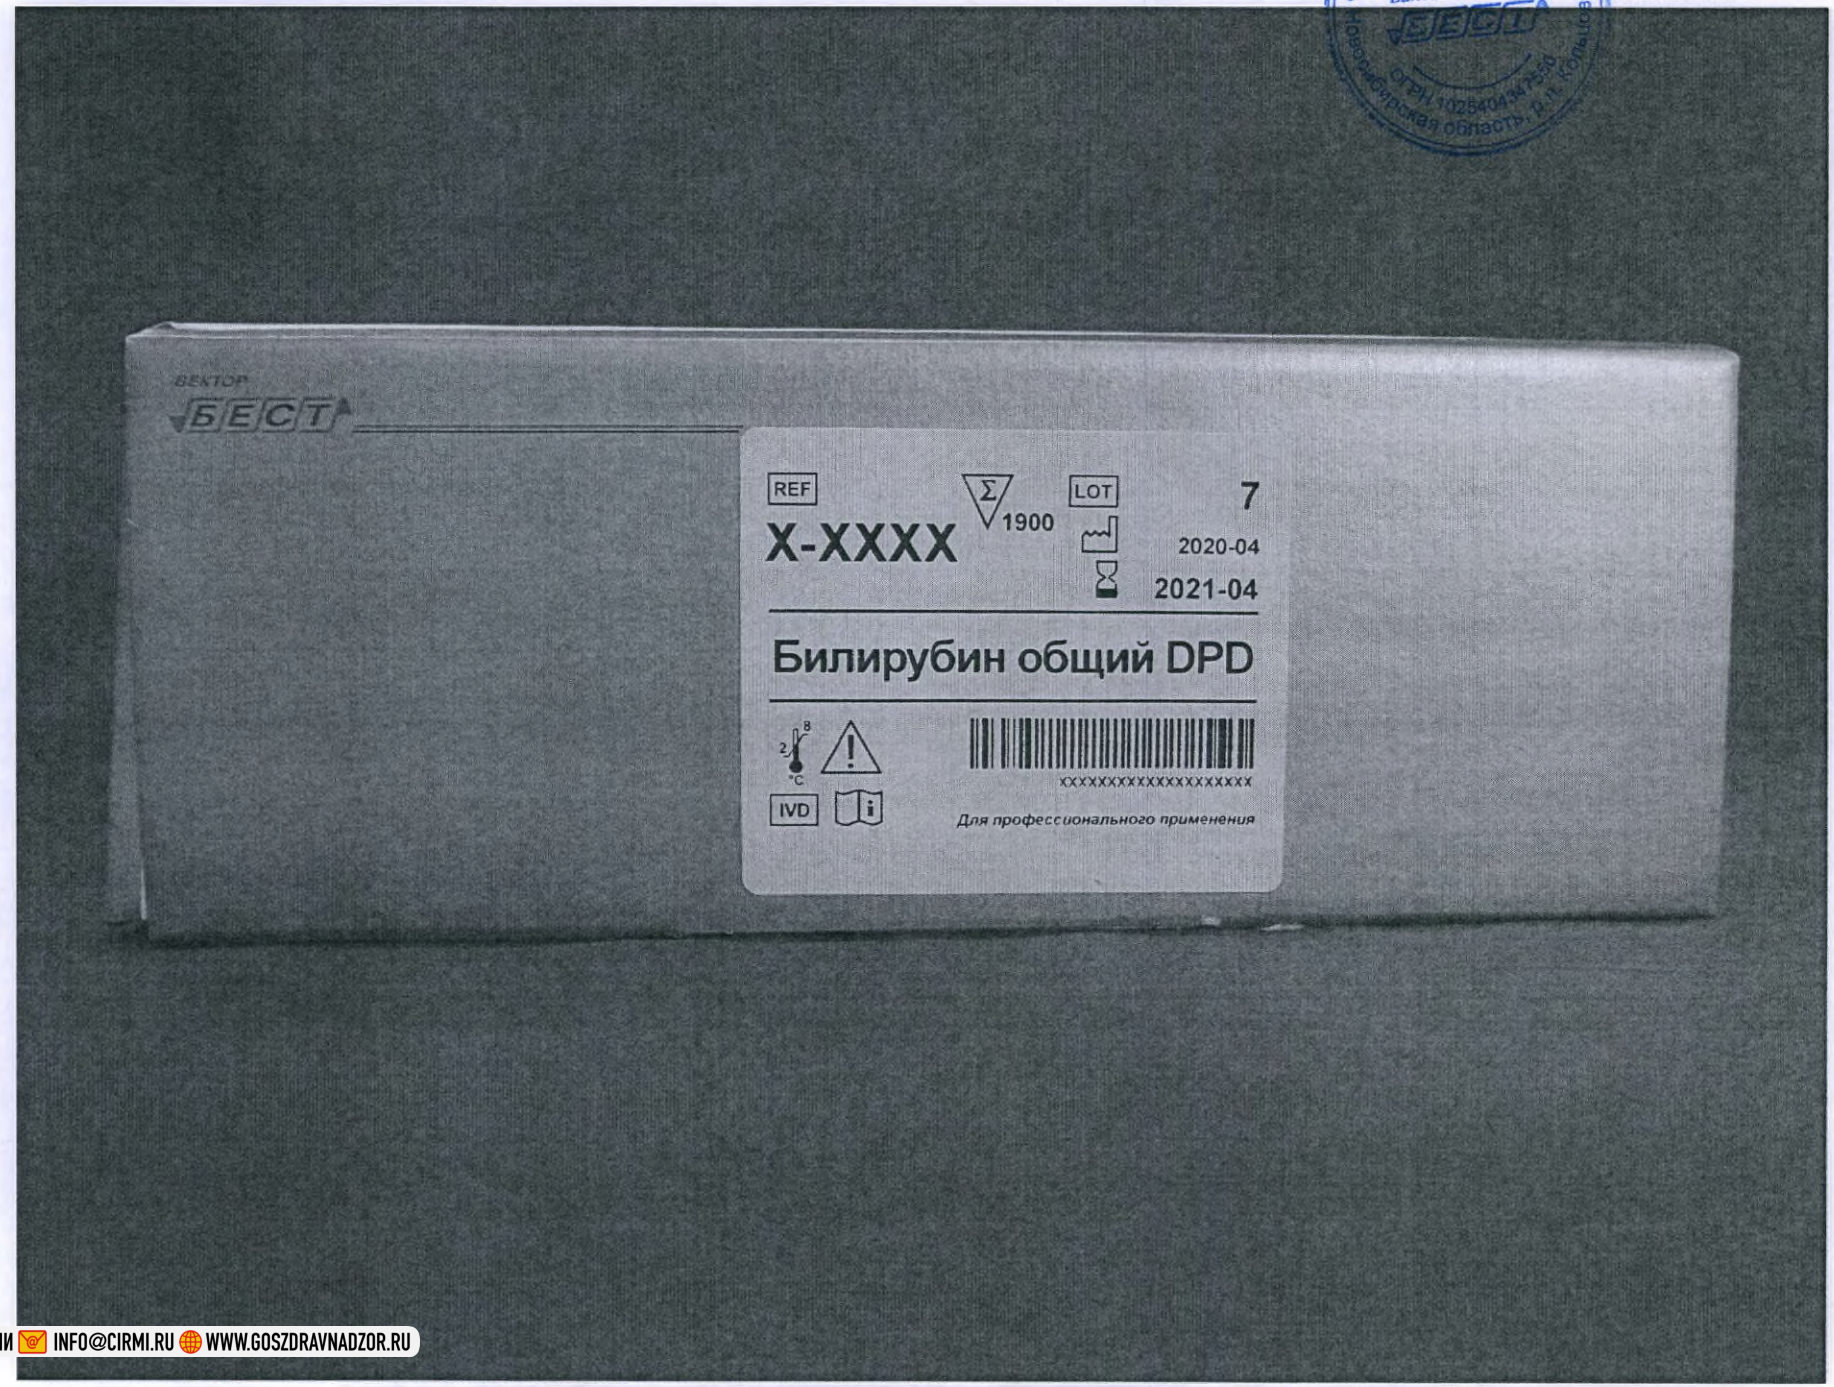

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU