ИнтерЛабСервис

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»


_____ Стариковская И.А.

«___» _____ 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИнтерЛабСервис» 1037700124076 * МОСКВА * 25

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro

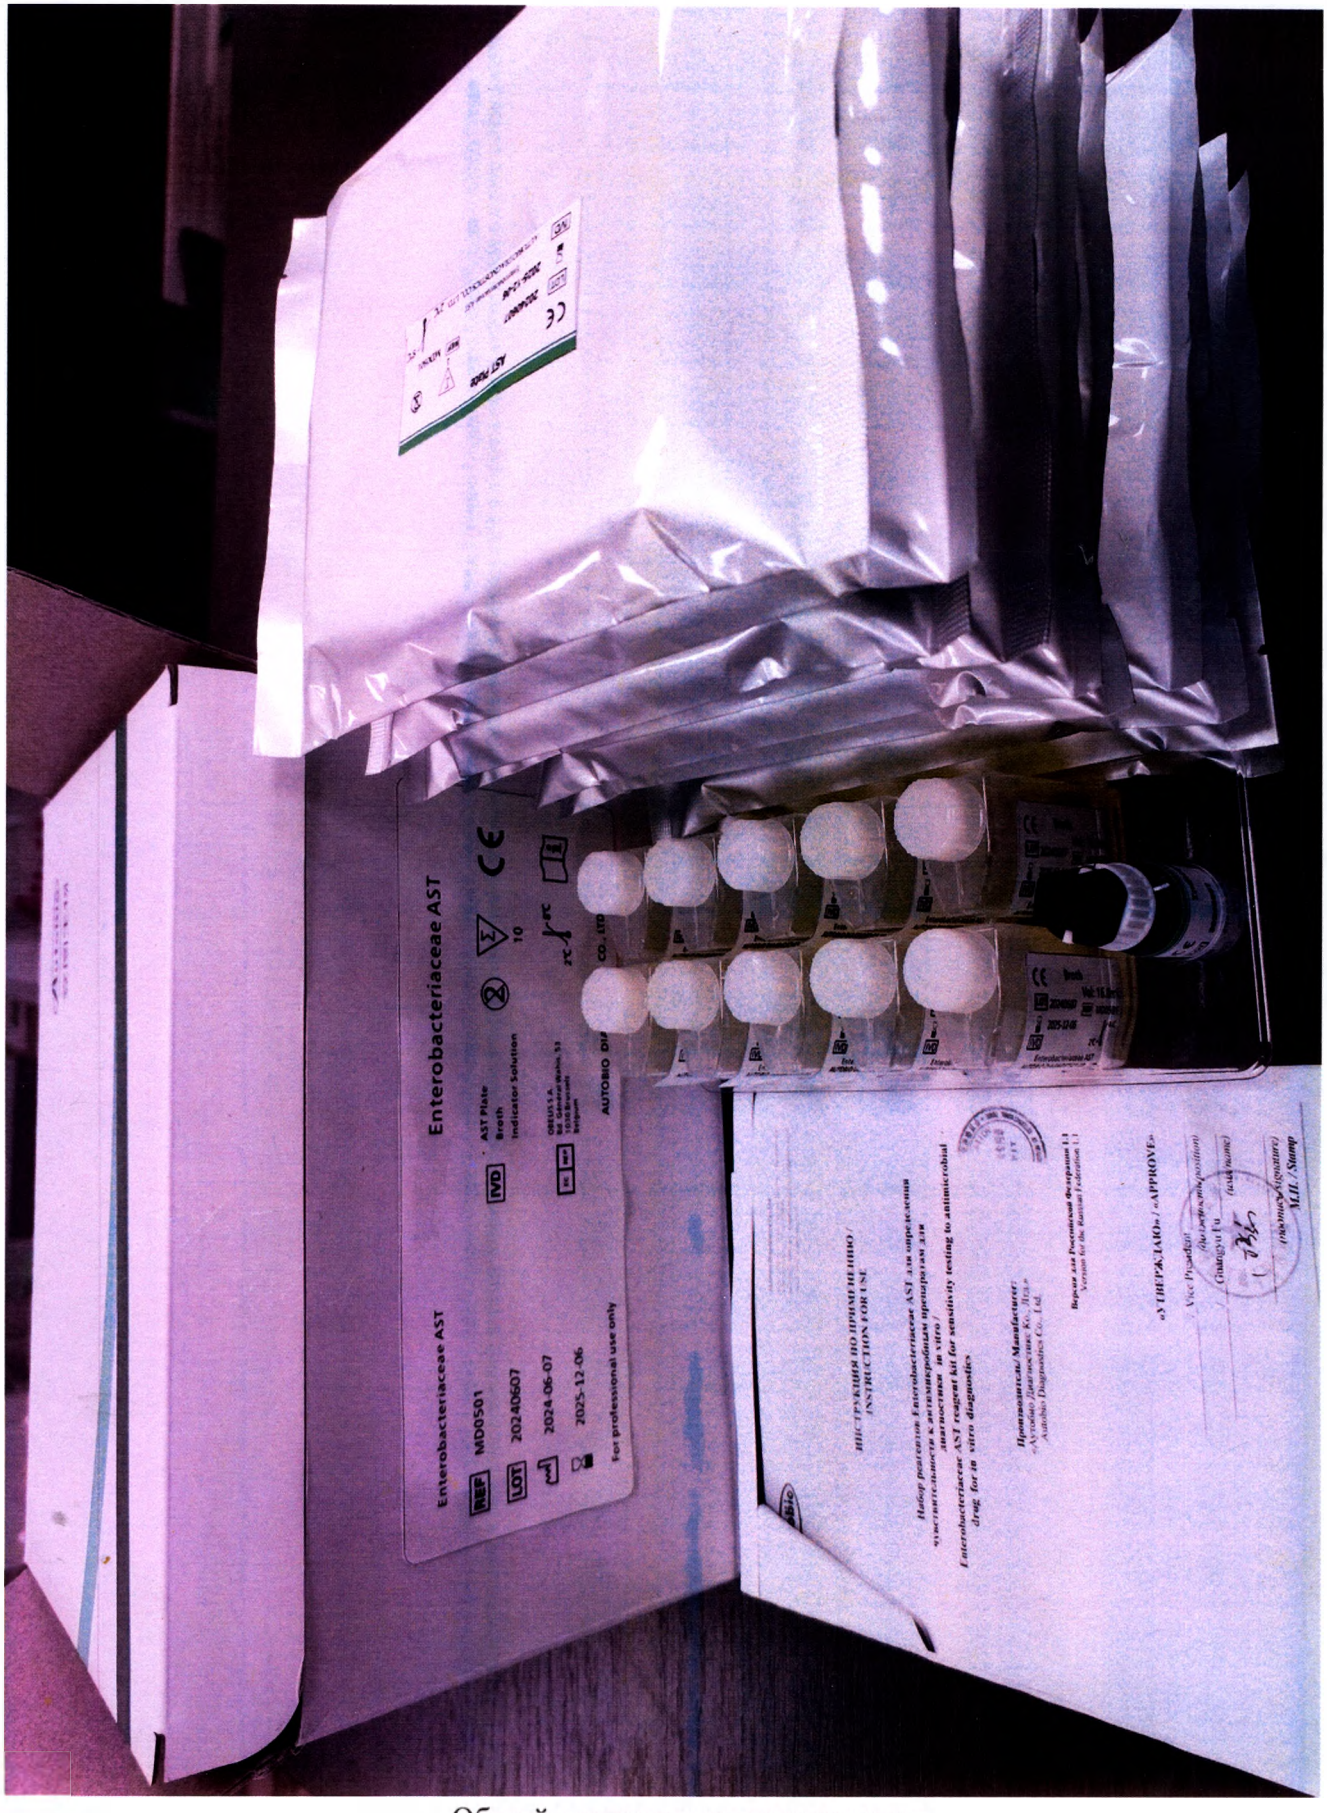

Общий вид медицинского изделия.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro



Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro

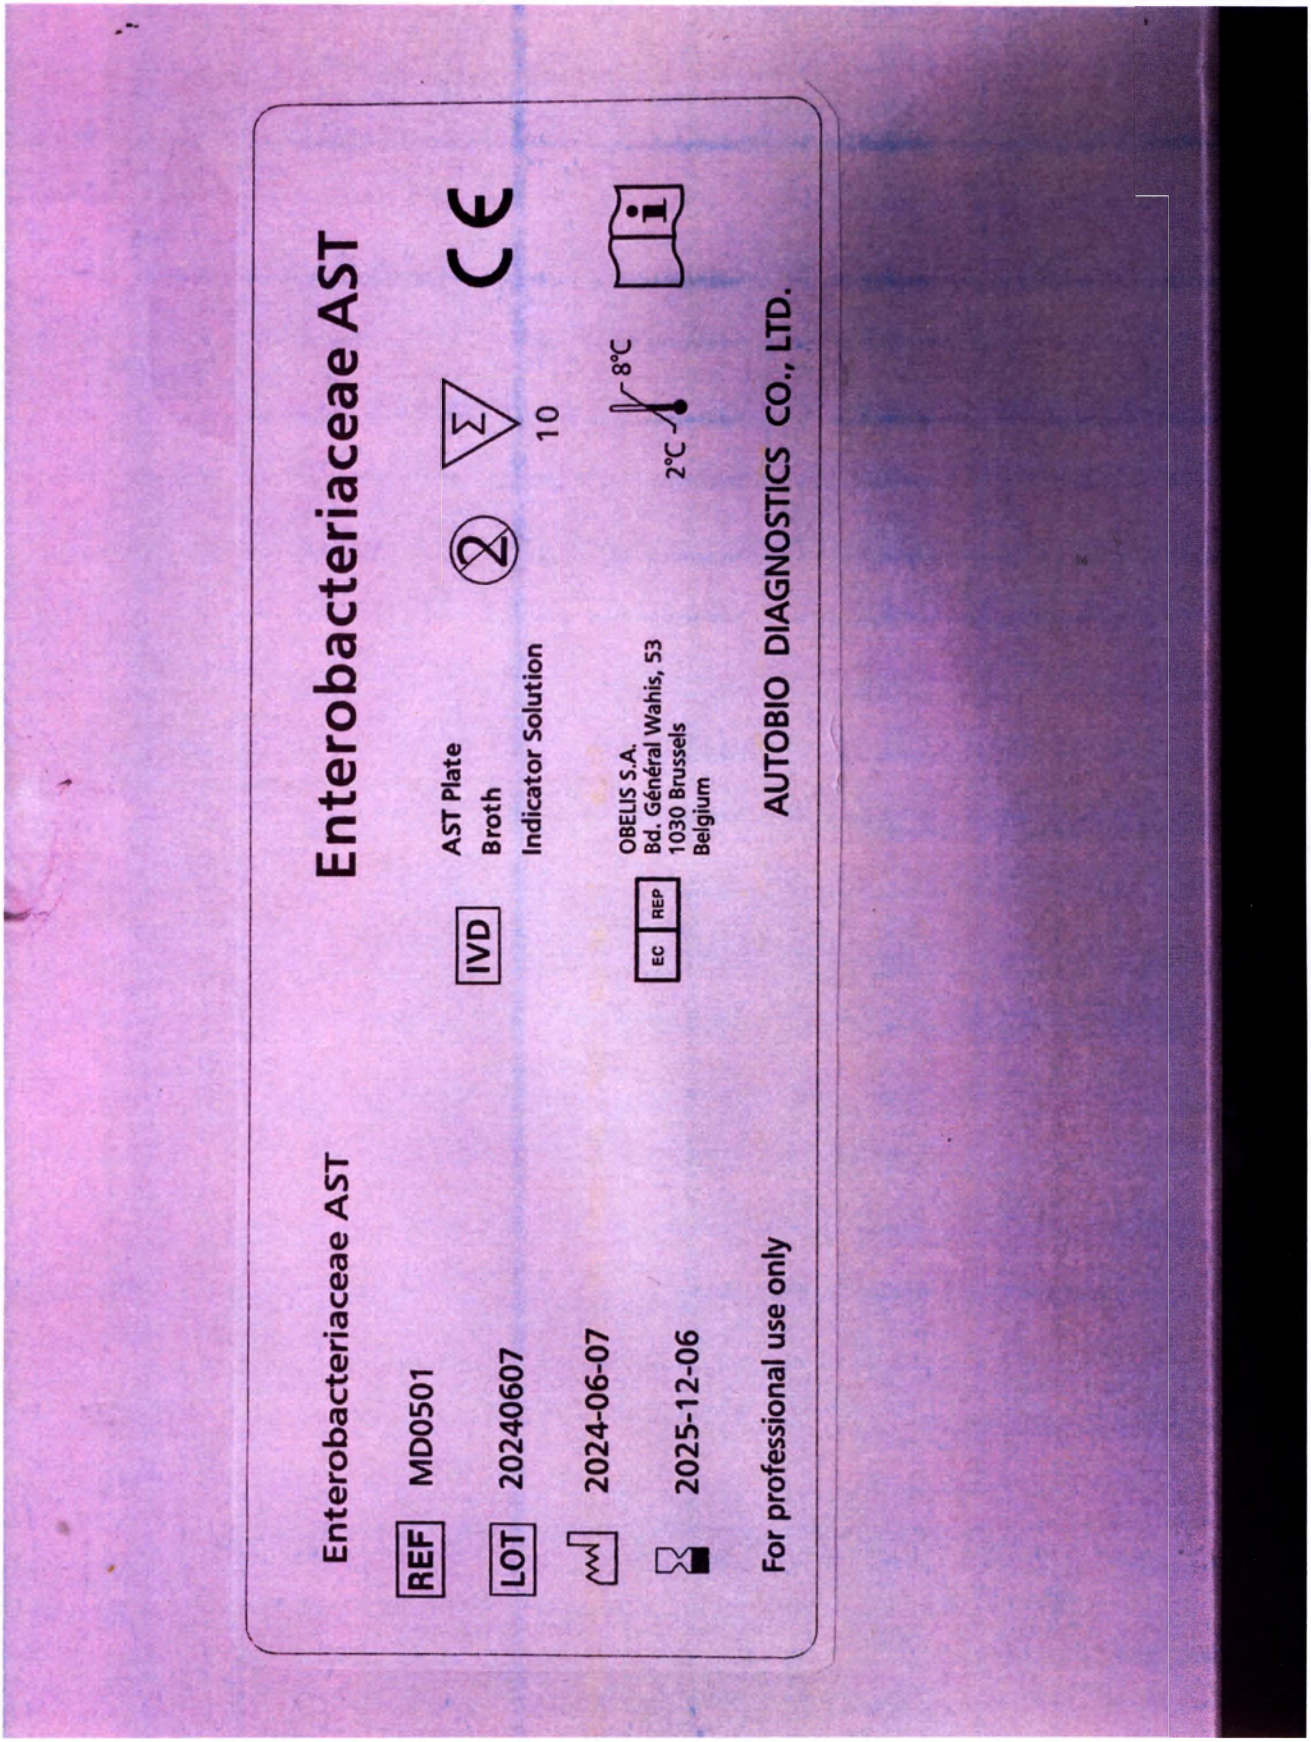

Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro

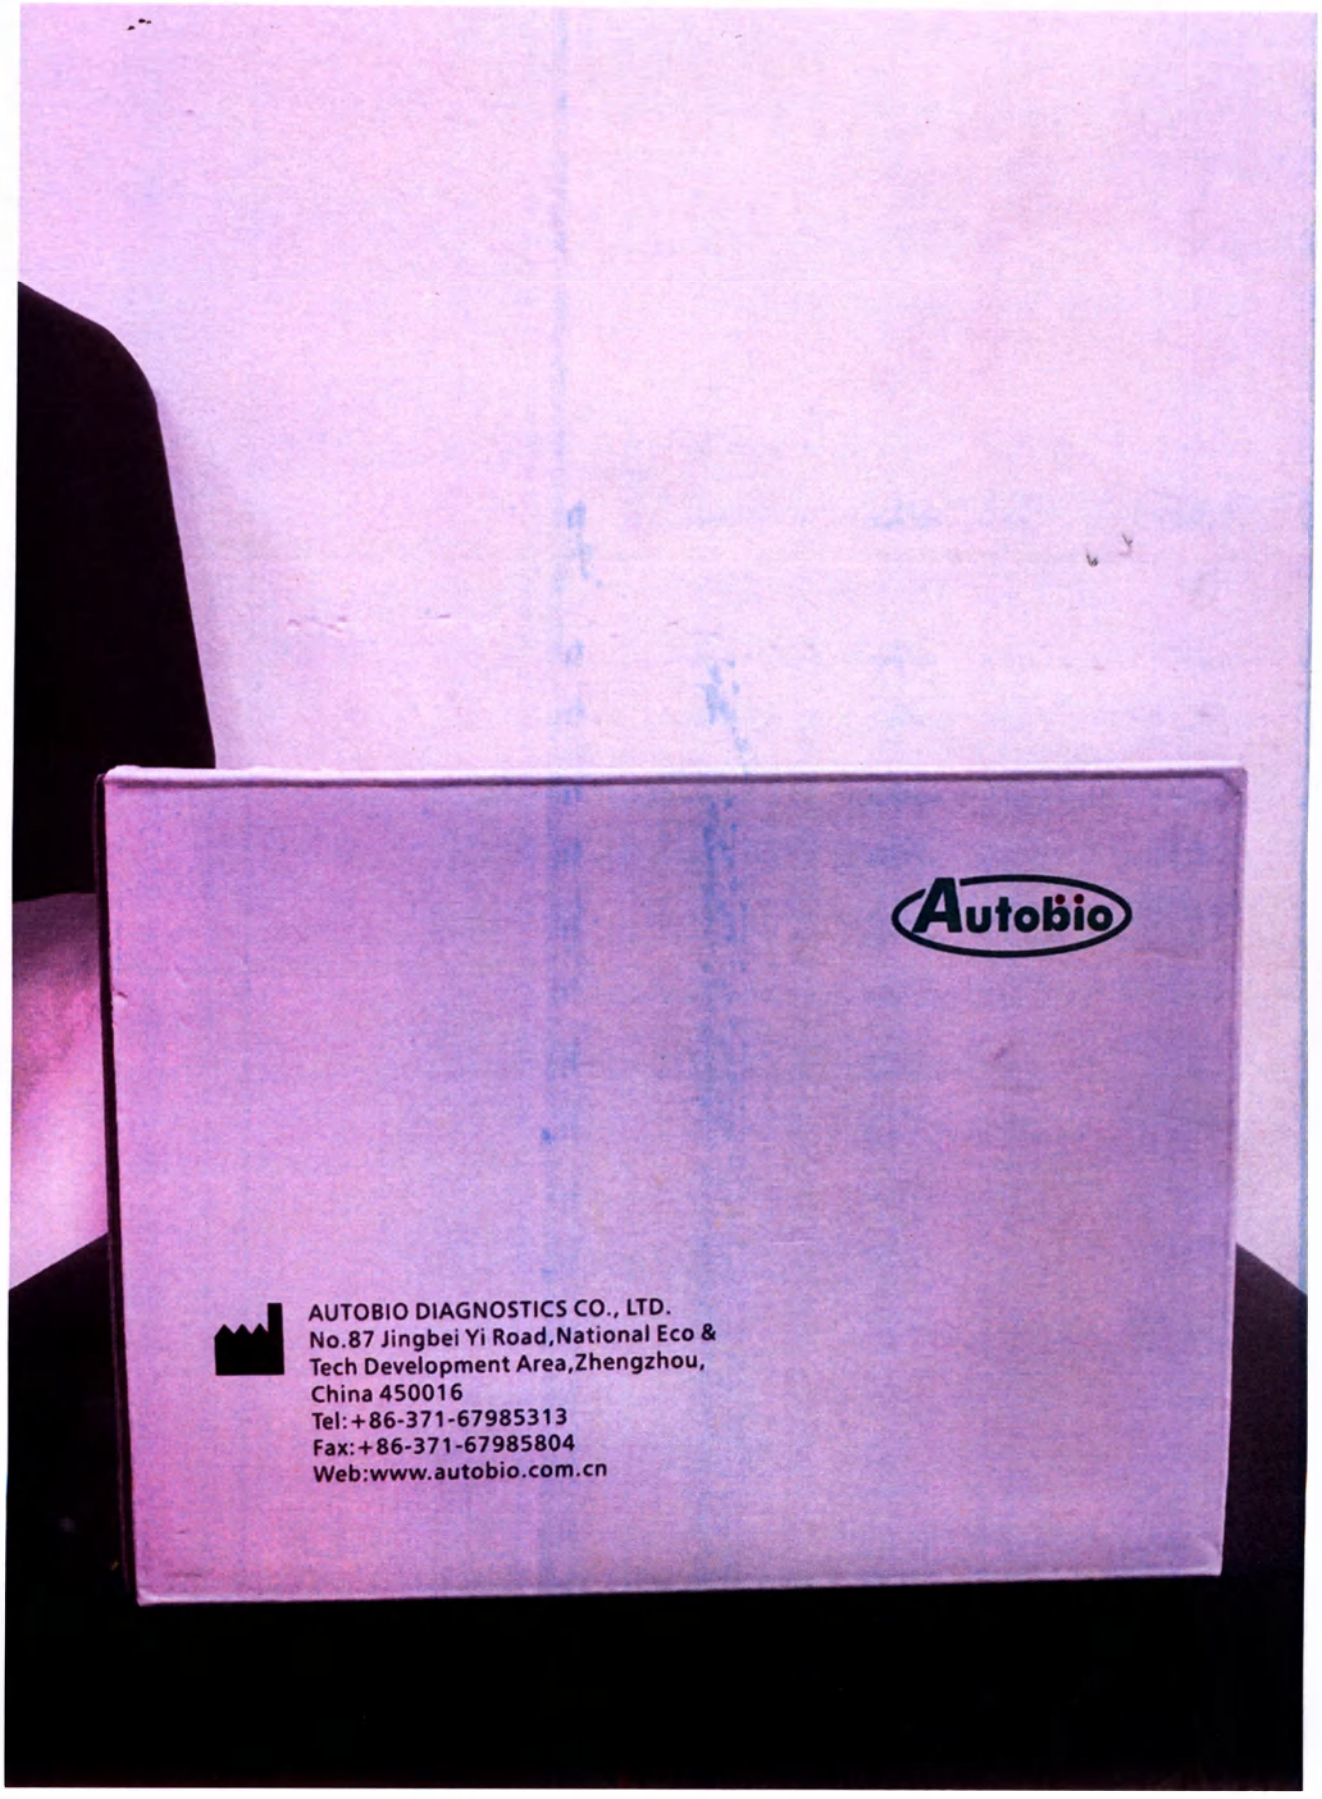

Дополнительная маркировка упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro



Дополнительная маркировка упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


1. **Планшет AST – 10 шт.**



Маркировка и упаковка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Планшет AST

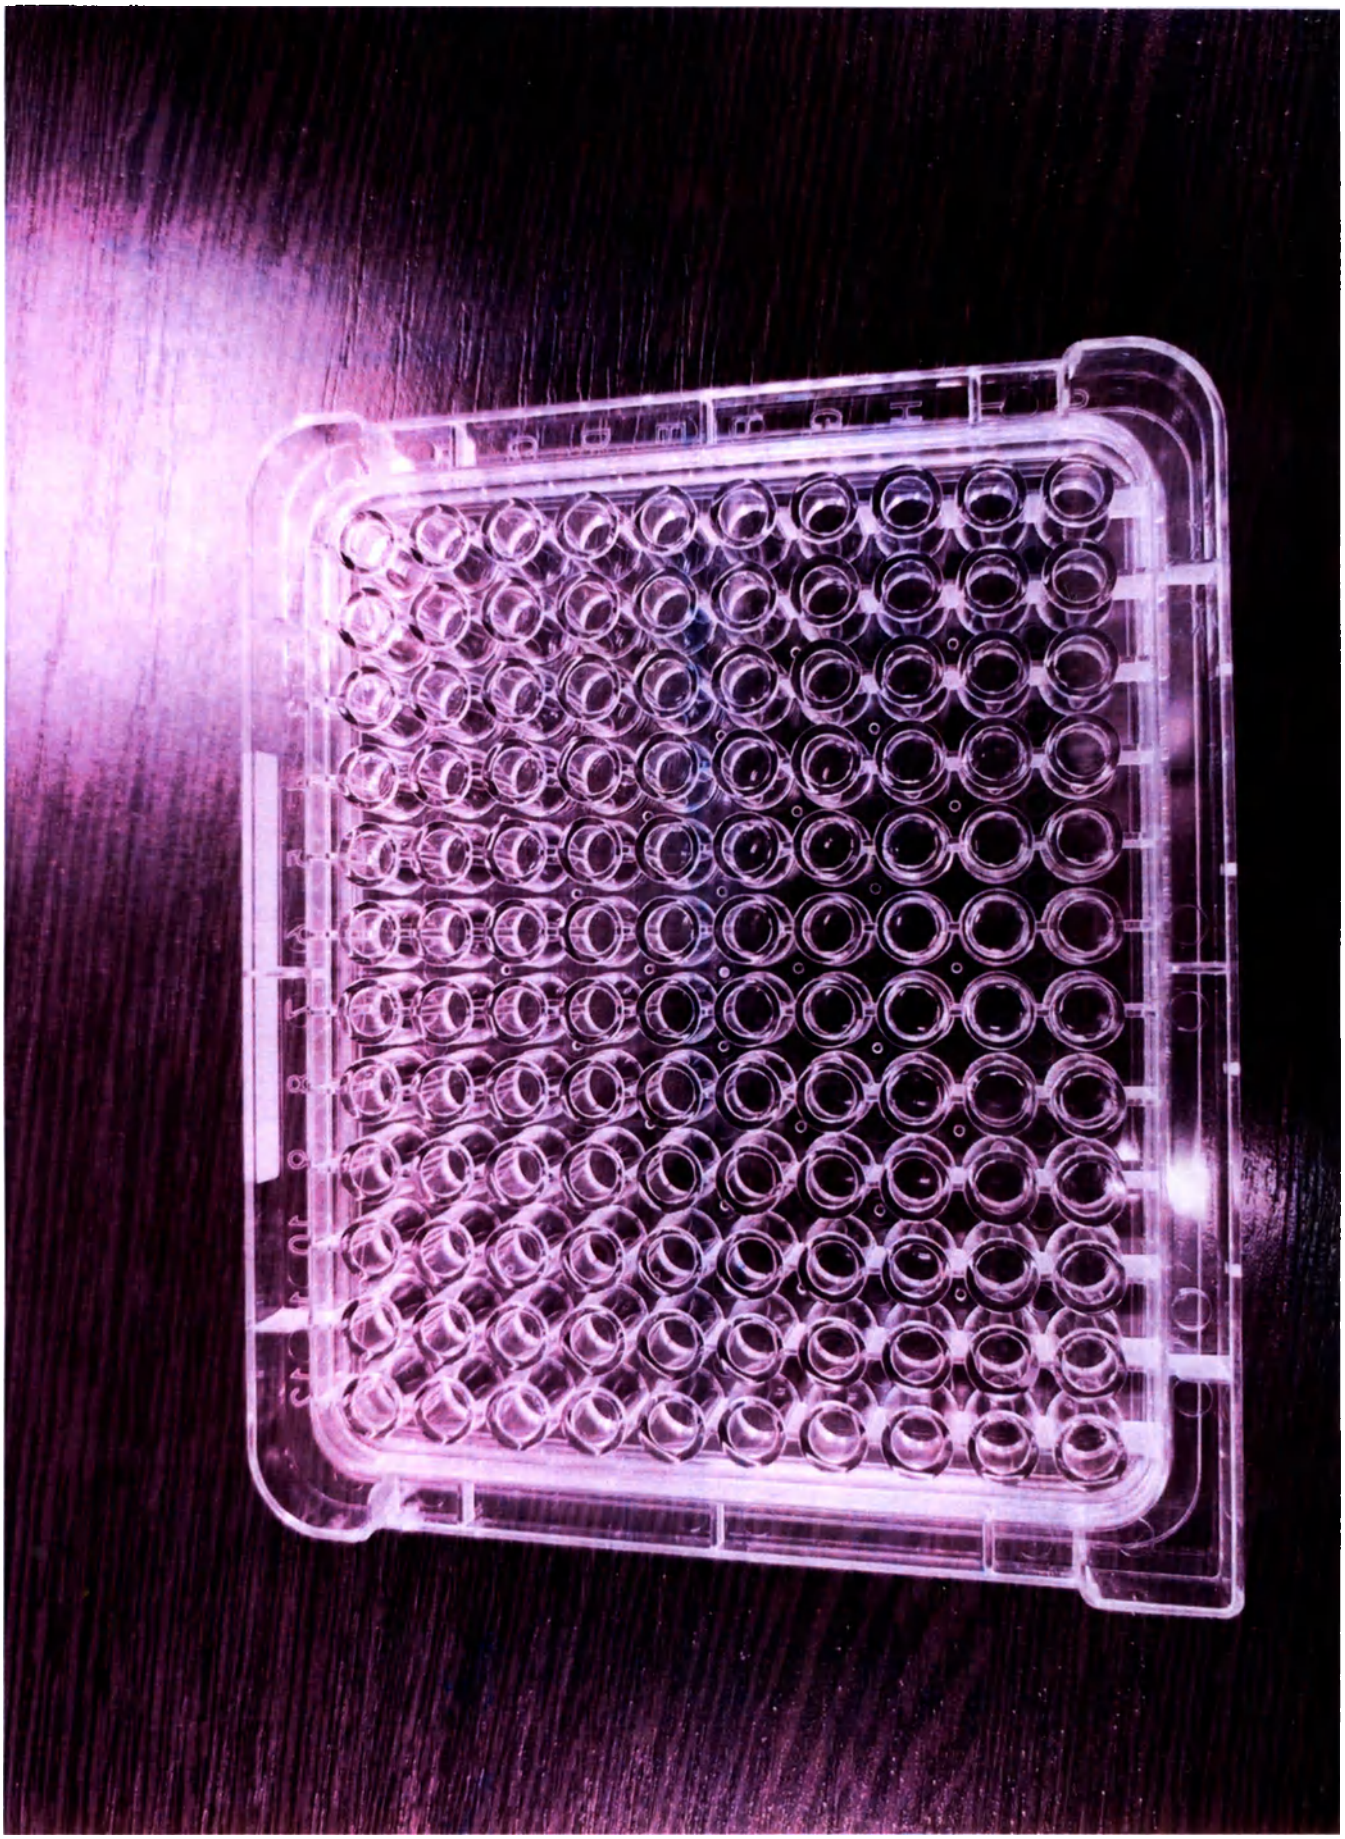

Общий вид

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


2. Бульон 16,0 мл – 10 шт.



Общий вид. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


3.Индикаторный раствор 3,0 мл – 1 шт.

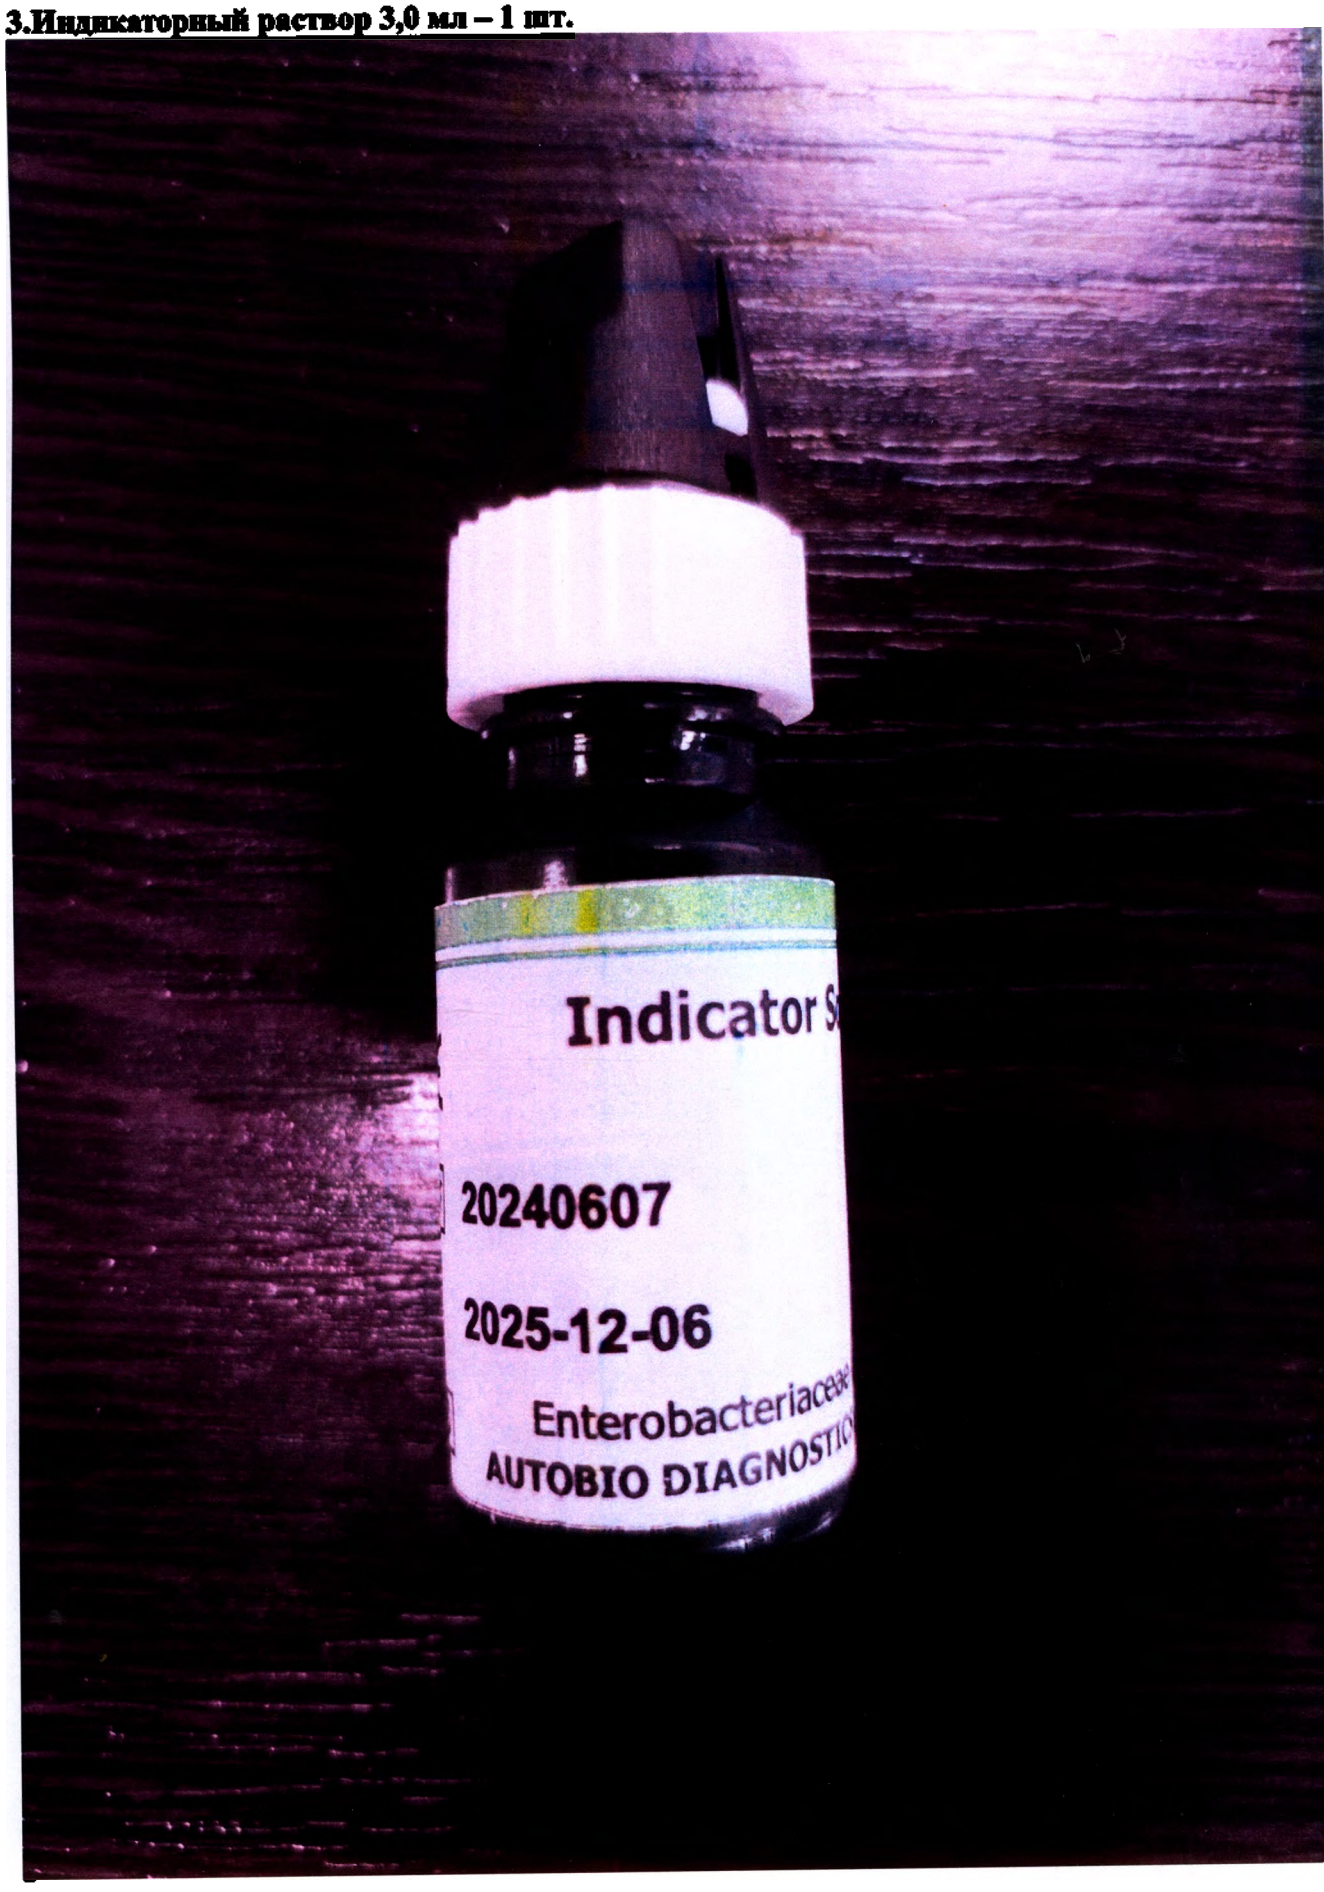

Общий вид. Маркировка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Инструкция по применению – 1 шт.

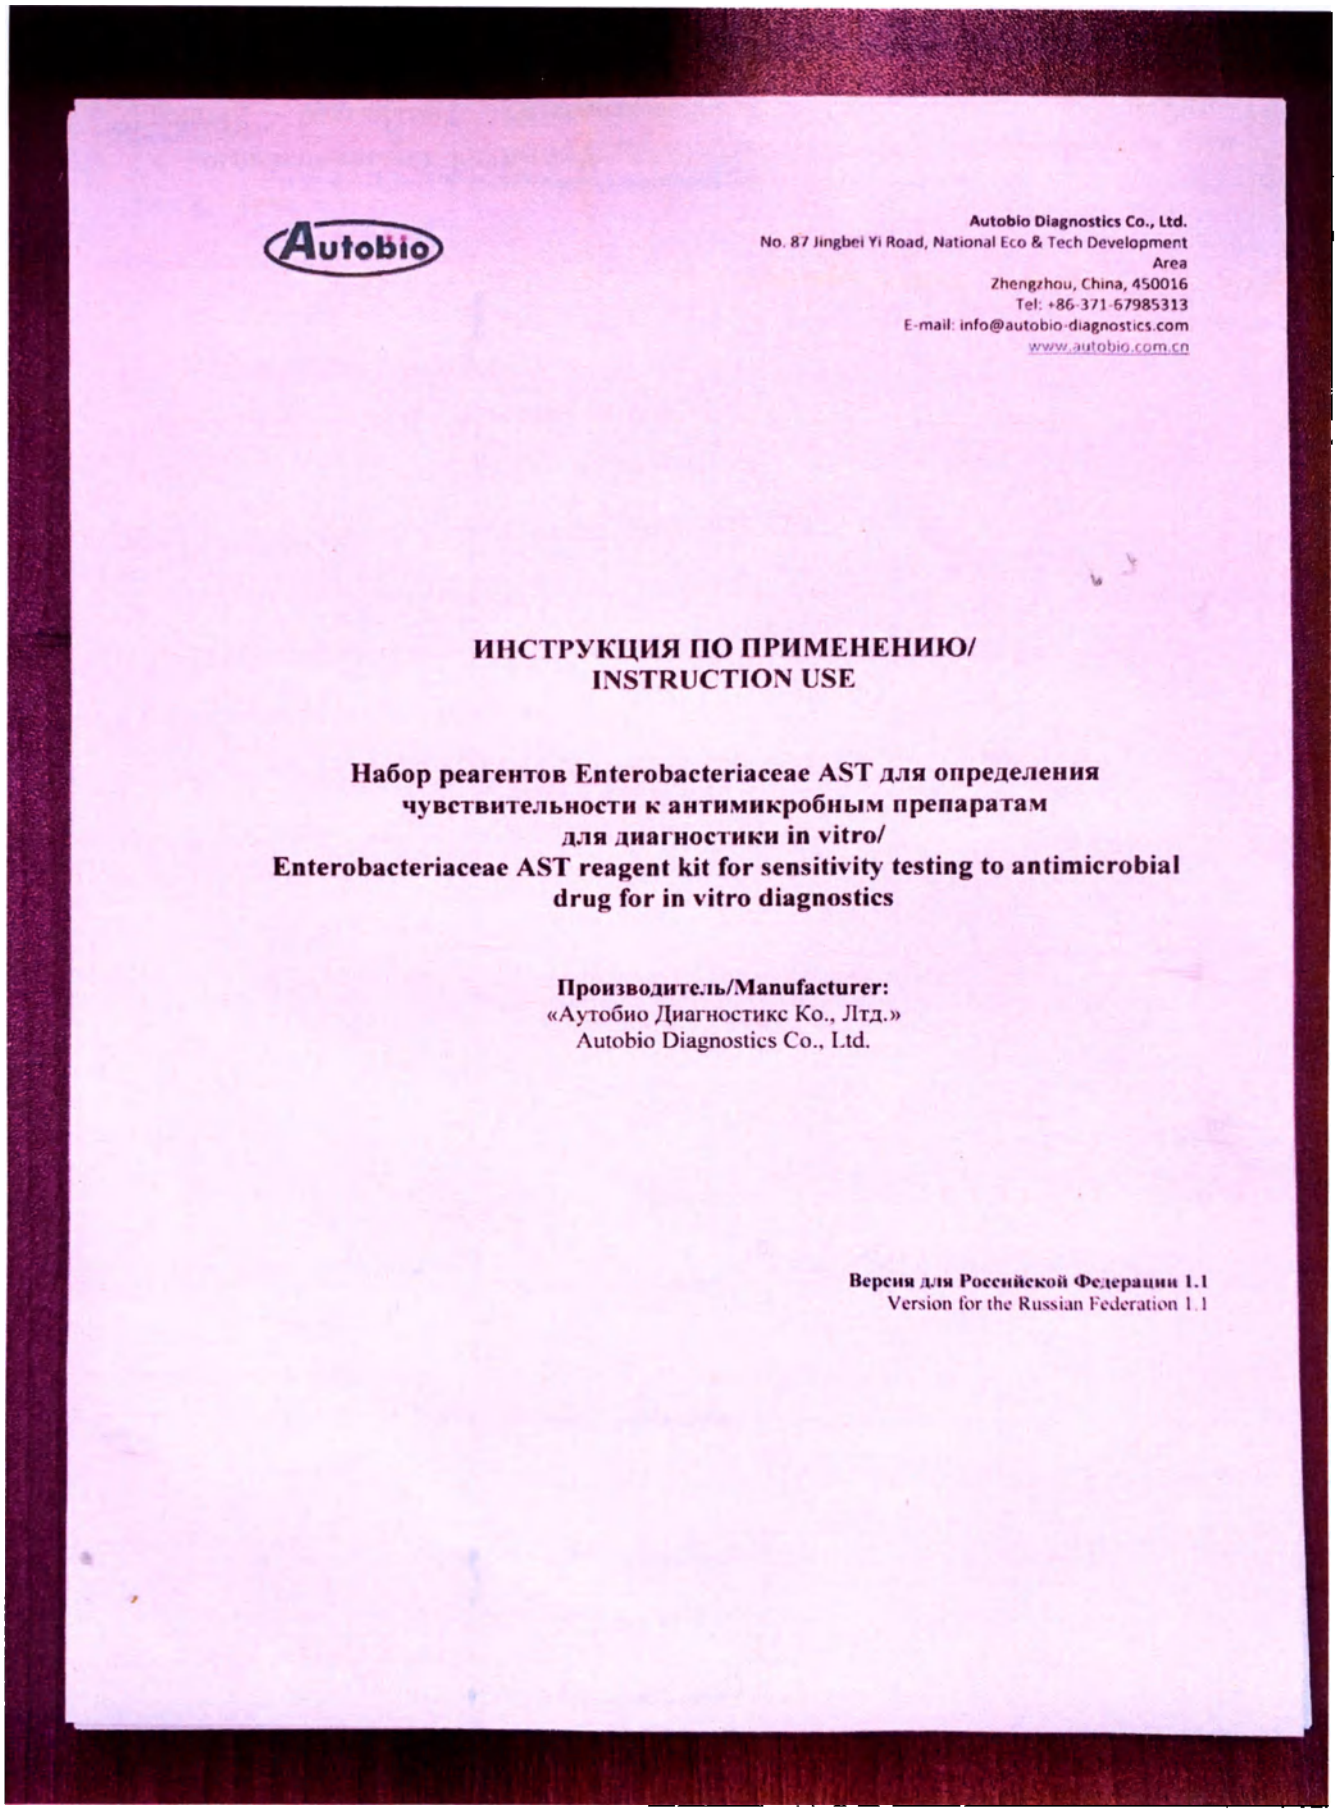

Autobio Diagnostics Co., Ltd.
No. 87 Jingbei Yi Road, National Eco & Tech Development Area
Zhengzhou, China, 450016
Tel: +86-371-67985313
E-mail: info@autobio-diagnostics.com
www.autobio.com.cn

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ/ INSTRUCTION USE

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro/
Enterobacteriaceae AST reagent kit for sensitivity testing to antimicrobial drug for in vitro diagnostics

Производитель/Manufacturer:
«Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»
Autobio Diagnostics Co., Ltd.

Версия для Российской Федерации 1.1
Version for the Russian Federation 1.1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки вторичной (потребительской) упаковки на русском языке

Набор реагентов Enterobacteriaceae AST для определения чувствительности к антимикробным препаратам для диагностики in vitro в составе:

1. Планшет AST - 10 шт.
2. Бульон 16,0 мл - 10 шт.
3. Индикаторный раствор 3,0 мл - 1 шт.
4. Инструкция по применению - 1 шт.

Только для профессионального применения

Производитель: «Аутобио Диагностикс Ко., Лтд.»

Сделано в Китае

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/20980 от _____

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ИЛС», 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664-28-84, info@interlabservice.ru

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 12 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»

_____И.А. Стариковская

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU