«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «БТЛ»

_____ Мираев И.
«__» ноября 2023 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия:**
«Аппарат физиотерапевтический для электролечения многофункциональный BTL-4000 с принадлежностями, модели: BTL-4620 Premium, BTL-4625 Premium, BTL-4620 Smart, BTL-4625 Smart»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ




Общий вид медицинского изделия моделей BTL-4620 Smart, BTL-4625 Smart

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Общий вид медицинского изделия моделей BTL-4620 Premium, BTL-4625 Premium


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## I. Основной состав




1. Блок управления BTL-4620 Smart, BTL-4625 Smart

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

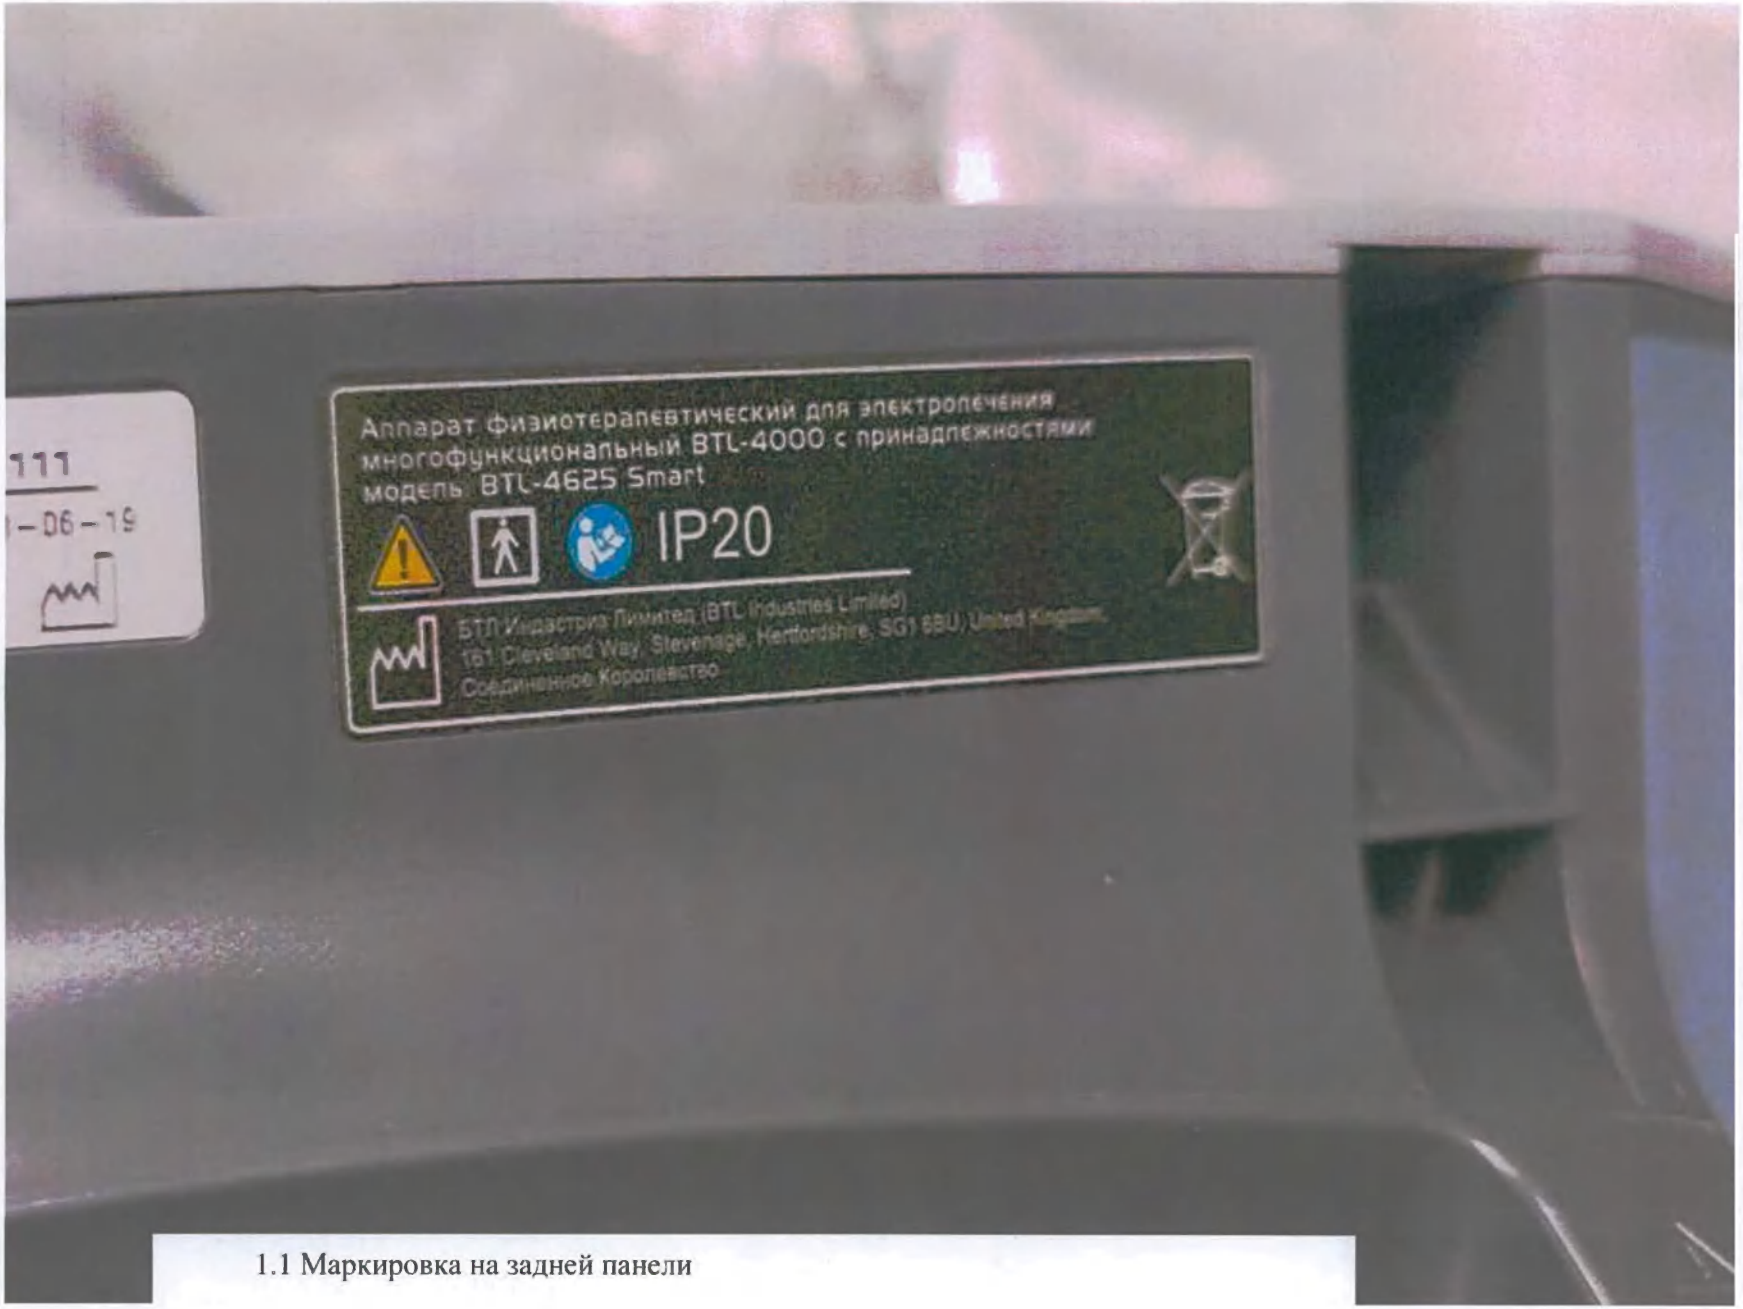



1.1 Маркировка на задней панели

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




2. Блок управления BTL-4620 Premium, BTL-4625 Premium

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

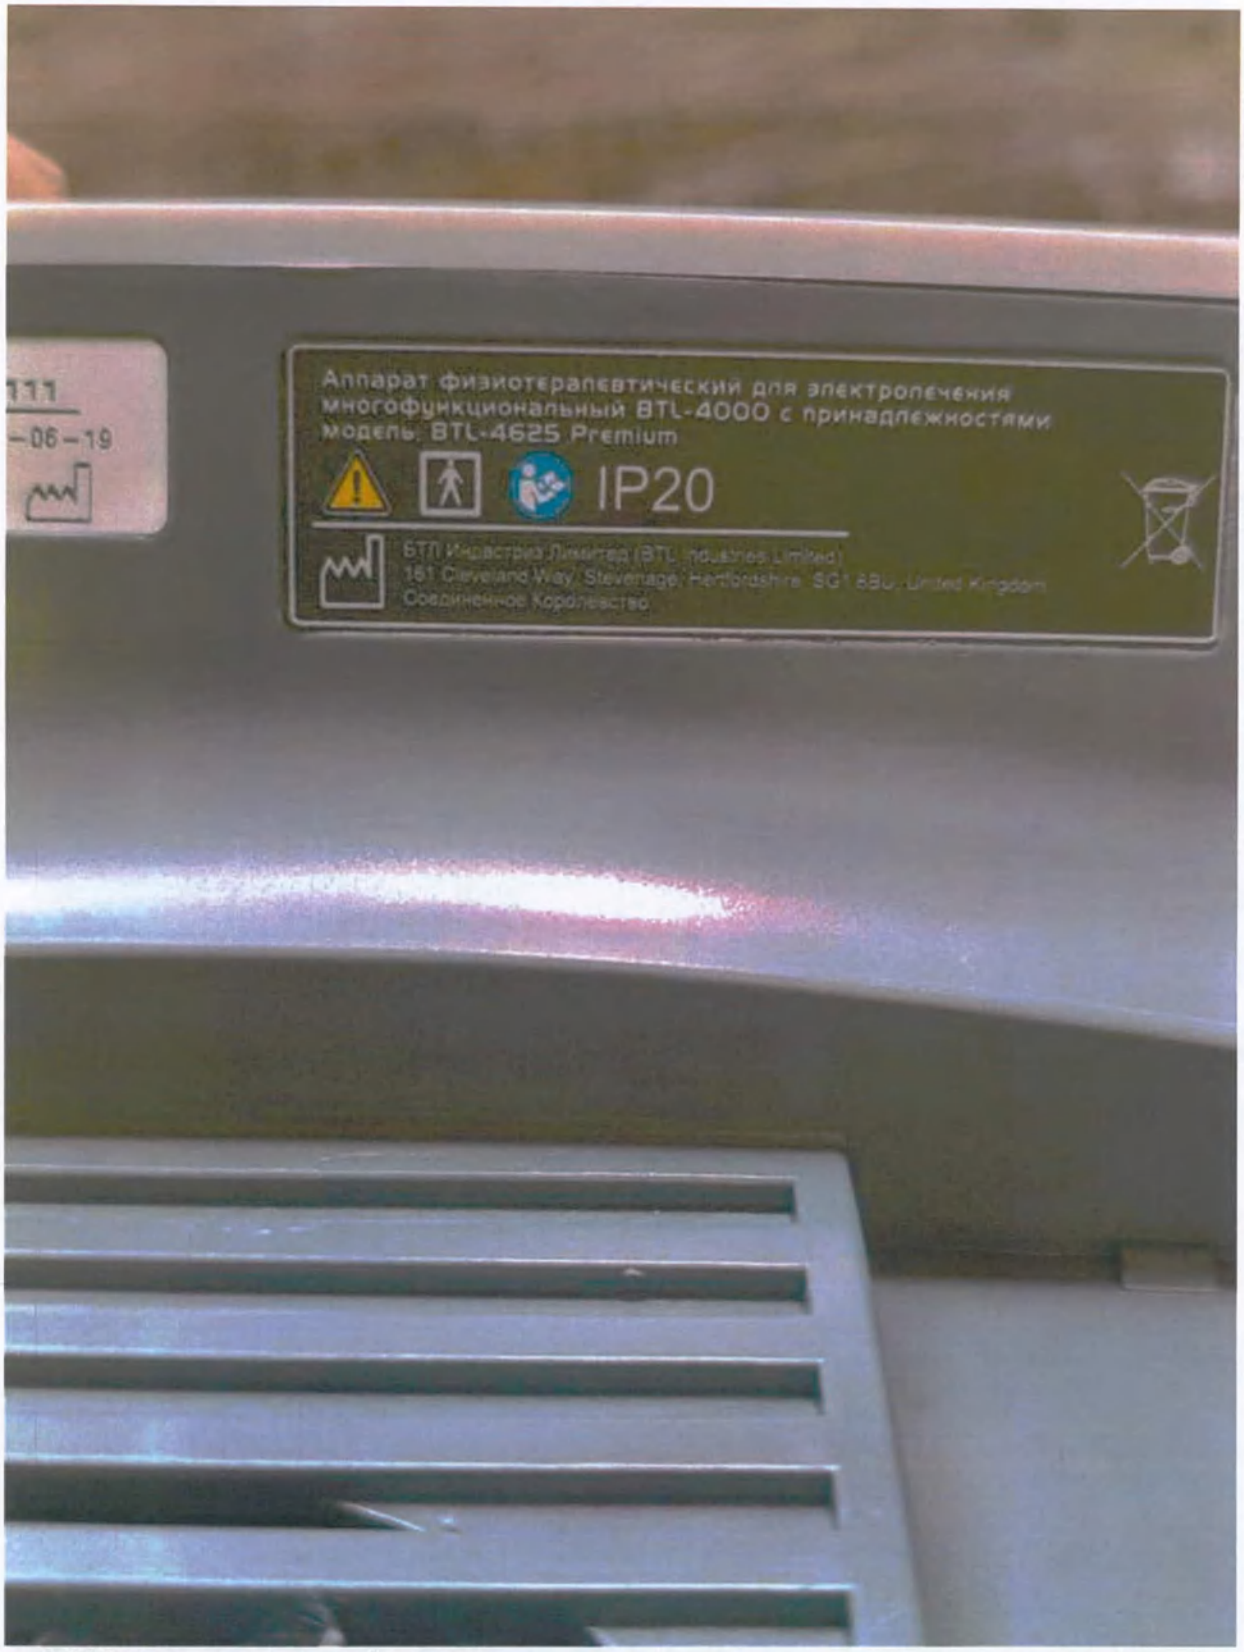


2.1 Маркировка на задней панели

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



3. Кабель питания (1 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




4. Адаптер производства MeanWell (1 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



5. Стилус для сенсорного экрана (1 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ BTL-4000 С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, МОДЕЛИ:**

**BTL-4620 PREMIUM**

**BTL-4625 PREMIUM**

**BTL-4620 SMART**

**BTL-4625 SMART**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6. Руководство пользователя (1 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



7. Фиксирующий ремешок для кабеля питания (не более 10 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



8. Плоский резиновый электрод (70 × 50 мм) (не более 50 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





8.1 Маркировка плоского резинового электрода (70 × 50 мм)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



9. Плоский резиновый электрод (120 × 80 мм) (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

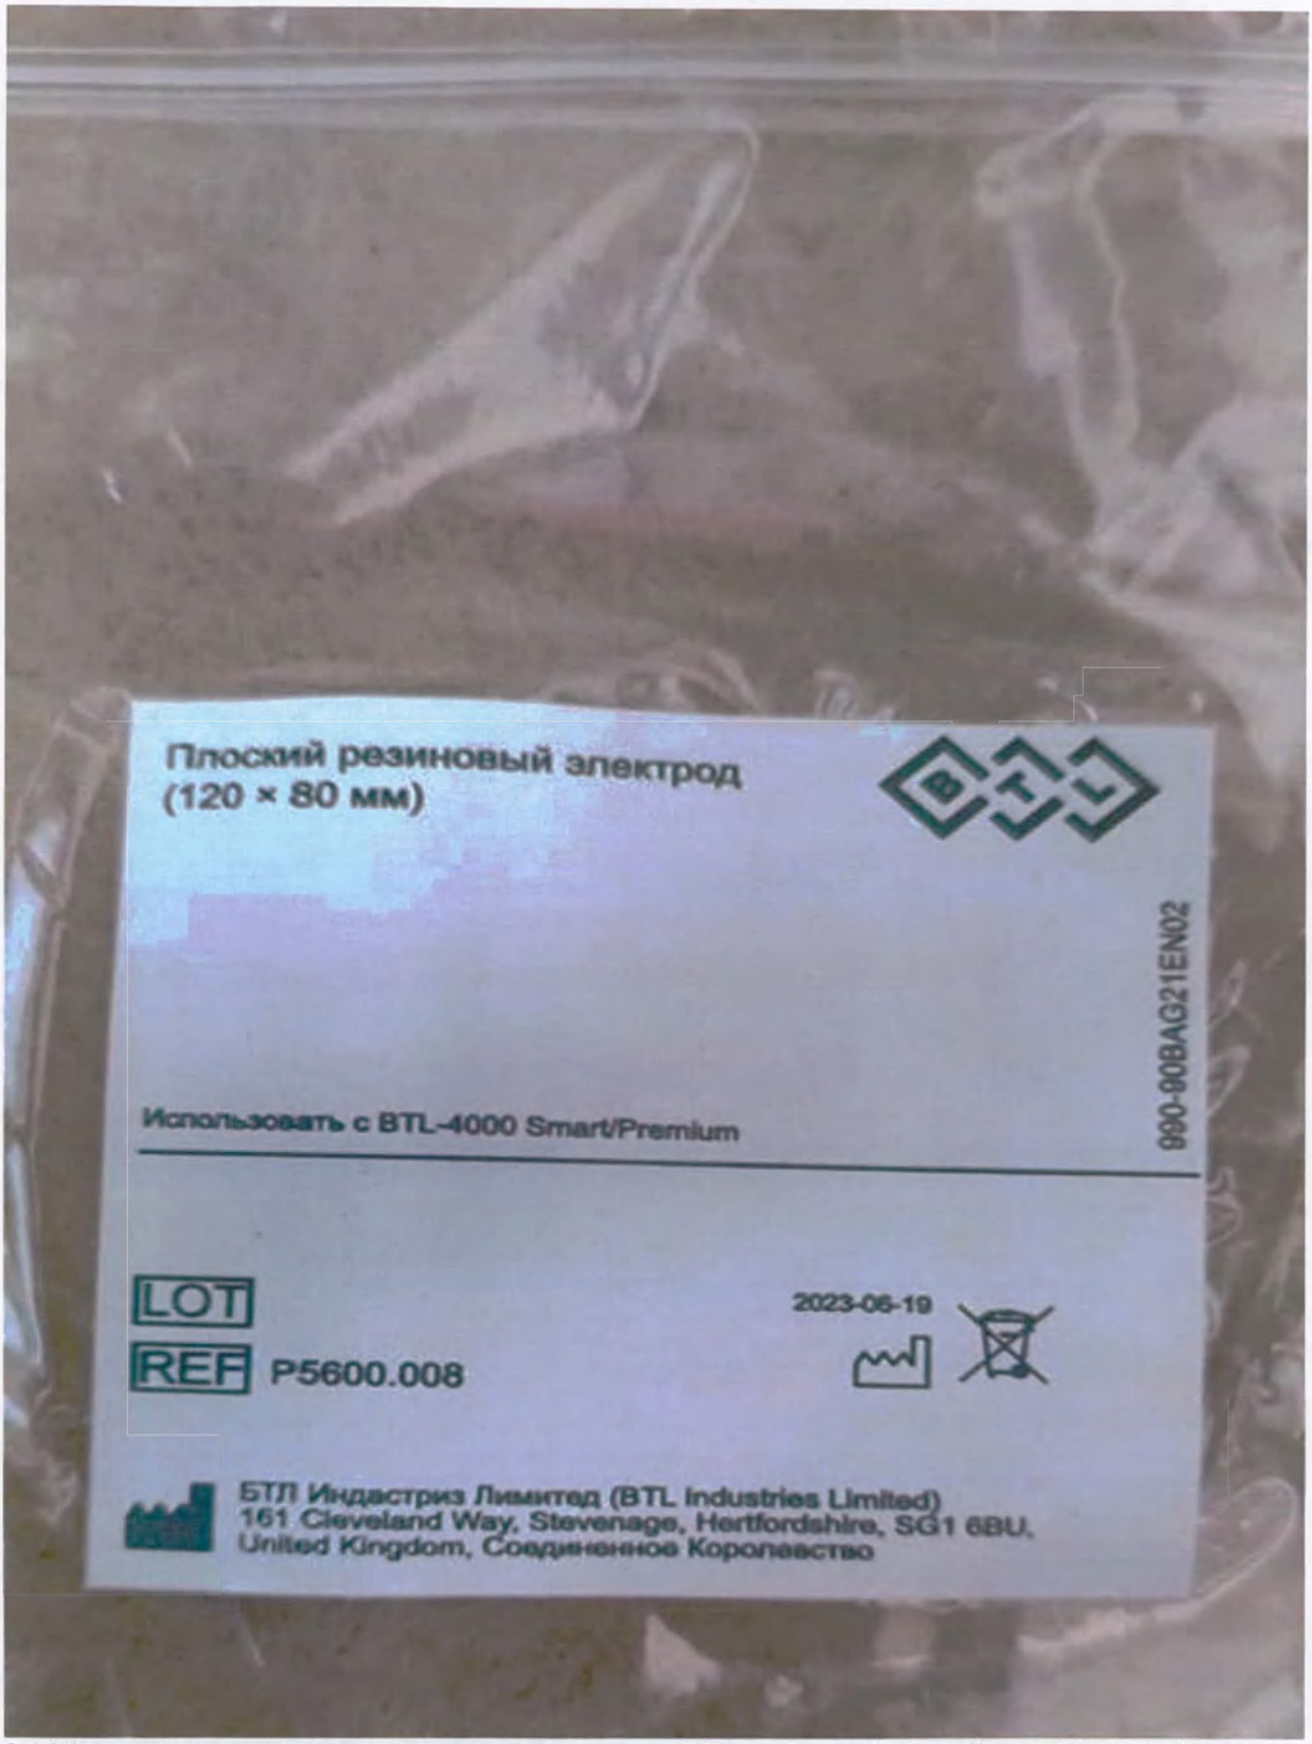



9.1 Маркировка плоского резинового электрода (120 × 80 мм) (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



10. Губковое покрытие для электродов (70 × 55 мм) (не более 50 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

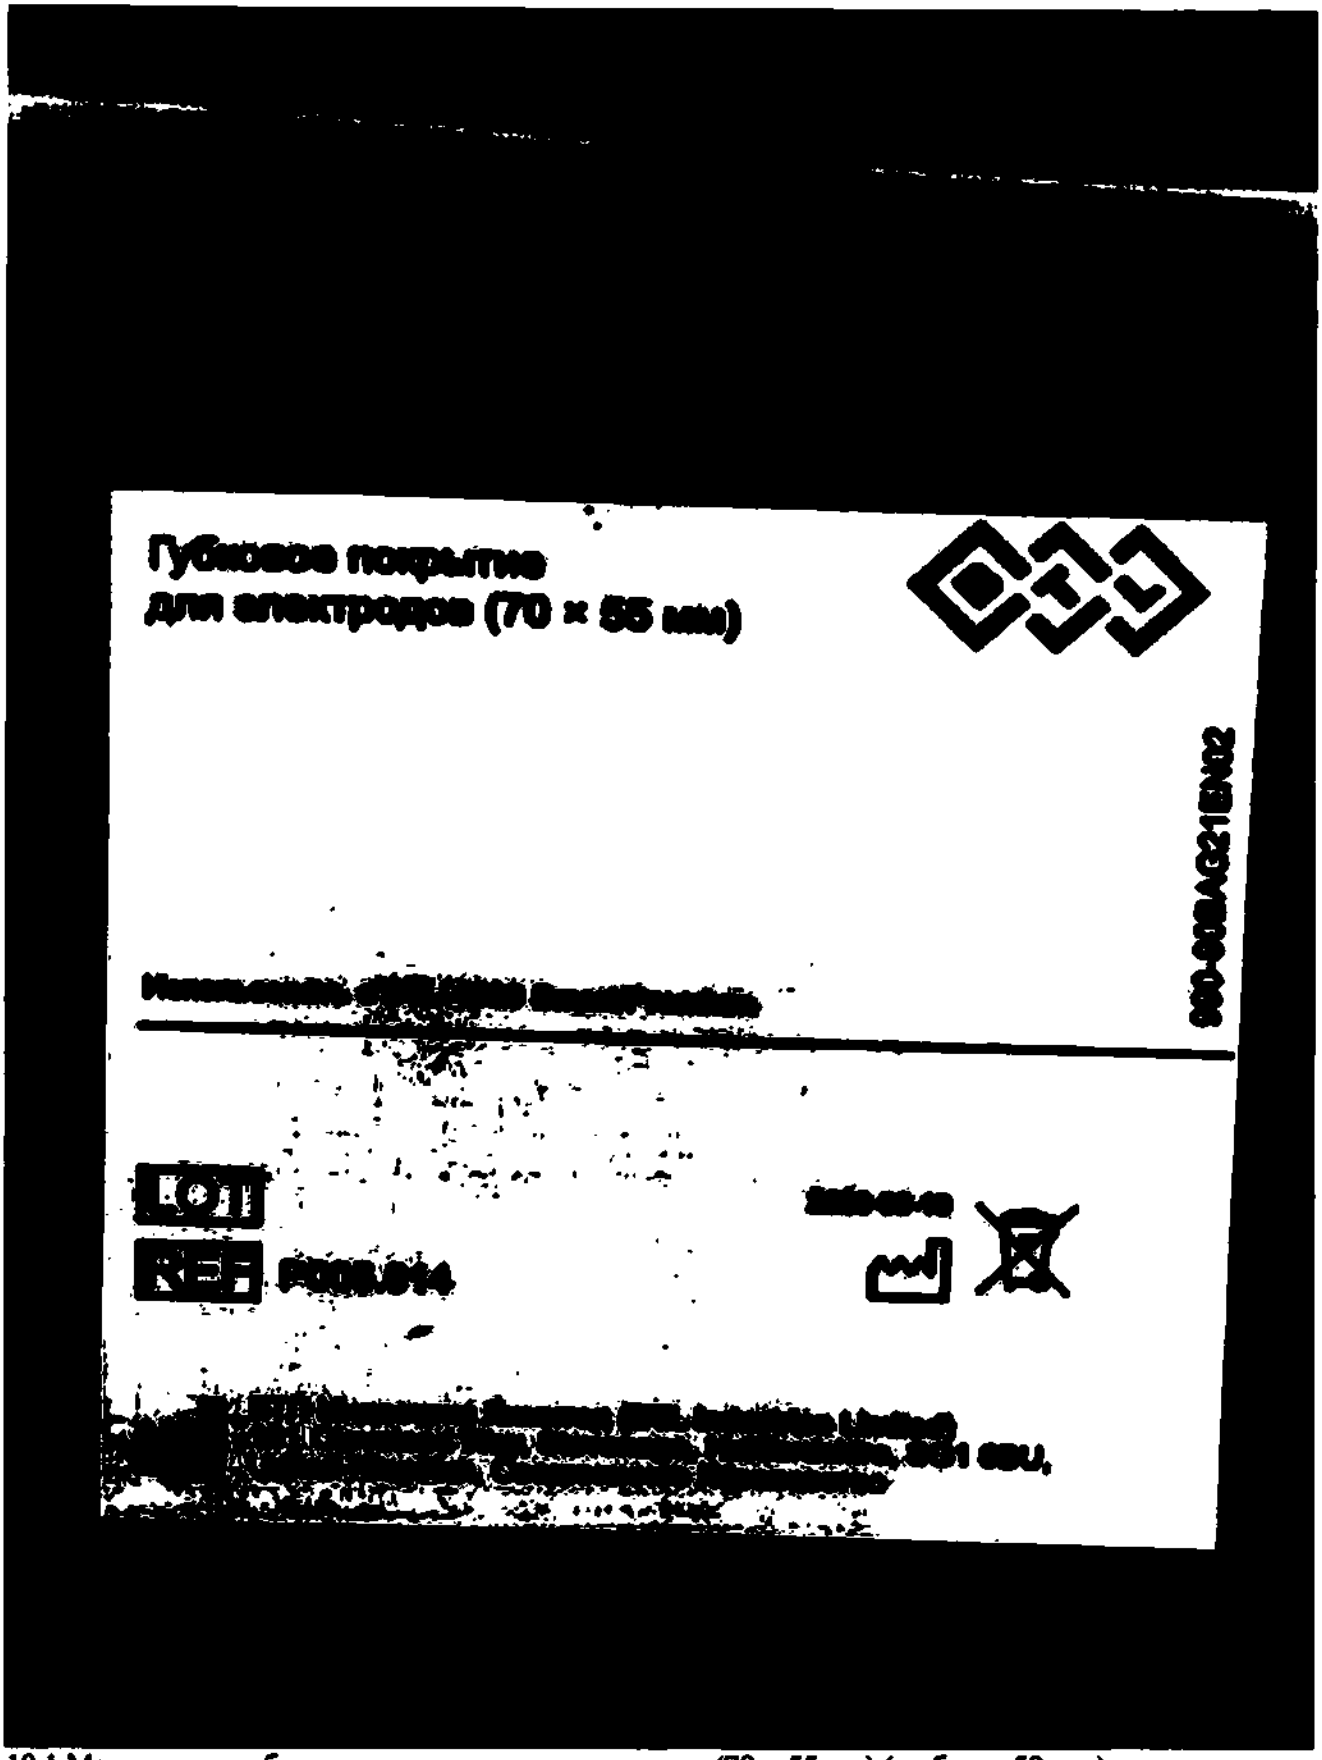



10.1 Маркировка губкового покрытия для электродов (70 × 55 мм) (не более 50 шт.)




11. Губковое покрытие для электродов (125 × 105 мм) (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

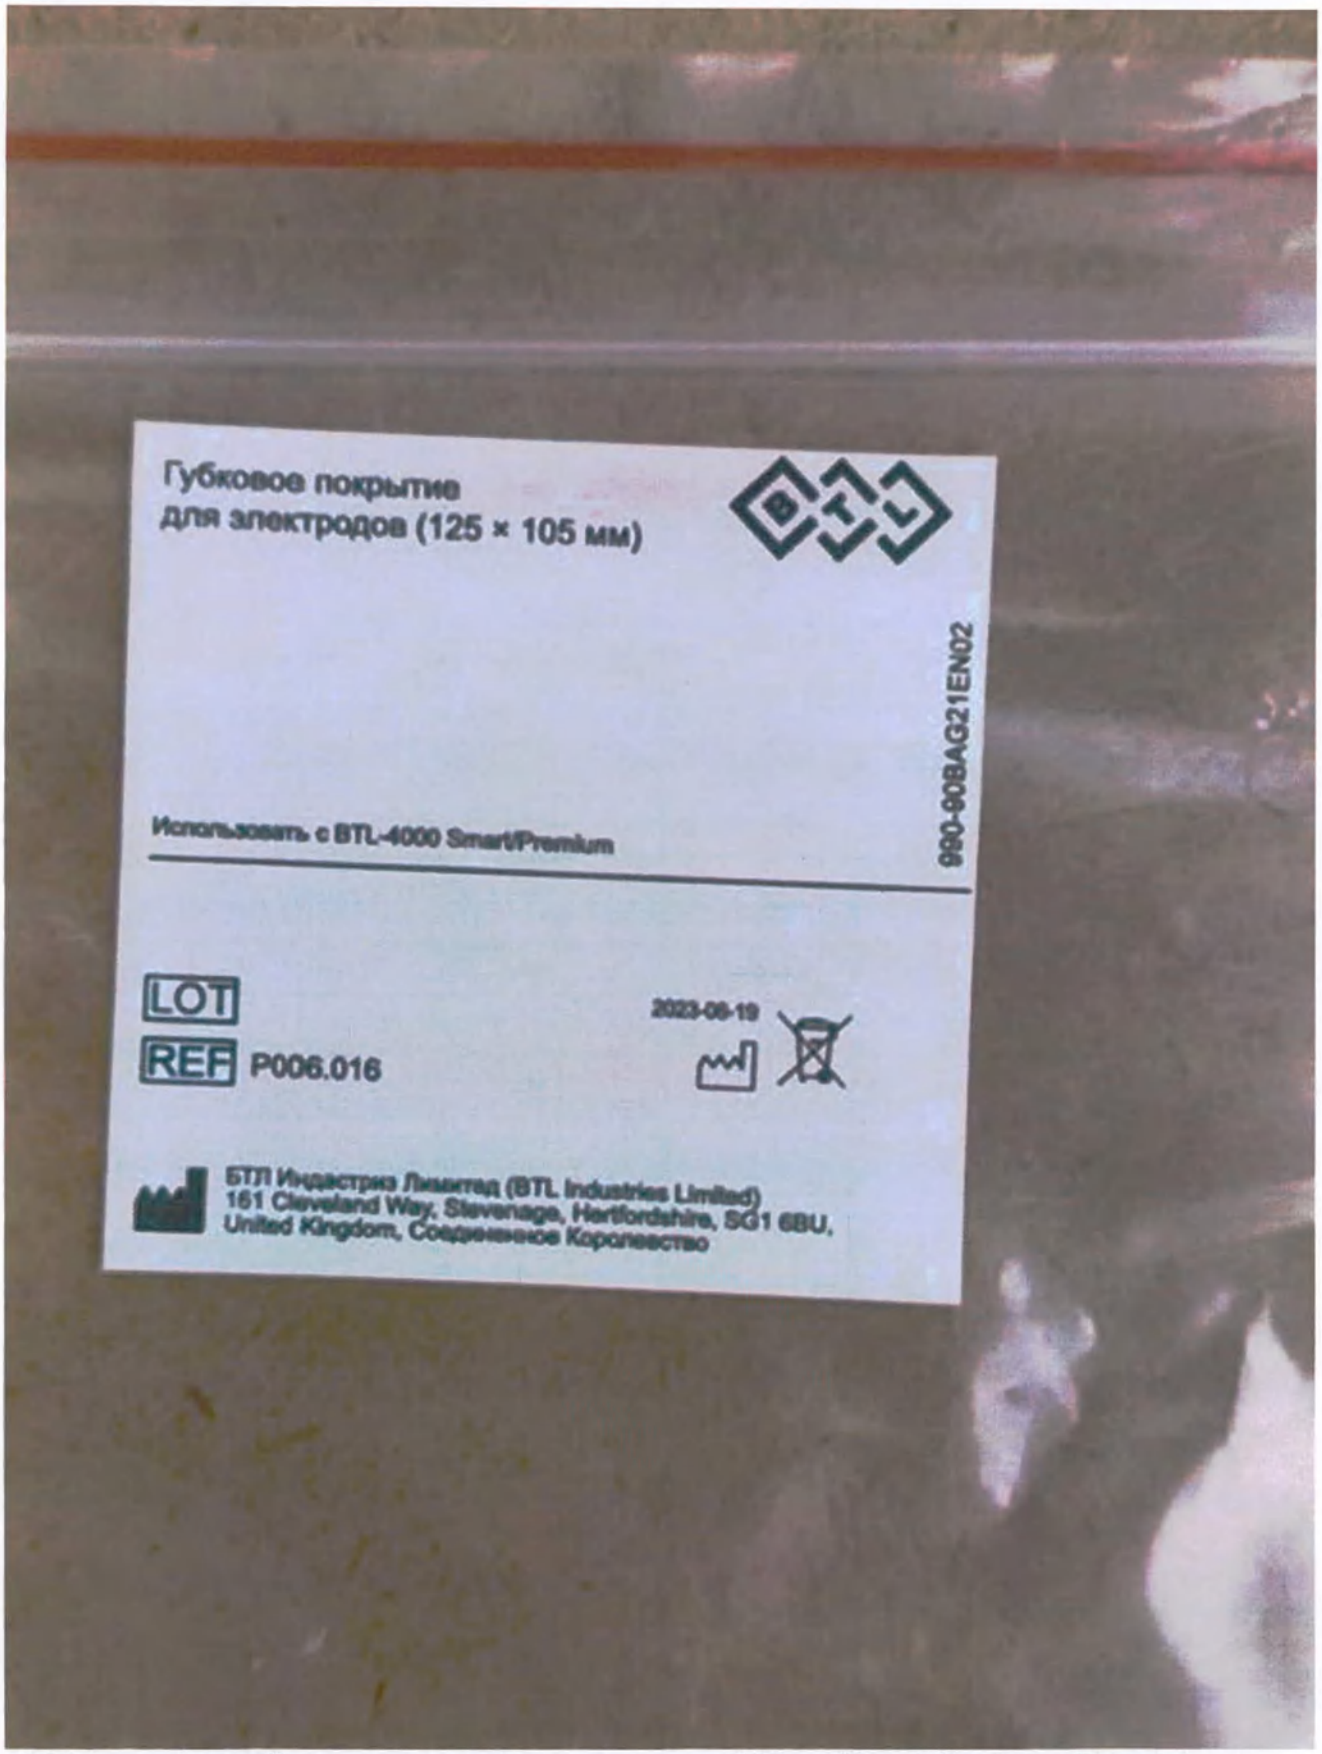


11.1 Маркировка губкового покрытия для электродов (125 × 105 мм) (не более 50 шт.) (при необходимости).


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

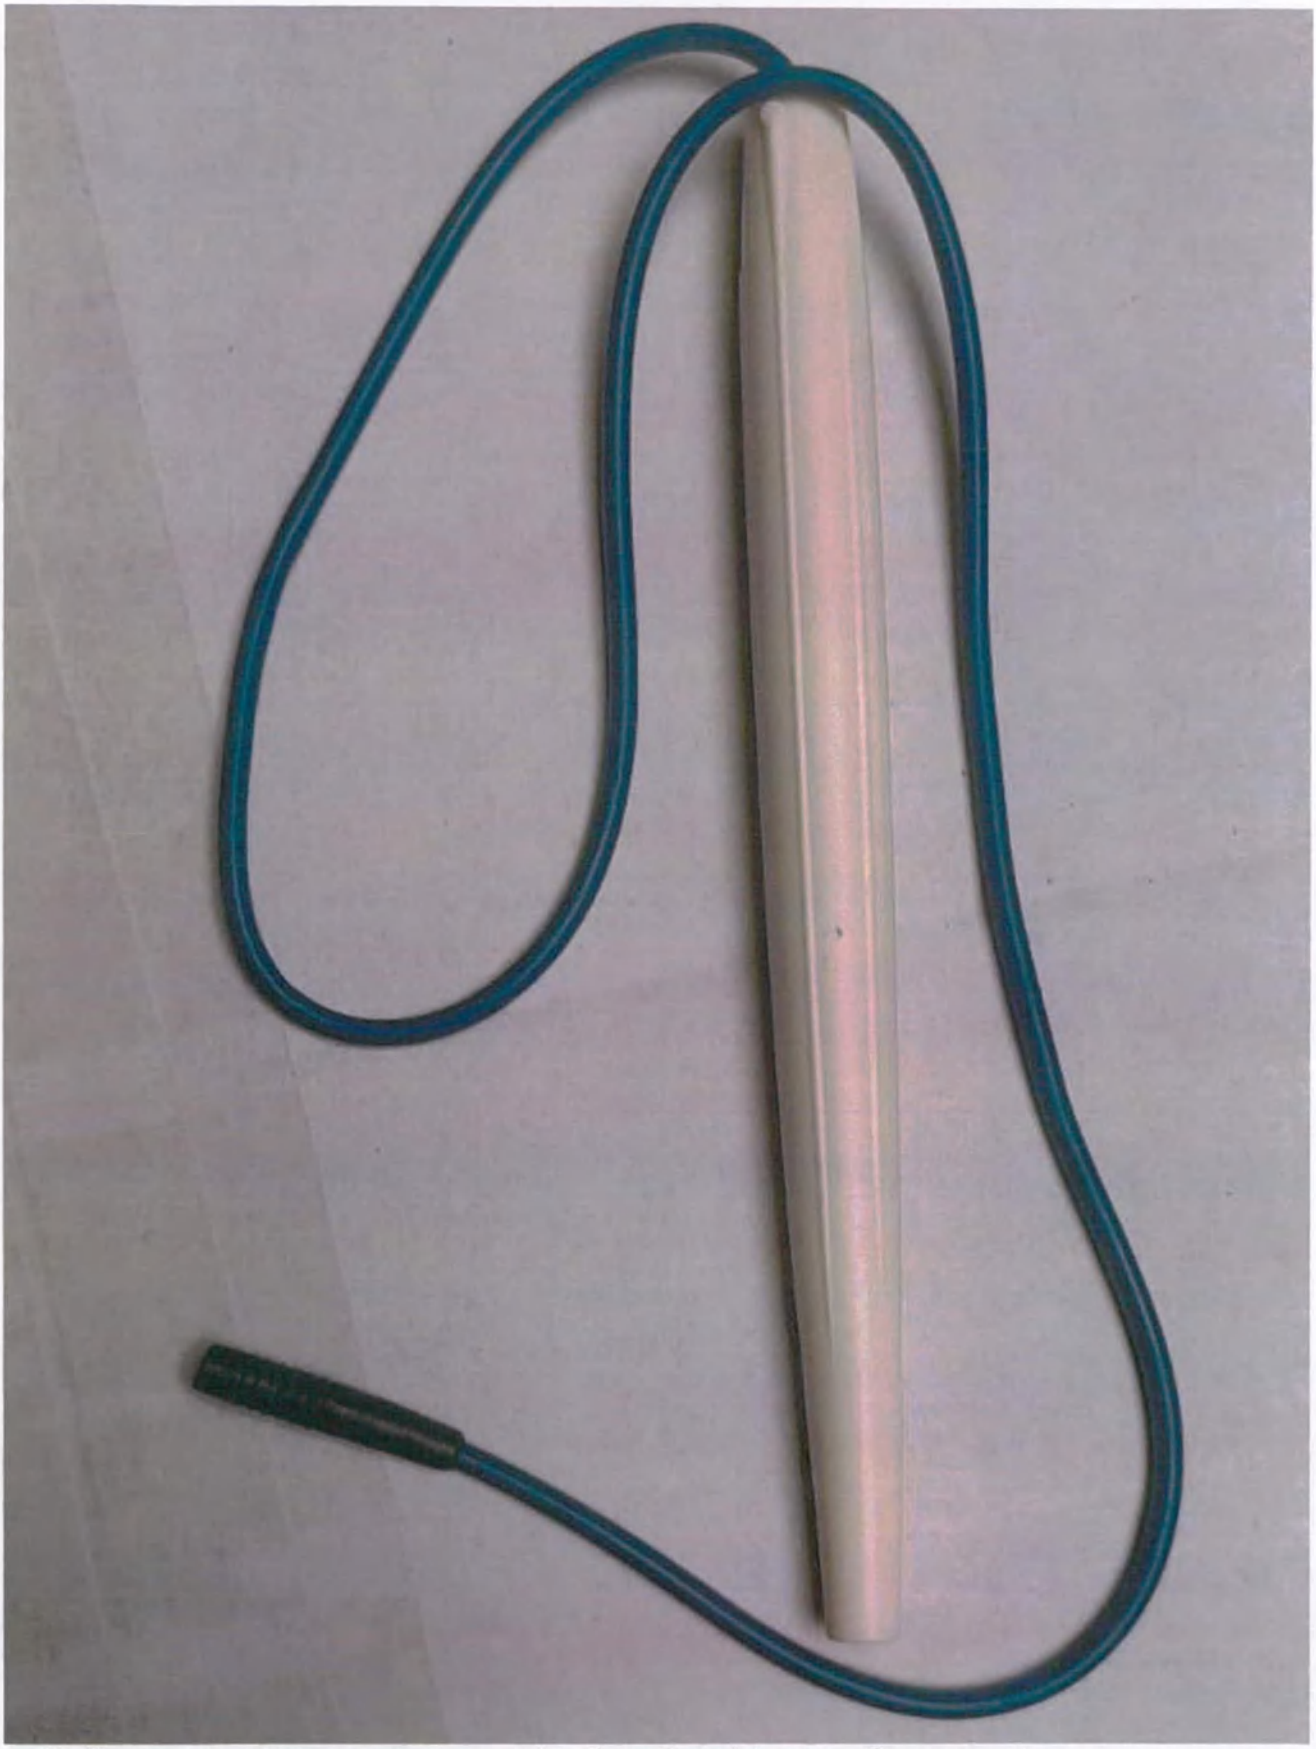

12. Держатель электрода шарикового (не более 6 шт.) (при необходимости).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

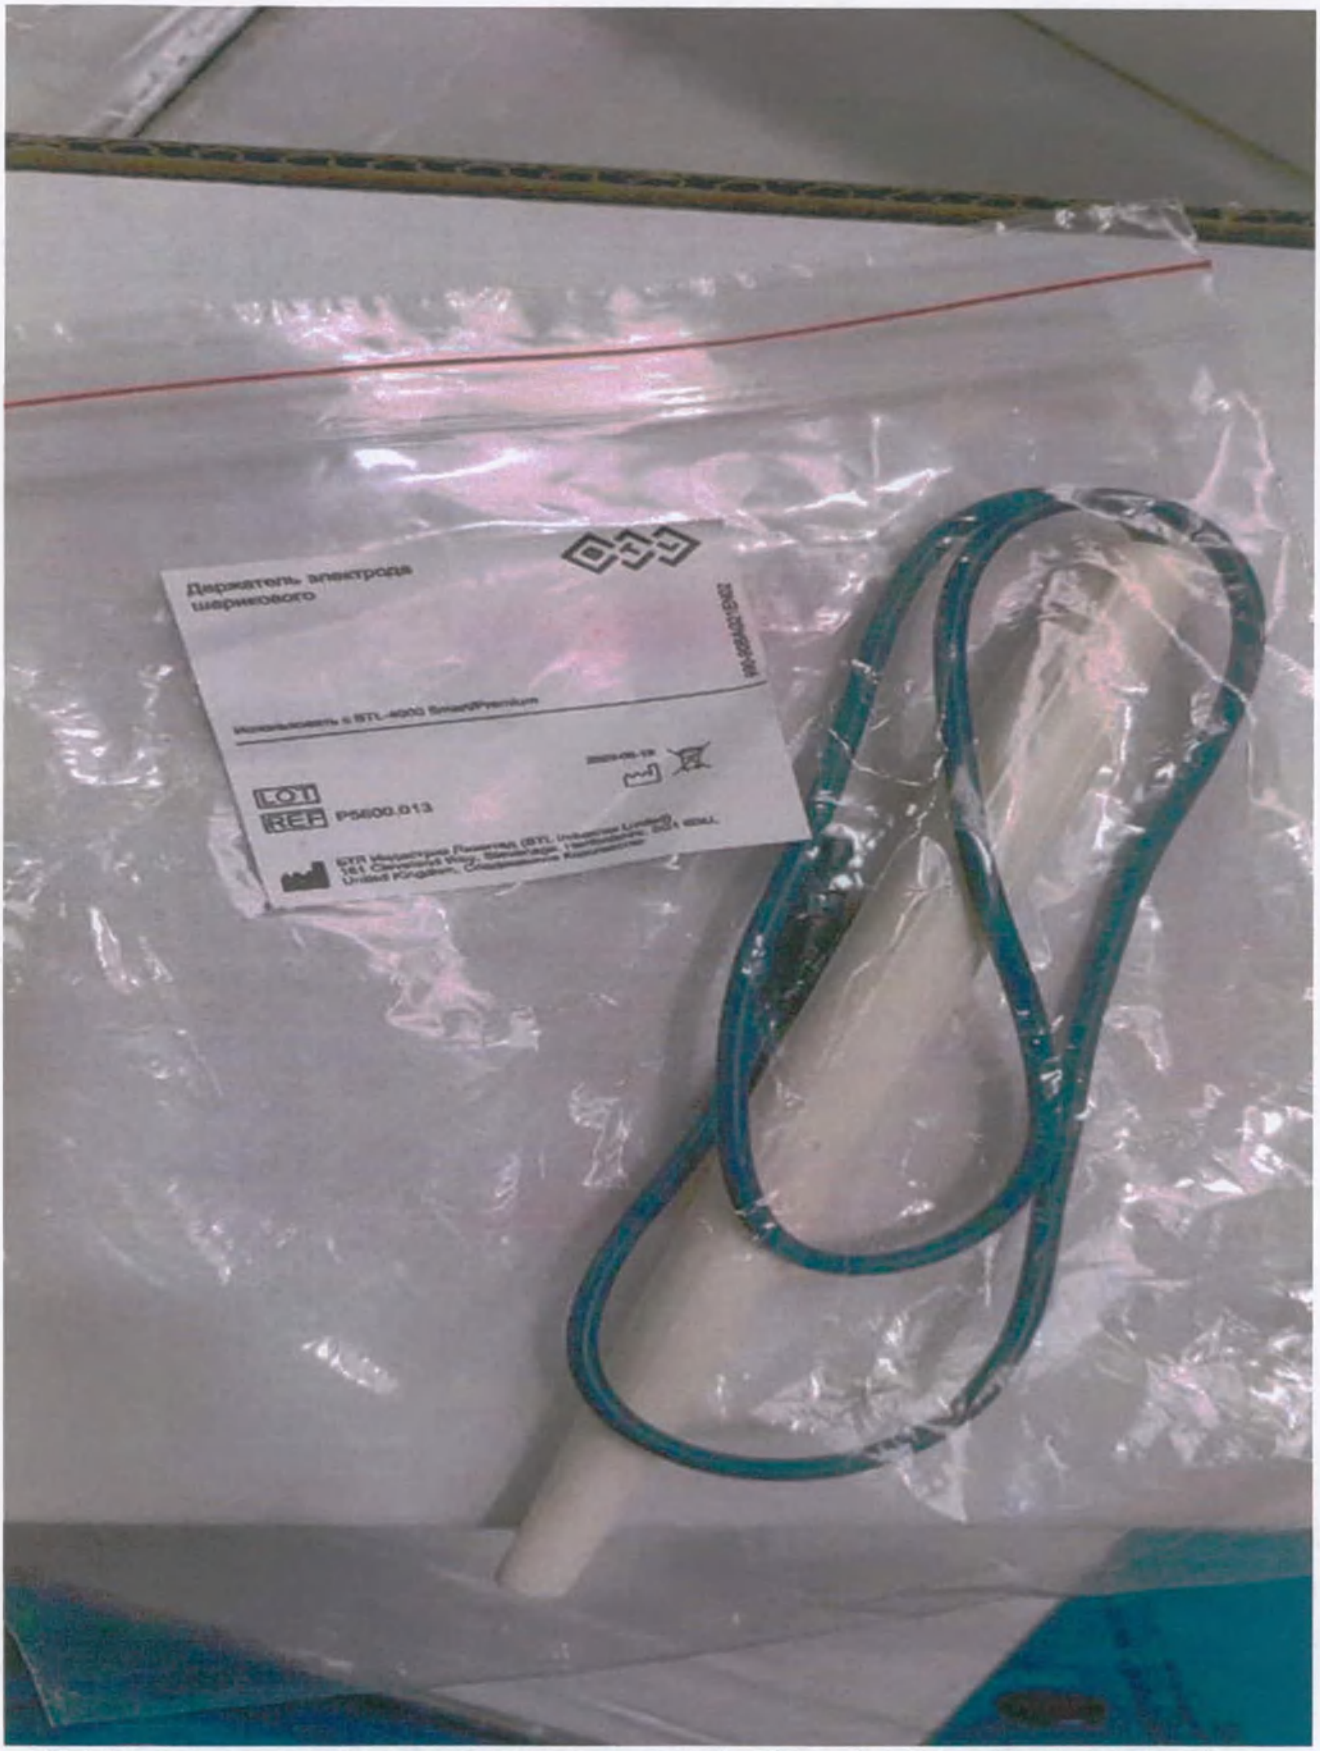



12.1 Маркировка держателя электрода шарикового (не более 6 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



13. Электрод шариковый, Ø 2 мм, производства Emed (не более 6 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

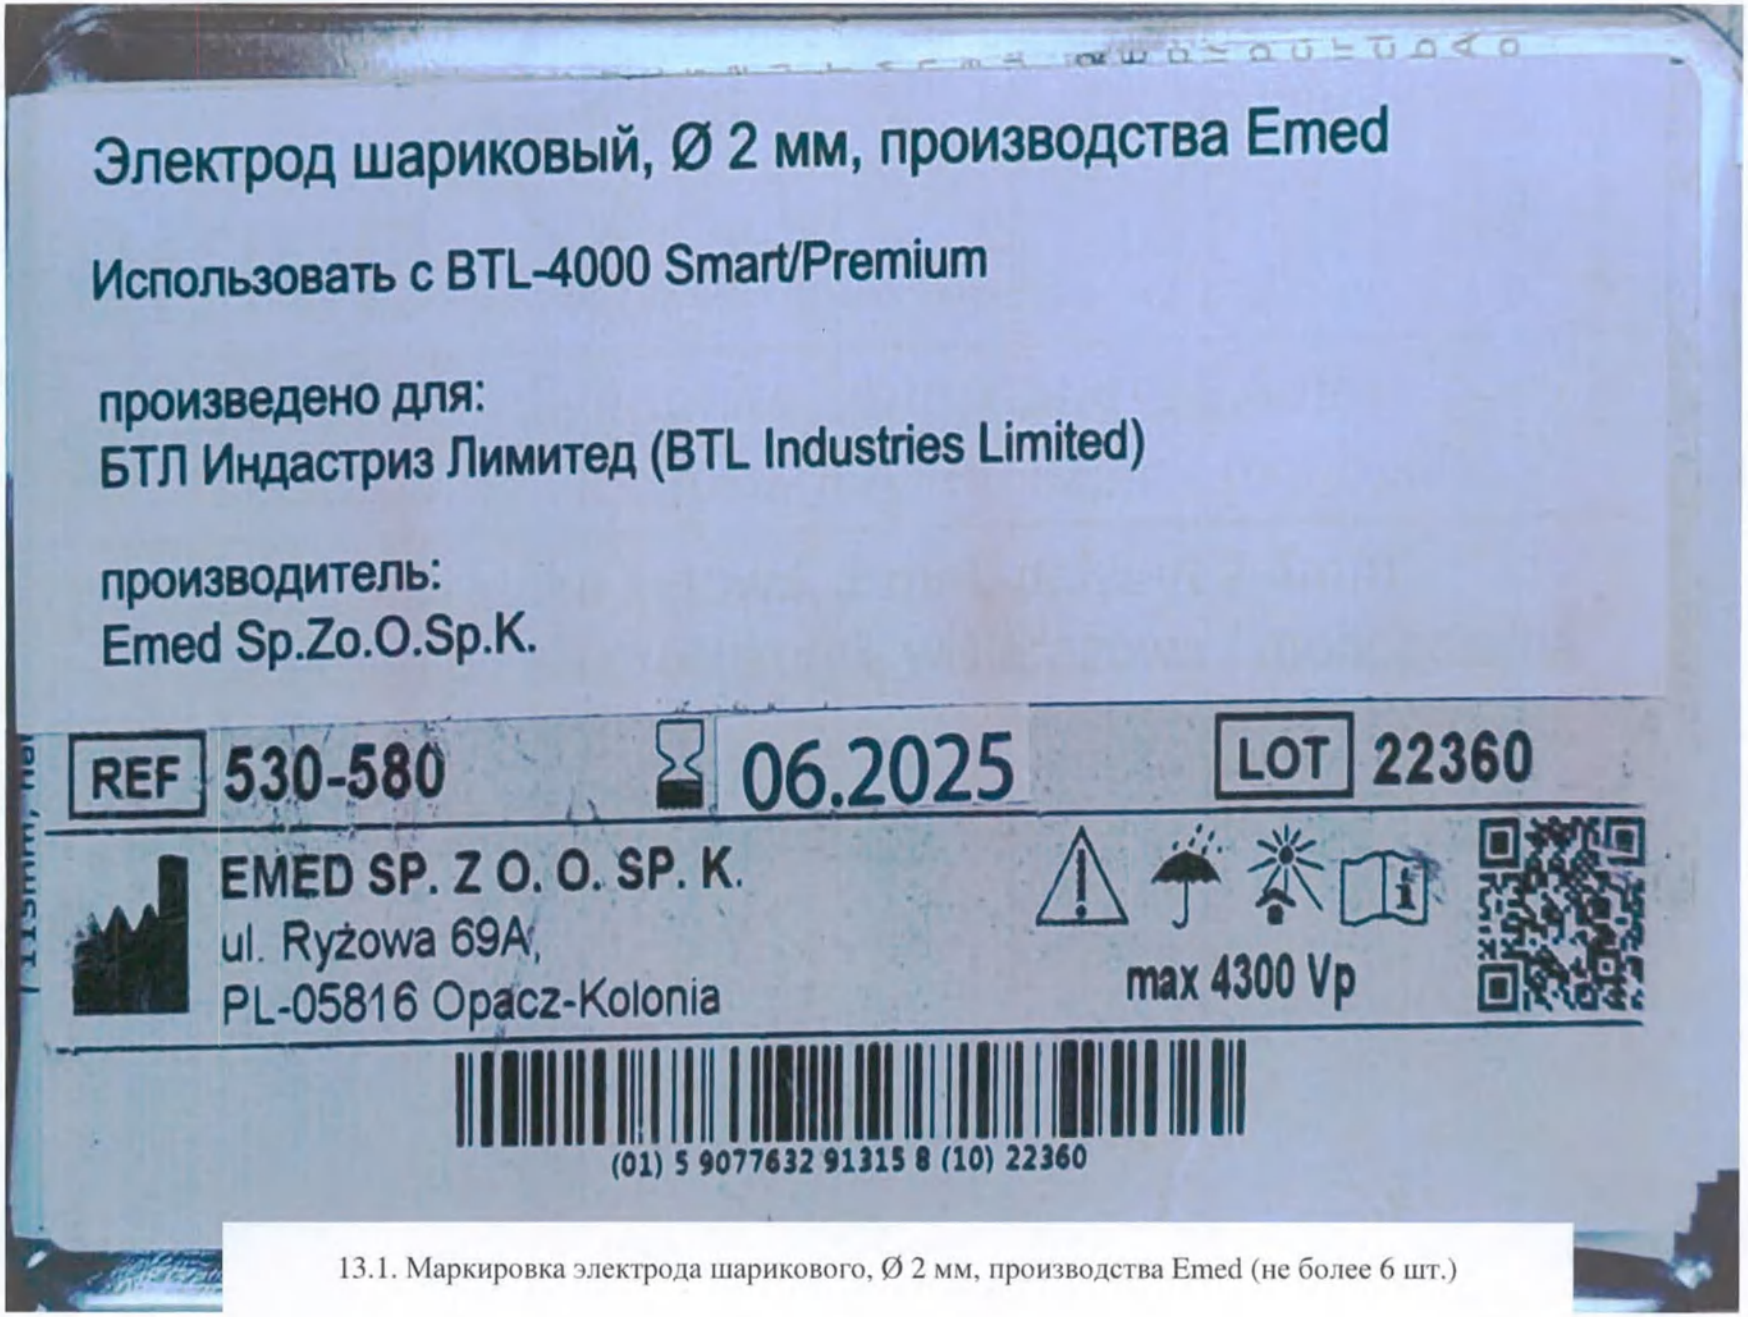



13.1. Маркировка электрода шарикового, Ø 2 мм, производства Emed (не более 6 шт.)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



14. Электрод шариковый, Ø 6 мм, производства Emed (не более 6 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

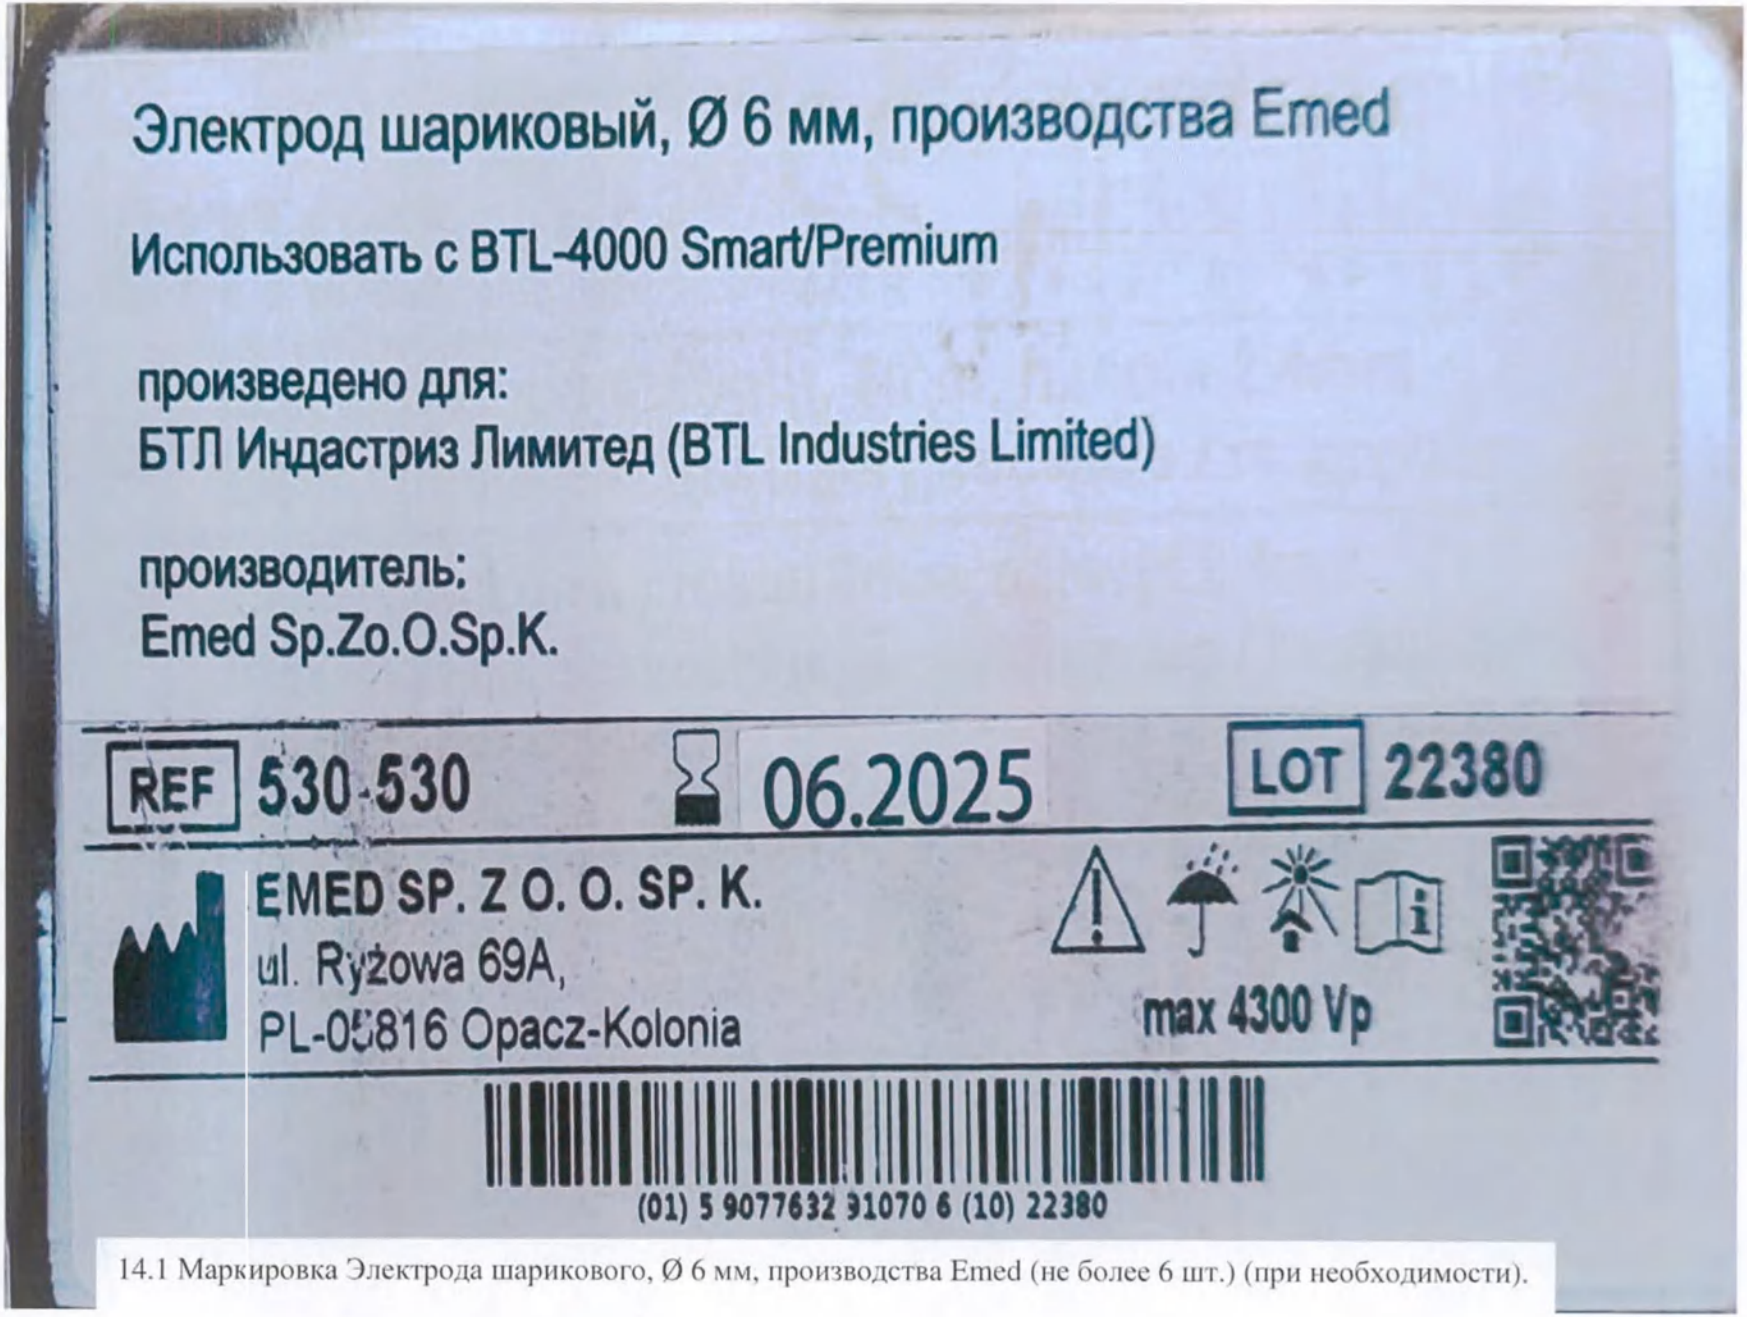



14.1 Маркировка Электрода шарикового, Ø 6 мм, производства Emed (не более 6 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



15. Набор зажимов для электродов, красные, производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

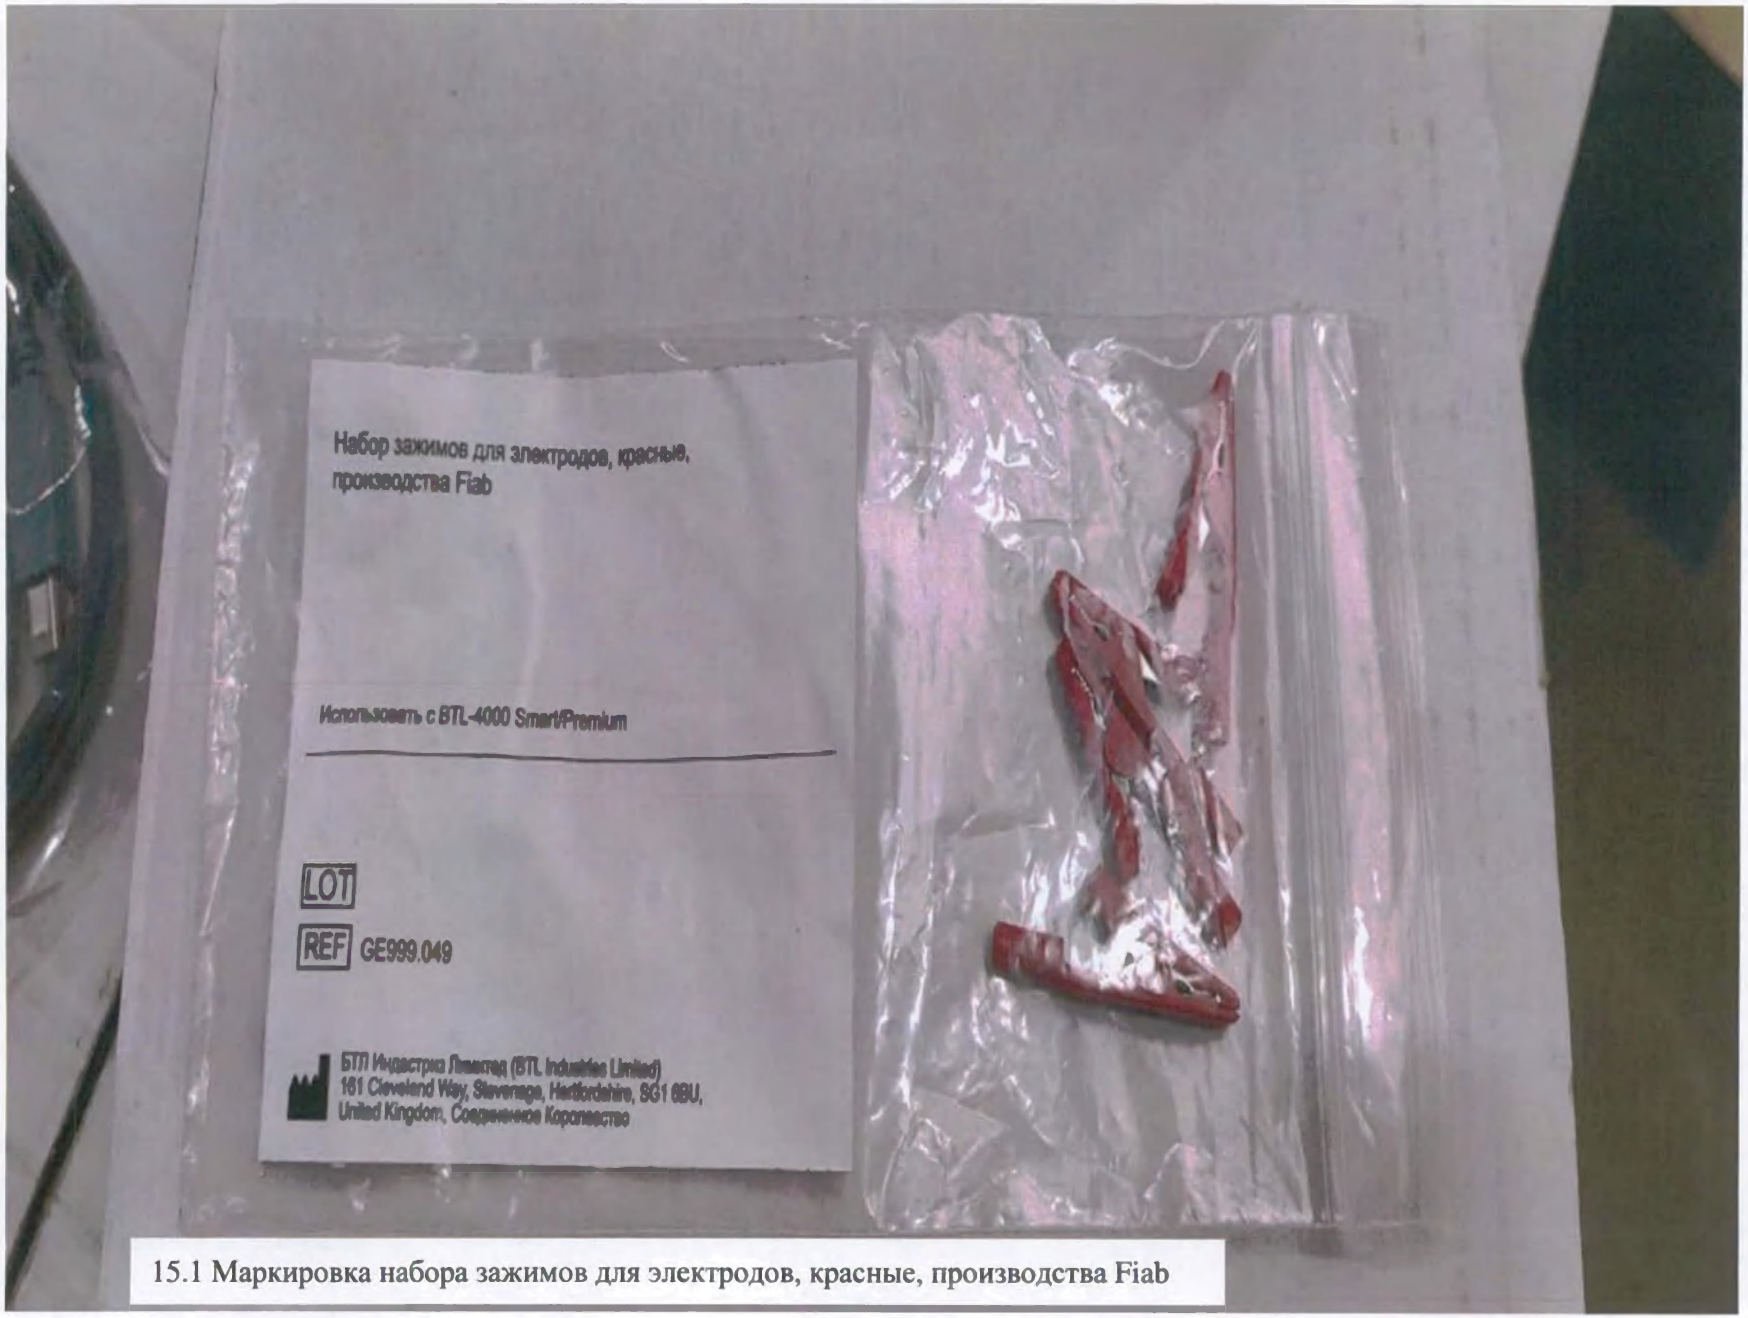



15.1 Маркировка набора зажимов для электродов, красные, производства Fiab

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




16. Набор зажимов для электродов, черные, производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

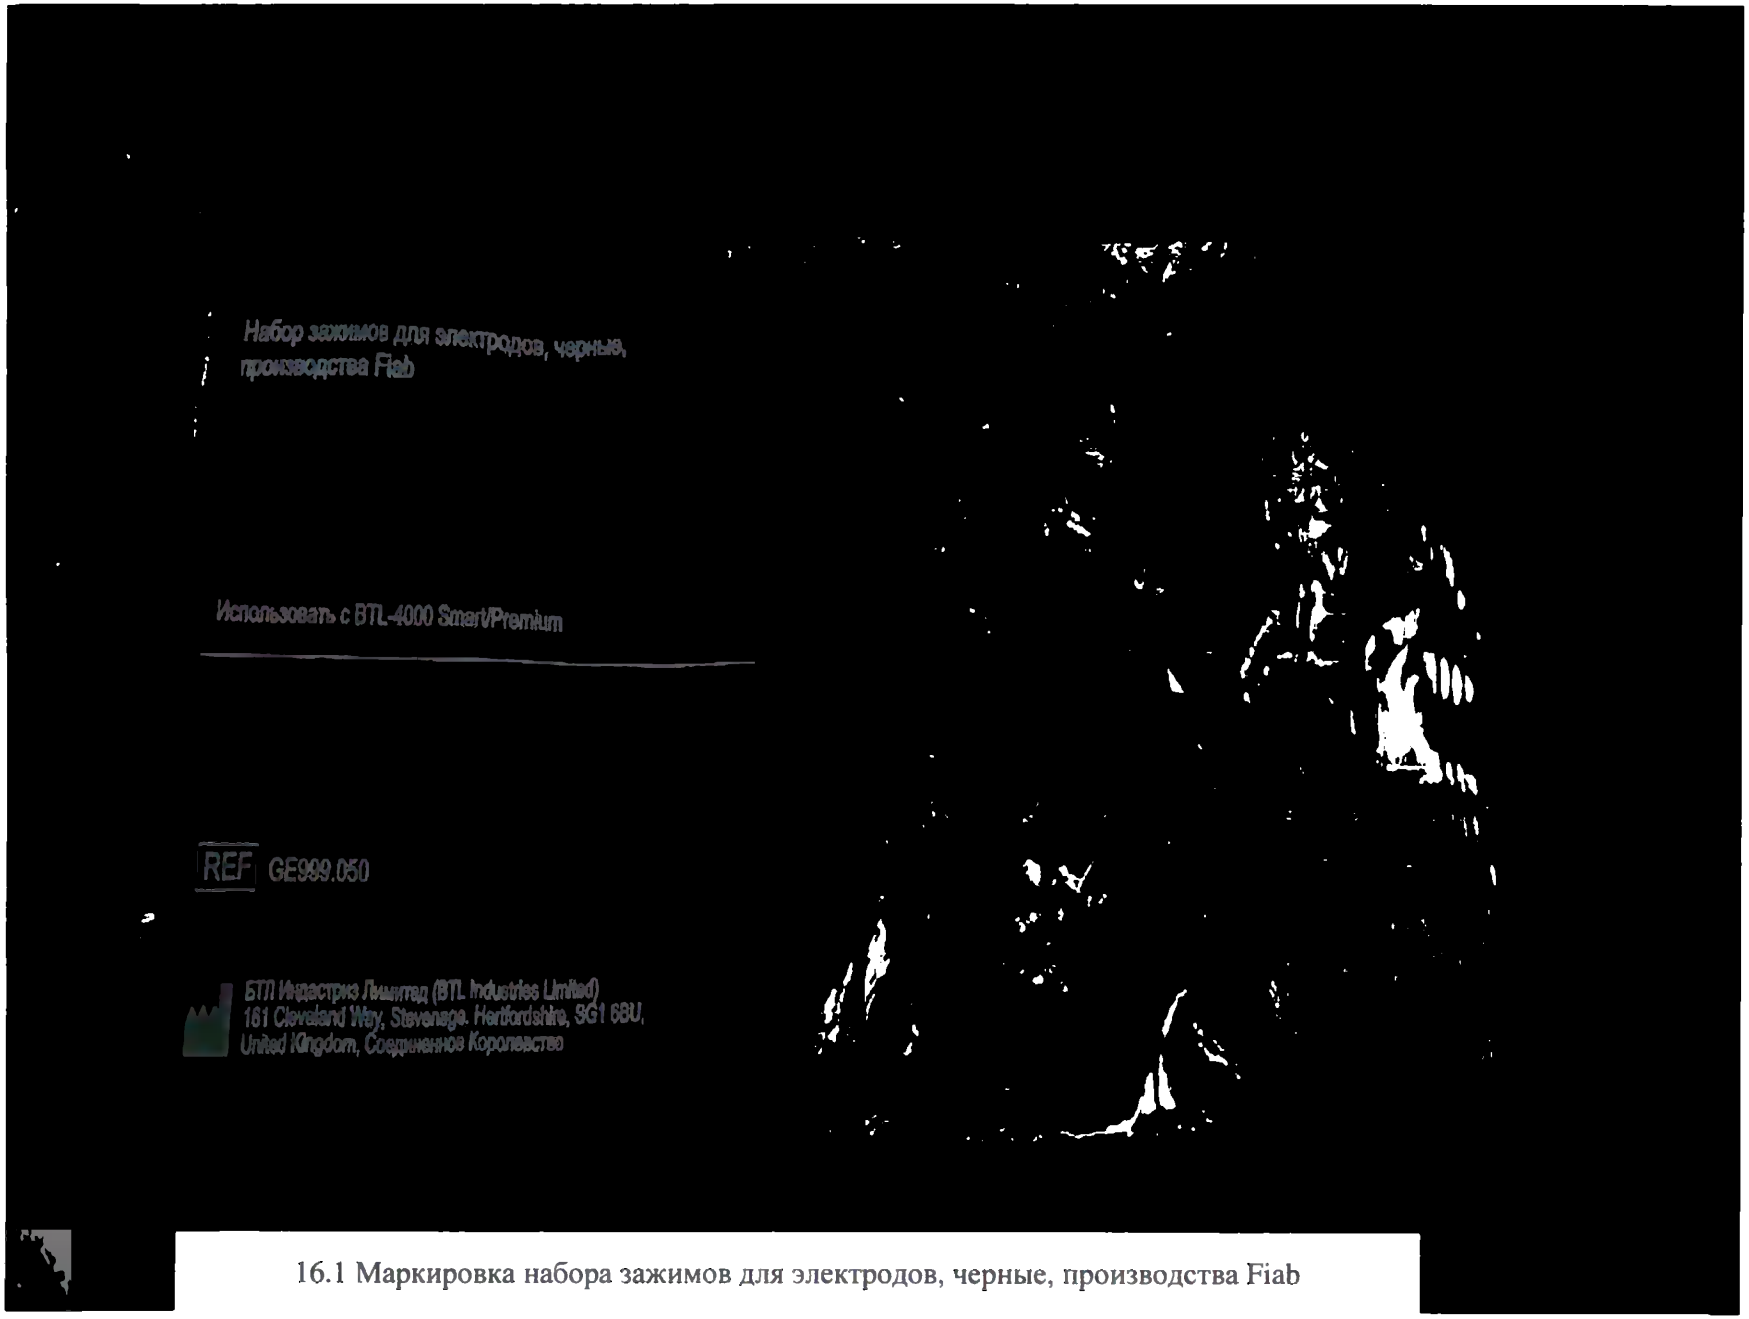


16.1 Маркировка набора зажимов для электродов, черные, производства Fiab

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

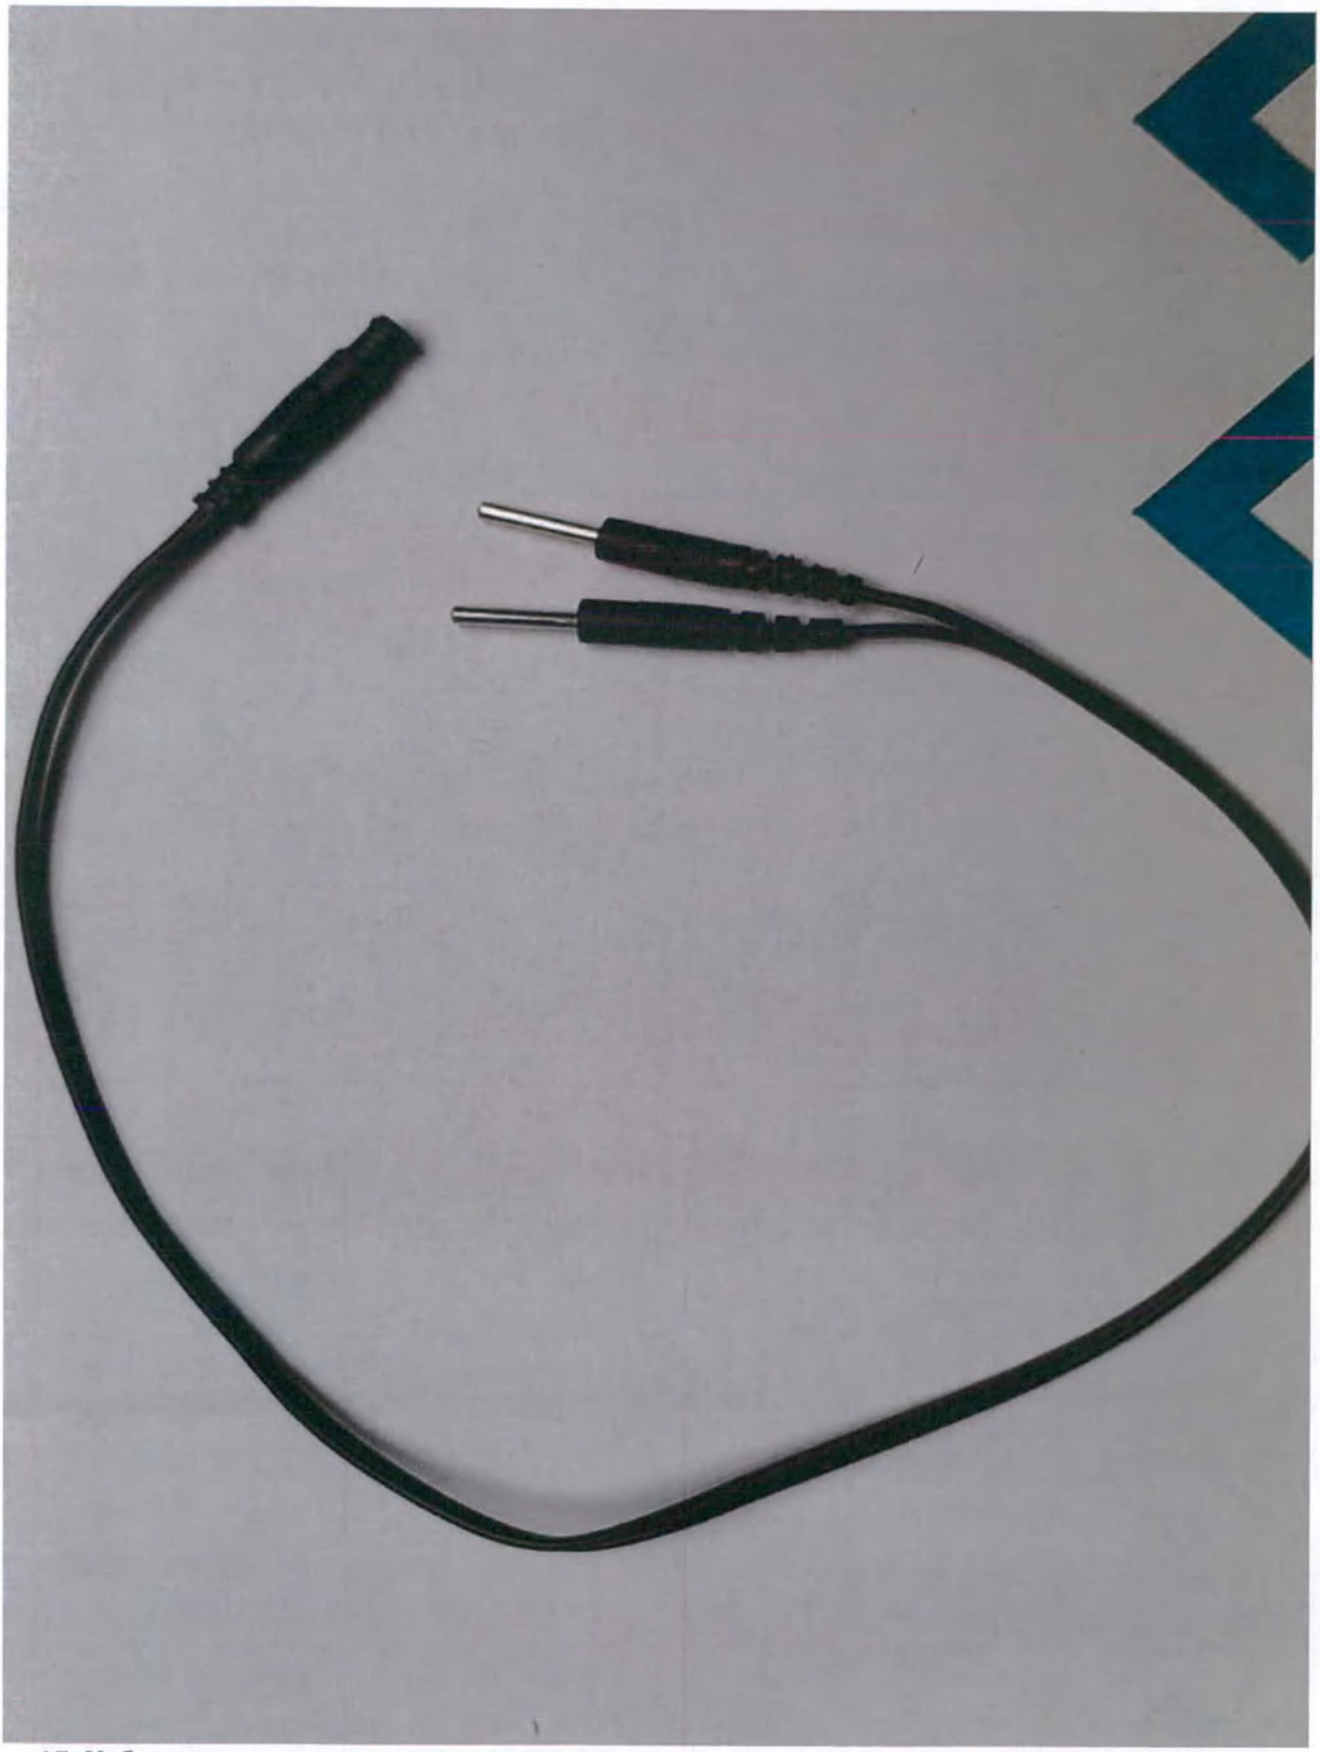

17. Кабель для подключения электродов, канал 1 (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



18. Кабель для подключения электродов, канал 2 (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



19. Электрод вагинальный биполярный Periform, производства Performance Health (не более 10 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





19.1. Маркировка электрода вагинального биполярного Periform, производства Performance Health (не более 10 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



20. Электрод ректальный биполярный Anuform производства Performance Health (не более 10 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

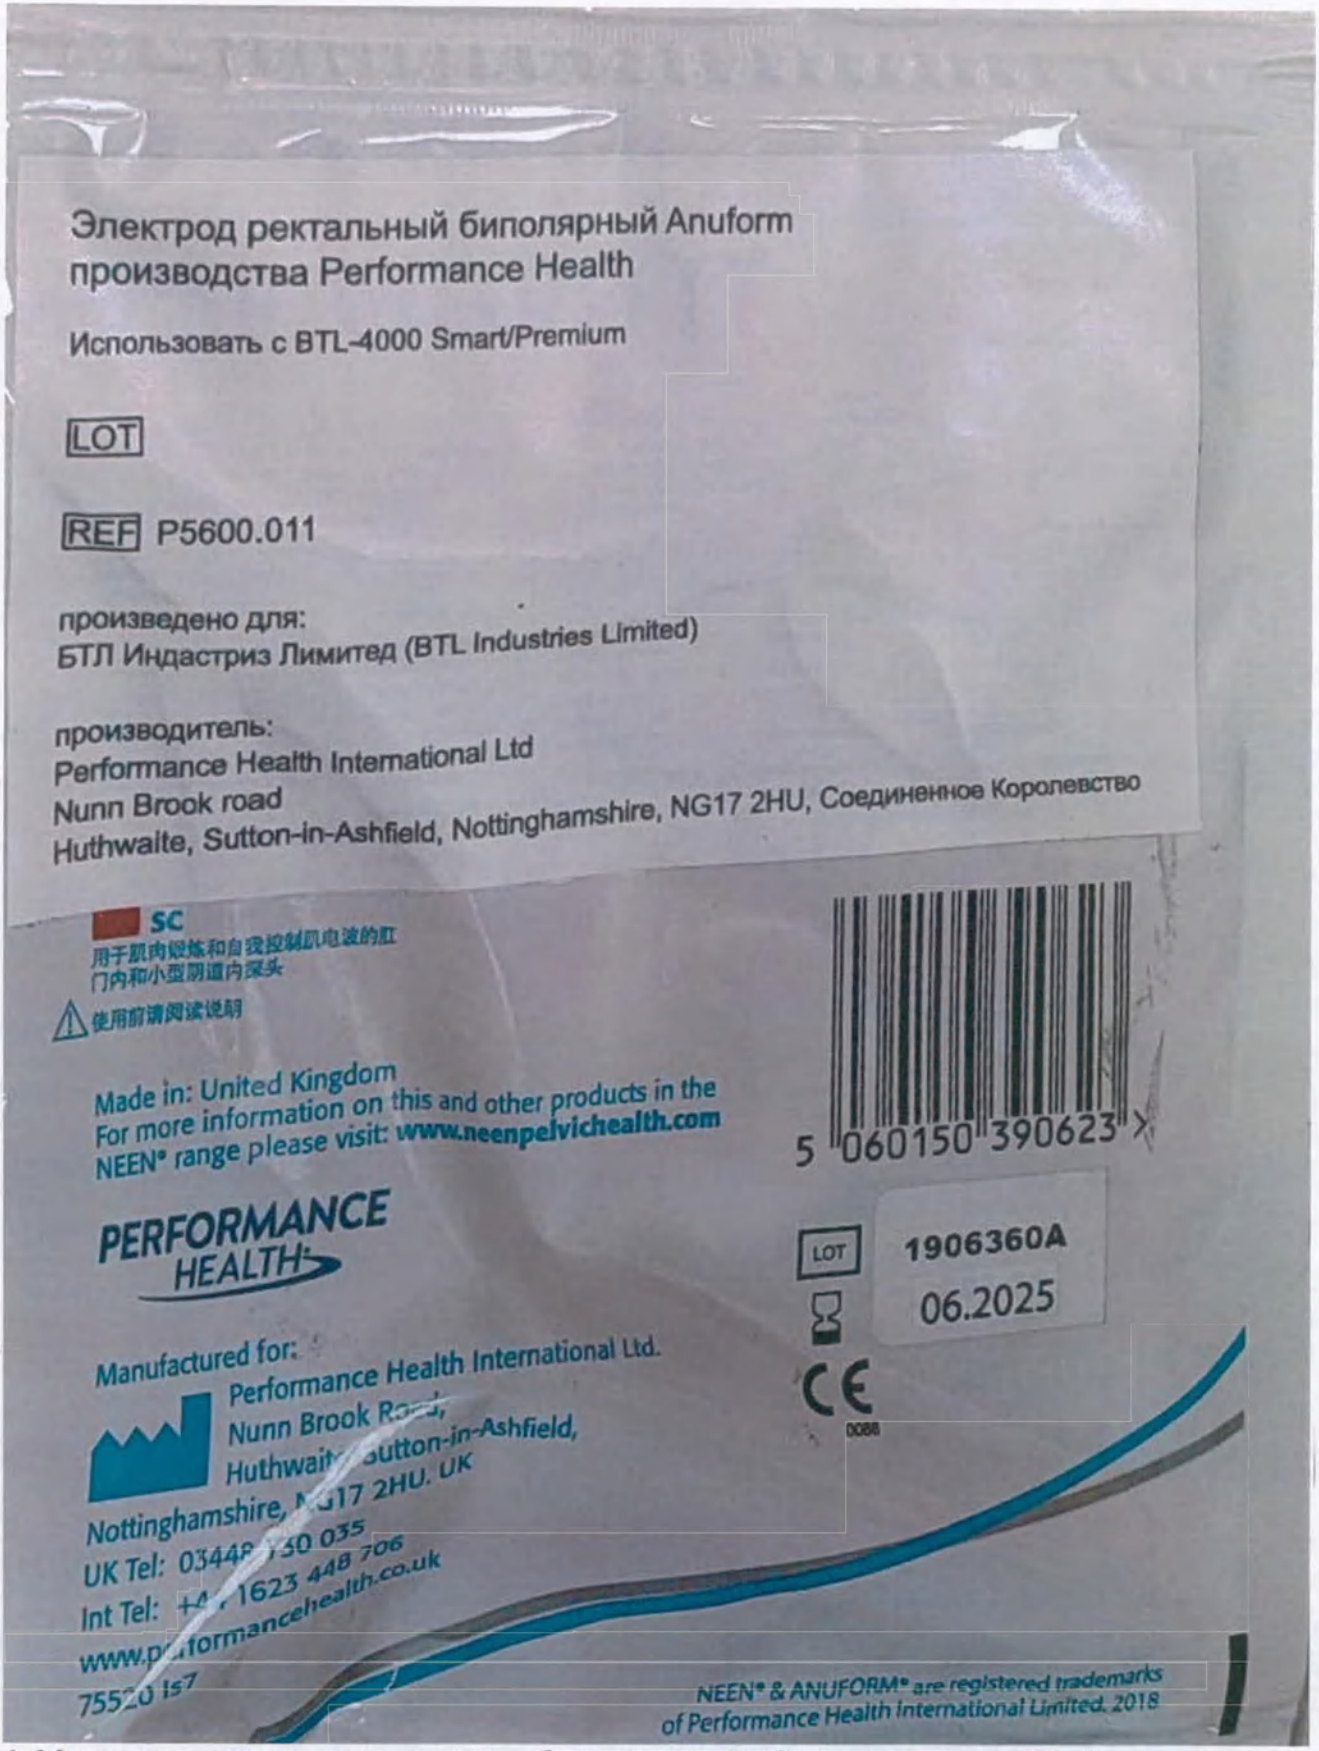


20.1 Маркировка электрода ректального биполярного Anuform производства Performance Health (не более 10 шт.) (при необходимости).




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



21. Вакуумный электрод 30 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

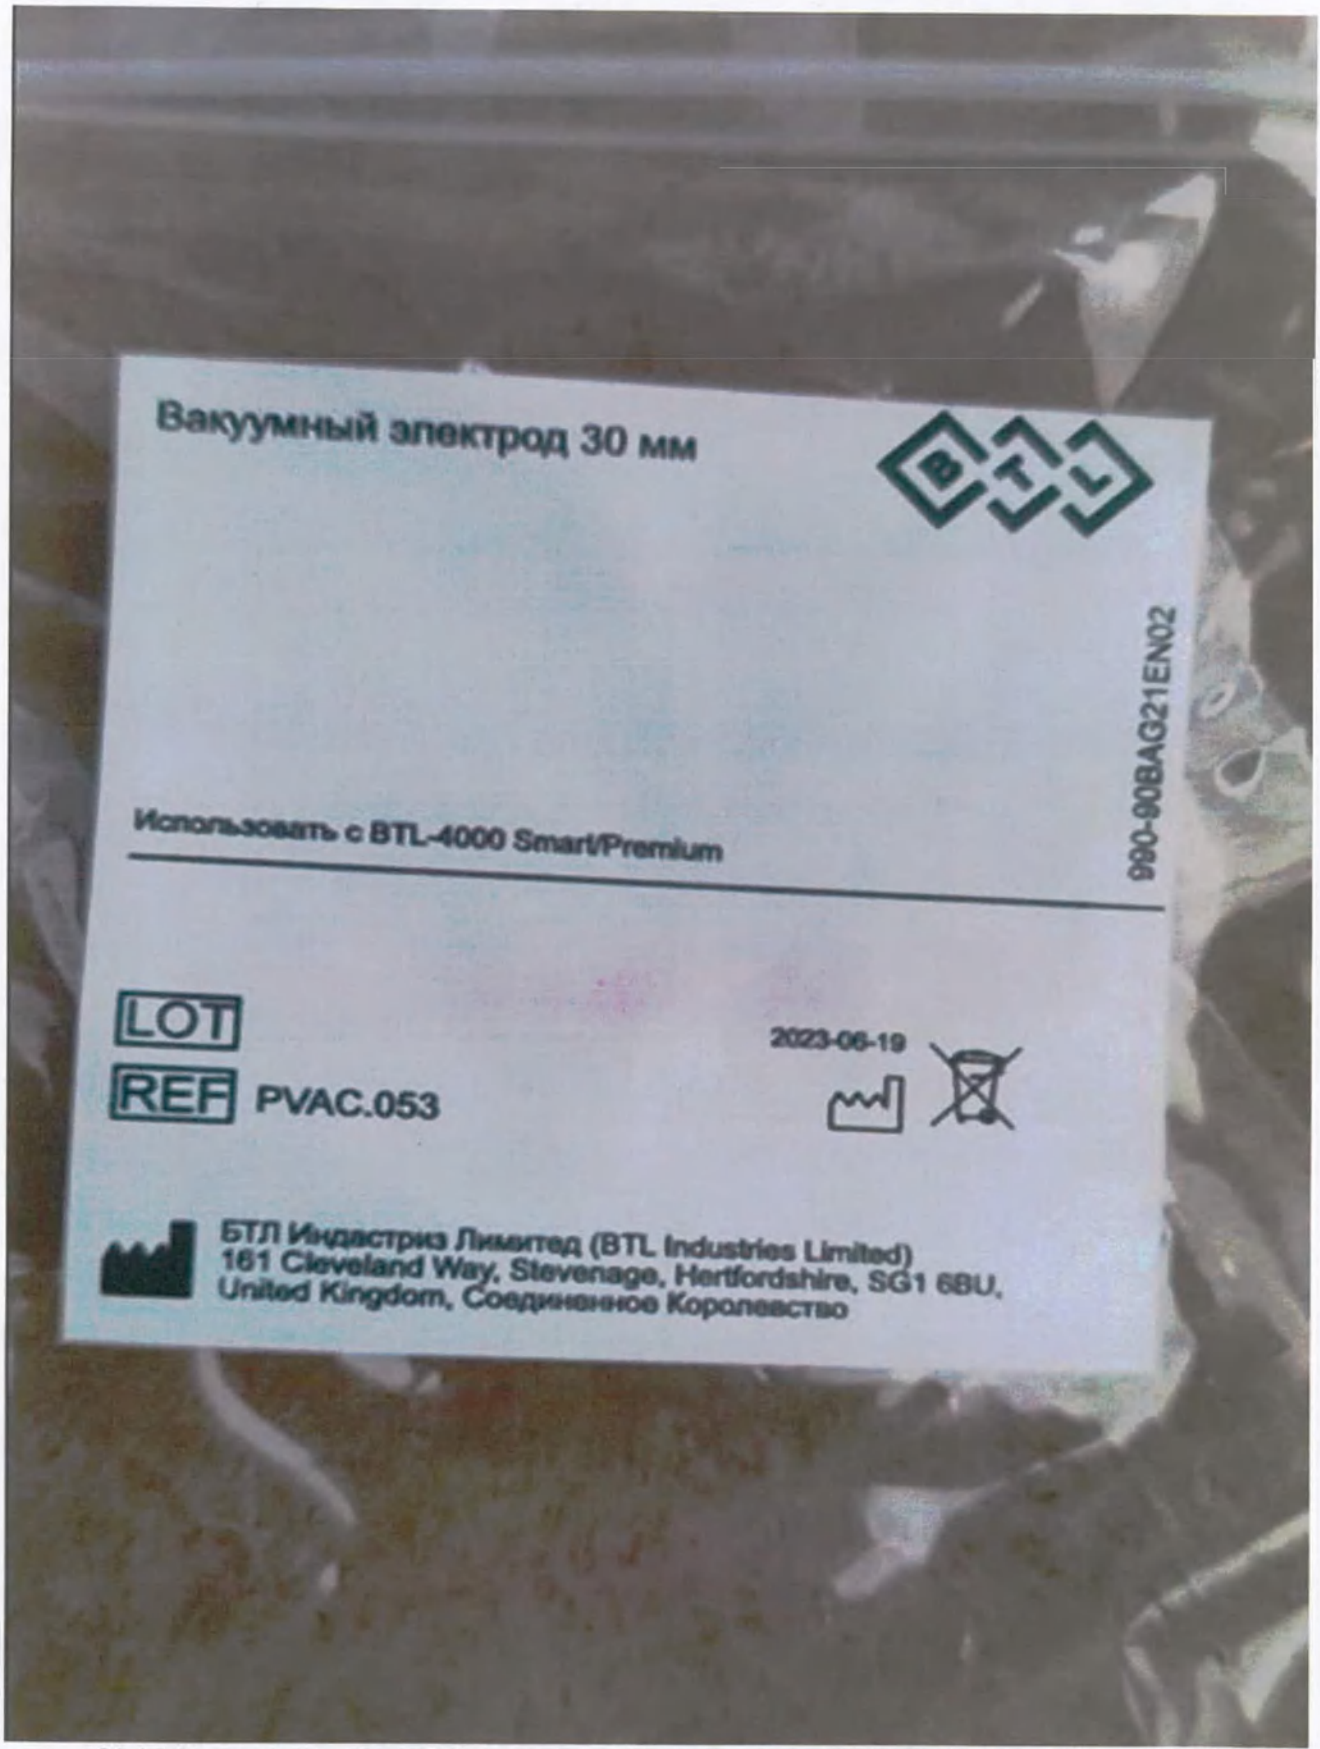


21.1 Маркировка вакуумного электрода 30 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



22. Вакуумный электрод 60 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




22.1 Маркировка вакуумного электрода 60 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



23. Вакуумный электрод 90 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




23.1 Маркировка вакуумного электрода 90 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





24. Кабель для электродов, 1.2 м, канал 1 (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




25. Кабель для электродов, 1.2 м, канал 2 (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

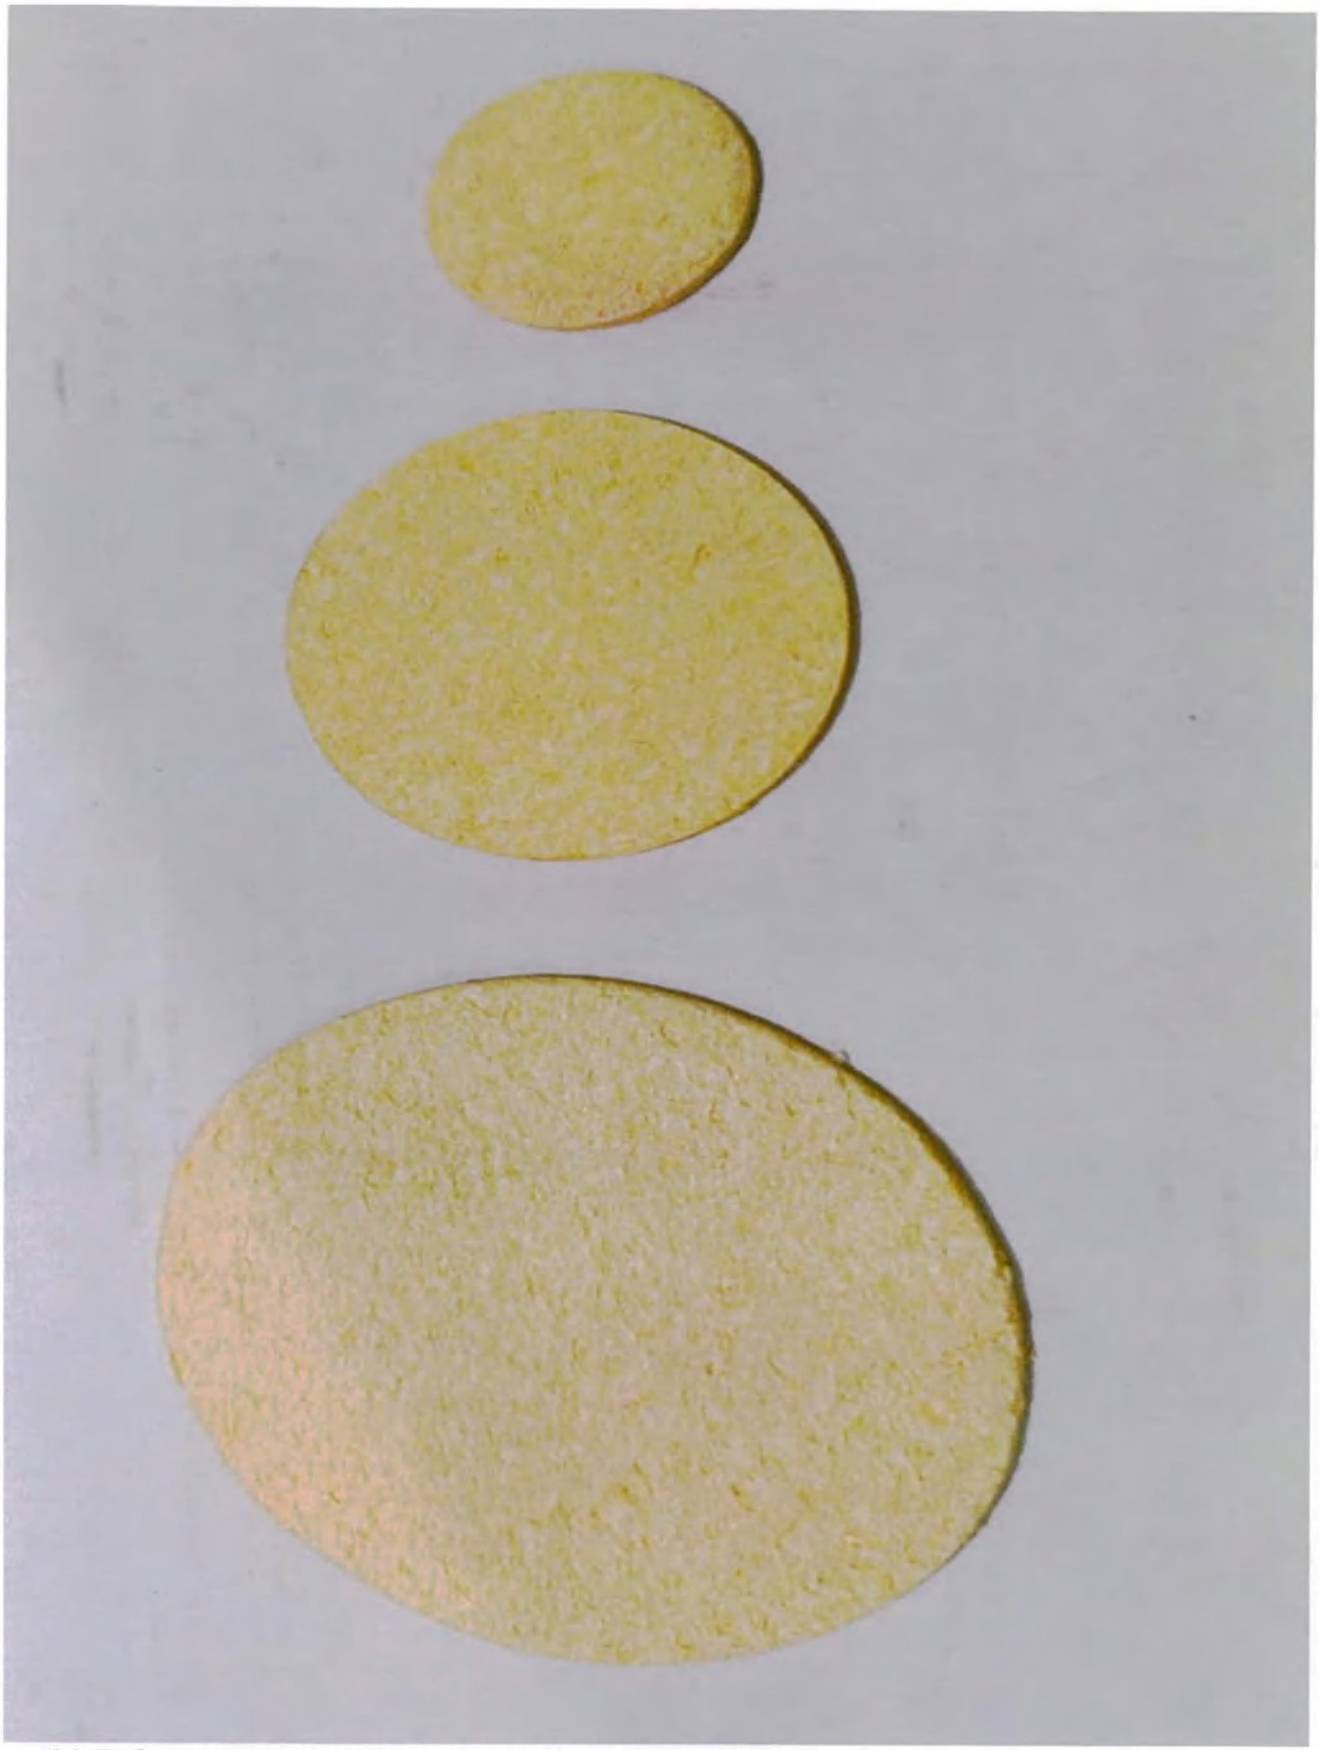

26. Губка для Вакуумного электрода 30 мм, 60 мм, 90 мм

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




26.1. Маркировка губки для Вакуумного электрода 30 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




26.2 Маркировка губки для Вакуумного электрода 60 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




26.3 Губка для Вакуумного электрода 90 мм (не более 50 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




27 Набор эластичных ремней для фиксации электродов (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




28. Аккумулятор 258-battpack (не более 2 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




29. Вакуумная приставка BTL-Vac II по РУ №РЗН2020/12648 от 24.11.2020 г. (1 шт.) (при необходимости).




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




29.1 Маркировка вакуумной приставки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

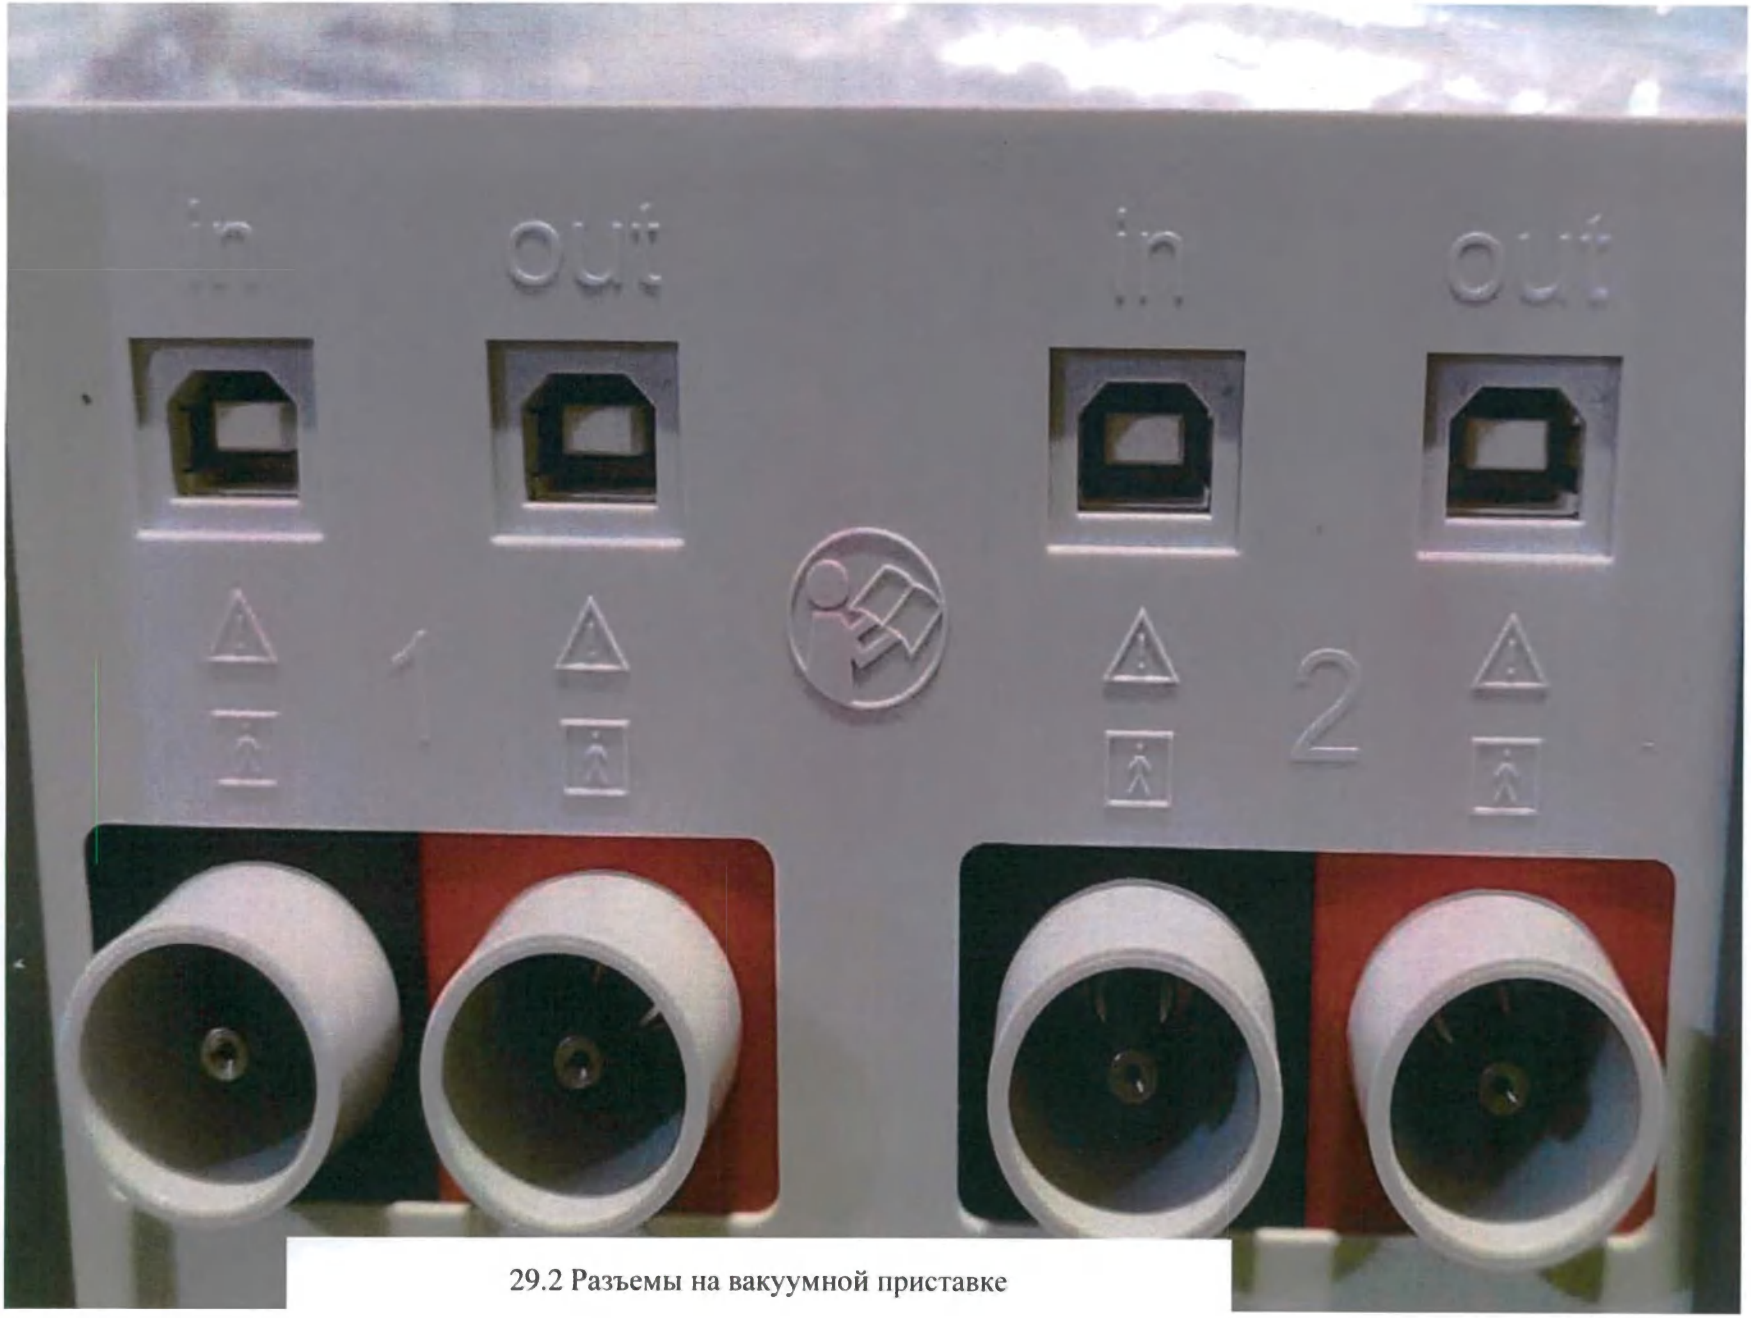


29.2 Разъемы на вакуумной приставке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




30. Соединительный кабель для BTL-Vac II (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




31. Сетевой адаптер питания BTL-Vac II (1 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




32. Кабель питания для BTL-Vac II (1 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

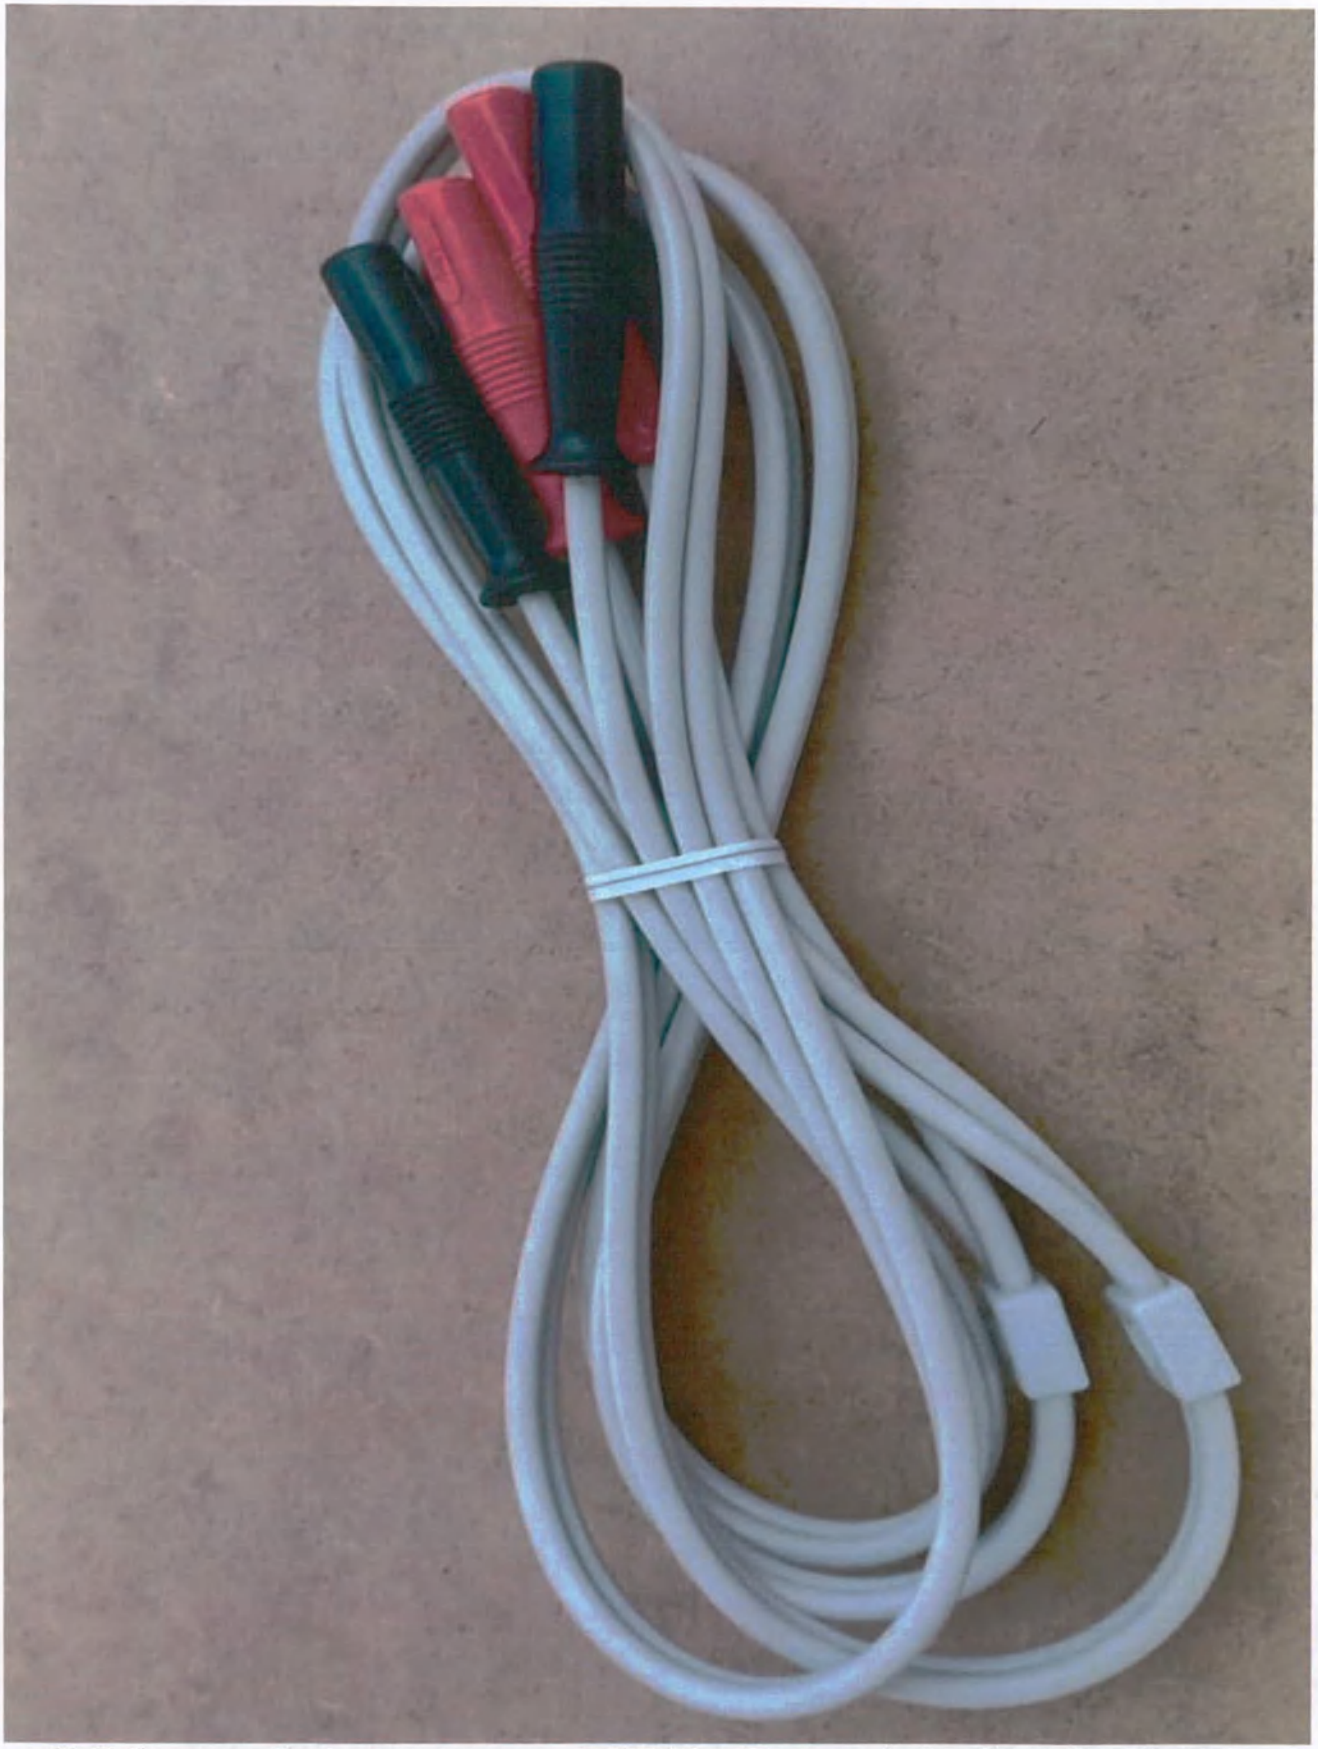

33. Кабель для Вакуумных электродов BTL-Vac II, канал 1 (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

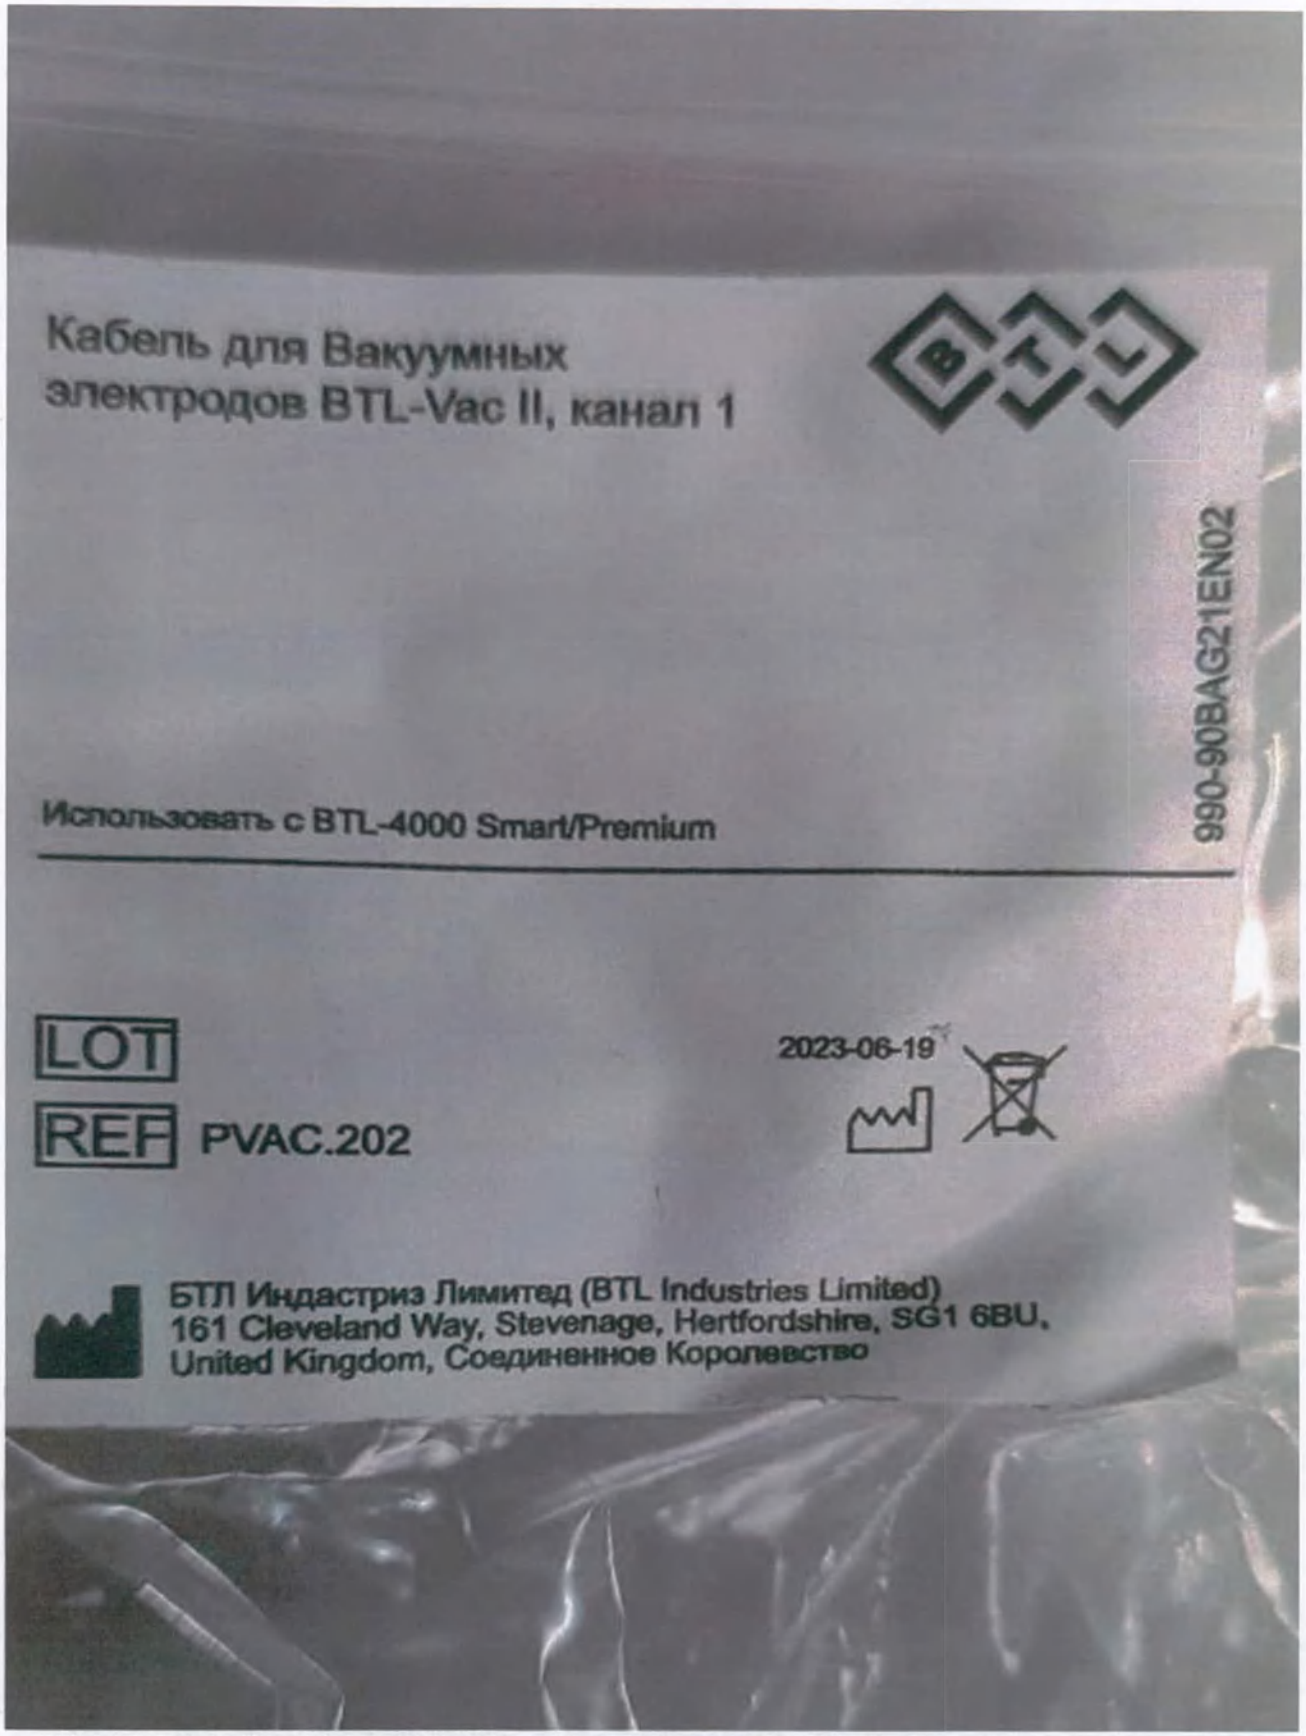



33.1 Маркировка кабеля для Вакуумных электродов BTL-Vac II, канал 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




34. Кабель для Вакуумных электродов BTL-Vac II, канал 2 (не более 8 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

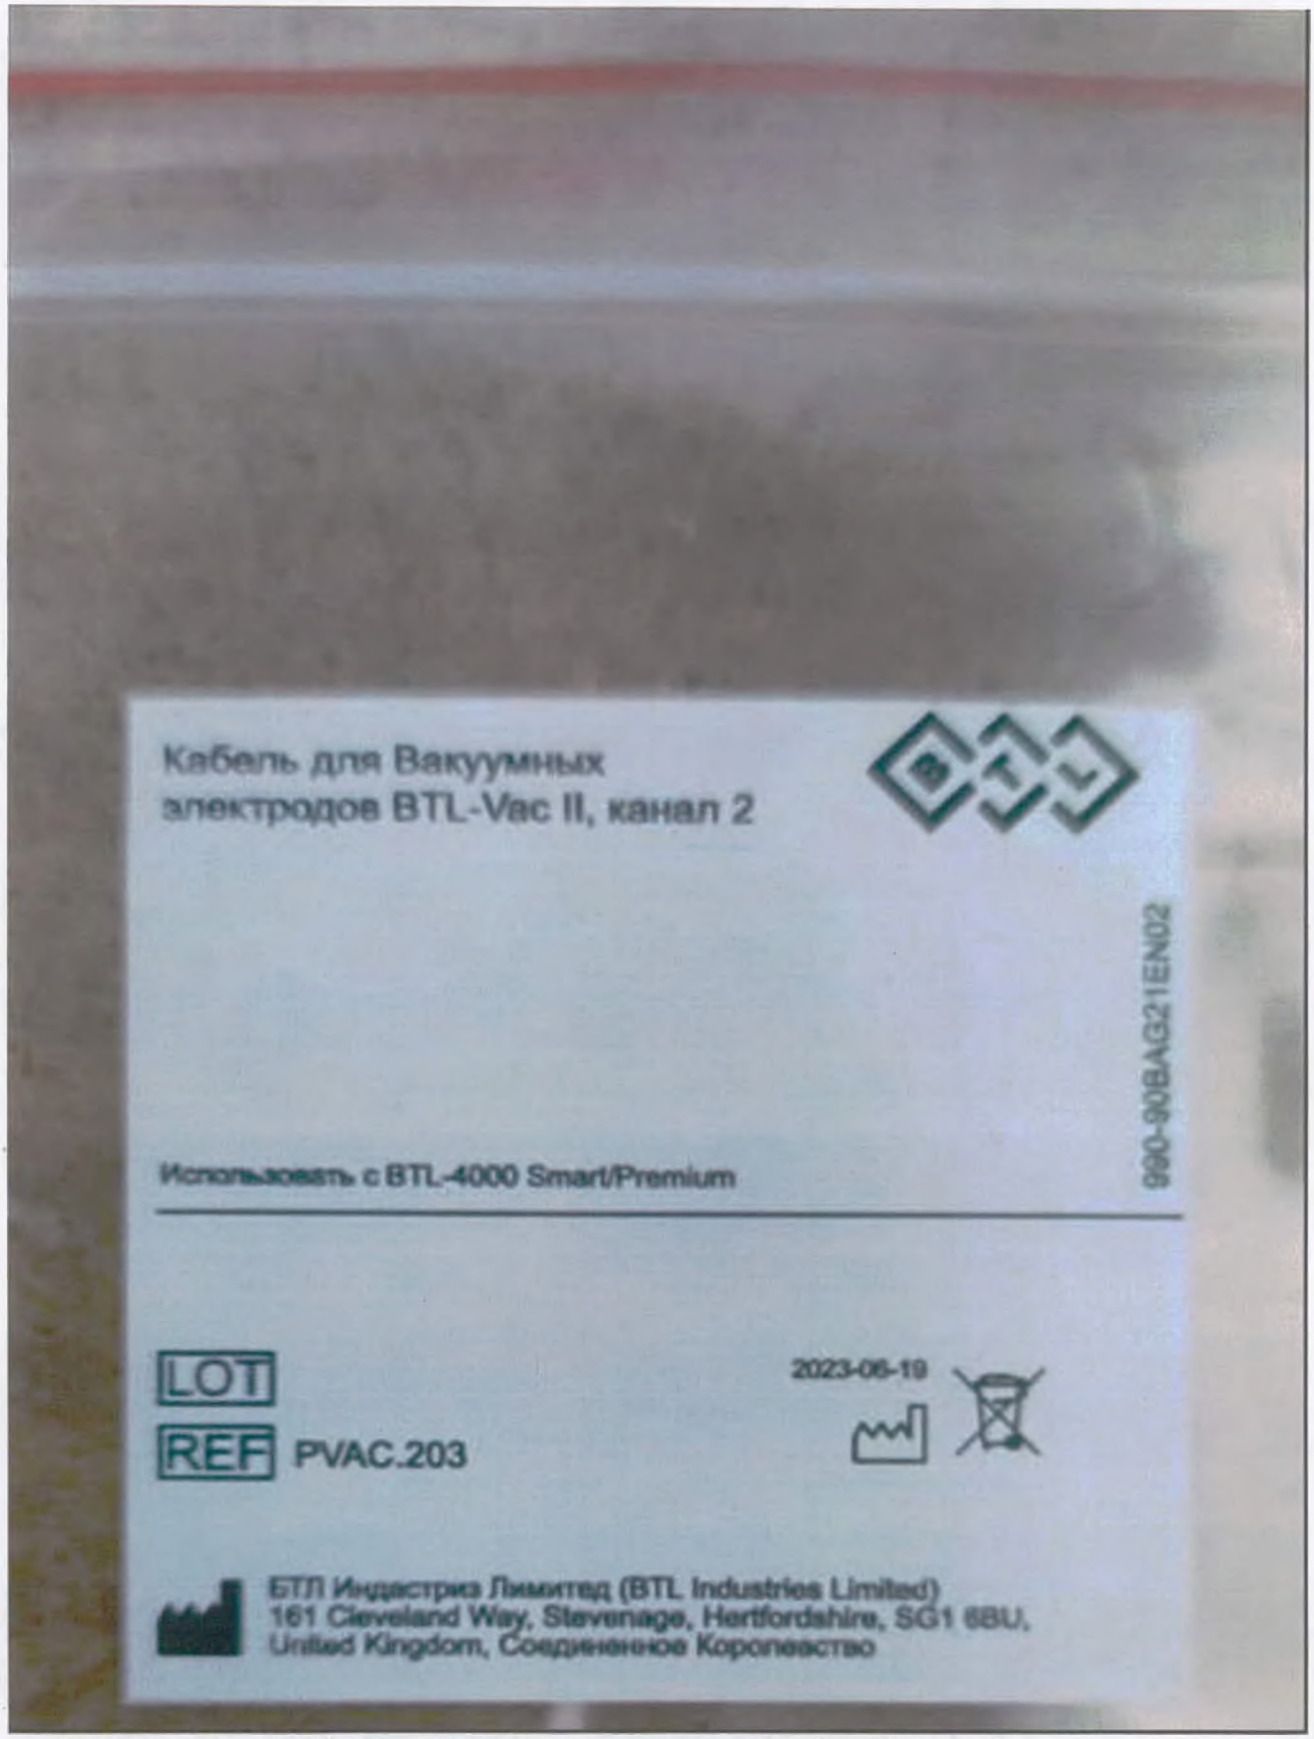



34.1 Маркировка кабеля для Вакуумных электродов BTL-Vac II, канал 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

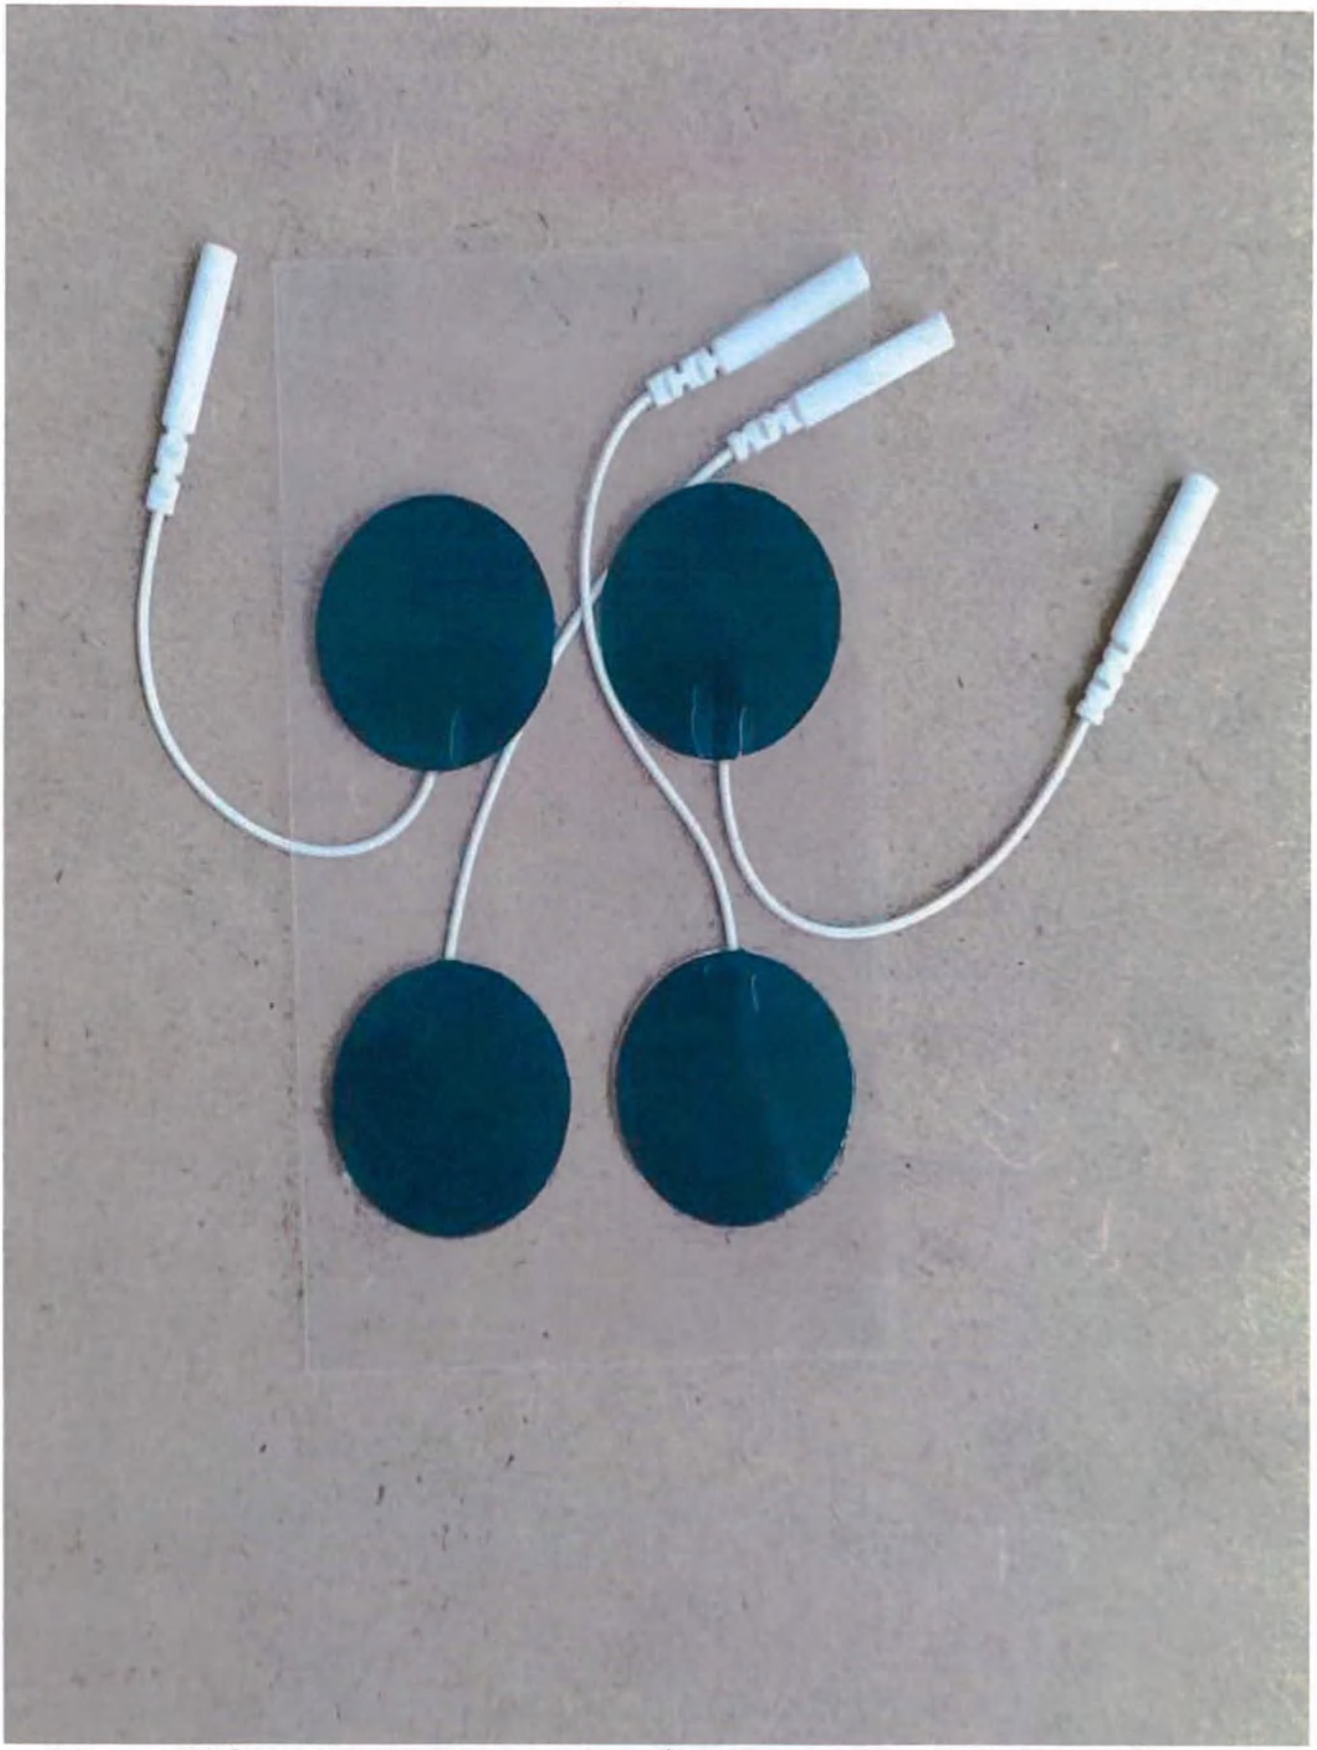


35. Набор самоклеящихся электродов, Ø 32 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

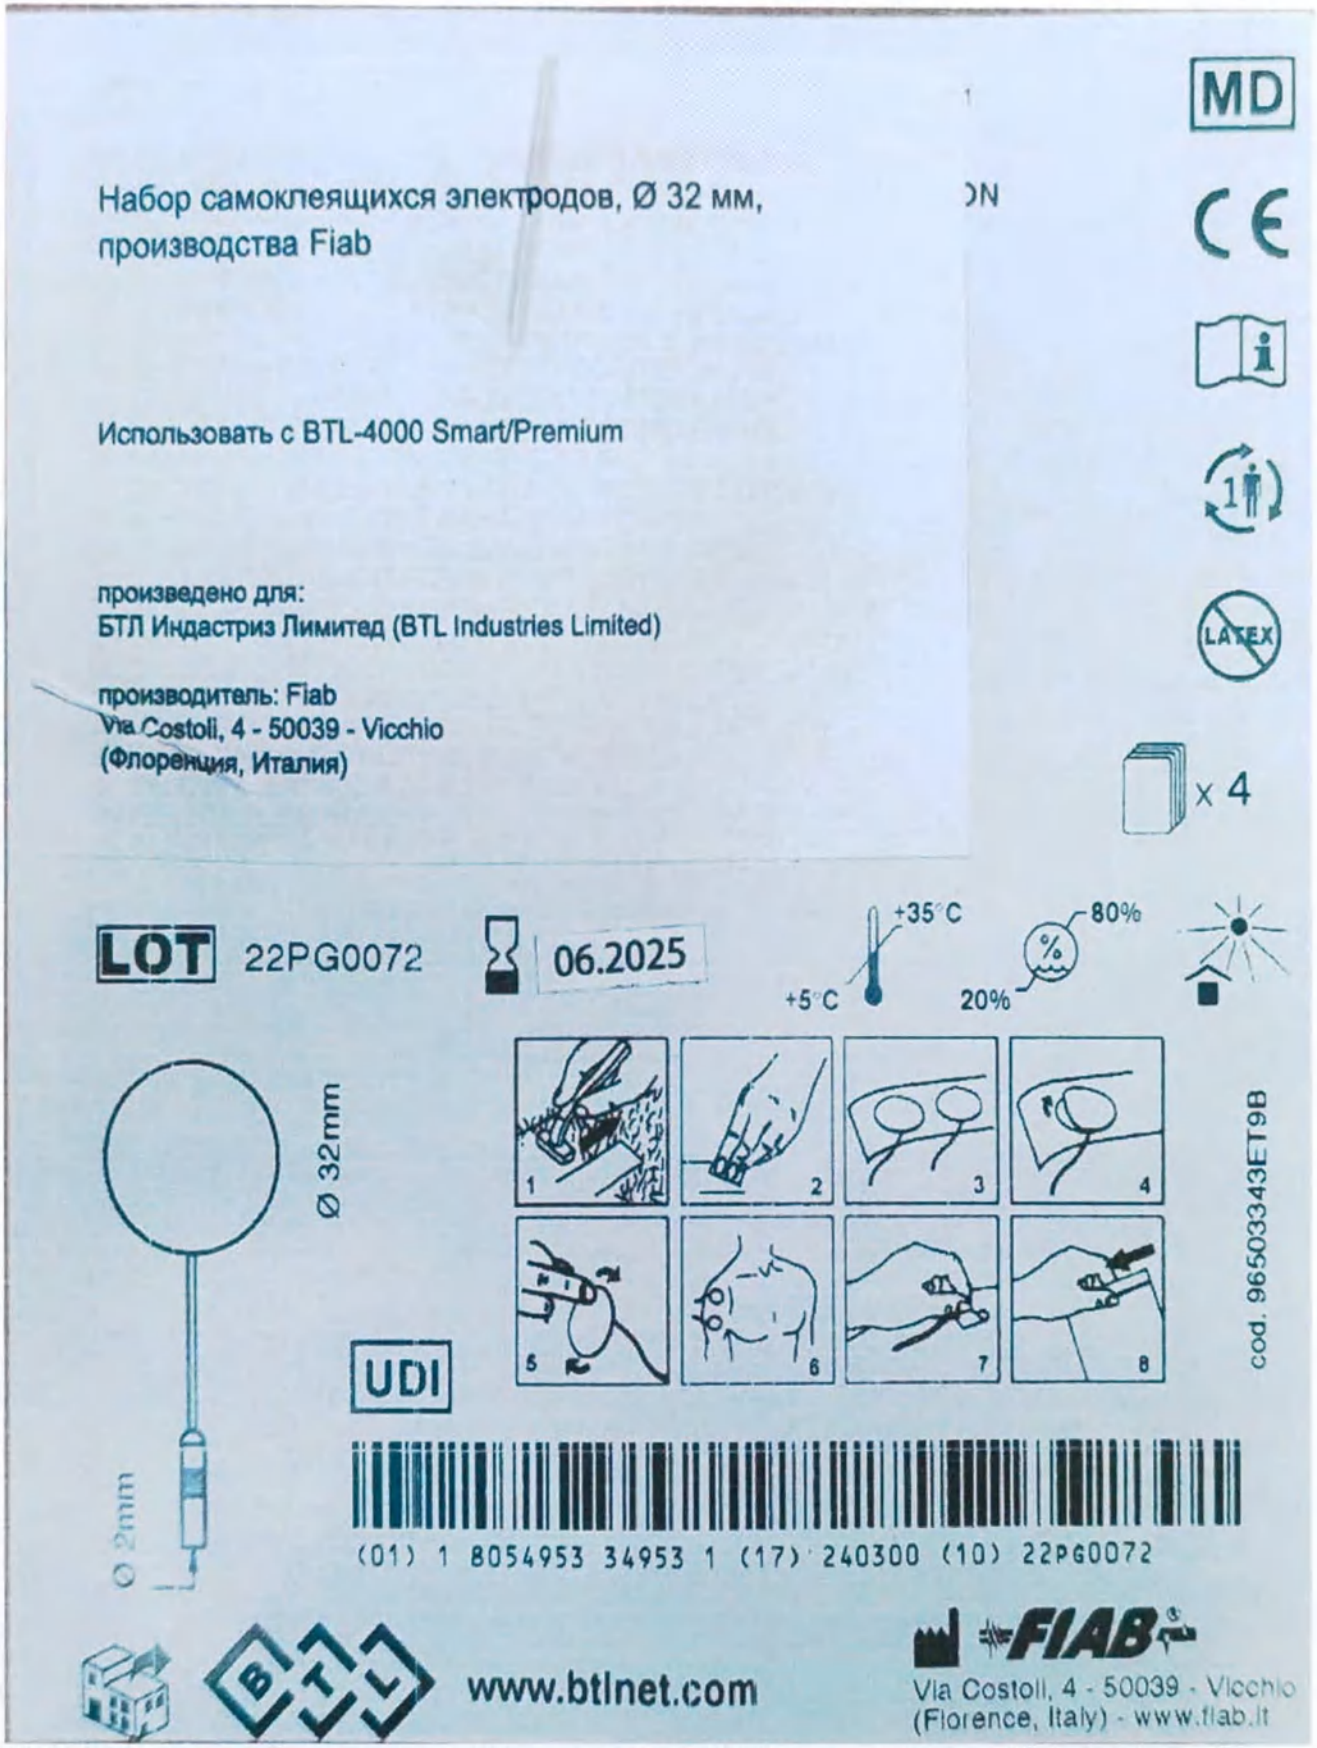


35.1 Маркировка набора самоклеящихся электродов, Ø 32 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

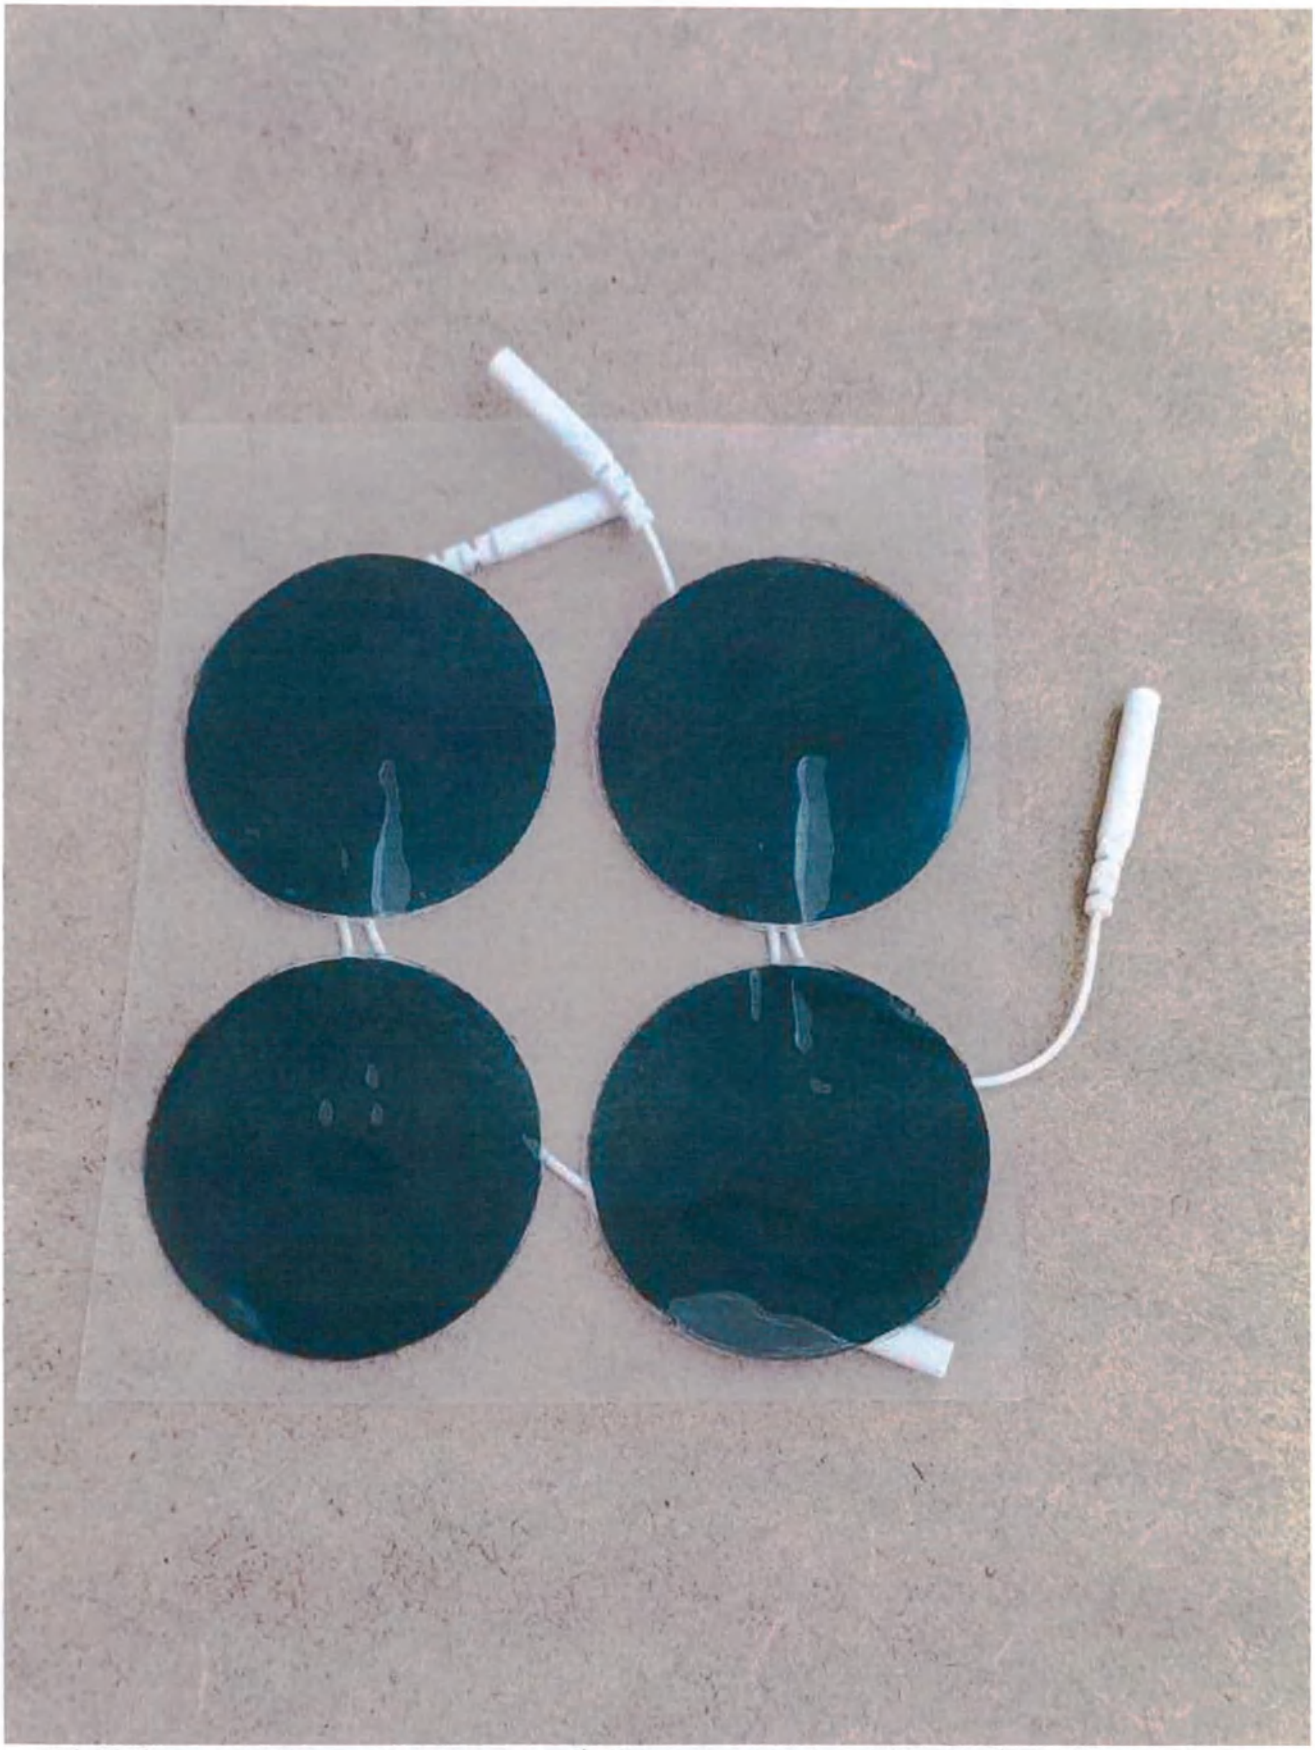


36. Набор самоклеящихся электродов, Ø 50 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





36.1 Маркировка набор самоклеящихся электродов, Ø 50 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

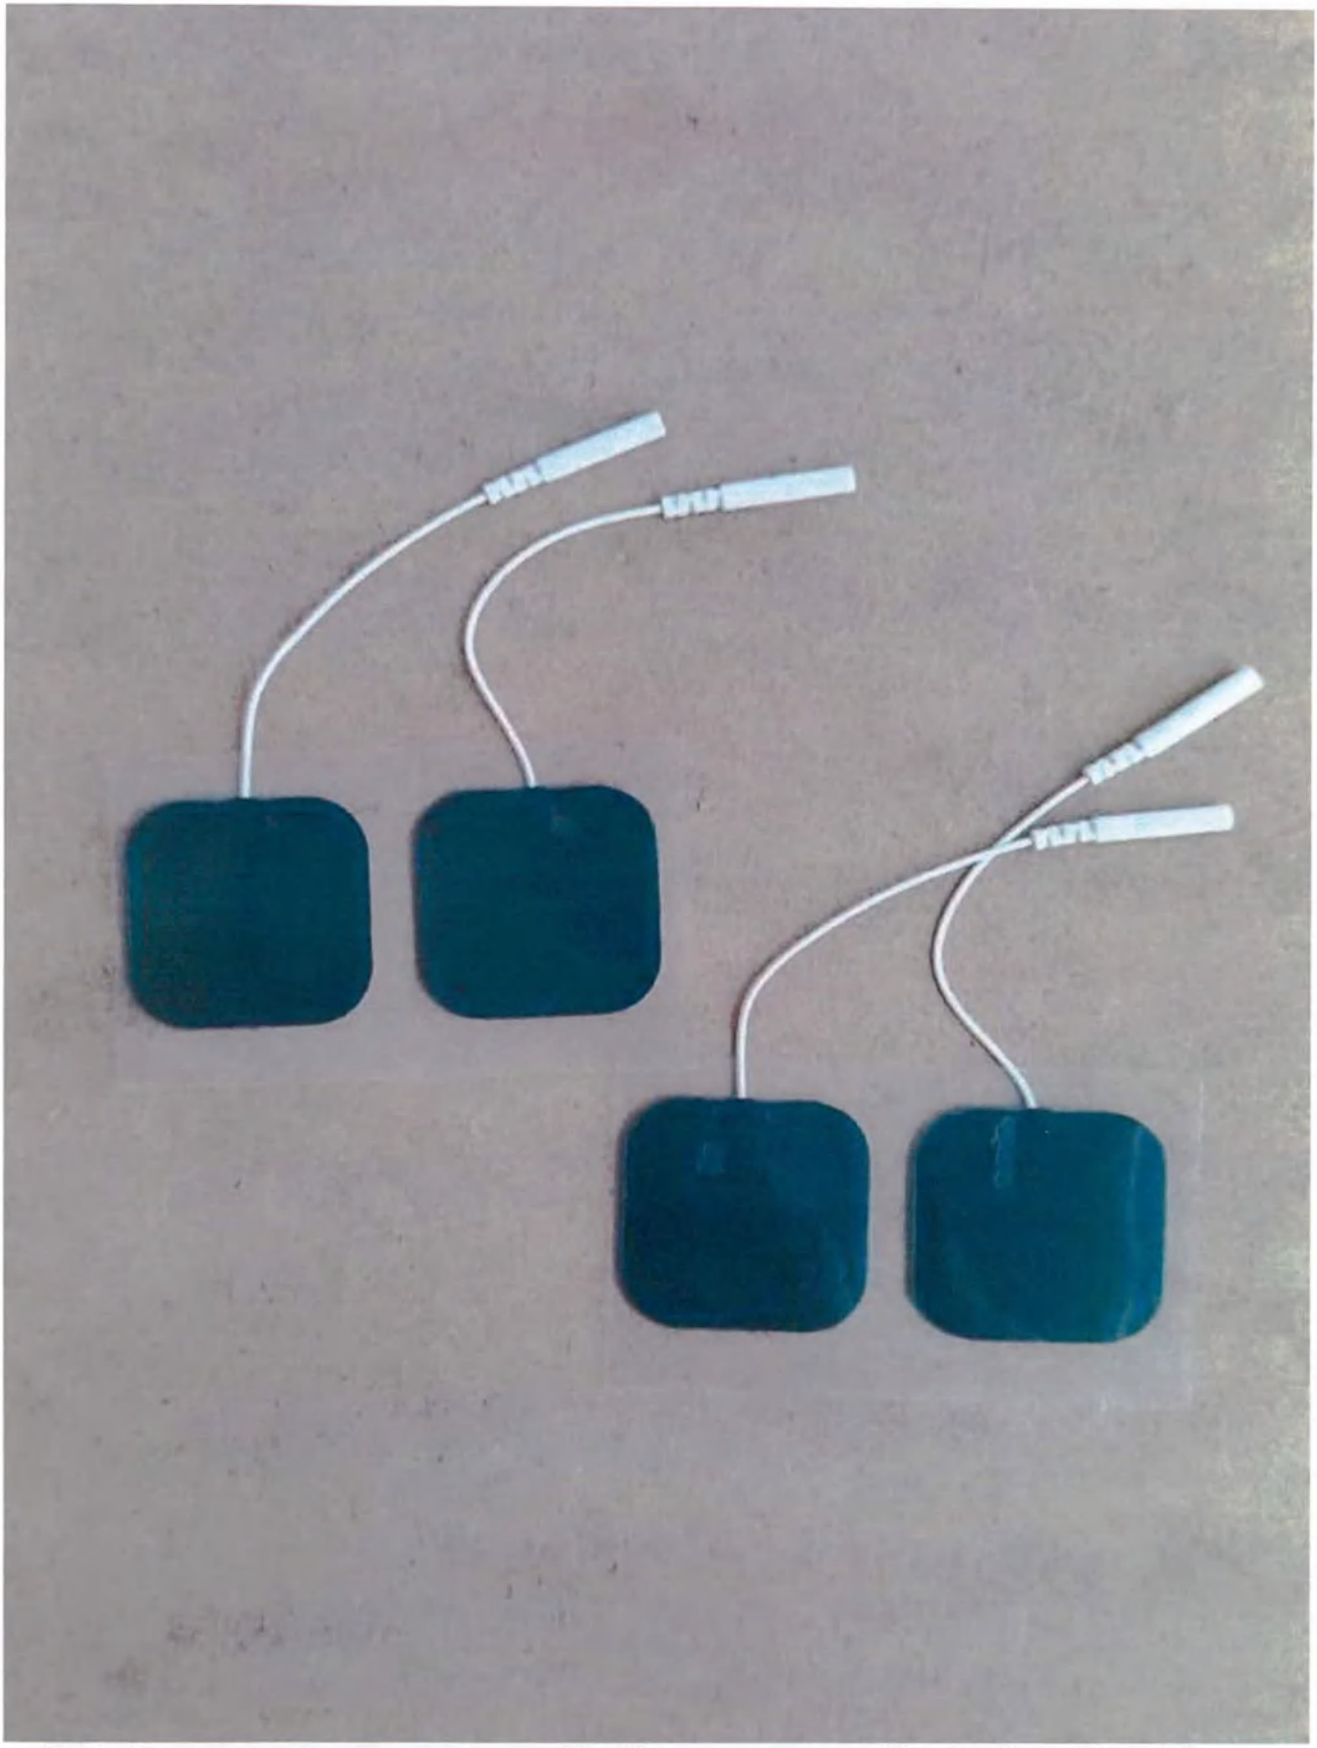


37. Набор самоклеящихся электродов, 40 × 40 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

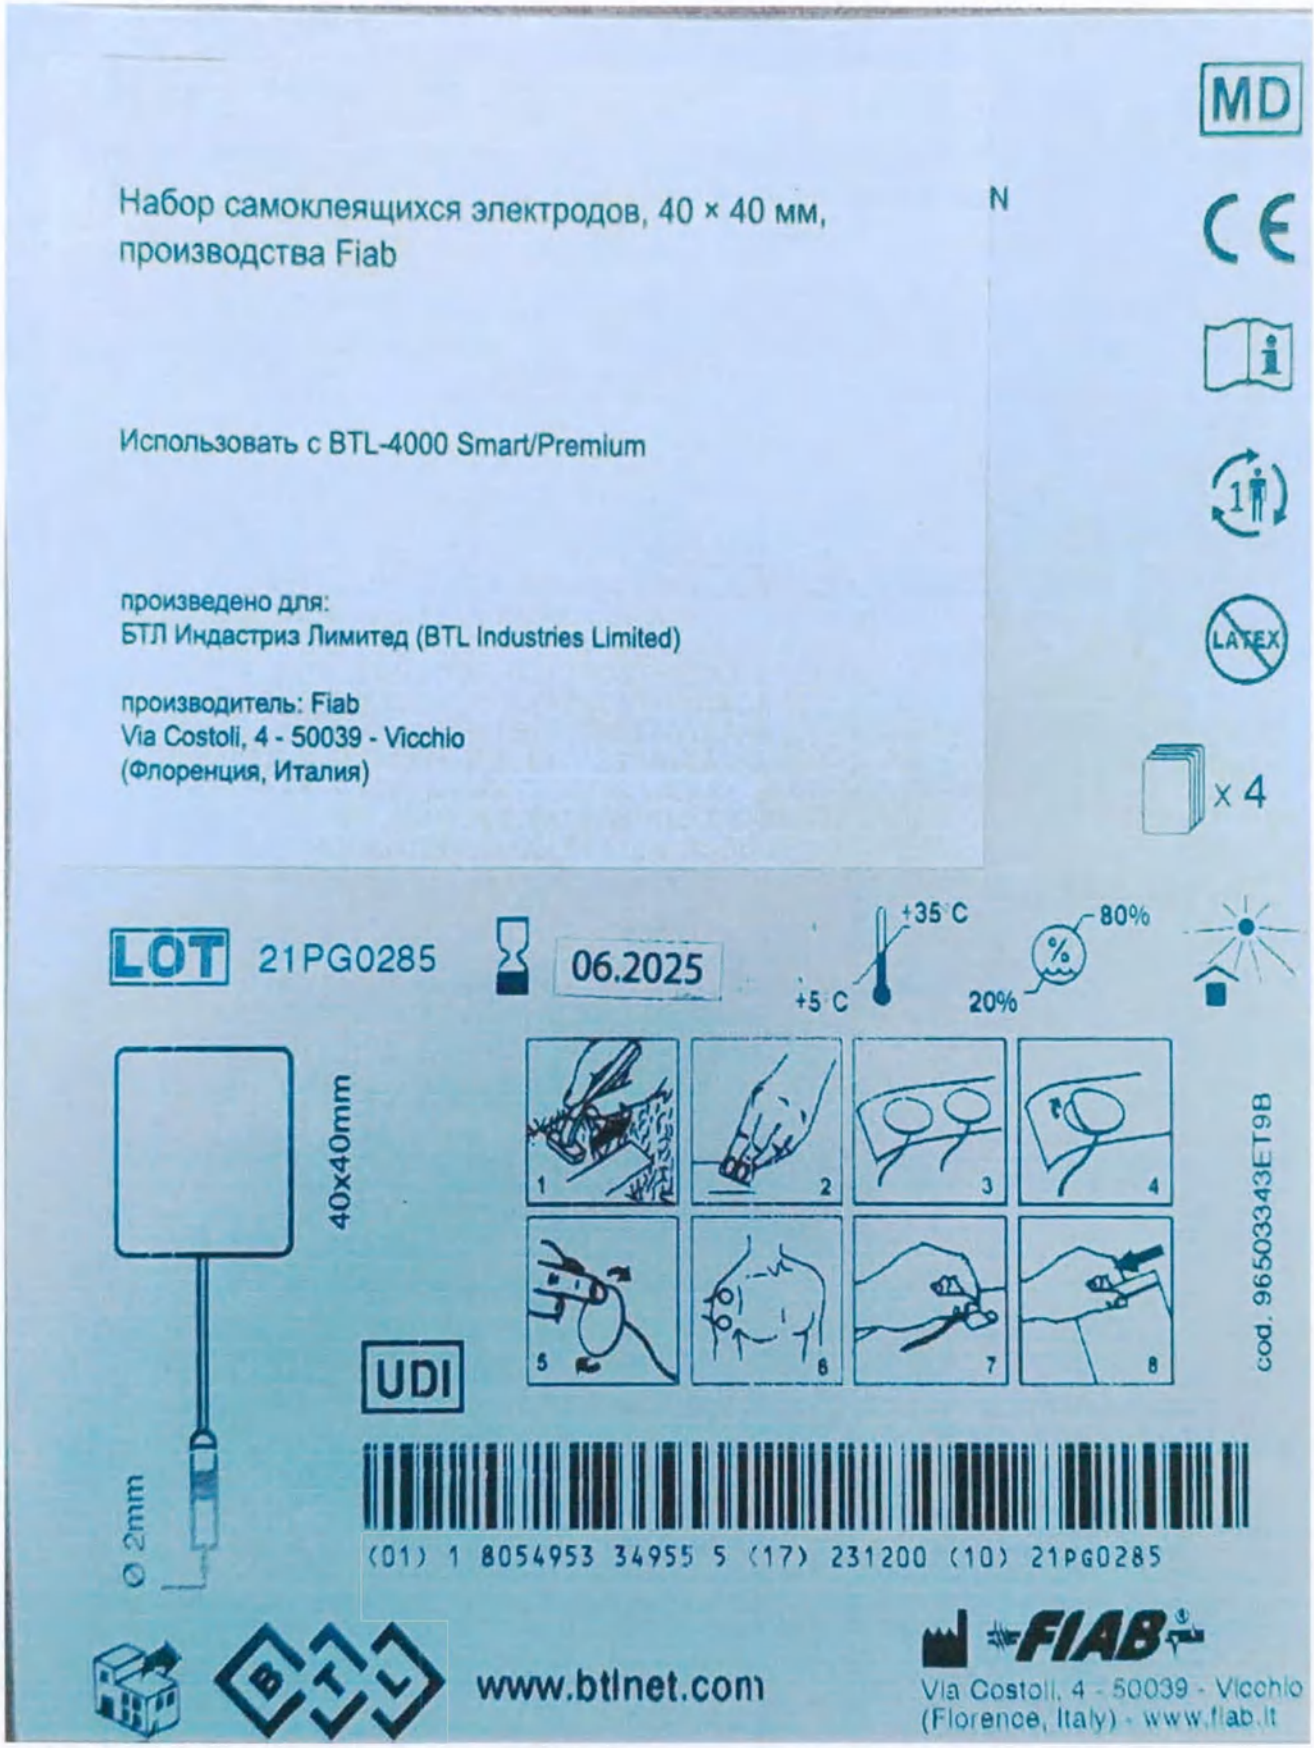



37.1 Маркировка набора самоклеящихся электродов, 40 × 40 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

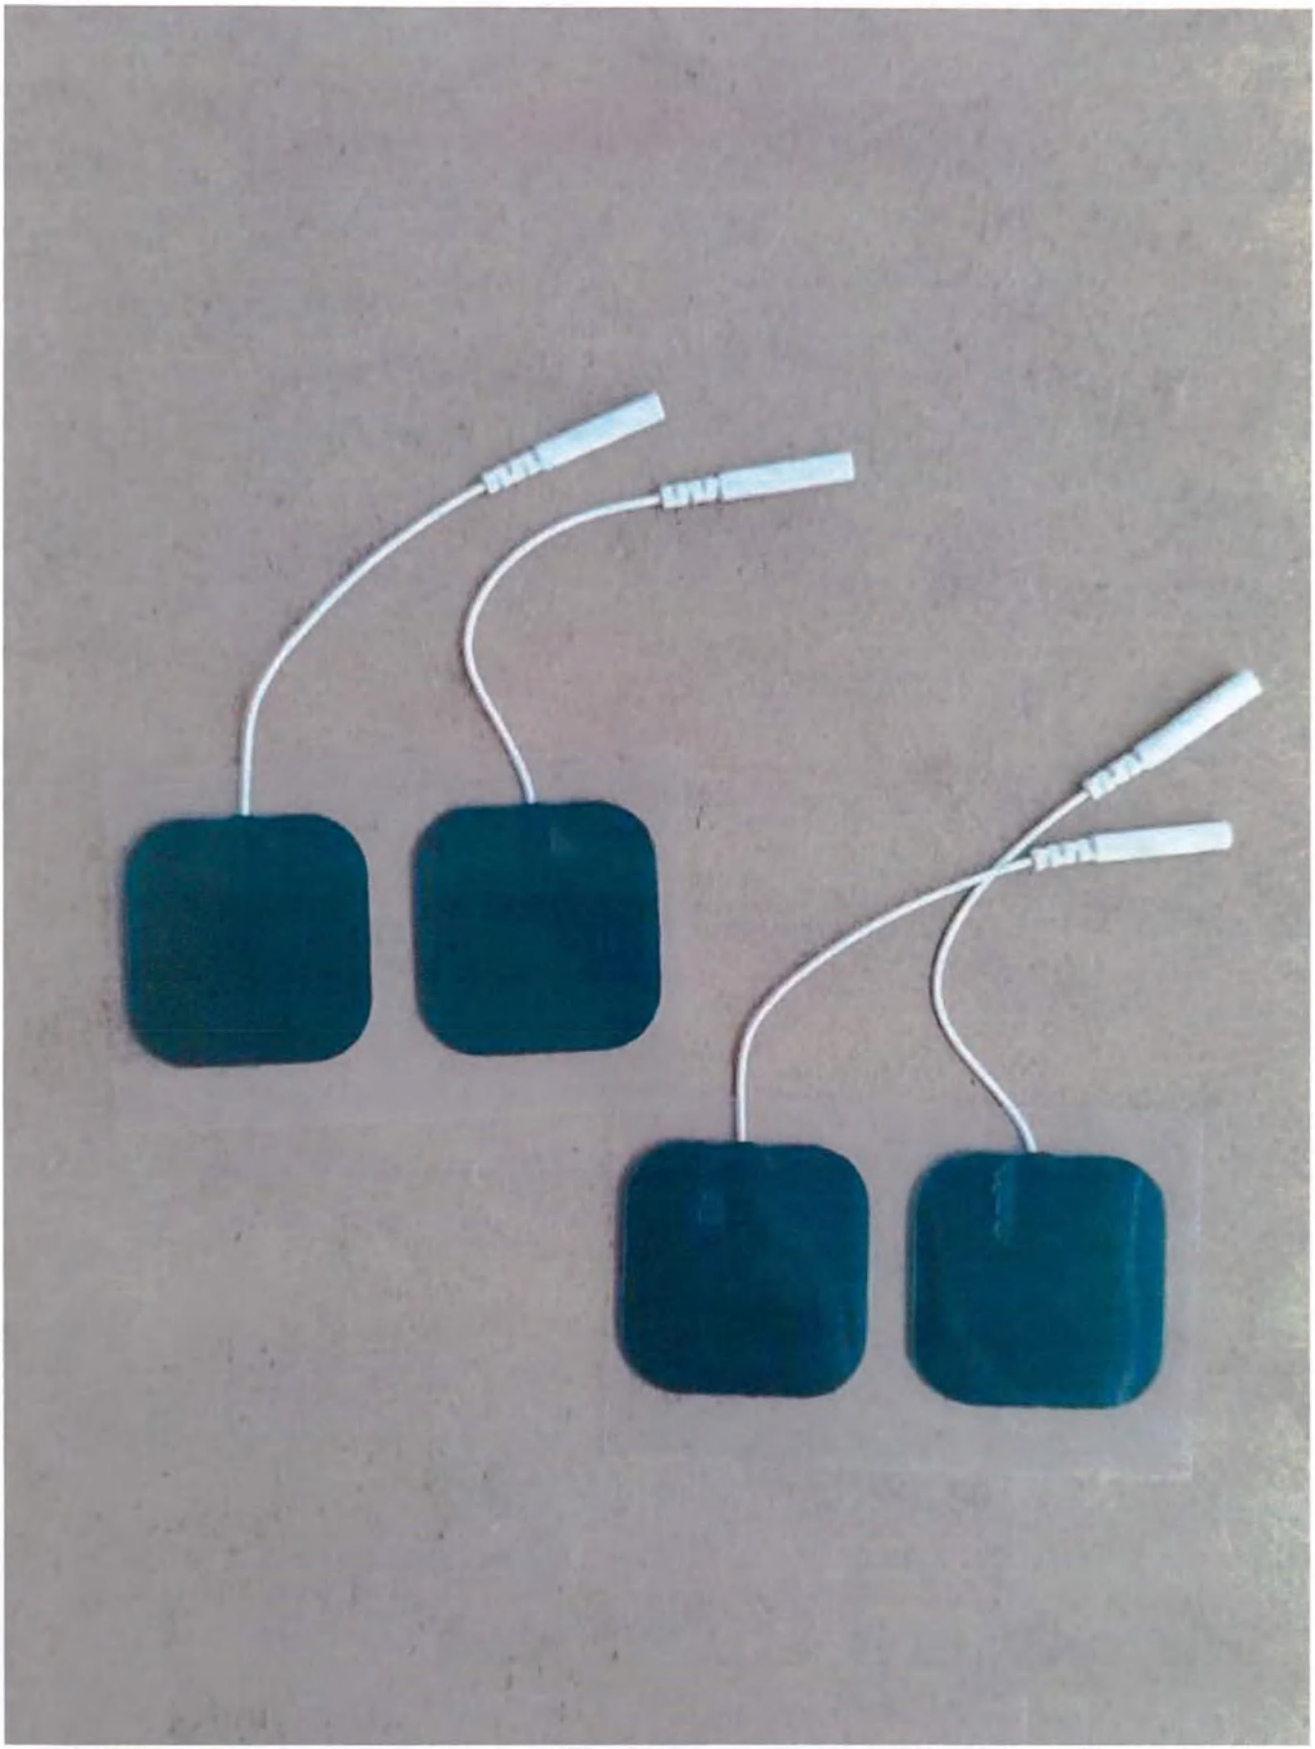


38. Набор самоклеящихся электродов, 50 × 50 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

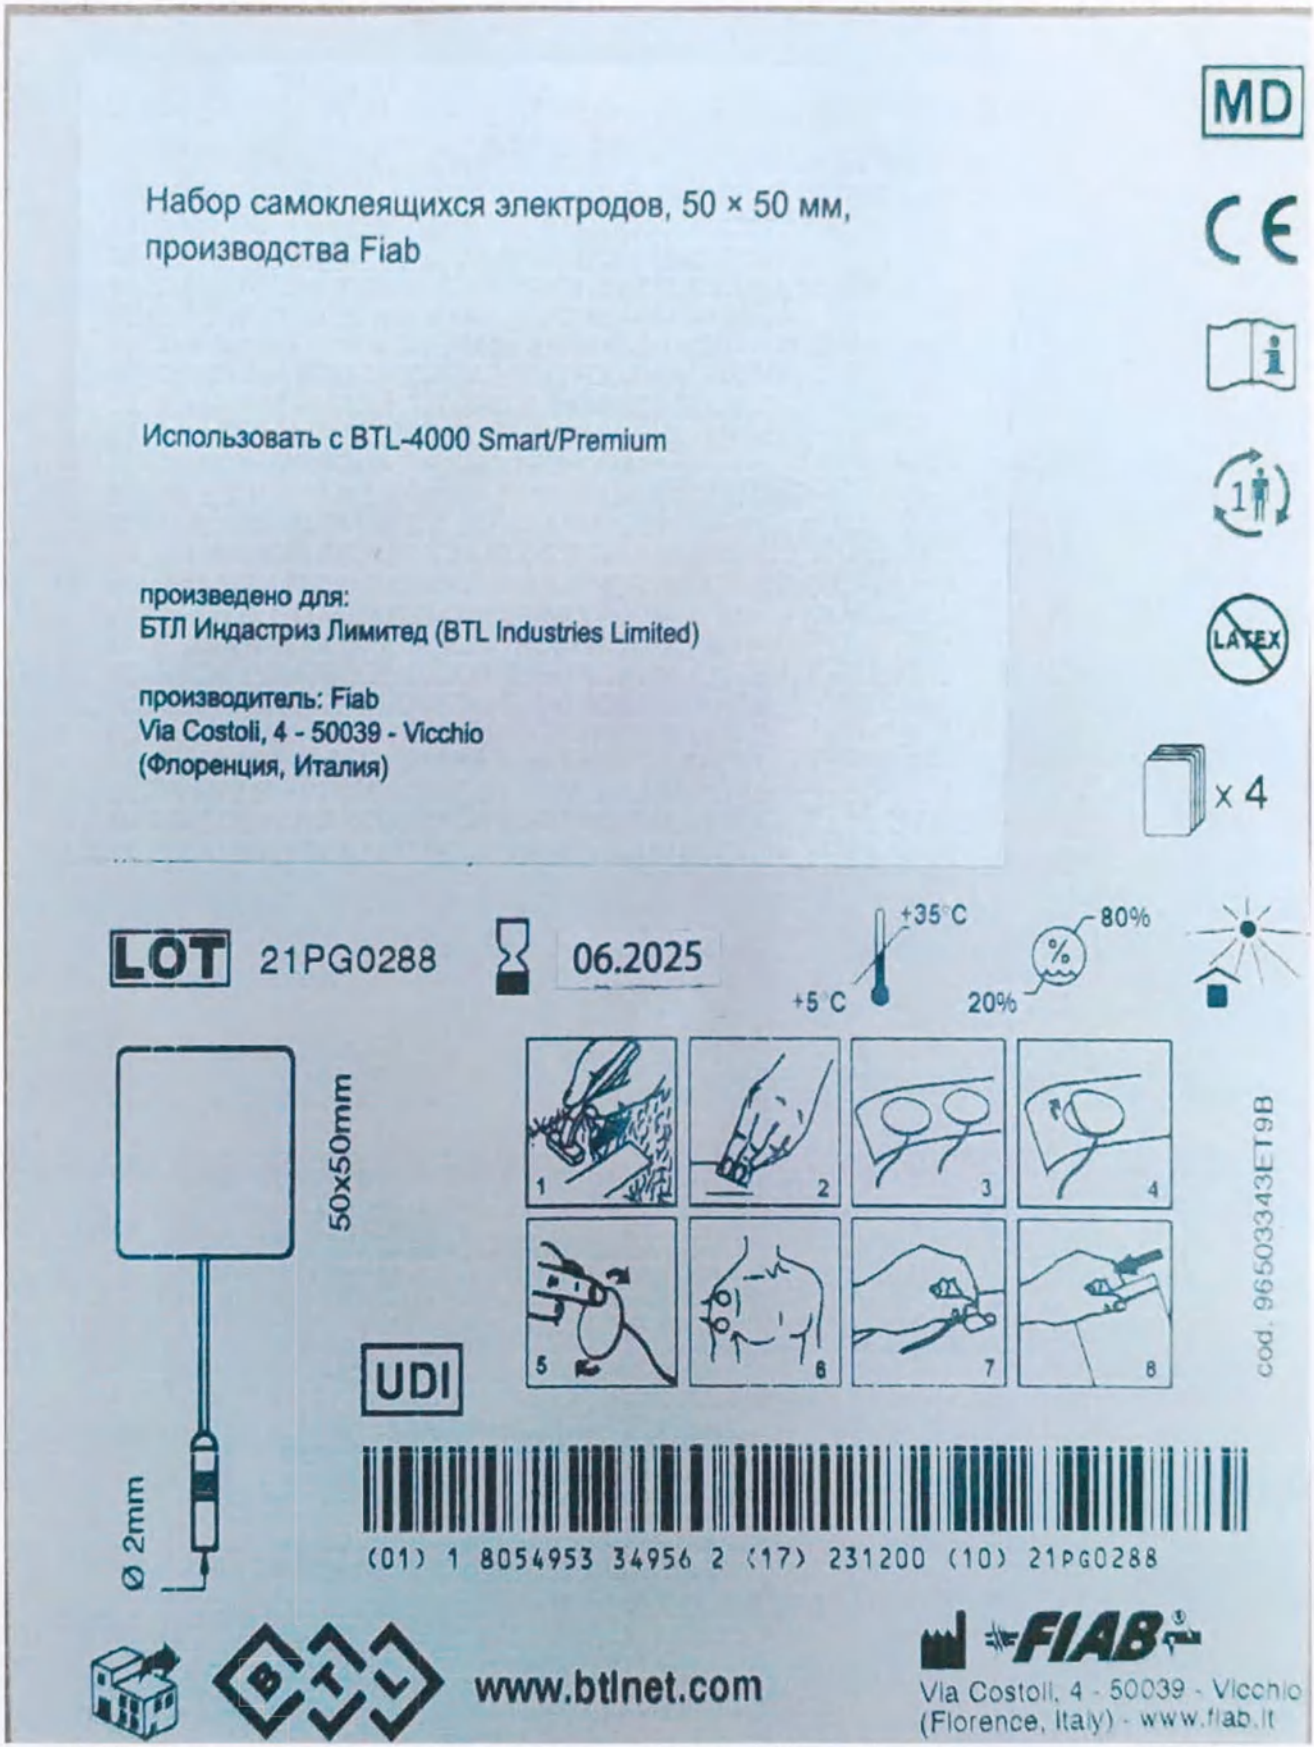


38.1 Маркировка набора самоклеящихся электродов, 50 × 50 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

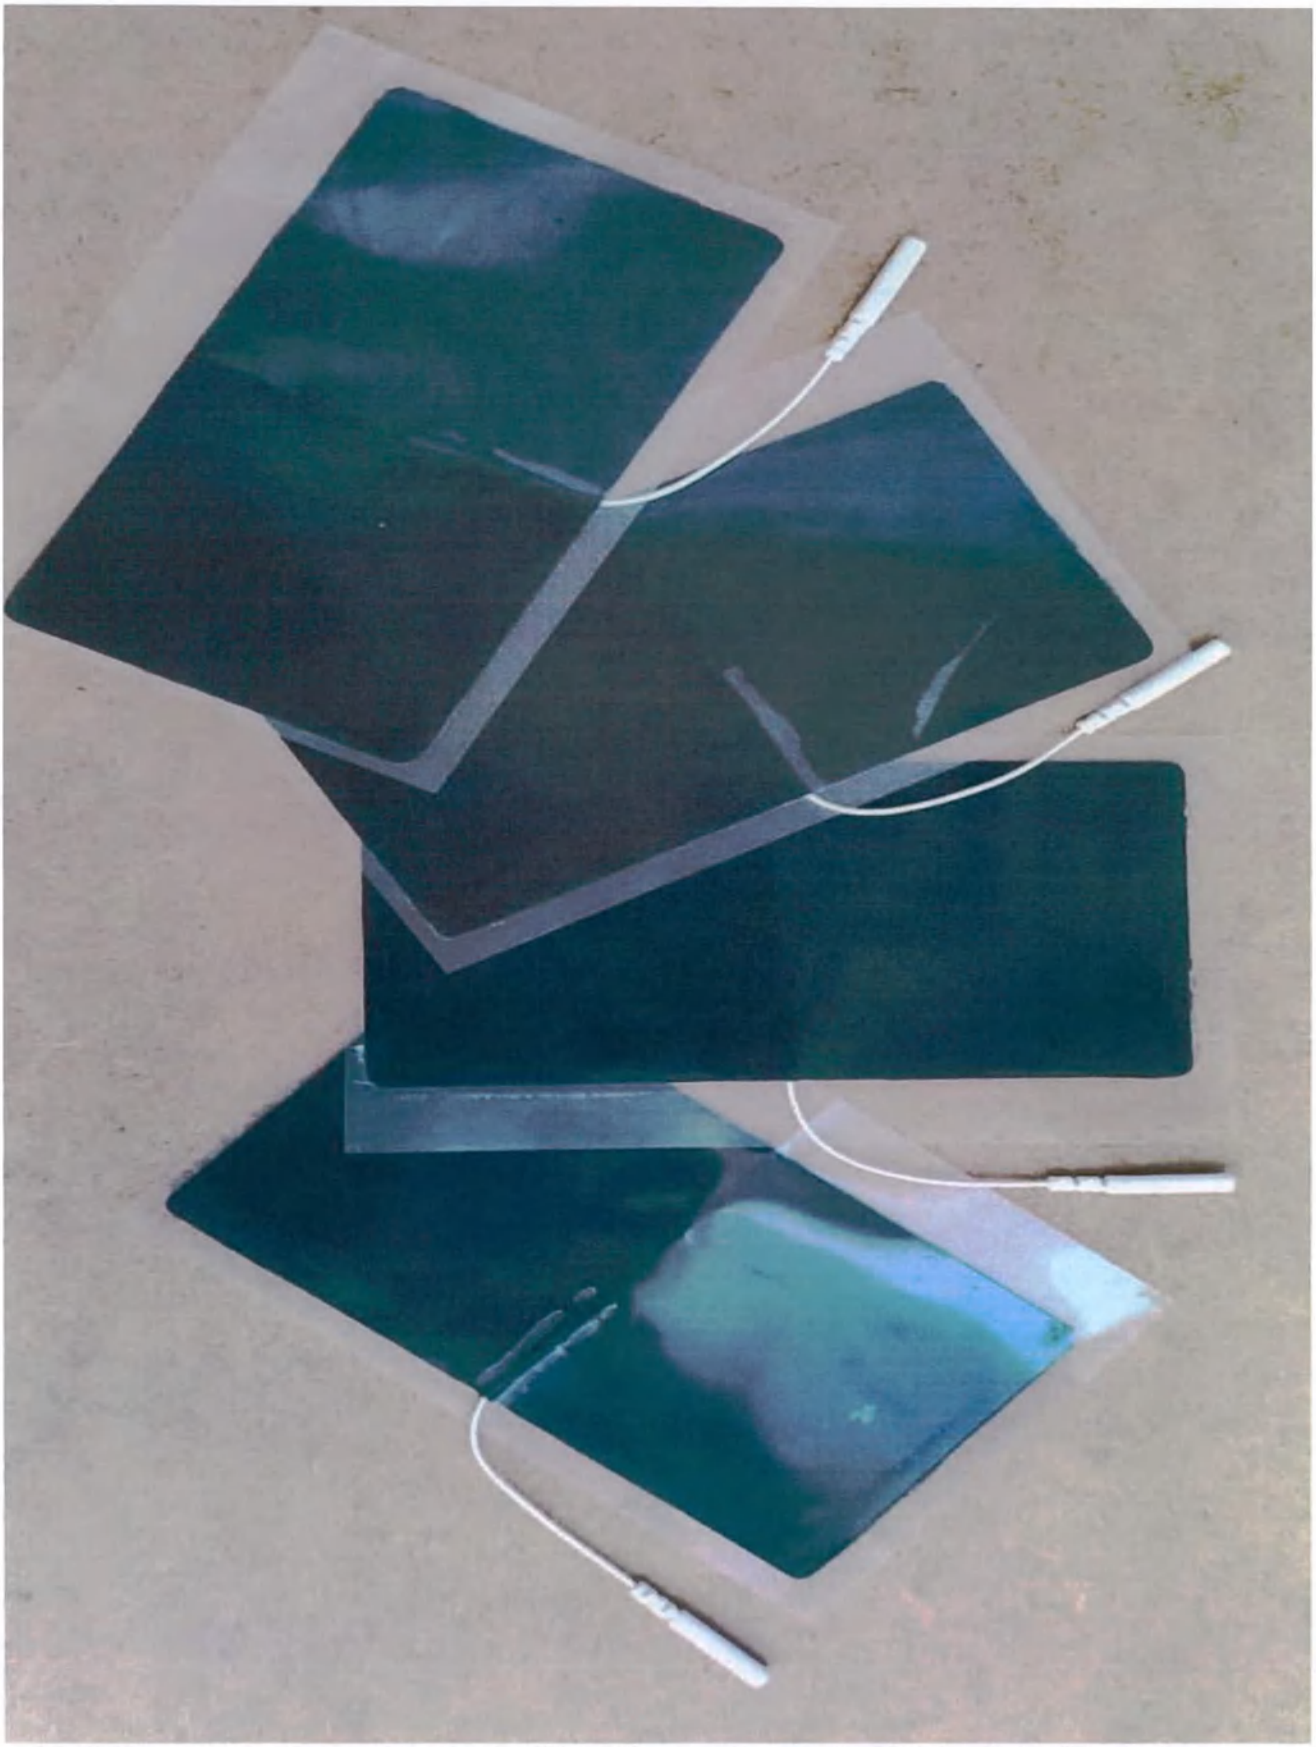


39. Набор самоклеящихся электродов, 75 × 140 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





39.1 Маркировка набора самоклеящихся электродов, 75 × 140 мм производства Fiab (не более 30 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

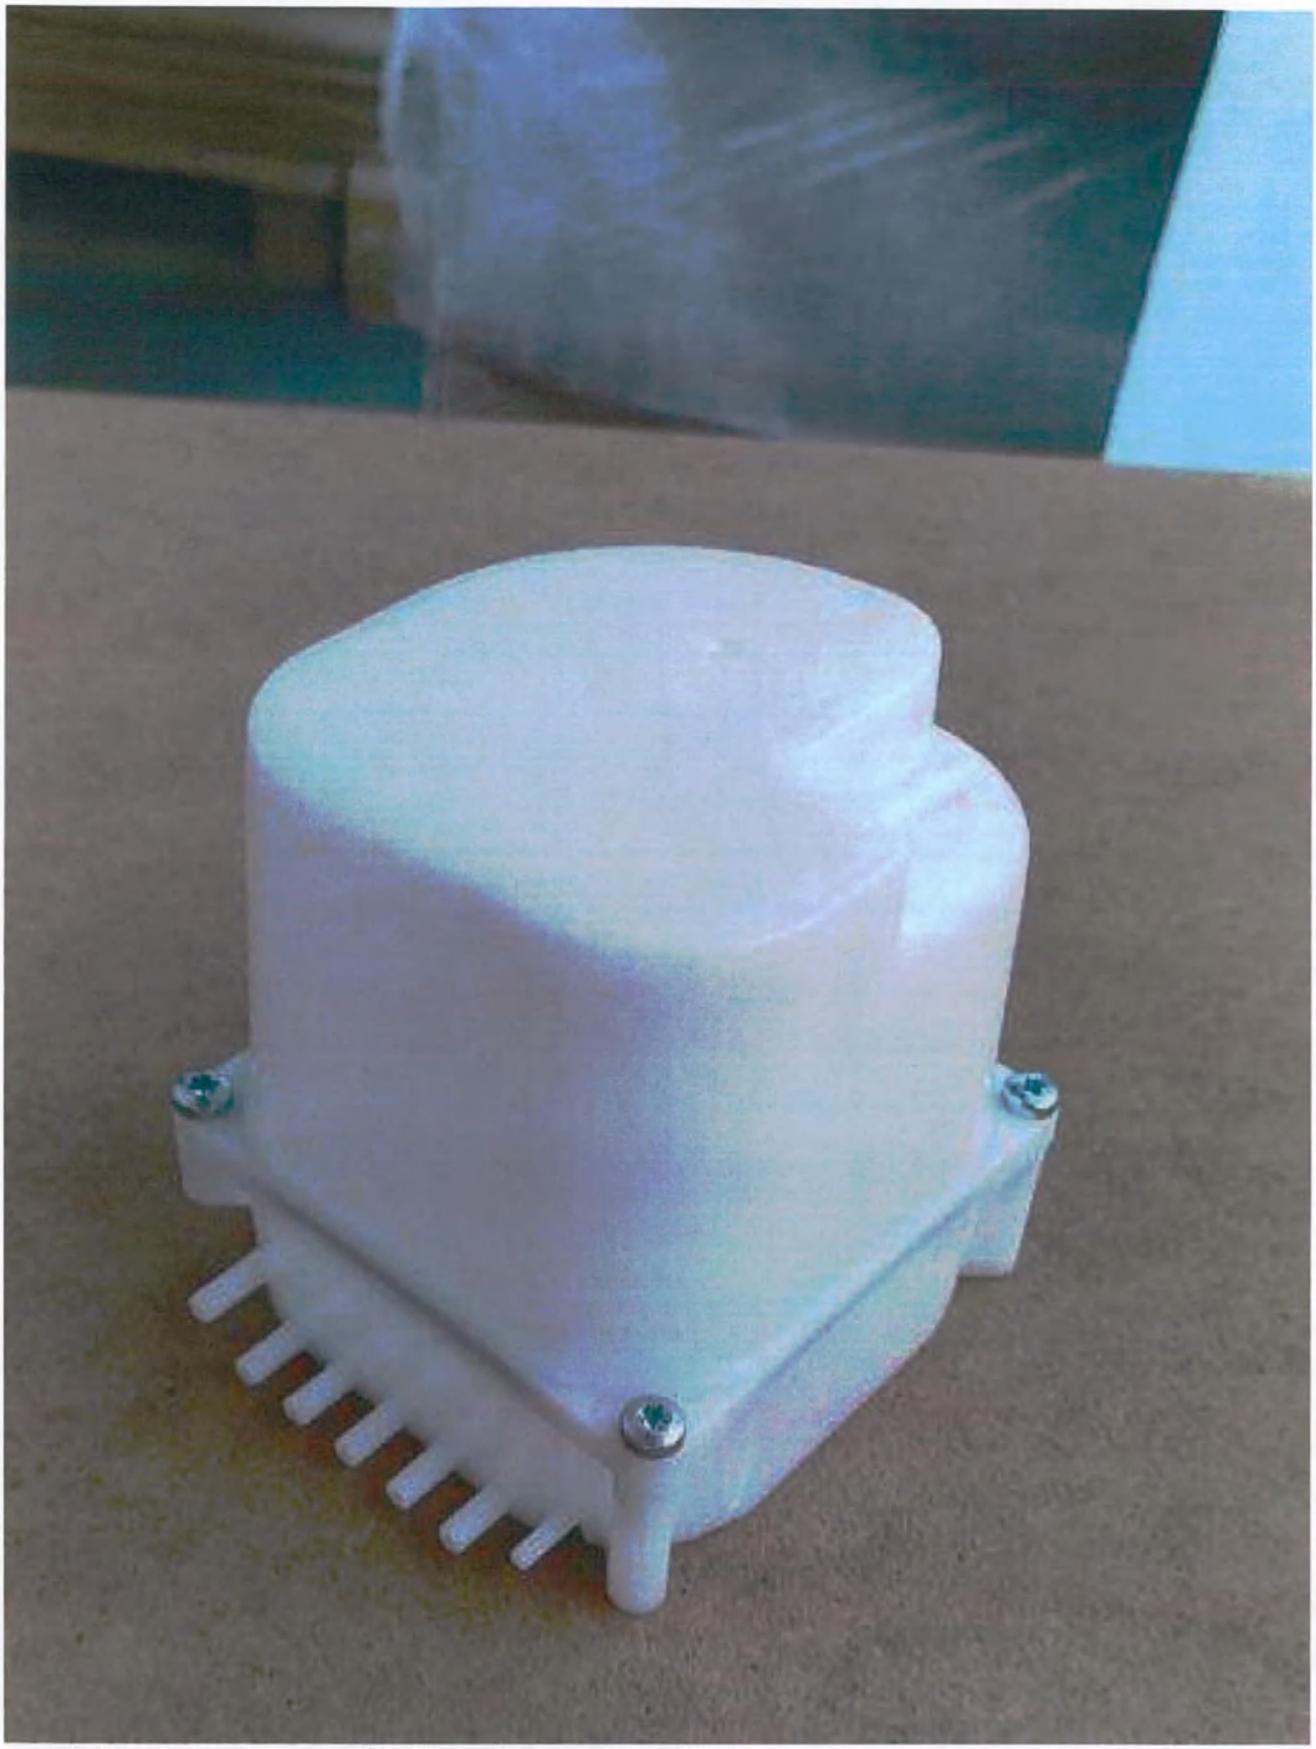


40. Резервуар для воды (не более 2 шт.) (при необходимости)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

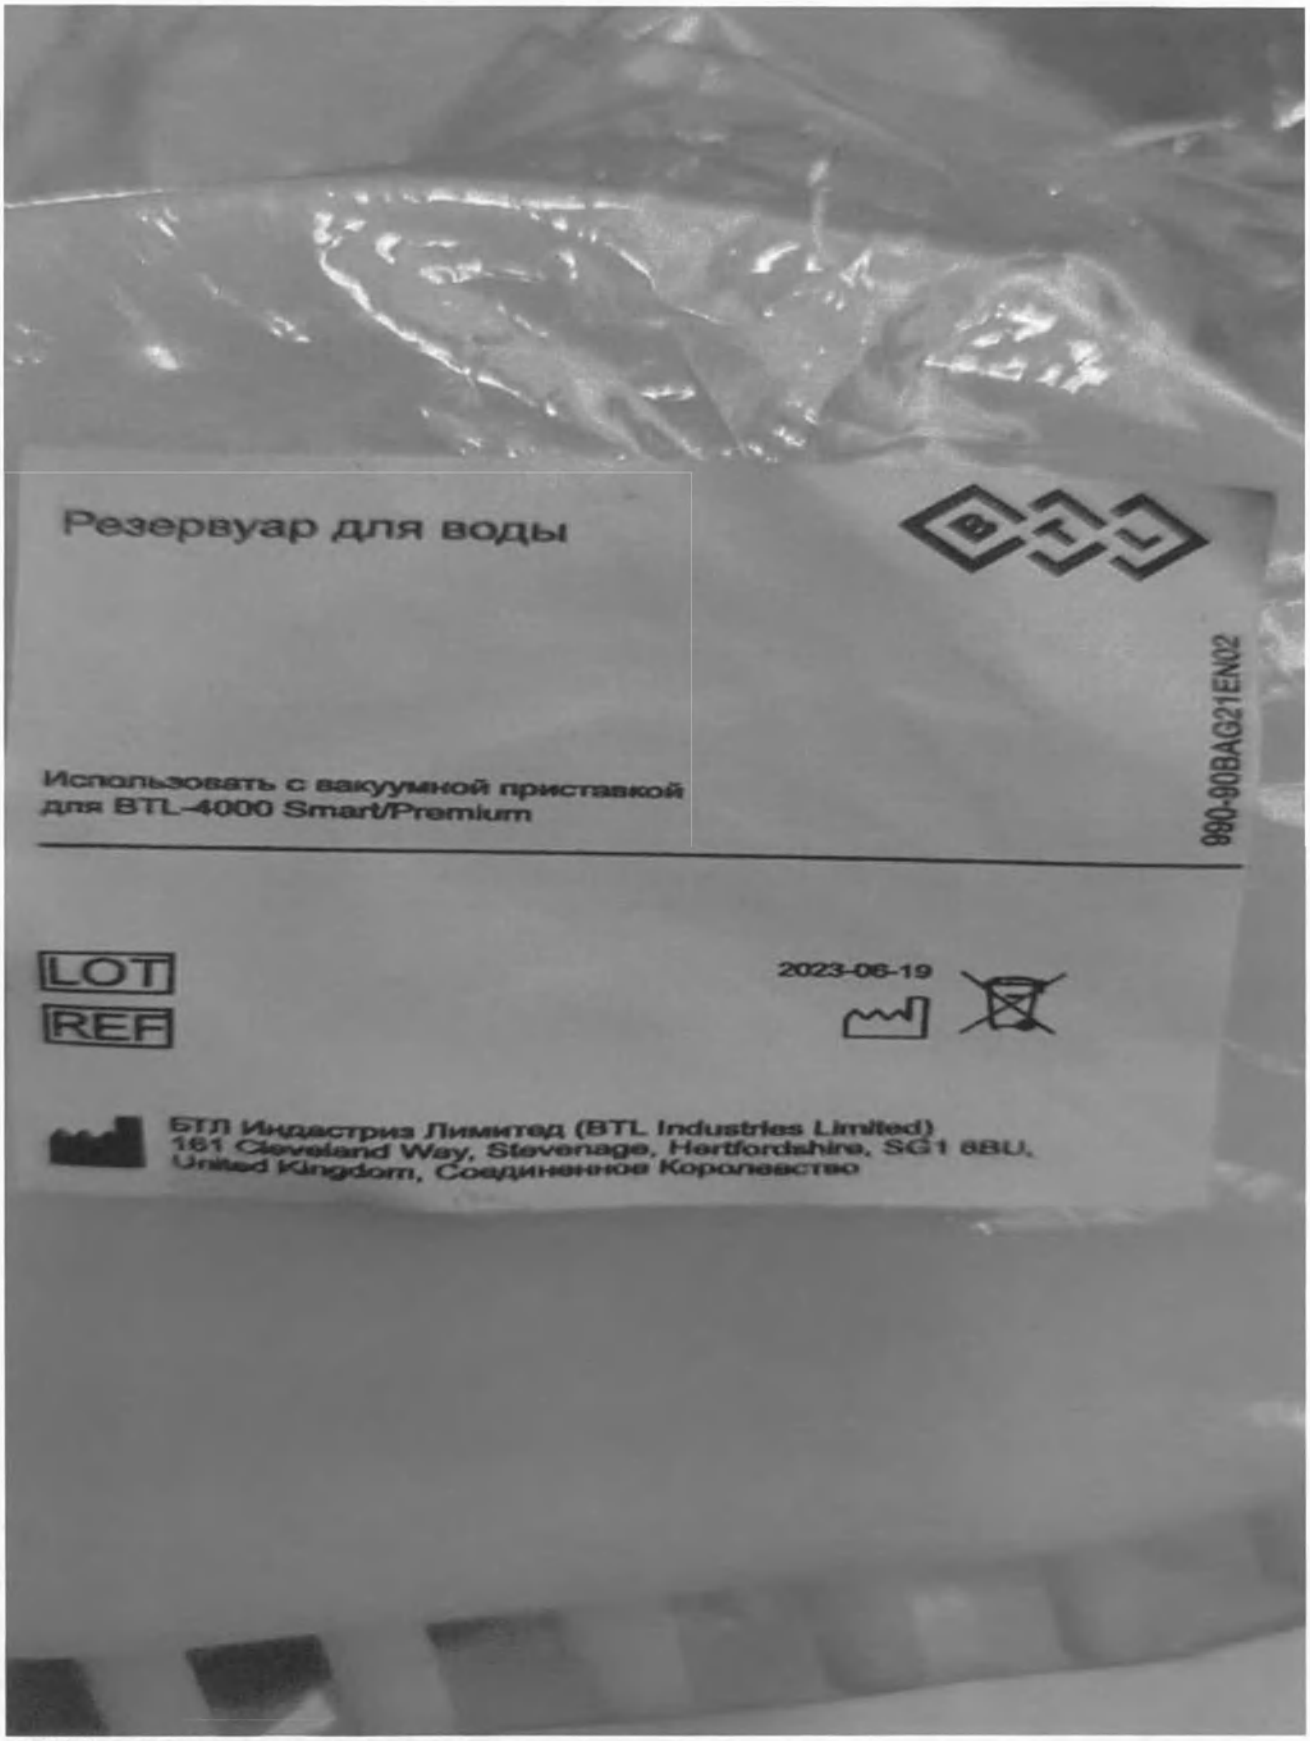


40.1 Маркировка резервуара для воды

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

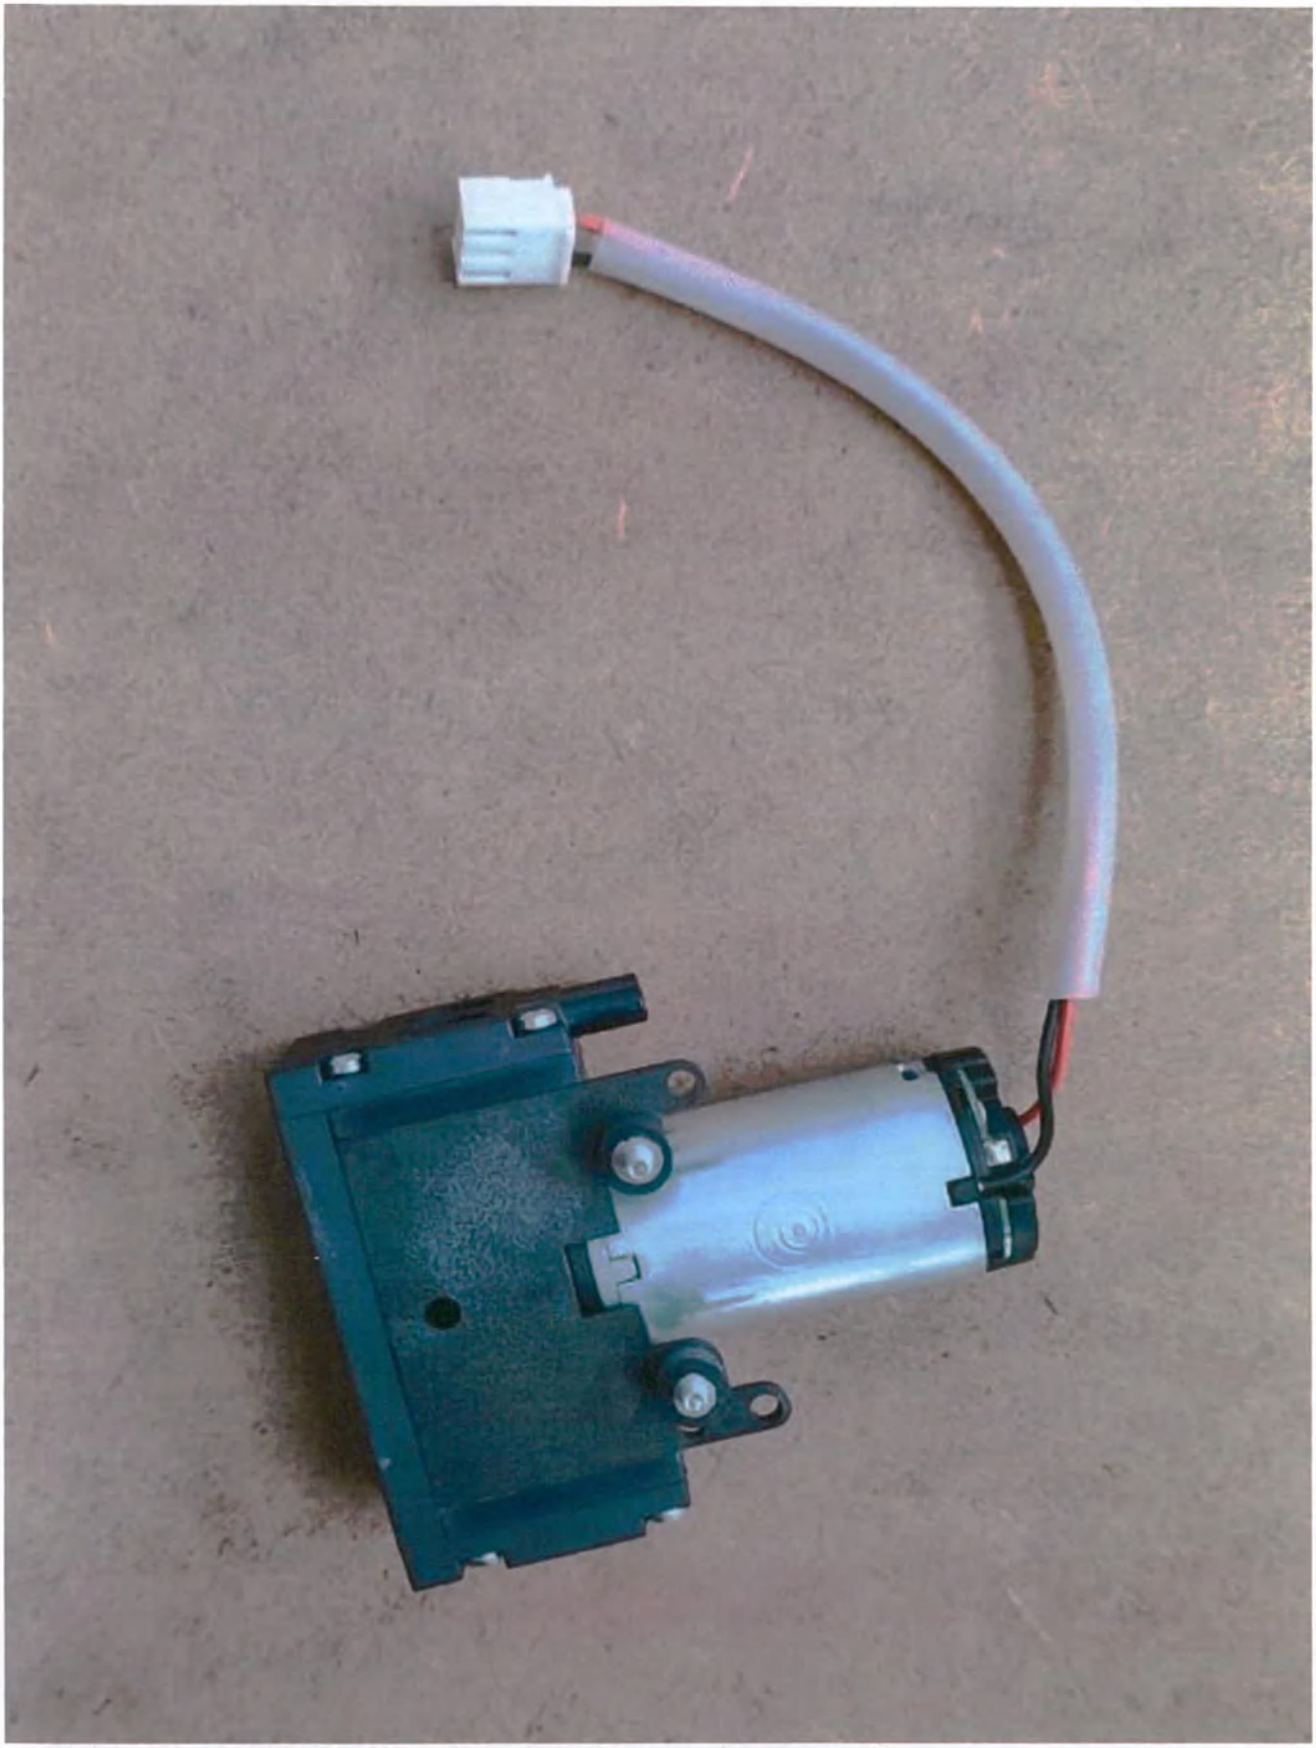

41. Помпа для BTL-Vac II (не более 2 шт.) (при необходимости)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности:

# ТЕЛЕЖКА BTL-040-06

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ТЕЛЕЖКИ


1. Руководство по сборке тележки (не более 2 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



2. Держатель для салфеток (1 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

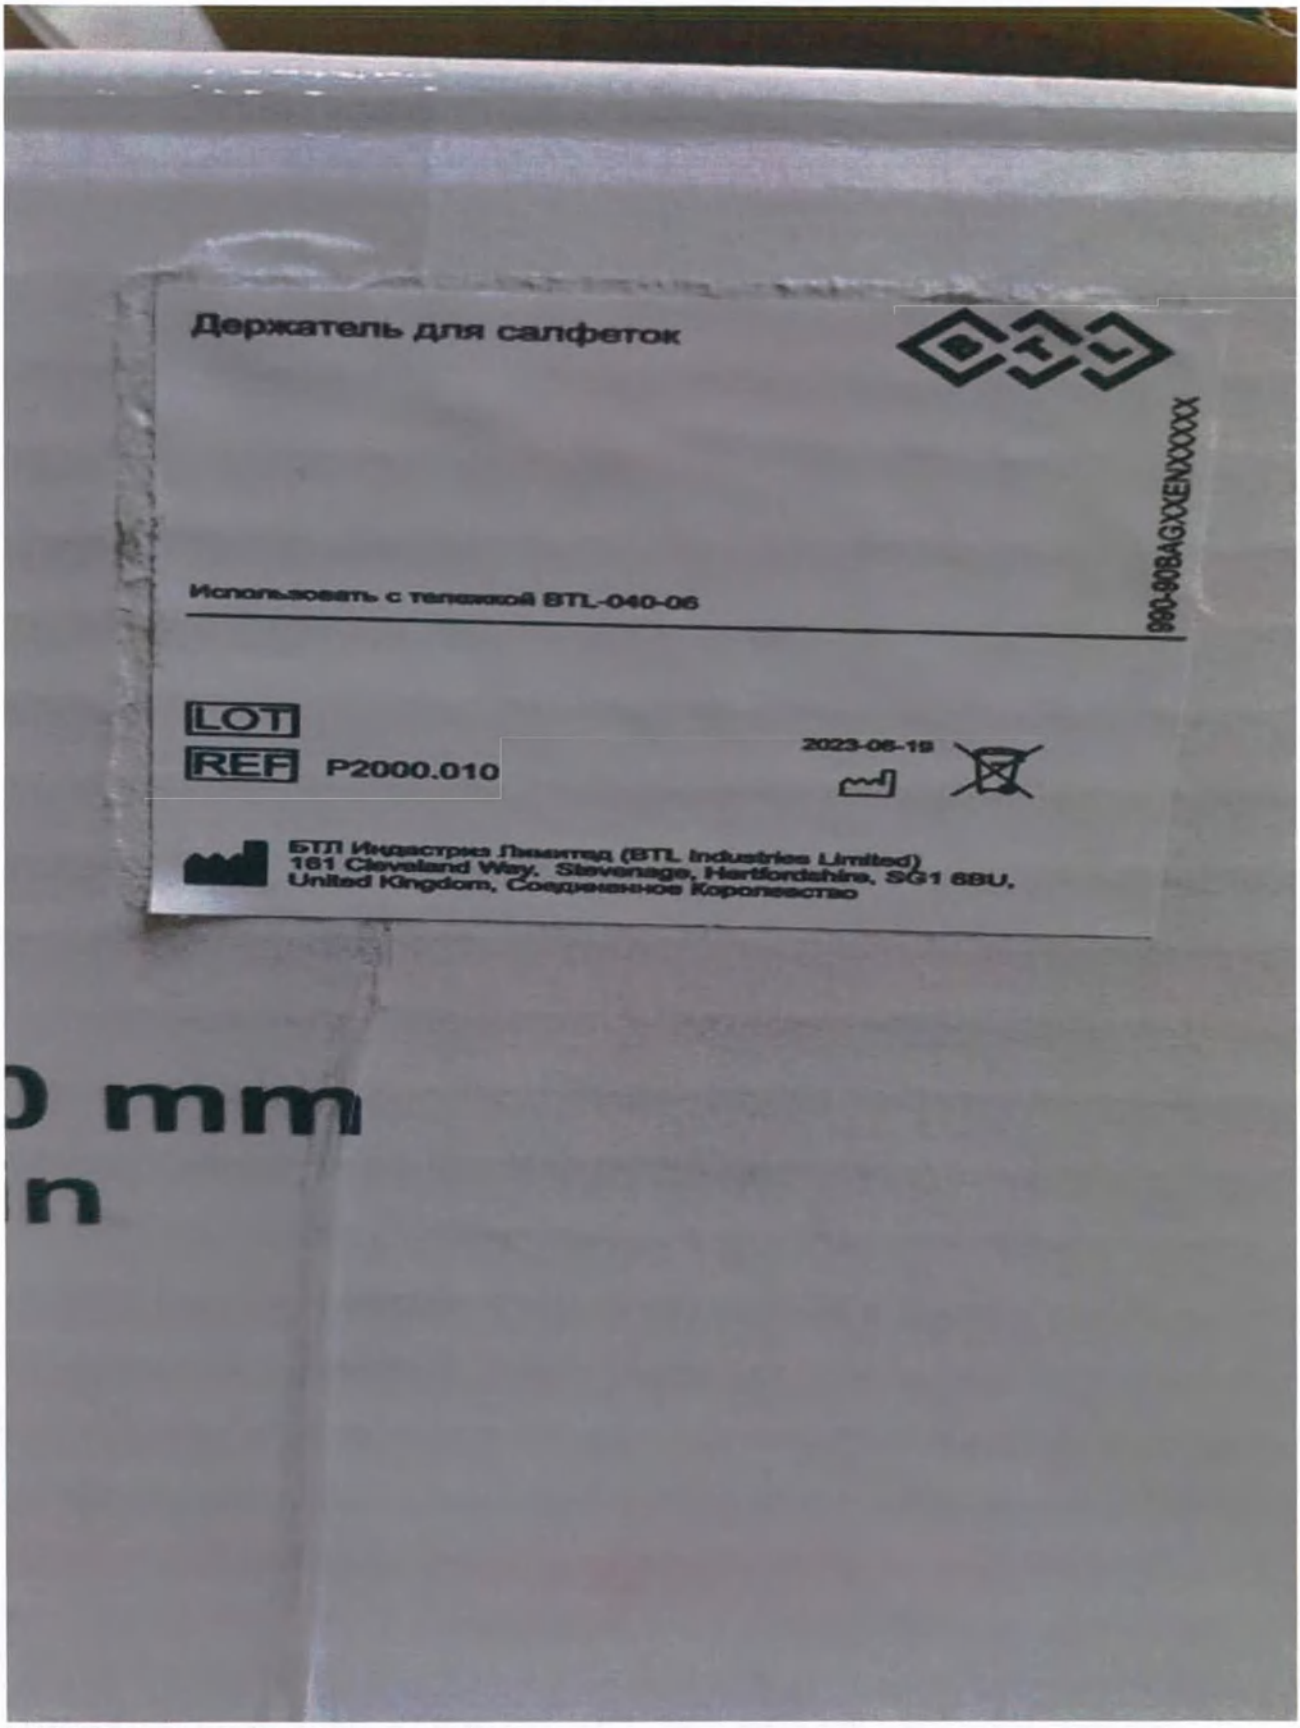


2.1 Маркировка держателя для салфеток

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



3. Болт для крепления аппарата к тележке (1 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



4. Сумка транспортировочная (не более 2 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU





4.1 Маркировка сумки транспортировочной

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



5. Тележка BTL-040-06 (не более 2 шт.) (при необходимости).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

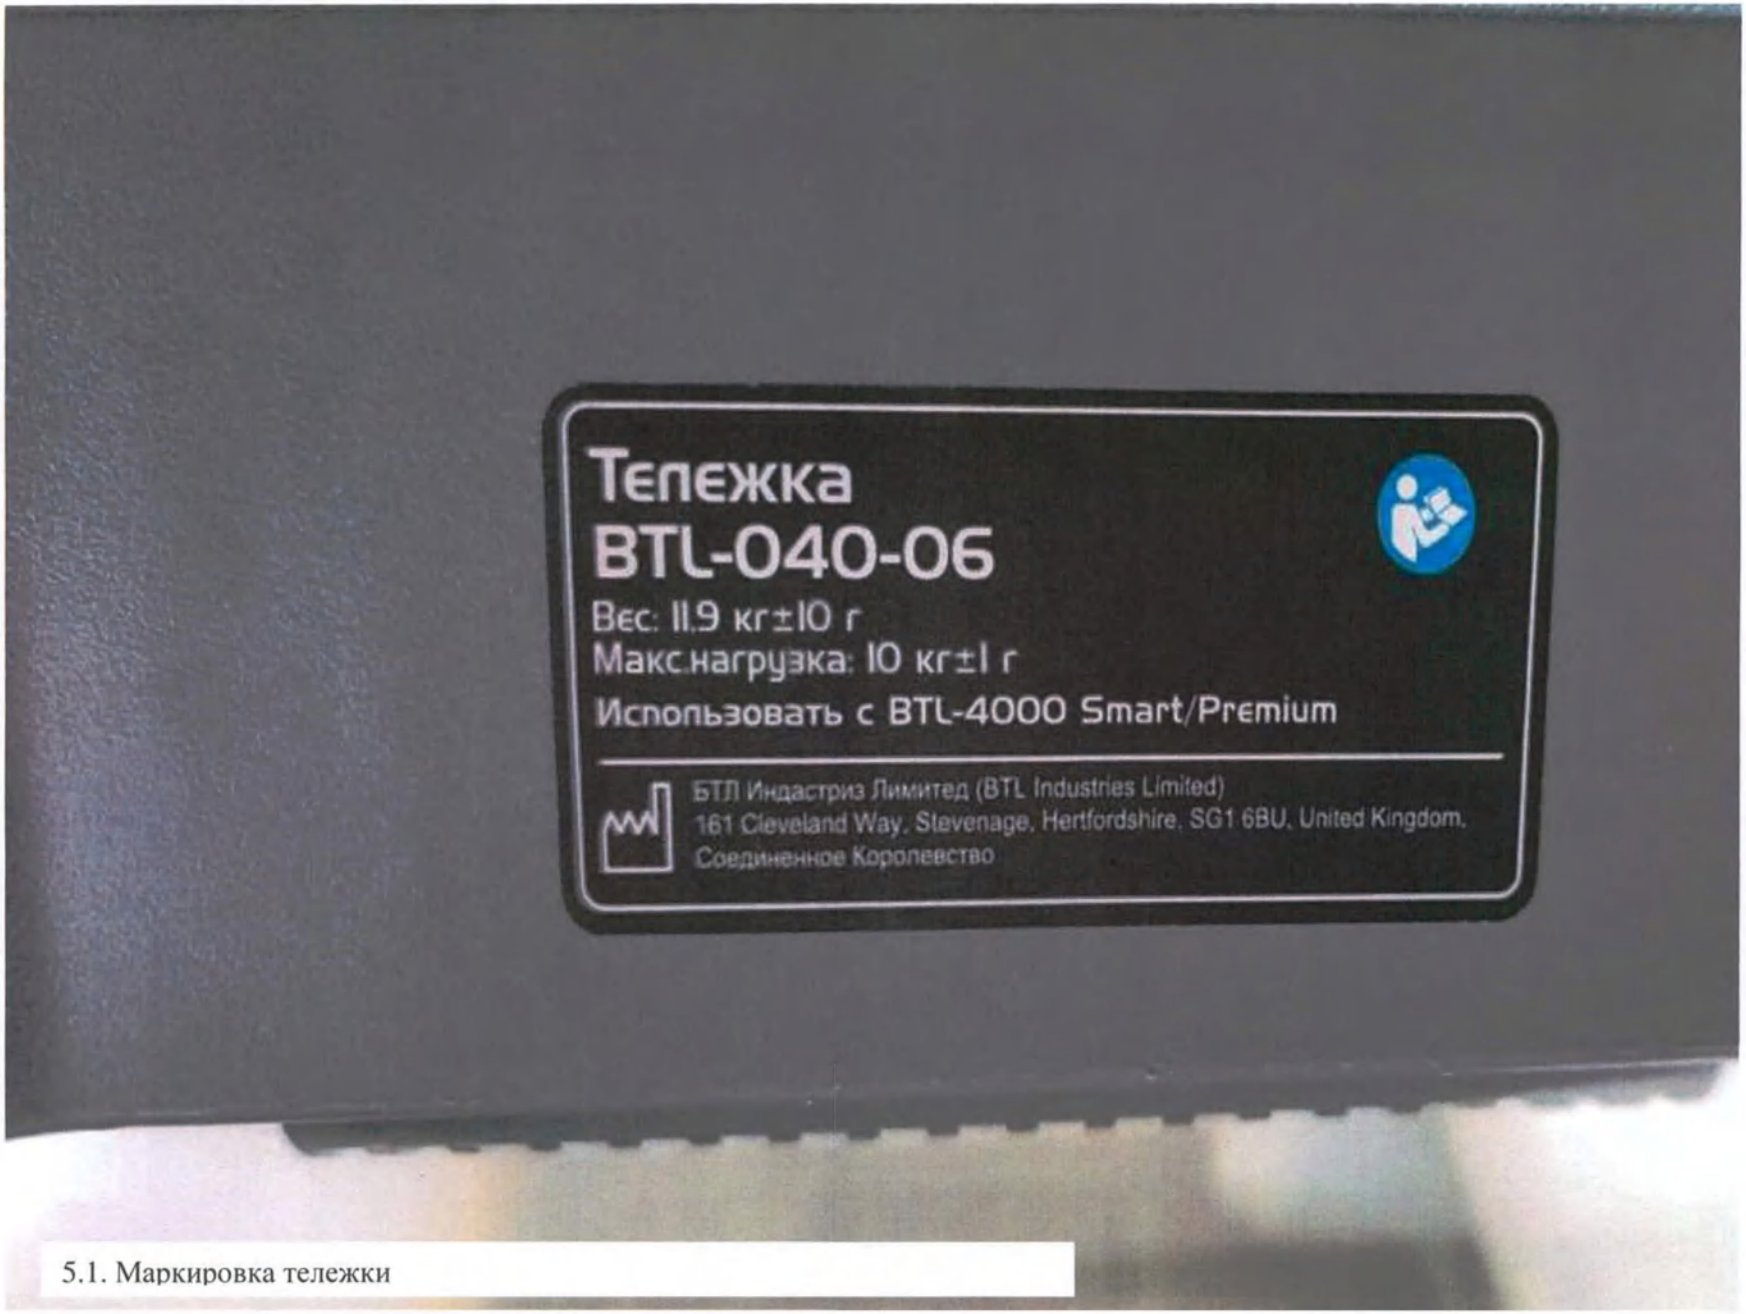


5.1. Маркировка тележки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5.2 маркировка разъема для подключения адаптера питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




5.3 Маркировка упаковки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 83 листов
Утверждено
Генеральным директором ООО «БТЛ»
Мираев И.
2023 г.




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU