Внешний вид набора реагентов **«Тест-сис[redacted] иммуноферментная для вы[redacted]тител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов» "Лайн-Блот ВИЧ-1,2"**

Комплект №1.

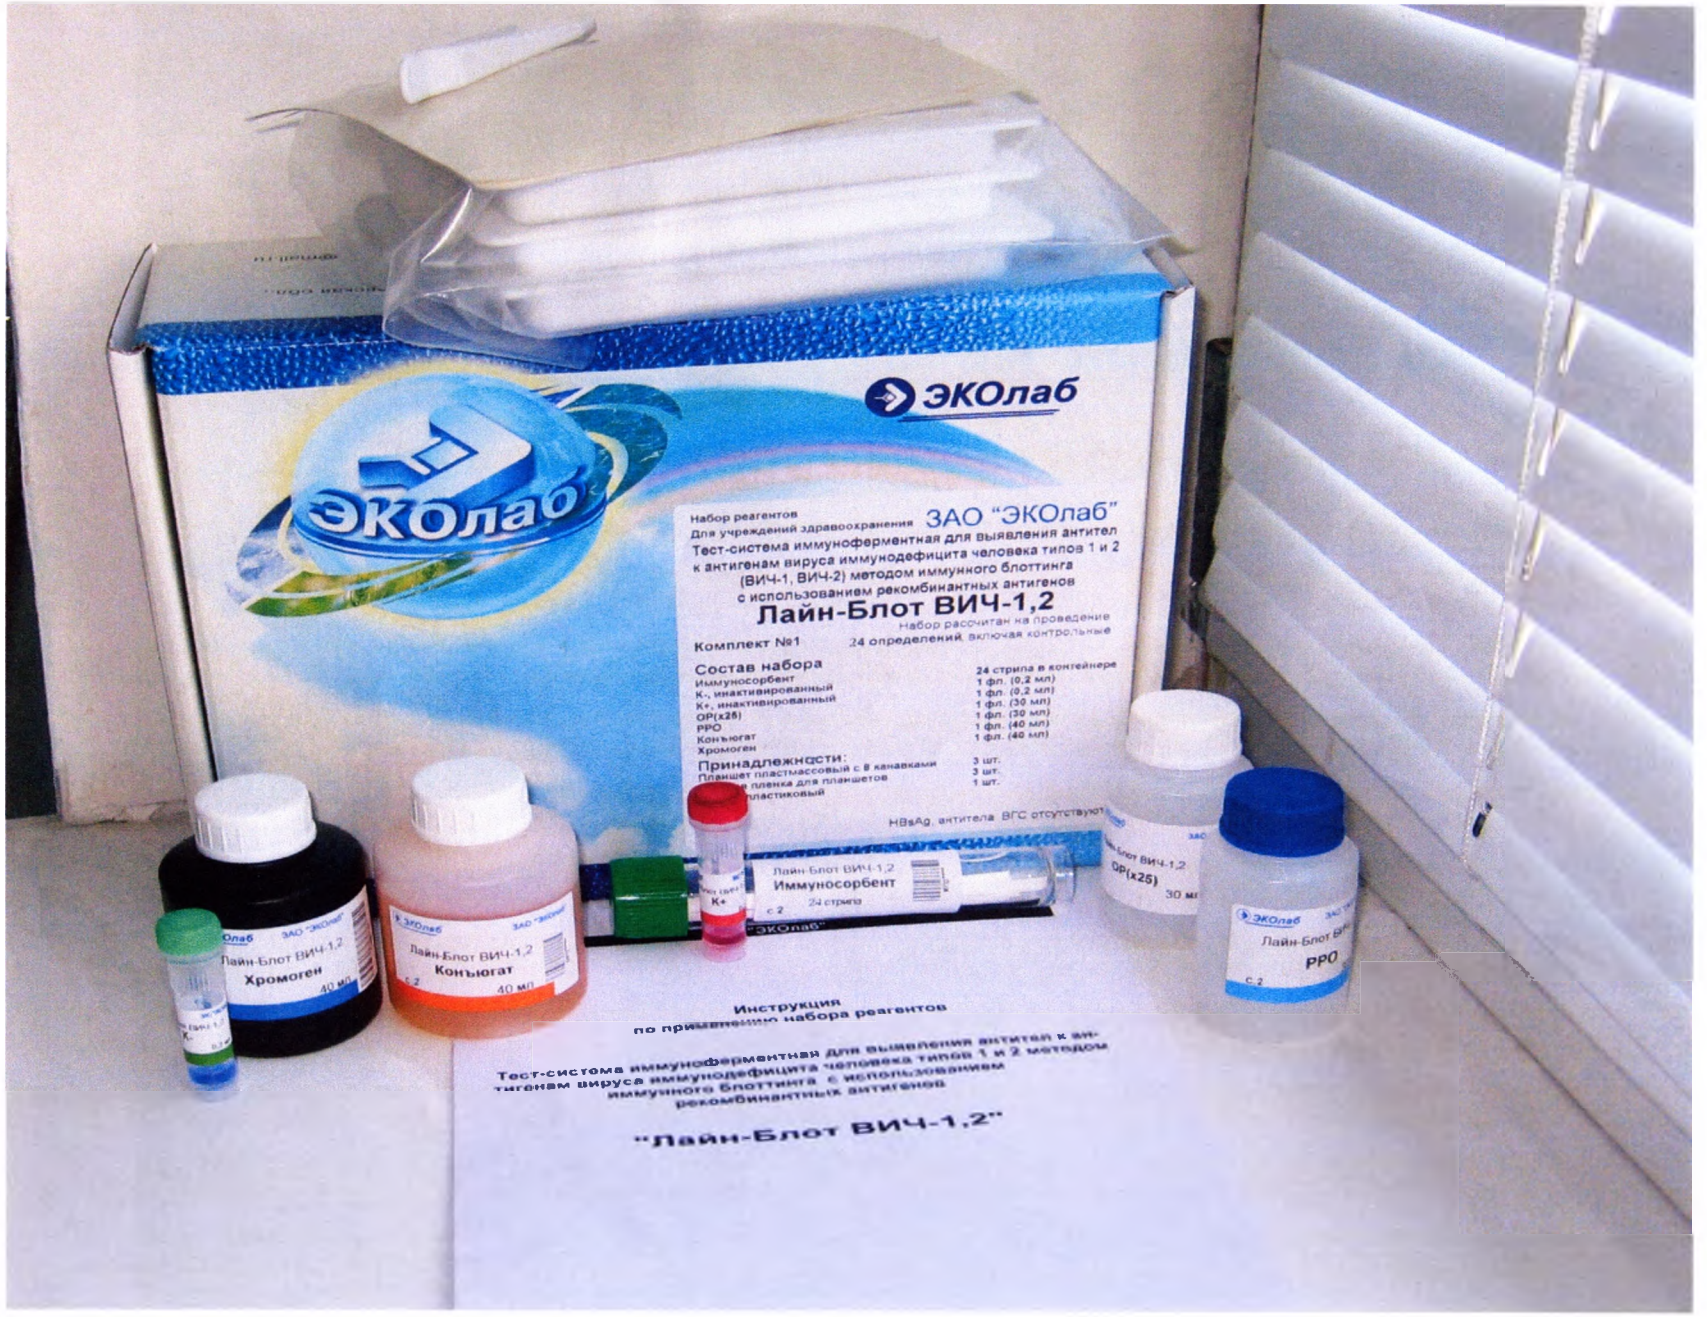

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Комплект №2.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комплект №3

В.Ю.Борисов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

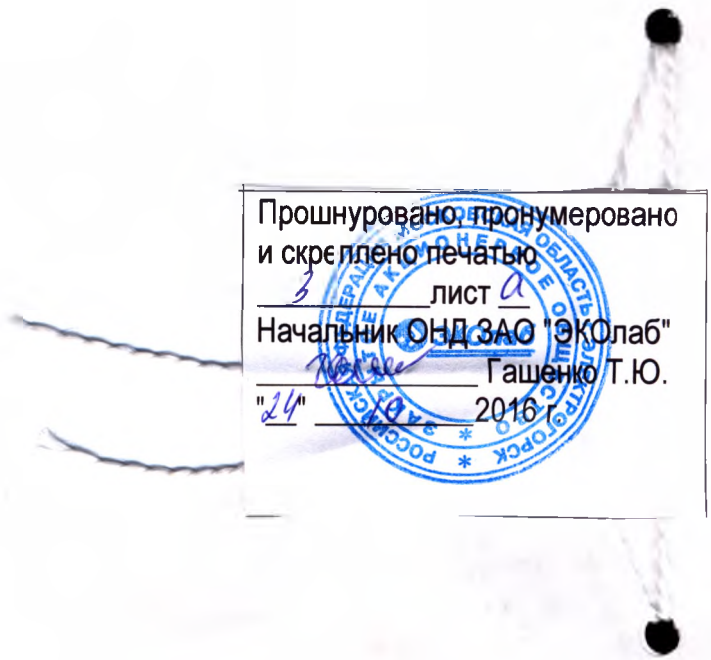

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"
_____ В.Ю. Борисов
"20" 11 2016 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Комплект №1

Набор рассчитан на проведение **24 определений**, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	24 стрипа в контейнере
К-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(х25)	1 фл. (30 мл)
РРО	1 фл. (30 мл)
Конъюгат	1 фл. (40 мл)
Хромоген	1 фл. (40 мл)

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8 канавками	3 шт.
Клейкая пленка для планшетов	3 шт.
Пинцет пластиковый	1 шт.

HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 9398-088-70423725-2015

РУ №

Комплект № 1 Каталожный № *****

Серия Контрольный №

Дата изготовления:

Годен до:

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

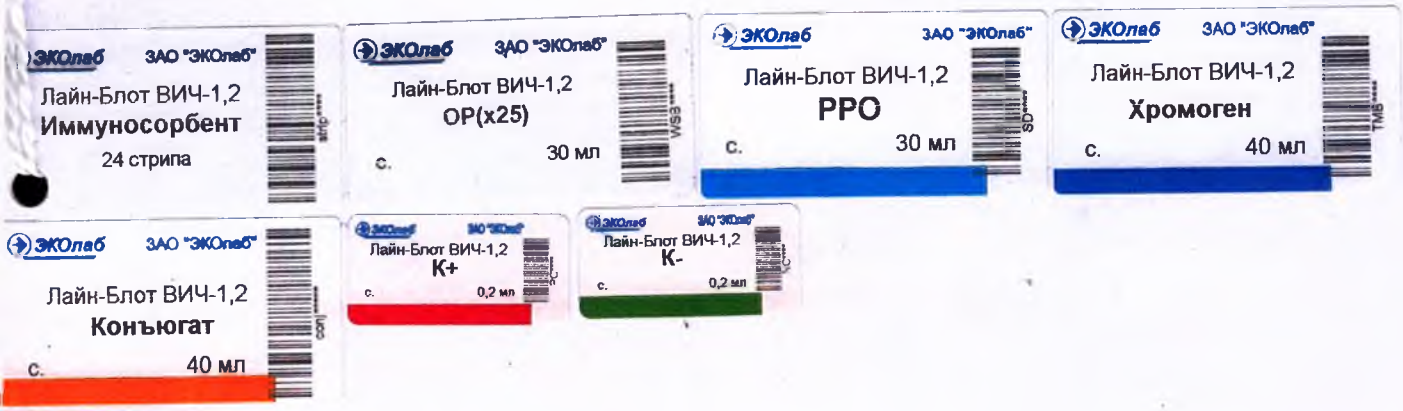

Директор производства ДП Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"
_____ В.Ю. Борисов
"20" _____ 20 г.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2) методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Комплект №2

Набор рассчитан на проведение **36 определений**, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	36 стрипов в контейнере
К-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(х25)	1 фл. (30 мл)
РРО	1 фл. (40 мл)
Конъюгат	2 фл. (по 30 мл)
Хромоген	1 фл. (40 мл)

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8 канавками	5 шт.
Клейкая пленка для планшетов	5 шт.
Пинцет пластиковый	1 шт.

HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 9398-088-70423725-2015

РУ №

Комплект № 2 Каталожный № *******

Серия Контрольный №

Дата изготовления:

Годен до:

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

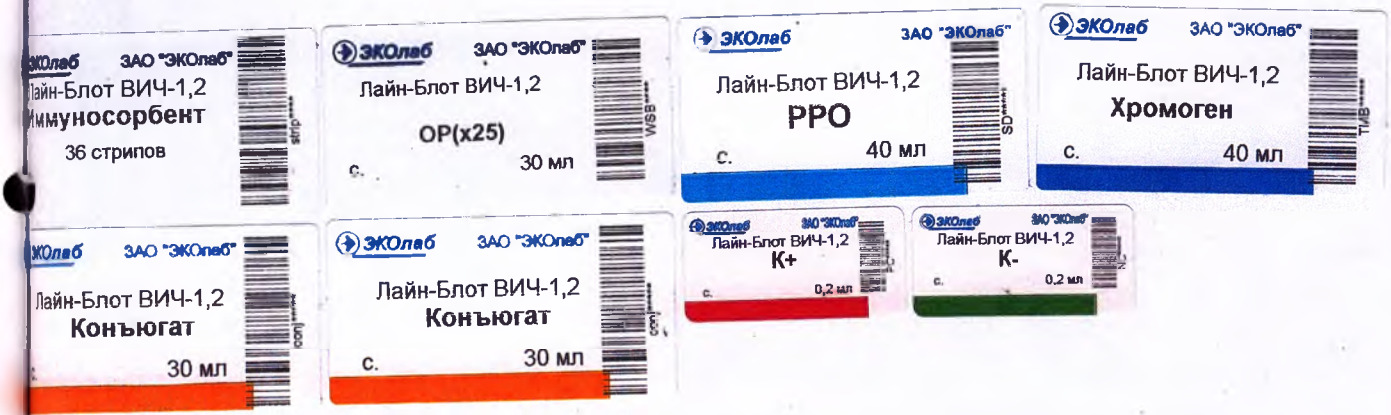

Директор производства ДП Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"
_____В.Ю. Борисов
"20" _____20 г.

р реагентов
учреждений здравоохранения **ЗАО "ЭКОлаб"**
т-система иммуноферментная для выявления антител
нтигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2
(ВИЧ-1, ВИЧ-2) методом иммунного блоттинга
с использованием рекомбинантных антигенов

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Комплект №3

Набор рассчитан на проведение
48 определений, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	по 24 стрипа в 2 контейнерах
Инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
Инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
(x25)	2 фл. (по 30 мл)
D	2 фл. (по 30 мл)
Конъюгат	2 фл. (по 40 мл)
Хромоген	2 фл. (по 40 мл)

Принадлежности:

Планшет пластмассовый с 8 канавками	6 шт.
Липкая пленка для планшетов	6 шт.
Пакет пластиковый	1 шт.

HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 9398-088-70423725-2015

РУ №

Комплект № 3 Каталожный № *******

Серия Контрольный №

Дата изготовления:

Годен до:

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Директор производства ДП Осинская А.Д.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
3 лист 0
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"27" 10 2016 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU