Фотографические изображения общего вида
набора реагентов **«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 6-го типа» «ИФА-ВГЧ6-IgG»**

Серия 01 от 2019.02

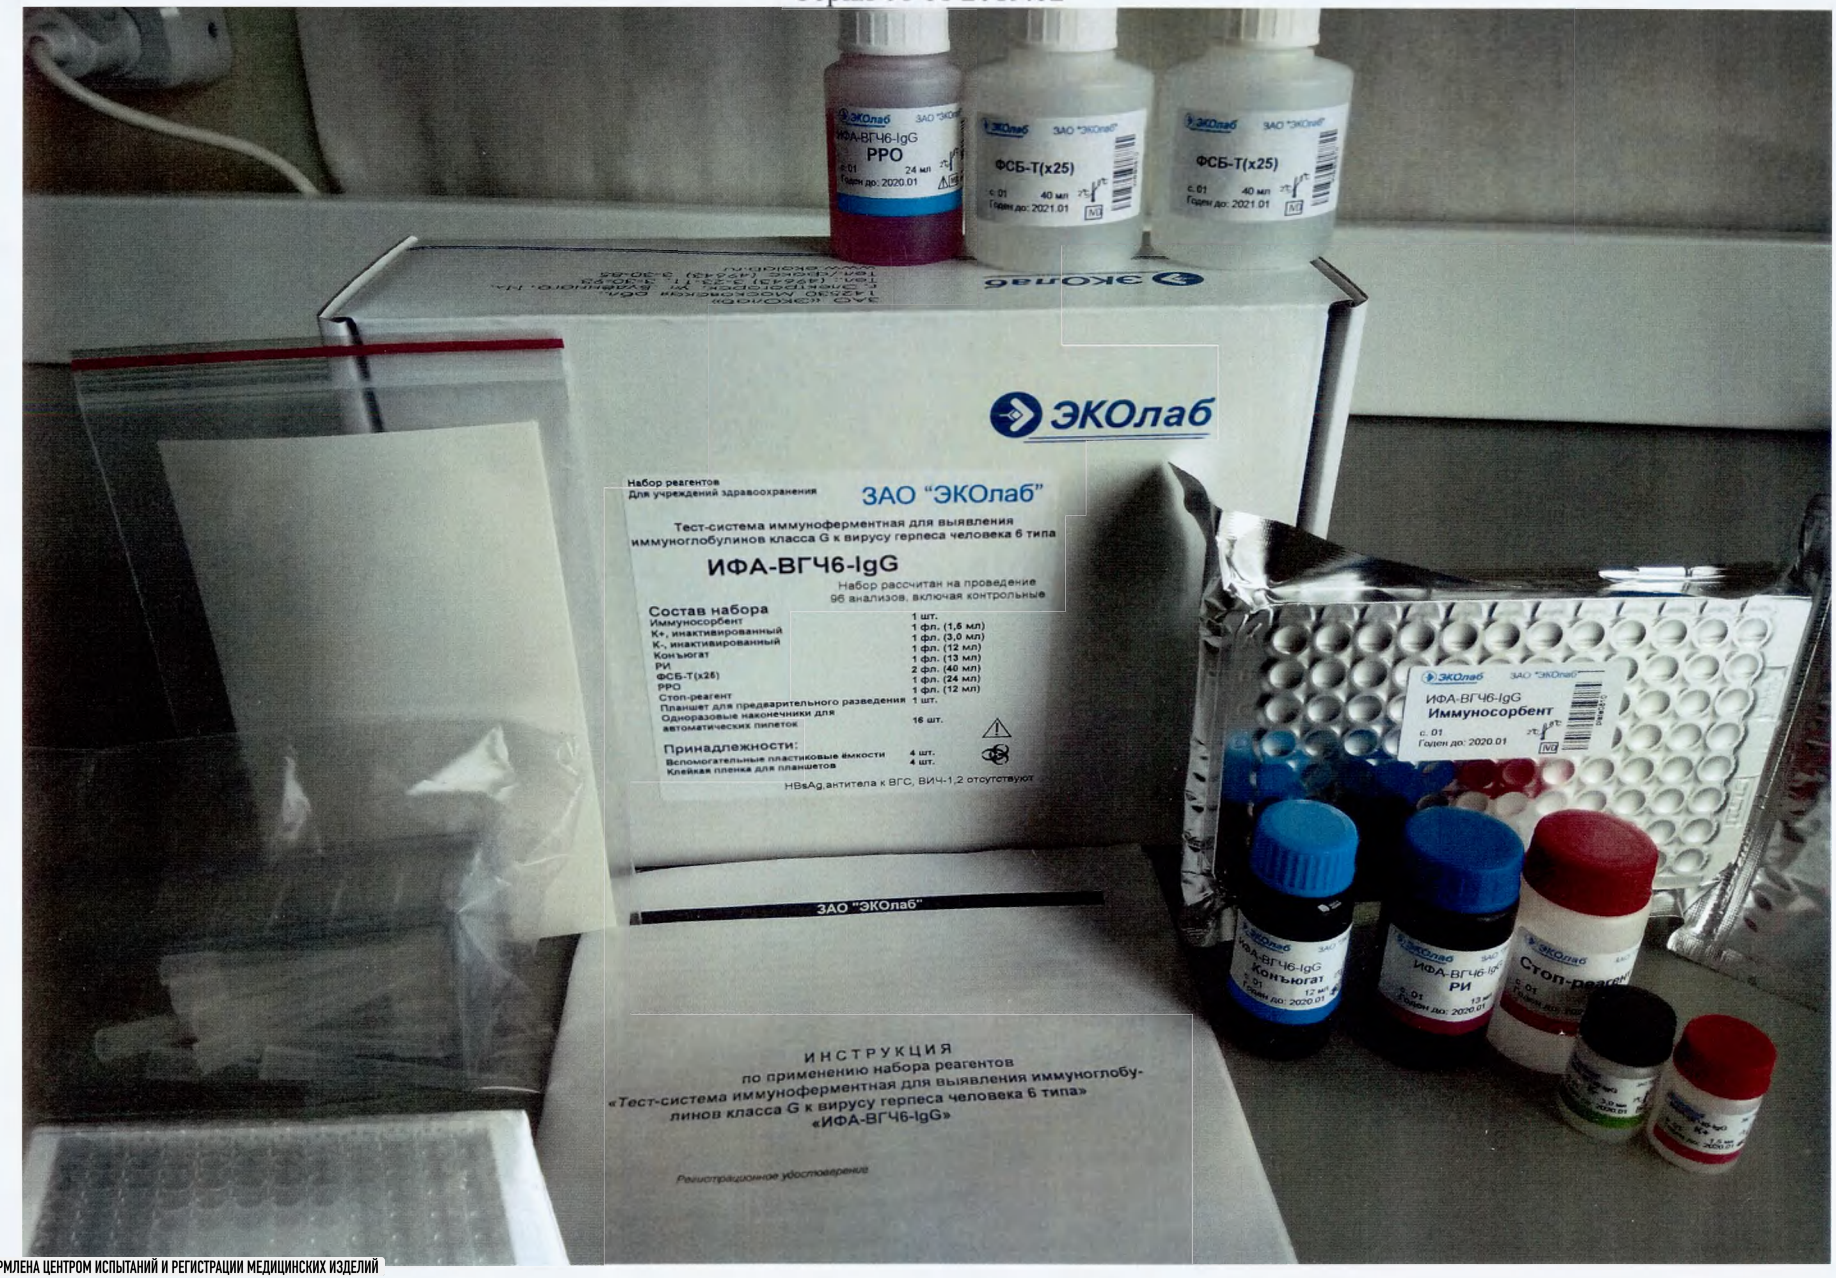

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Серия 02 от 2019.02.

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб» В.Ю. Борисов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
"12" 12 Борисов В.Ю.
2019 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"
_____ В.Ю. Борисов
"09" 01 2019 г

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 6 типа

ИФА-ВГЧ6-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3,0 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (24 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12 мл)
Планшет для предварительного разведения	1 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

HBsAg,антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВГЧ6-IgG

ТУ 21.20.23-256-70423725-2019
РУ №

Серия 01

Каталожный № 08.10

Контрольный № 85

Дата изготовления: 2019.01
Годен до: 2020.01

08.10

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке

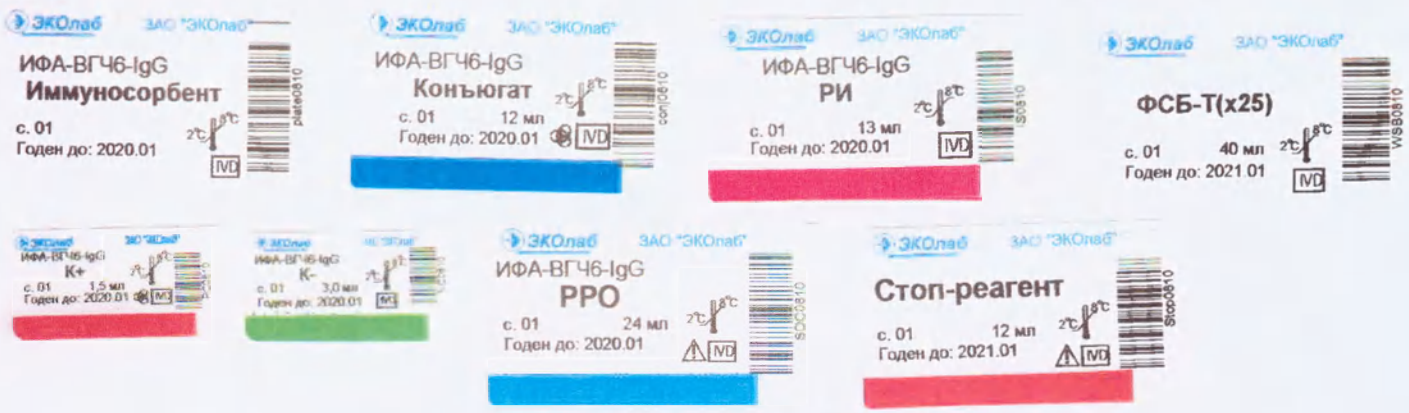

Начальник ОПР Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"
_____В.Ю. Борисов
"09" 01 2019 г

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу герпеса человека 6 типа

ИФА-ВГЧ6-IgG

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3,0 мл)
Конъюгат	1 фл. (12 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (24 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12 мл)
Планшет для предварительного разведения	1 шт.
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

HBsAg,антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВГЧ6-IgG

ТУ 21.20.23-256-70423725-2019
РУ №

Серия 02
Каталожный № 08.10
Контрольный № 86

Дата изготовления: 2019.01
Годен до: 2020.01

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке

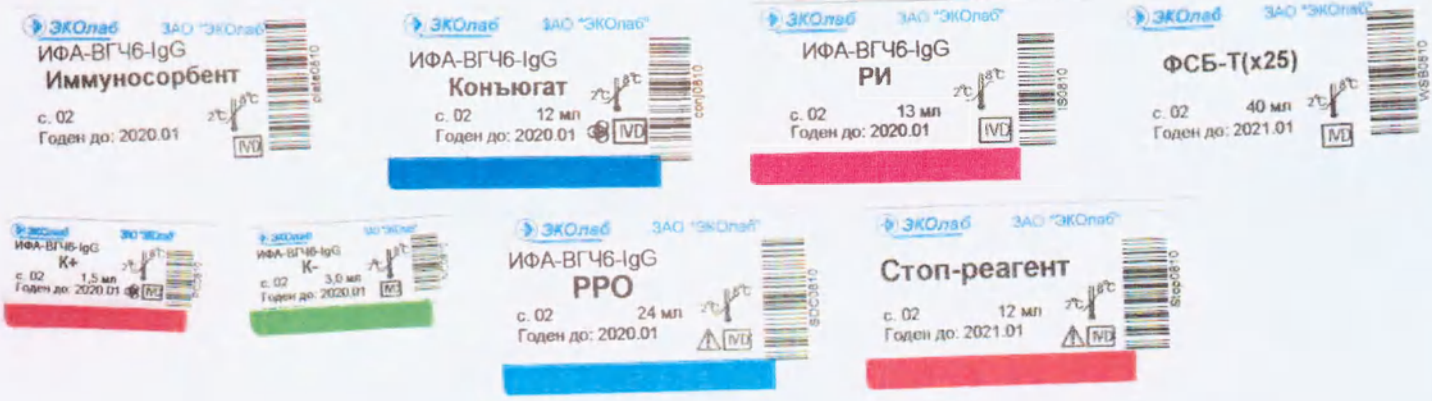

Начальник ОПР Амелина Е.А.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК Юрина Т.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
"12" 12 Борисов В.Ю.
2019 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU