Внешний вид

набора реагентов **«Диагностикум для выявления антител класса М к вирусу простого герпеса 1 типа в реакции иммунофлюоресценции» «ВПГ-1-Флюороген-IgM»**

Комплект №1 вид спереди

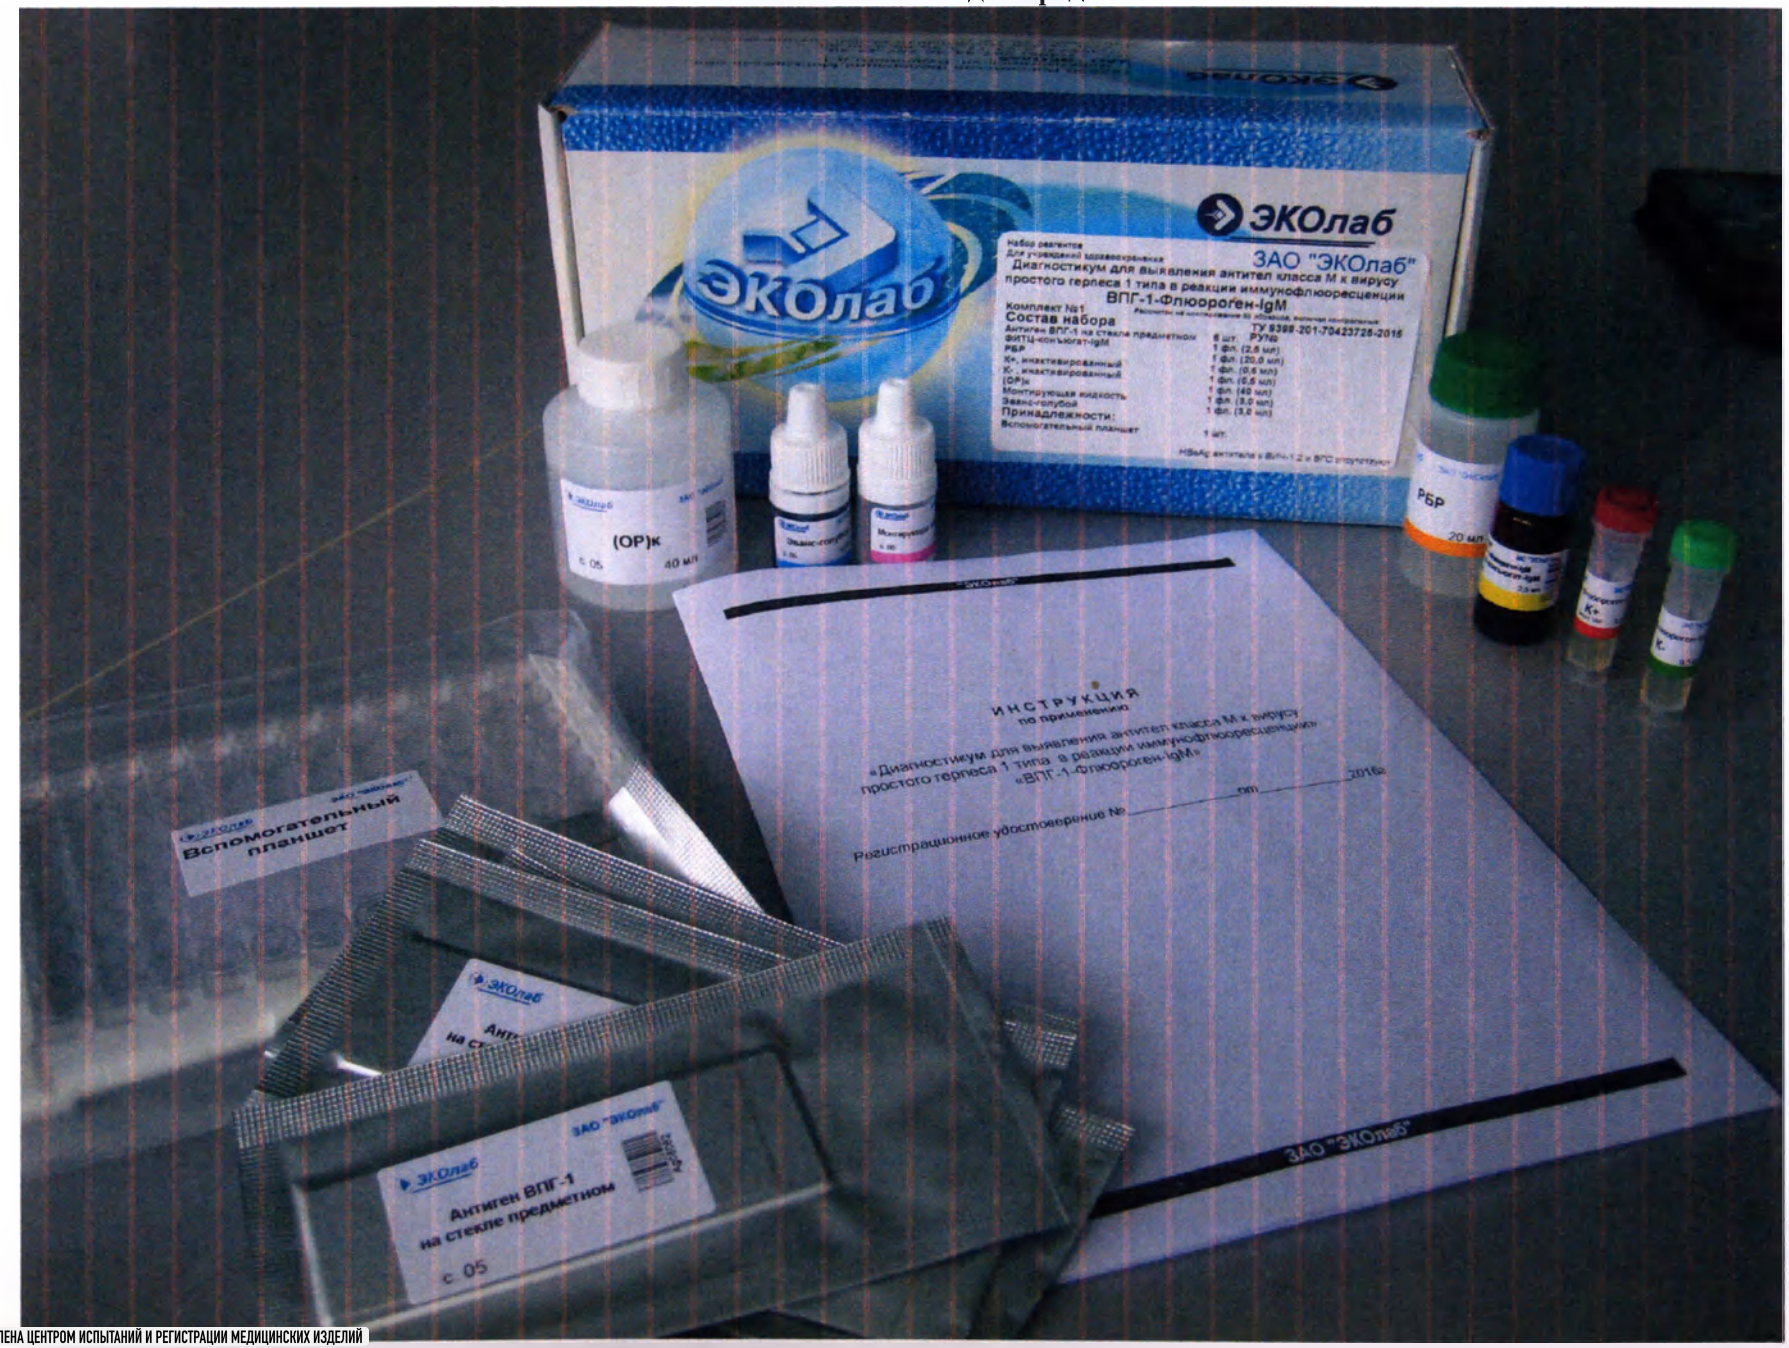

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Комплект №2 вид спереди

Генеральный директор ЗАО “ЭКОлаб» В.Ю. Борисов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____лист
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
"__" _____2016 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU