Фотографические изображения общего вида

Набора реагентов **«Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов» «ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM»**

Серия 02 от 2020.06.10

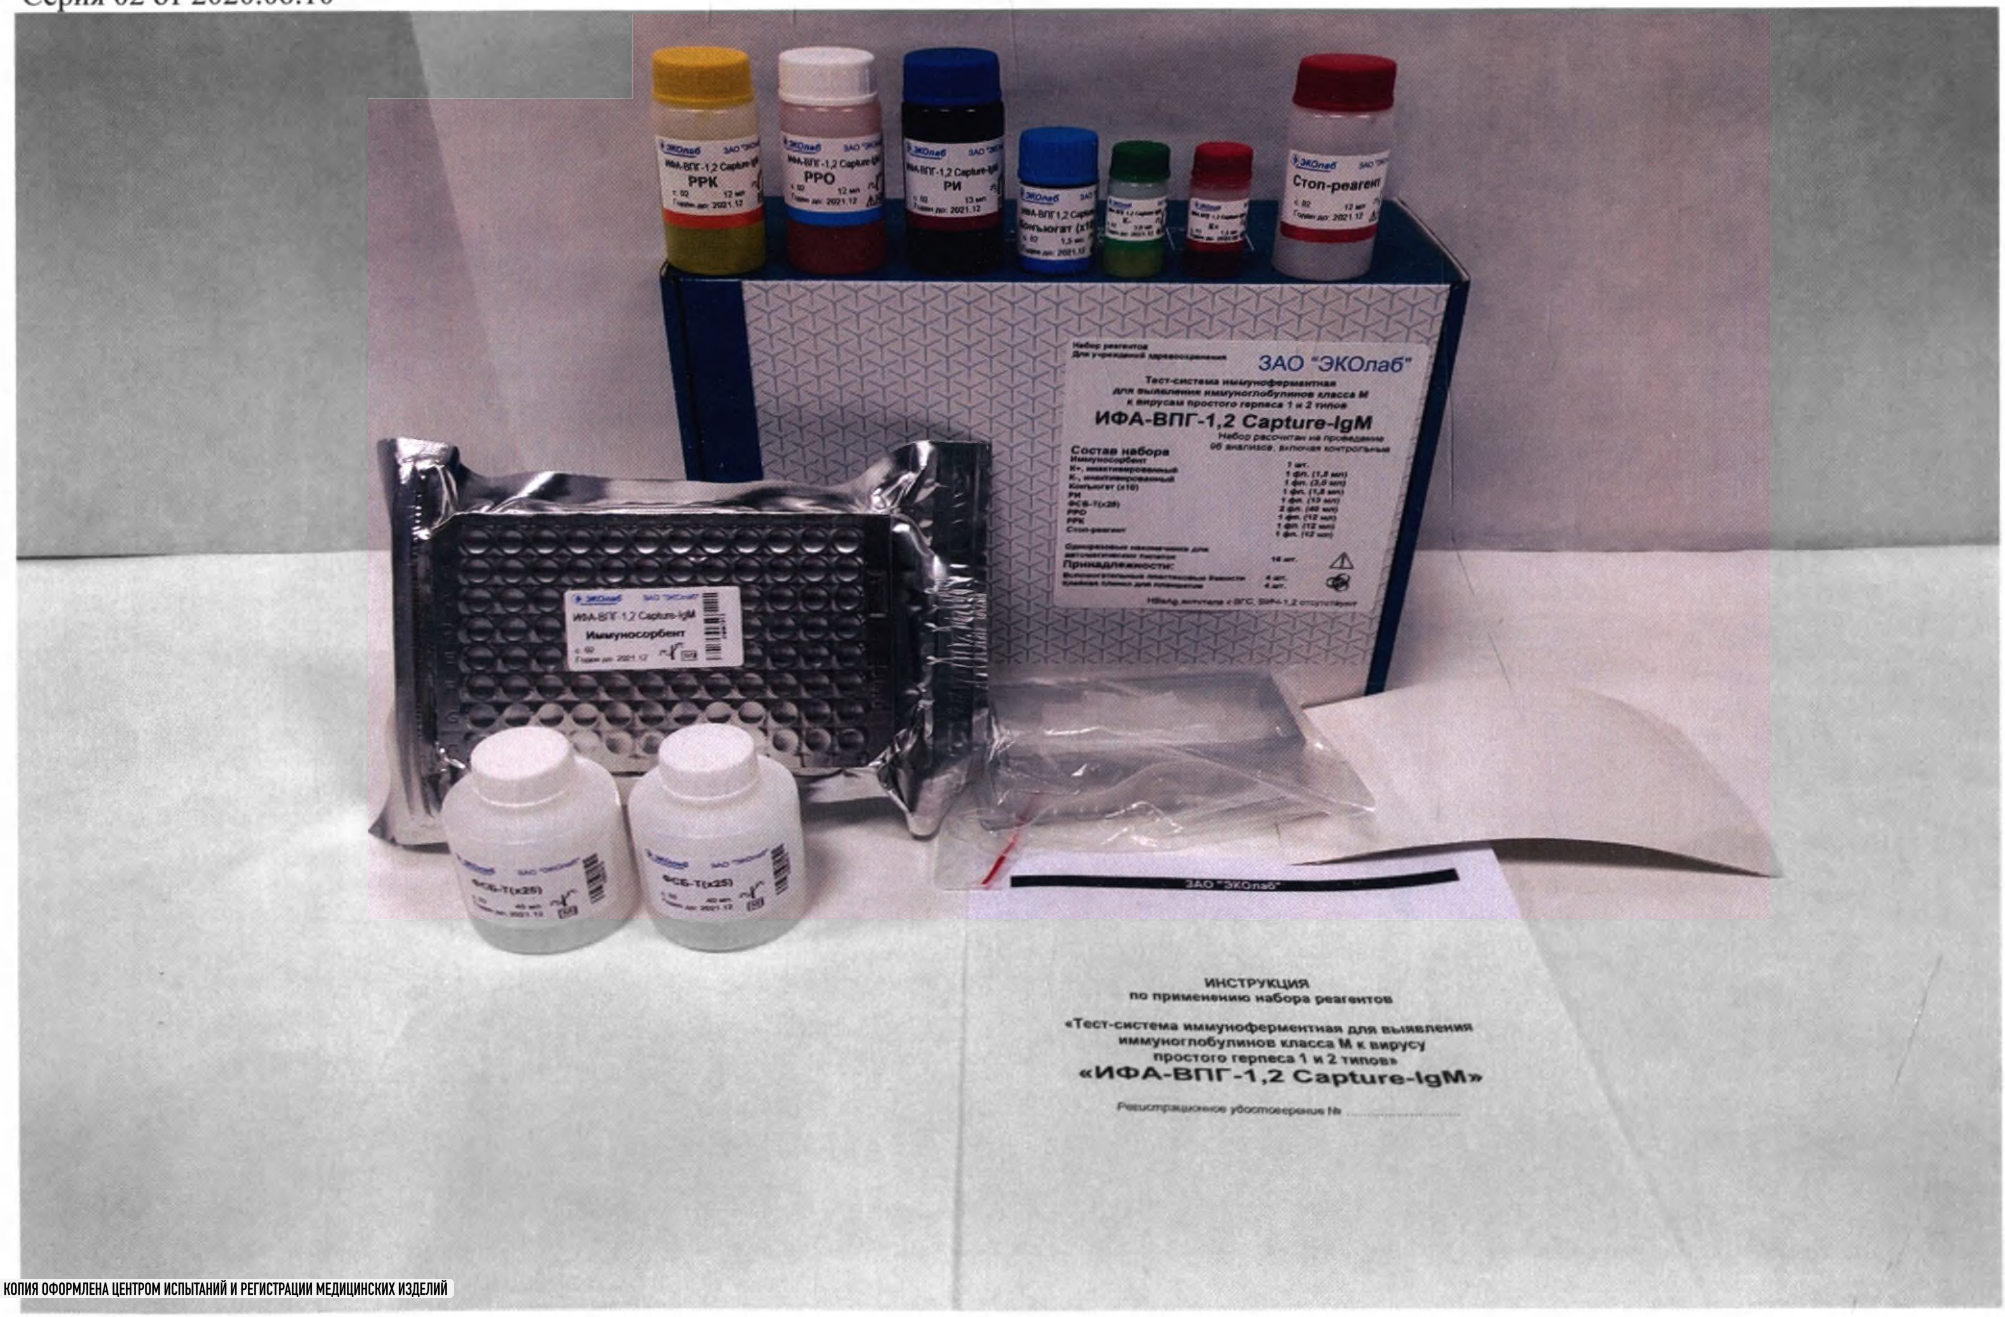

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

03 от 2020.06.11

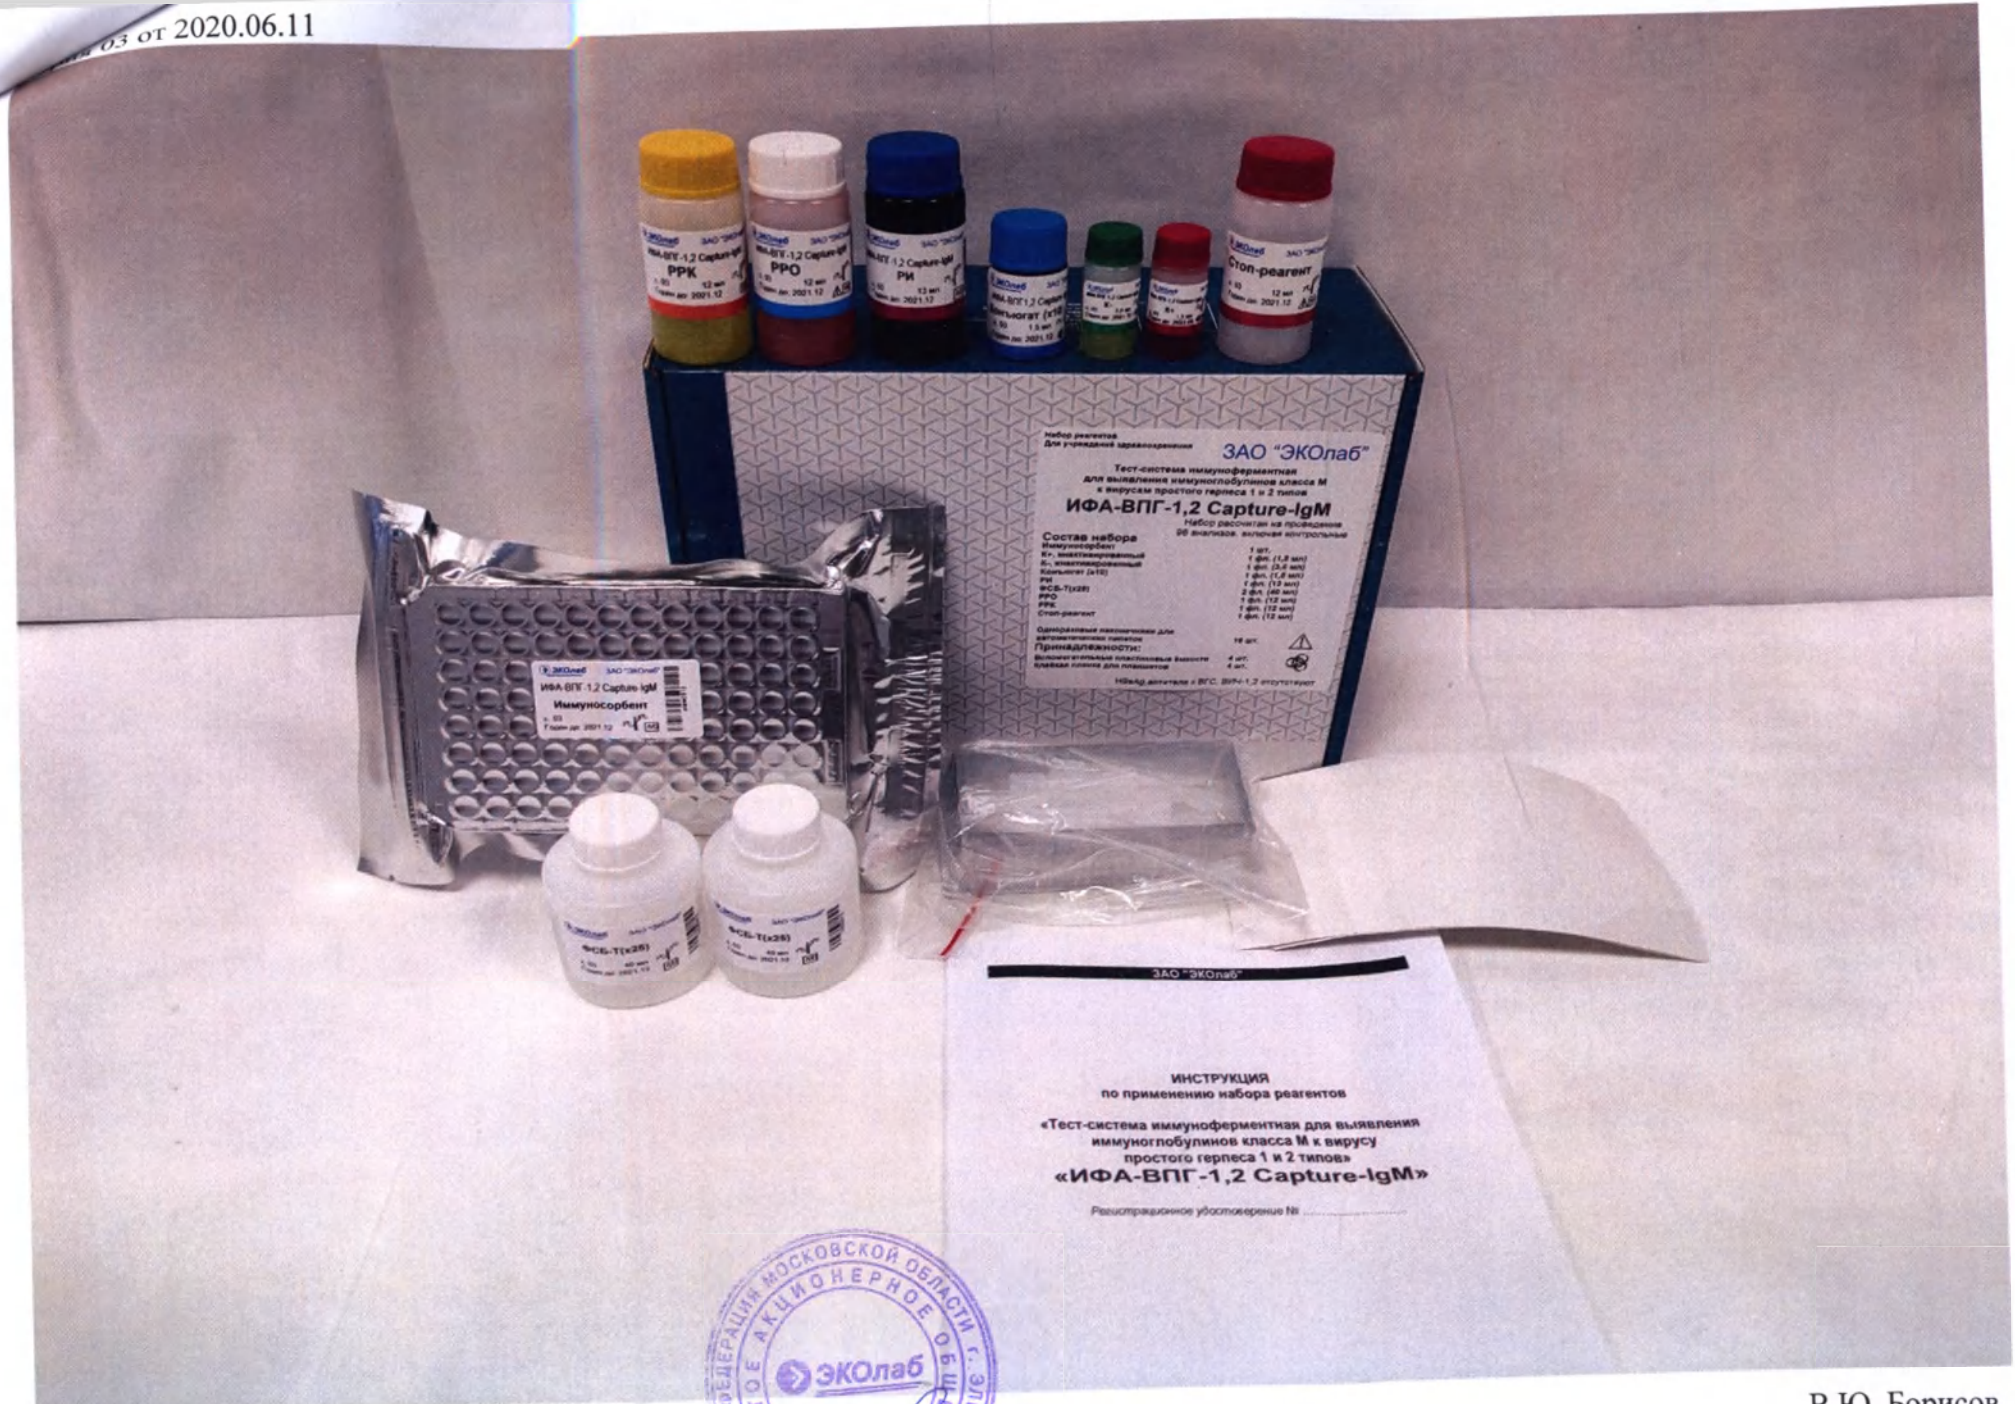

В.Ю. Борисов

ЗАО "ЭКОлаб»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист 2
Зам.Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"03" 11 2021 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная
для выявления иммуноглобулинов класса М
к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов

ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3,0 мл)
Конъюгат (х10)	1 фл. (1,5 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
РРК	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

HBsAg,антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

_____ В.Ю. Борисов

«01» 06 2020 год.

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM

ТУ 21.20.23-255-70423725-2019 с изм.№1
РУ №

Серия 02

Каталожный № 08.12

Контрольный № 242

Дата изготовления: 2020.06.10
Годен до: 2021.12.10

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

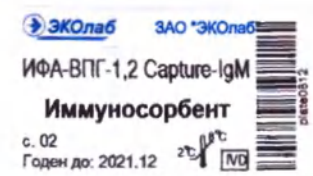

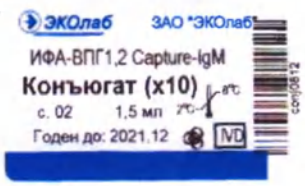

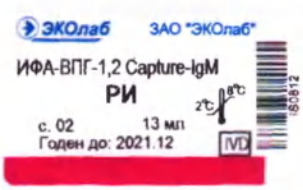

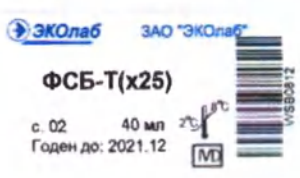

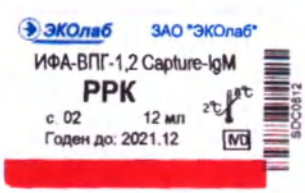

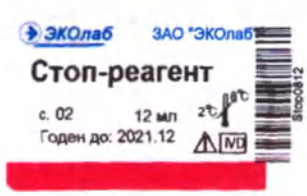

Директор производства ДП: _____ Осинская А.Д.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная
для выявления иммуноглобулинов класса М
к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов

ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
К+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (3,0 мл)
Конъюгат (х10)	1 фл. (1,5 мл)
РИ	1 фл. (13 мл)
ФСБ-Т(х25)	2 фл. (40 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
РРК	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12 мл)

Одноразовые наконечники для автоматических пипеток 16 шт.

Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.

HBsAg,антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

«01» 06 2020 год.

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-ВПГ-1,2 Capture-IgM

ТУ 21.20.23-255-70423725-2019 с изм.№1
РУ №

Серия 03

Каталожный № 08.12

Контрольный № 243

08.12

Дата изготовления: 2020.06.11
Годен до: 2021.12.11

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

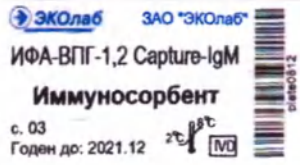

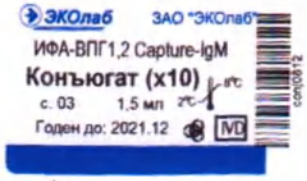

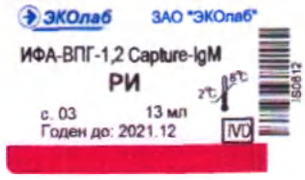



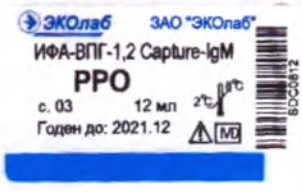

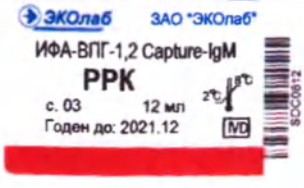

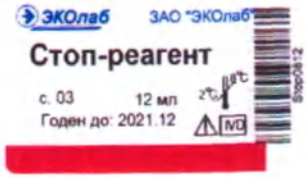

Директор производства ДП: Осинская А.Д.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 лист 2
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
_____ Гашенко Т.Ю.
"03" 11 2021 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU