

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Версия 1

Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе.

производства Bio-Rad Laboratories, Inc. («Био-Рад Лабораториес, Инк.»), США



Общий вид МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе».

BIO-RAD

12006327

Liquichek12006365
(PER 500045463)**AMH Control****Trilevel****6 x 2 mL
(2 per level)**

A human serum assayed AMH control. // Човешки серум с определени стойности за AMH контрола. // 人體血清定值 AMH 品管液。// En human serumanalyseret AMH-kontroll. // Contrôle titré à base de sérum humain pour le dosage de l'AMH. // AMH-Humanserumkontrolle, mit Zielwertangaben. // Ταυτοποιημένος μάρτυρας αντιμυλλεριανής ορμόνης (AMH) από ανθρώπινο ορό. // Siero di controllo umano dosato per AMH. // ヒト血清をベースとしたAMH測定用コントロールです。// Żmogaus serumo kilmės AMH kontrolinė medžiaga. // Analysert AMH-kontroll av humant serum. // Ludzka mianowana surowica kontrolna do oznaczeń hormonu antymüllerowskiego (AMH). // Um soro humano ensaiado de controlo para a AMH. // Siero control humano valorado para hormona antimülleriana (AMH). // En analyserad AMH-kontroll framställd av humant serum. // Insan serumunda değeri bilinen AMH kontrolü.

(01) 03610521176510
(17) 250531
(10) 1001900-20°C
-70°C

1001900




2025-05-31

UNITED STATES, Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road, Irvine, CA 92618FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré,
92430 Marnes-la-Coquette

Made in USA

Вторичная упаковка, вид сверху МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе».

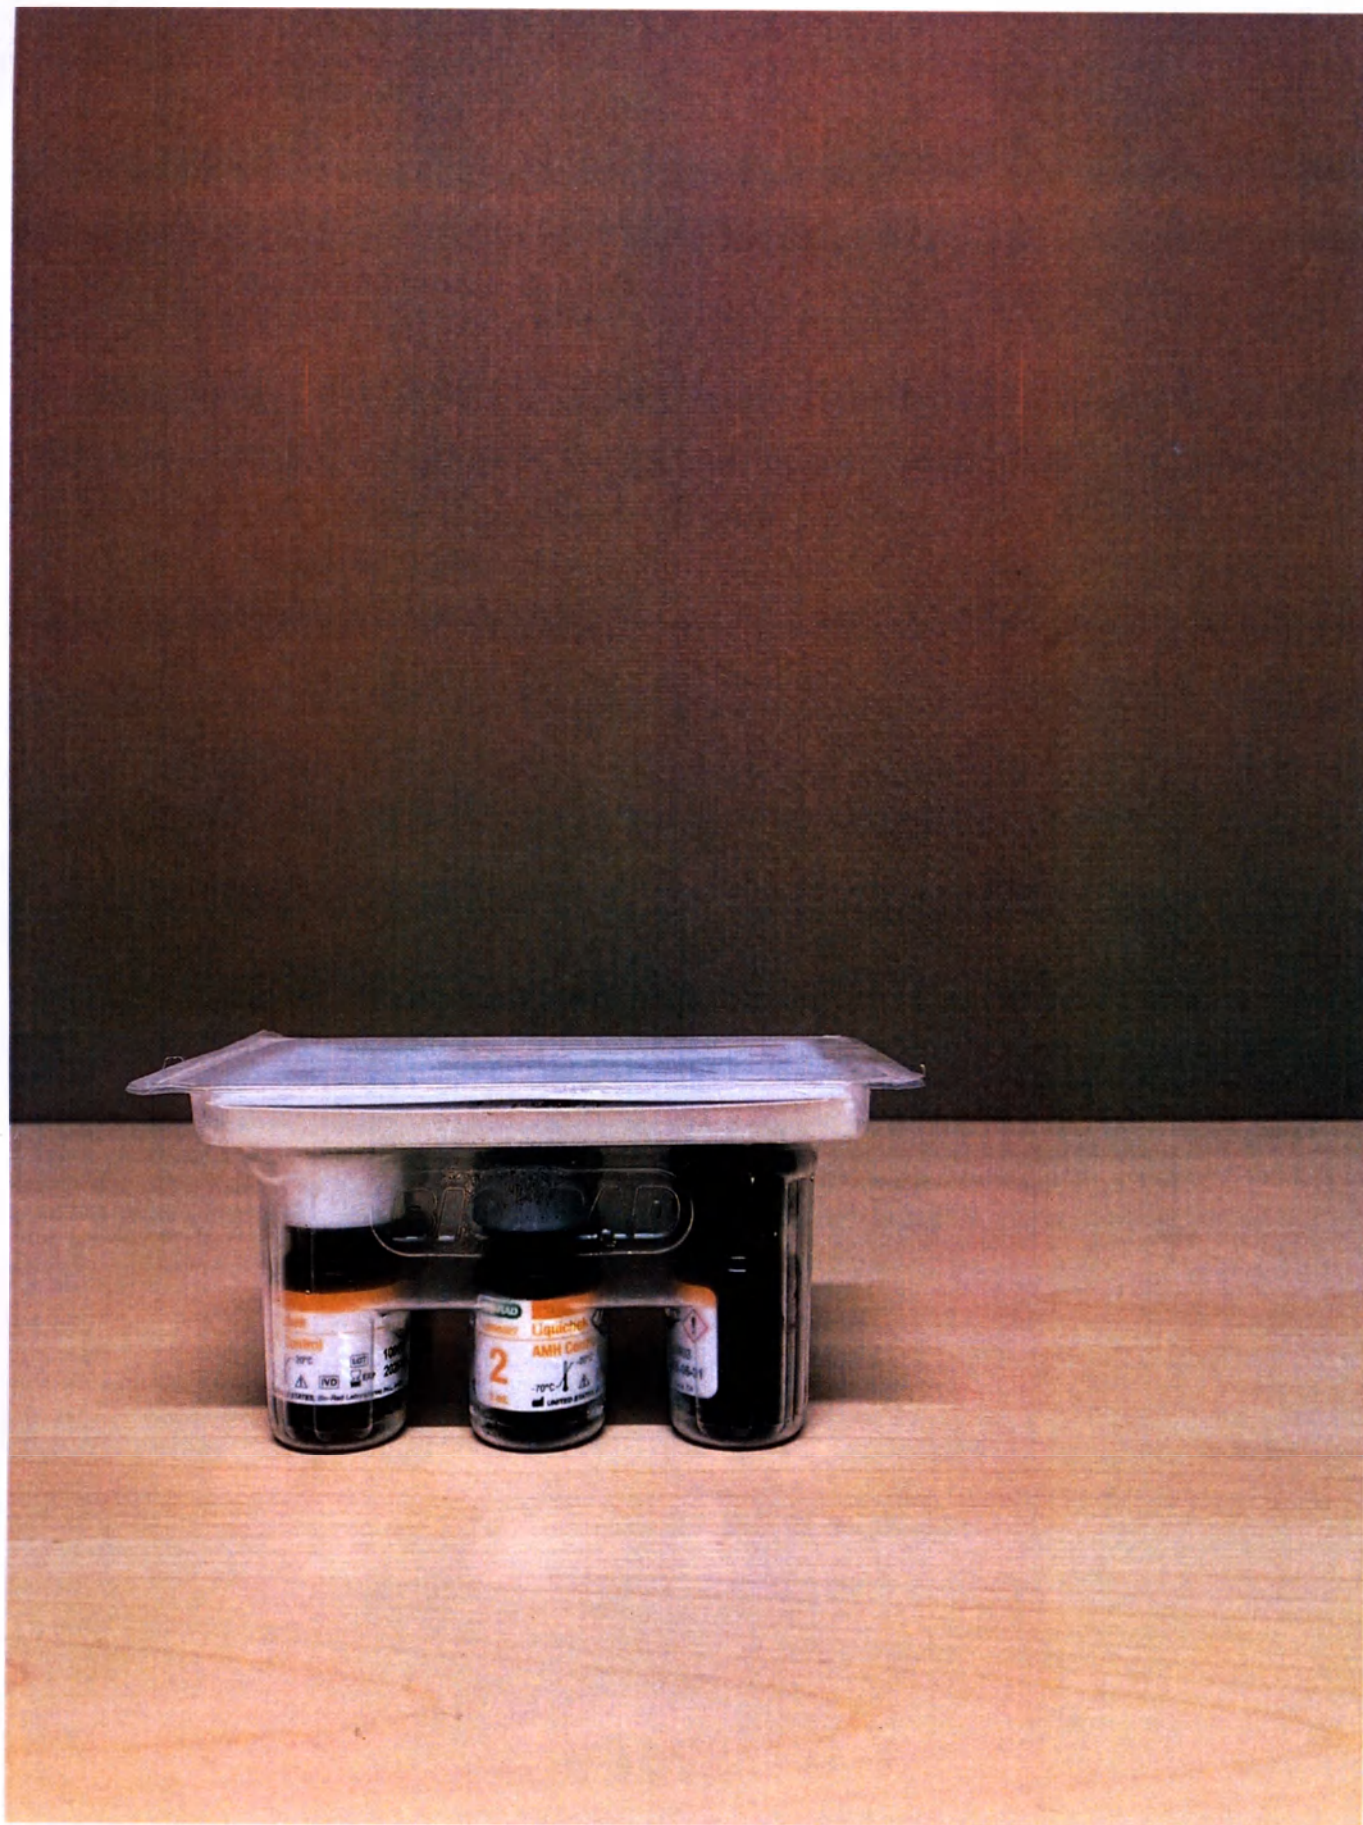

Вторичная упаковка, вид сбоку МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики *in vitro* для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе».



Вторичная упаковка, вид сбоку МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе».



Внешний вид флакона «Уровень 1, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 1, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики *in vitro* для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 1, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 2, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики *in vitro* для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 2, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 3, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 3, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»



Внешний вид флакона «Уровень 3, флакон, объем 2 мл» МИ «Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе»

REF: 12006327



Материал контрольный трехуровневый «Ликвичек Контроль АМГ» (Liquichek AMH Control) для диагностики in vitro для контроля внутрилабораторной воспроизводимости процедур лабораторных анализов, в составе:

1. Уровень 1, флакон, объем 2 мл – 2 шт.
2. Уровень 2, флакон, объем 2 мл – 2 шт.
3. Уровень 3, флакон, объем 2 мл – 2 шт.

Только для диагностики in vitro. Для профессионального применения
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Номер серии, срок годности, условия хранения, номер по каталогу и графические символы указаны на оригинальной упаковке.

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: Bio-Rad Laboratories, Inc. (9500 Jeronimo Road, Irvine, California 92618, USA)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, стр. 5А

Телефон: +7 (495) 721-14-04, e-mail: diag_support_rcis@bio-rad.com

Инструкцию по применению в бумажном виде см. в сопроводительной документации;
в электронном виде - доступна по ссылке <https://www.qcnet.com/ru/Документация/Инструкции>

Место производства: США

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 14 листа «ОВ»

По доверенности № 19/2024
от 01.12.2023

