

Фотографические изображения медицинского изделия

**Анализатор автоматический микробиологический для идентификации
микроорганизмов и определения их чувствительности к
антимикробным препаратам AutoMic-i600**

Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»



Стариковская И.А.

Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (вид спереди)




Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (вид сбоку)




Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (вид сзади)



Монитор

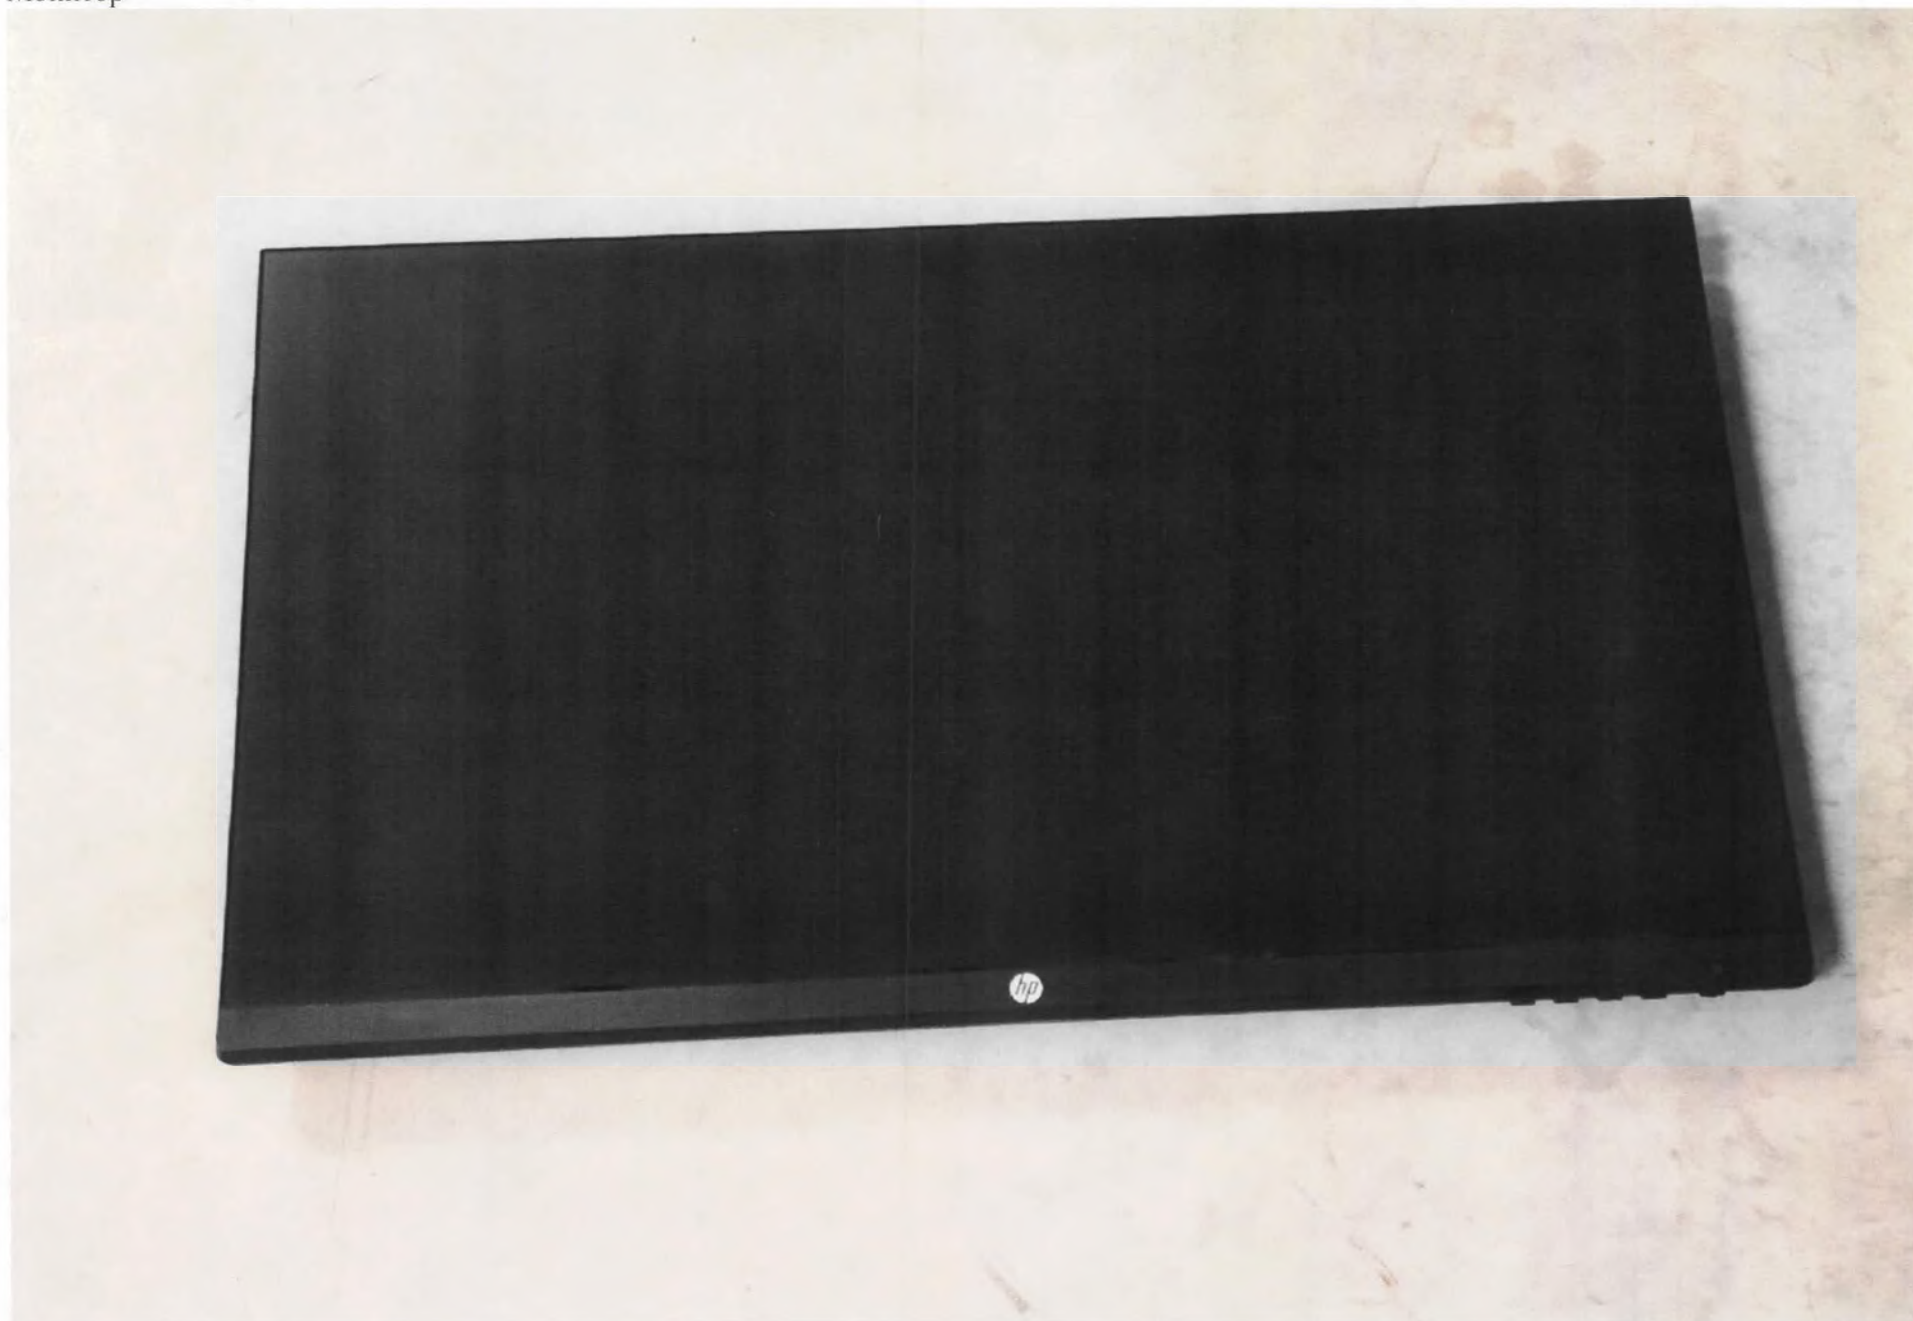


Подставка под монитор

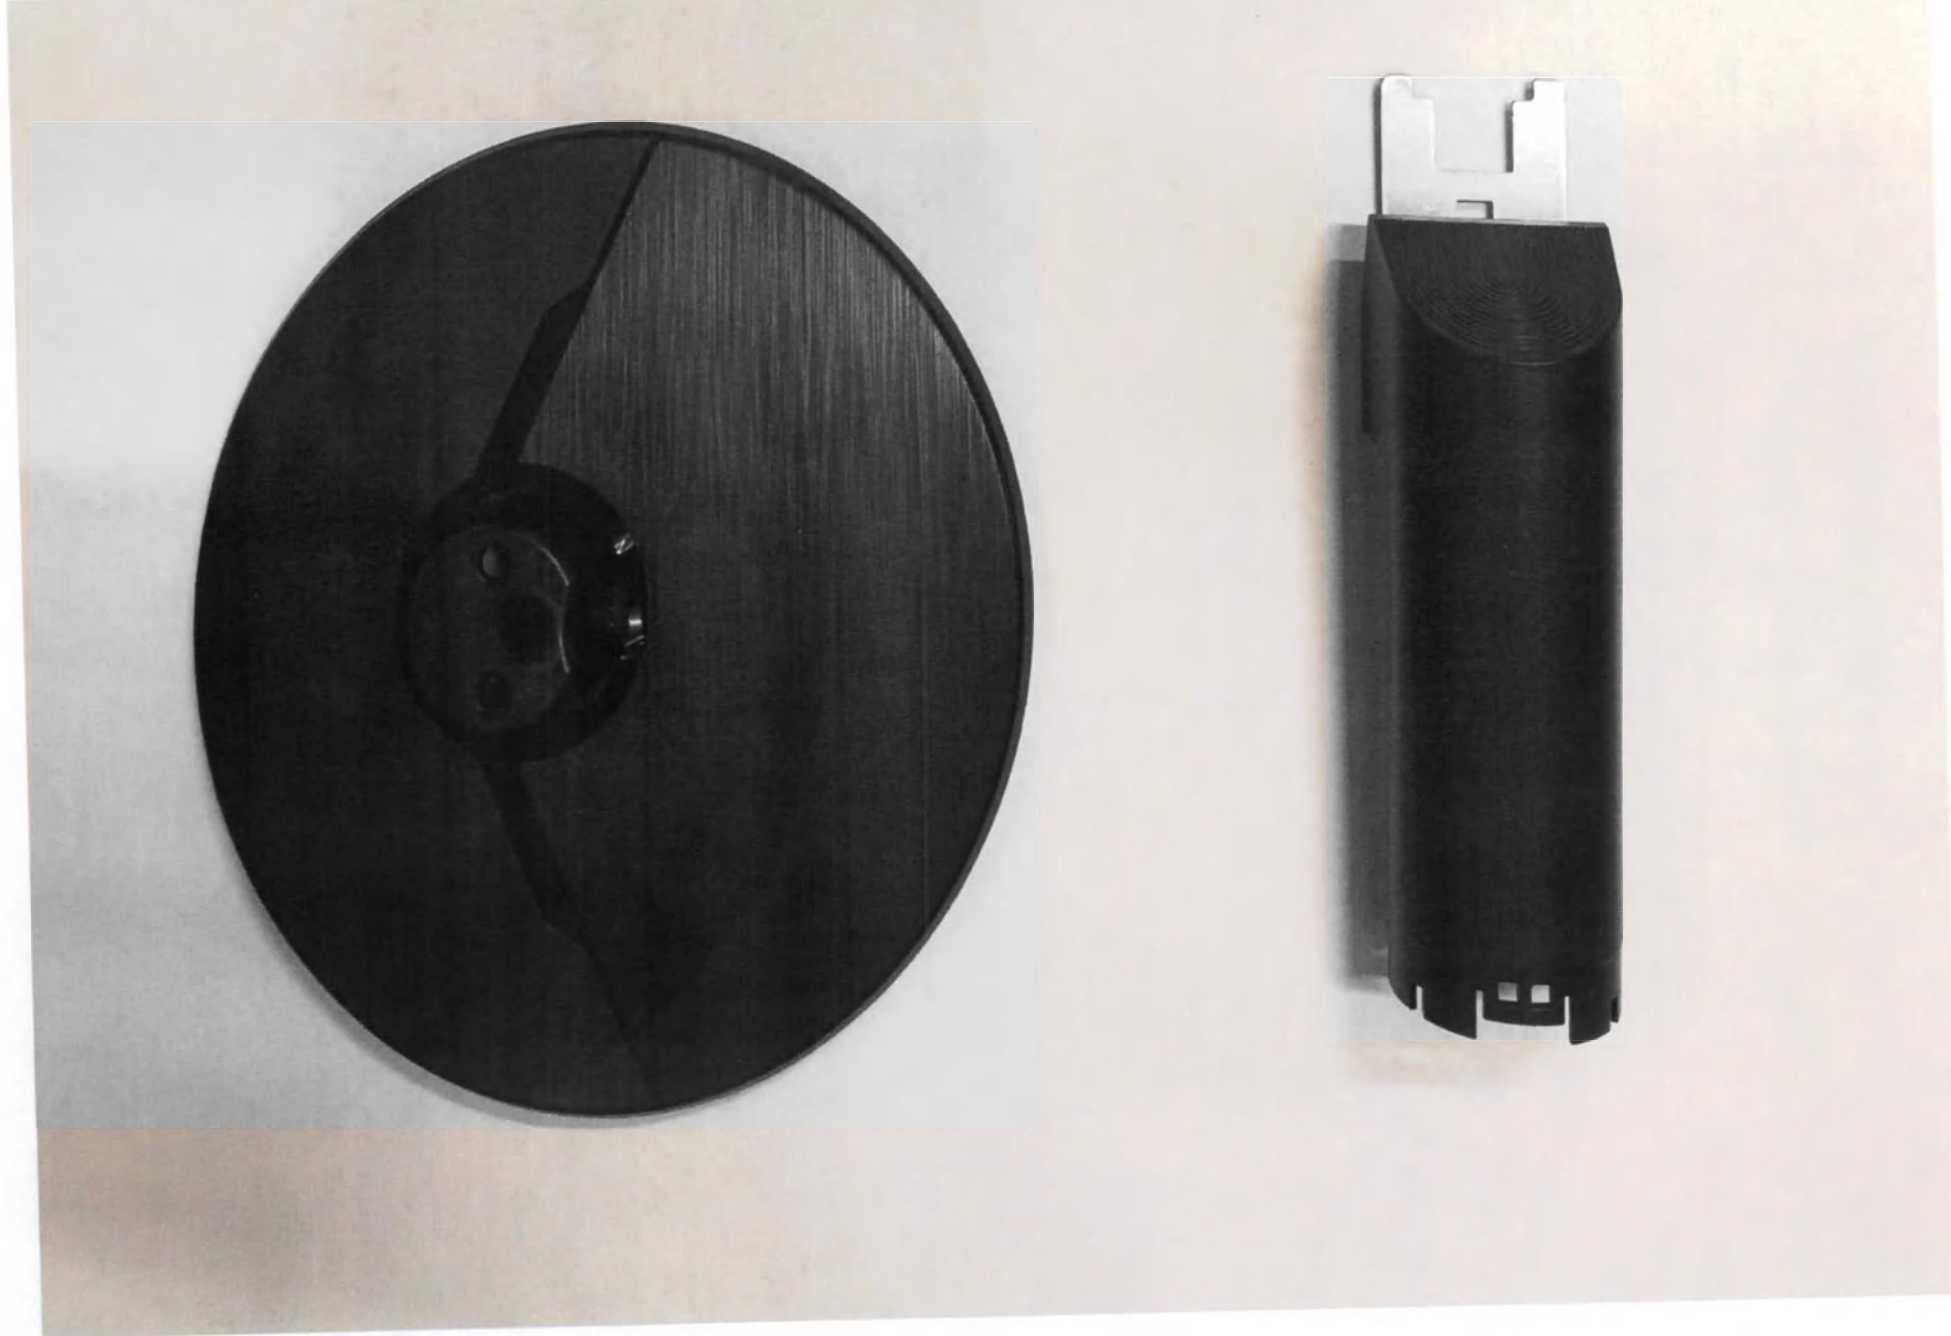

Кабель HDMI




Рабочая станция

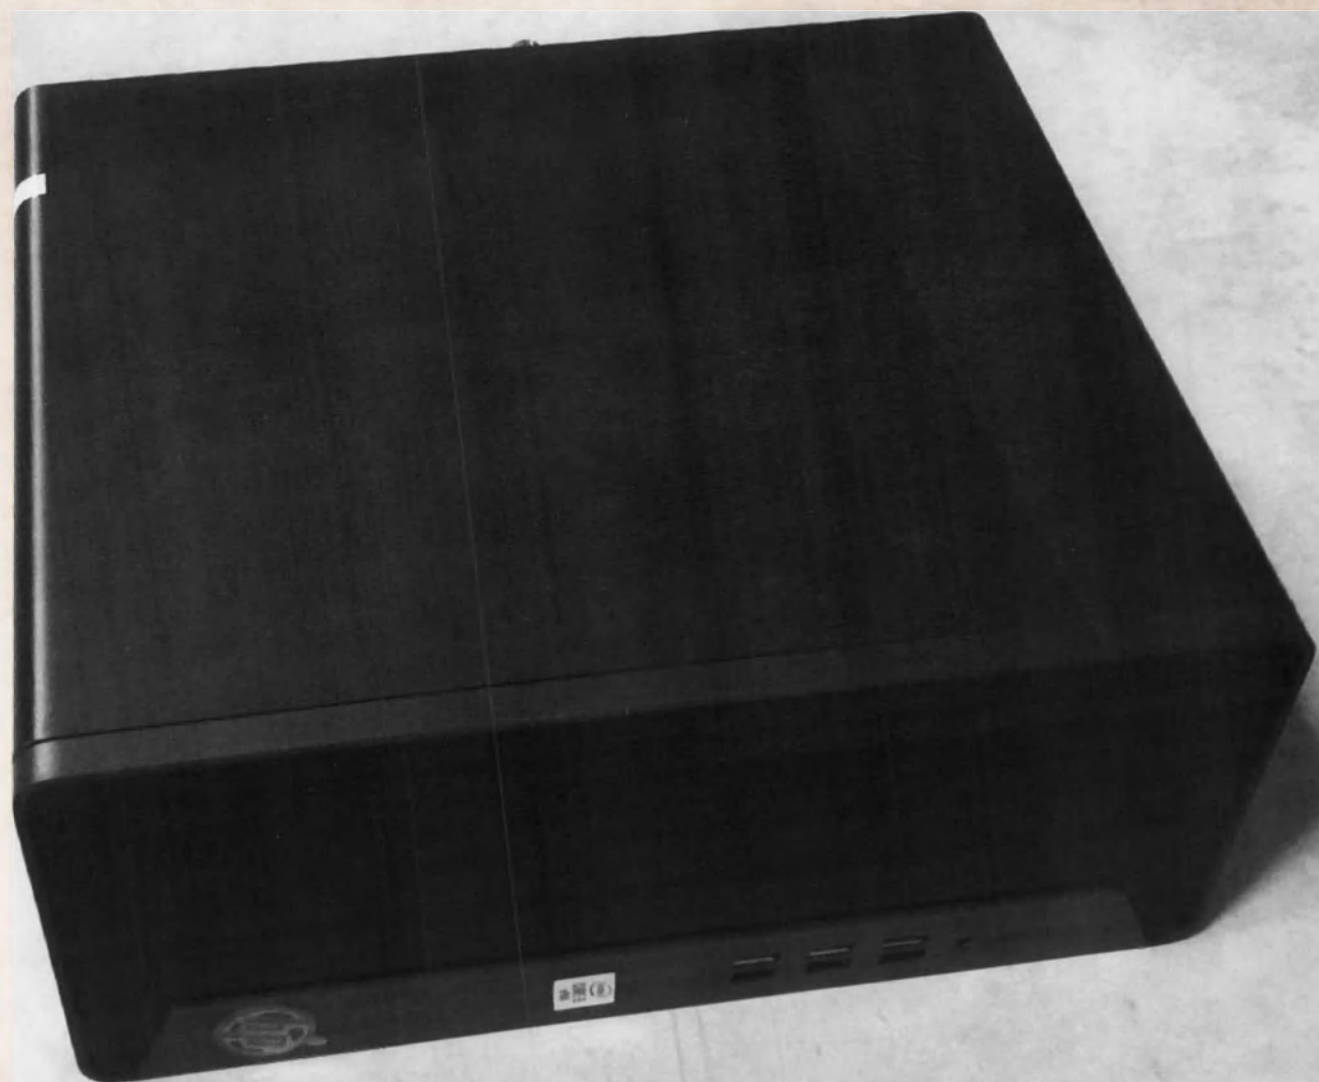

Клавиатура




Мышка

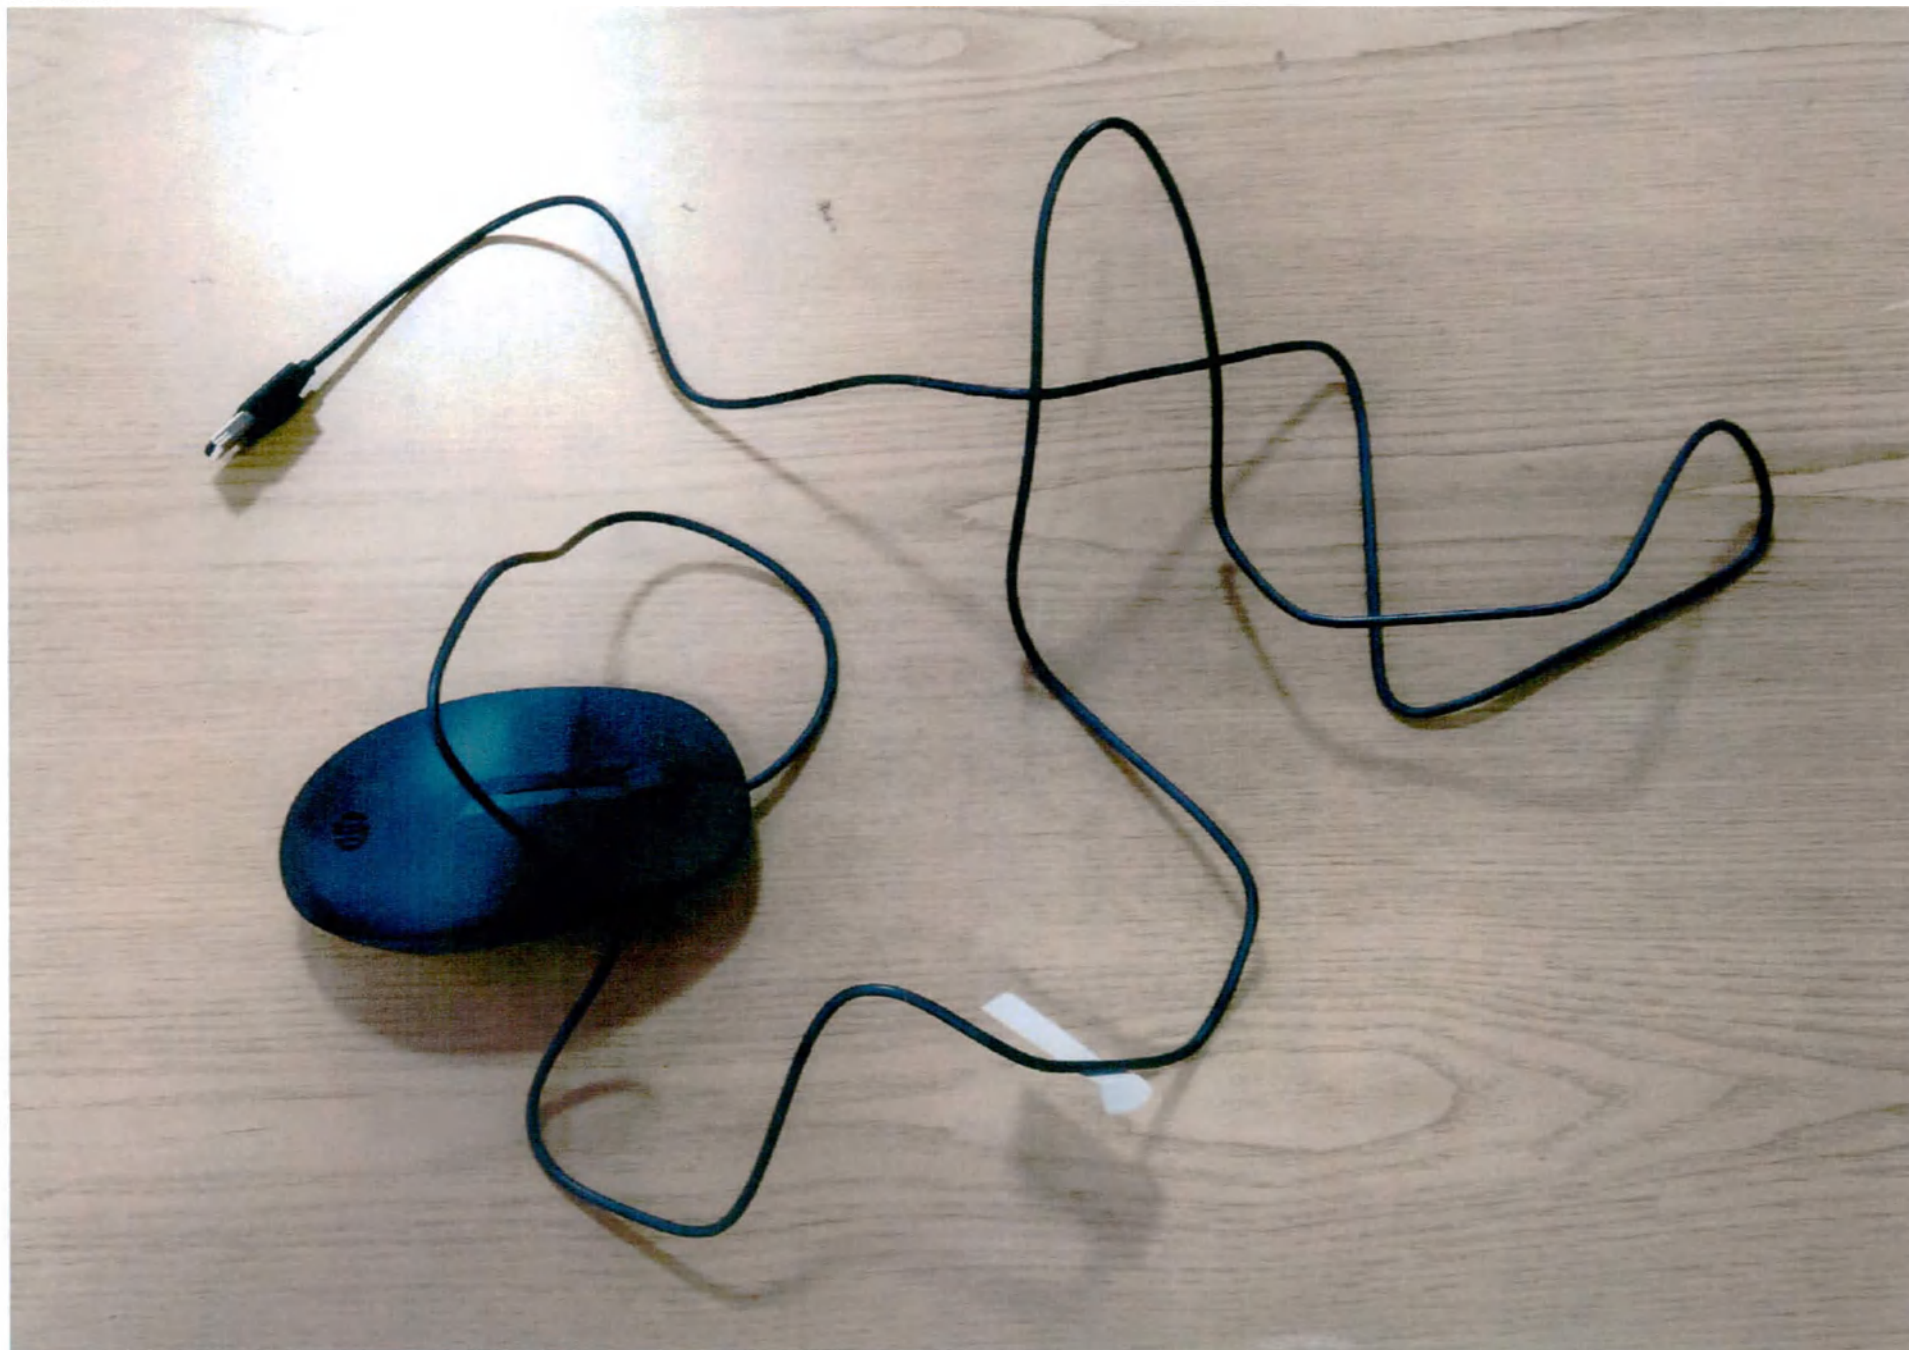

Коврик для мышки



Шнур питания

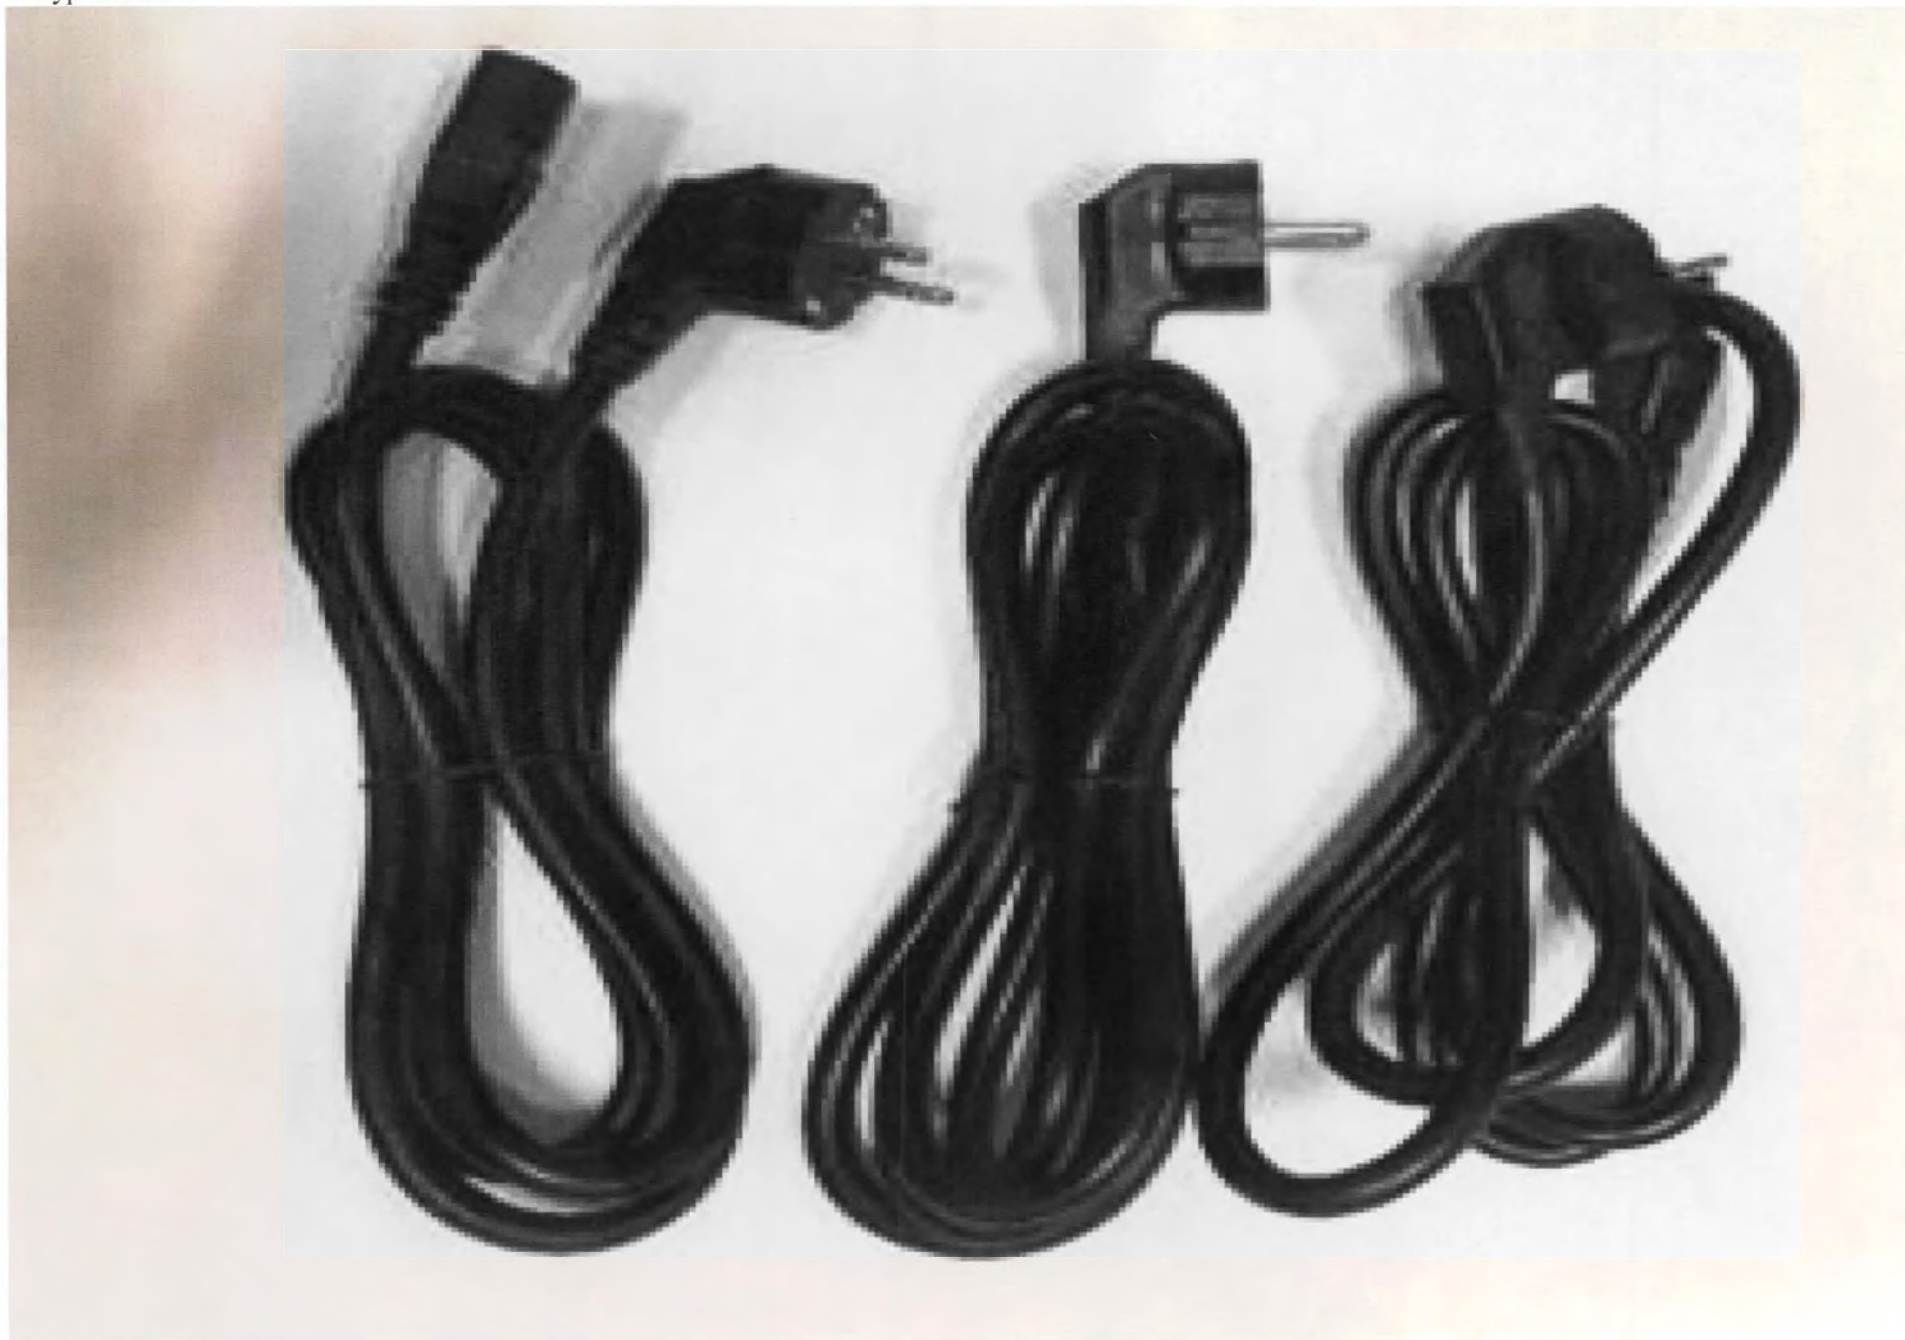



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Development Area
Zhengzhou, China, 450016
Tel.: +86-371-67985313 e-mail: info@autobio-diagnostics.com
website: en.autobio.com.cn


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
OPERATING MANUAL

Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и
определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 /
Automatic microbiological analyzer for identifying microorganisms and determining their sensitivity
to antimicrobial drugs AutoMic-i600

Производитель / Manufacturer
«Аутобио Лабтек Инструментс Ко., Лтд.» /
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

Версия для Российской Федерации
Version for Russian Federation

Подставка для планшетов

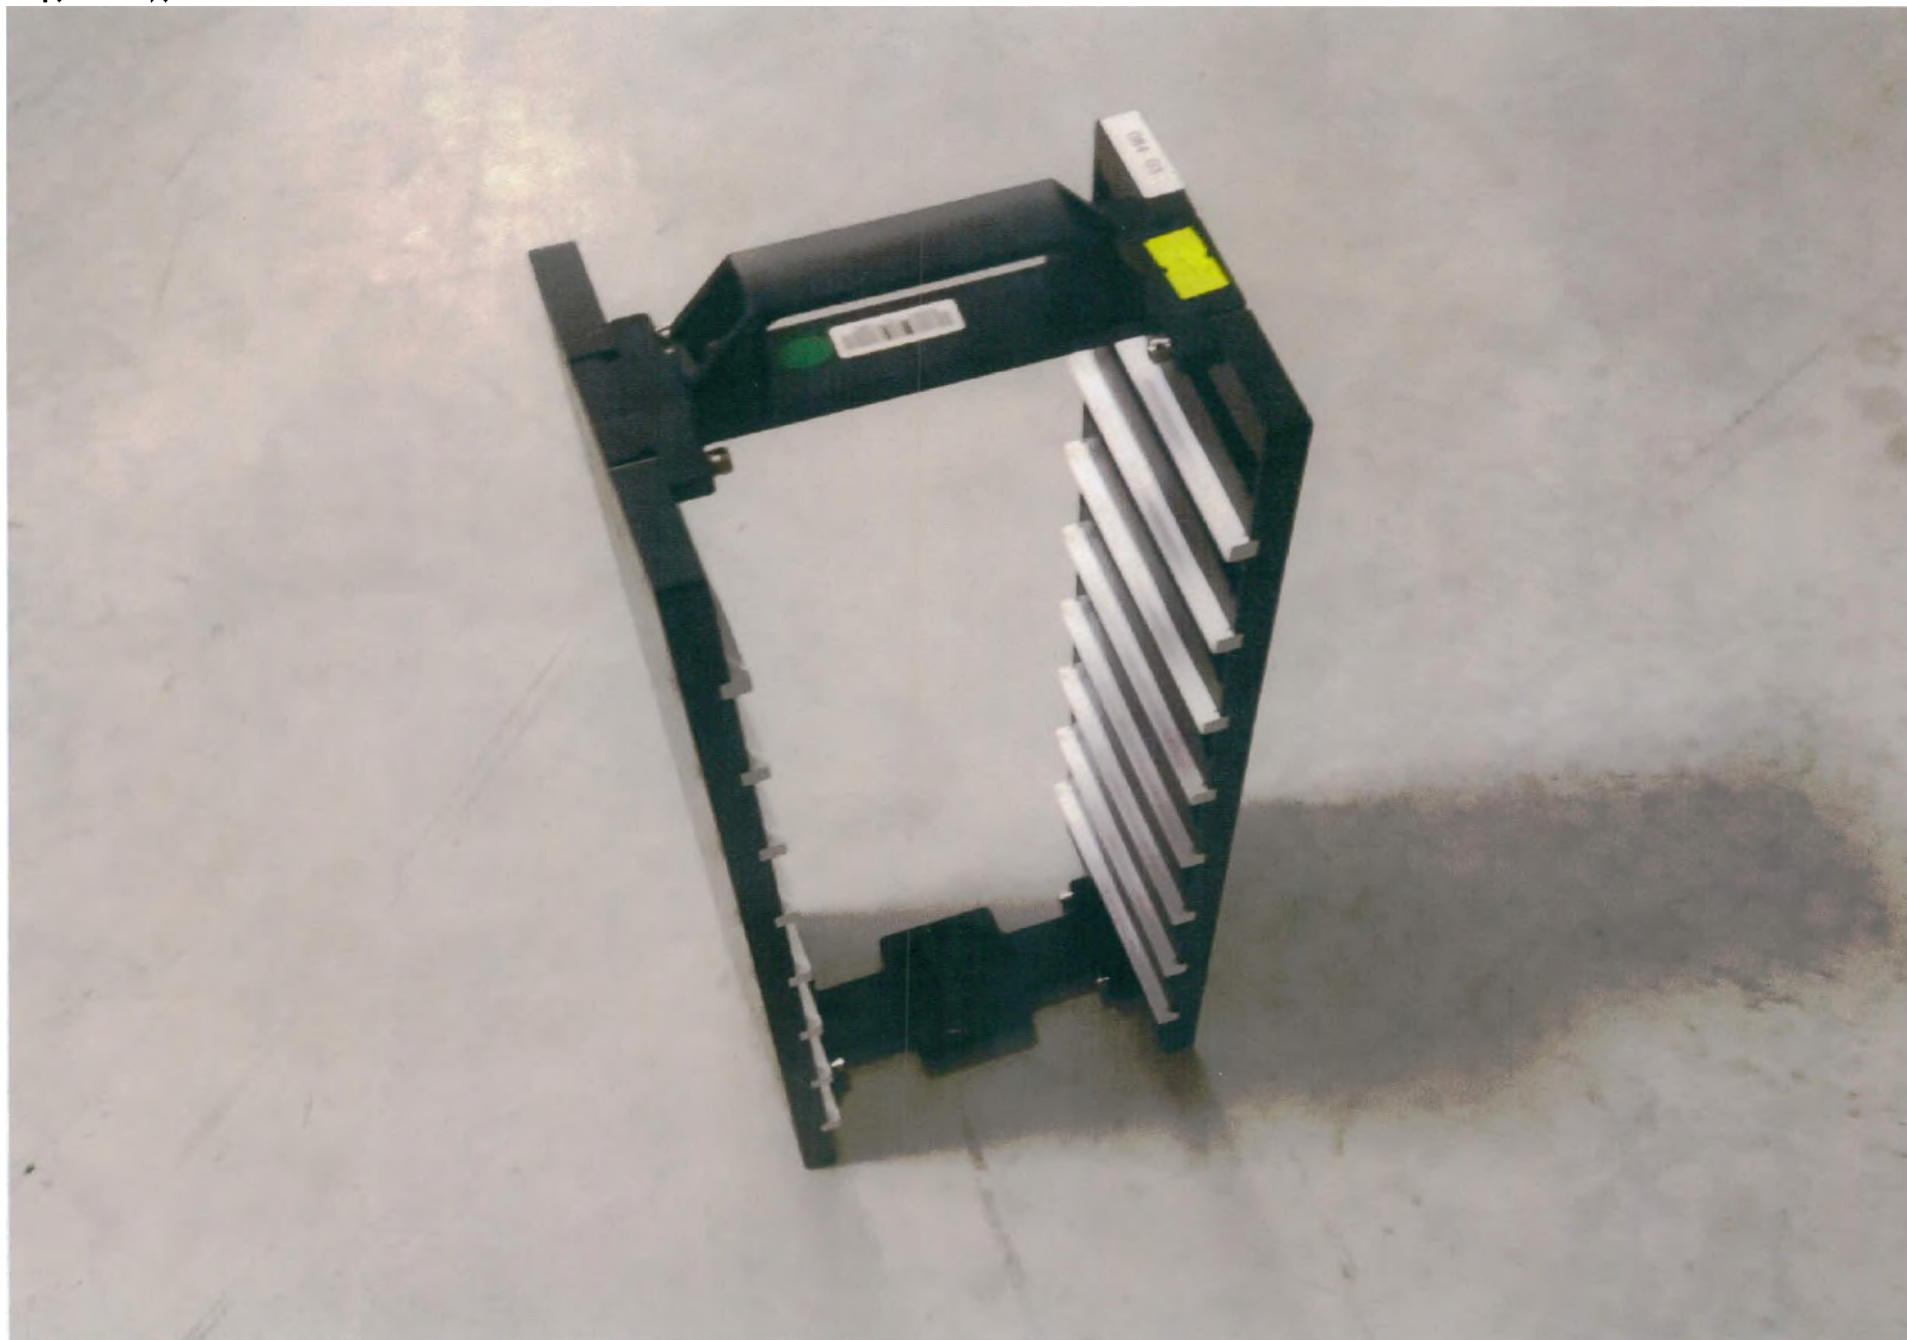

Хранилище для чистых планшетов



Калибровочный планшет с крышкой со штрих-кодом на 120 лунок



Наконечники



Калибровочный пластиковый флакон 16,0 мл со штрих-кодом



Шлицевая отвертка (6*300)



LAN кабель



Болт ручной фиксации



Комплект держателя кабеля




в составе:

- Болт держателя кабеля М3*6 мм



- Держатель кабеля

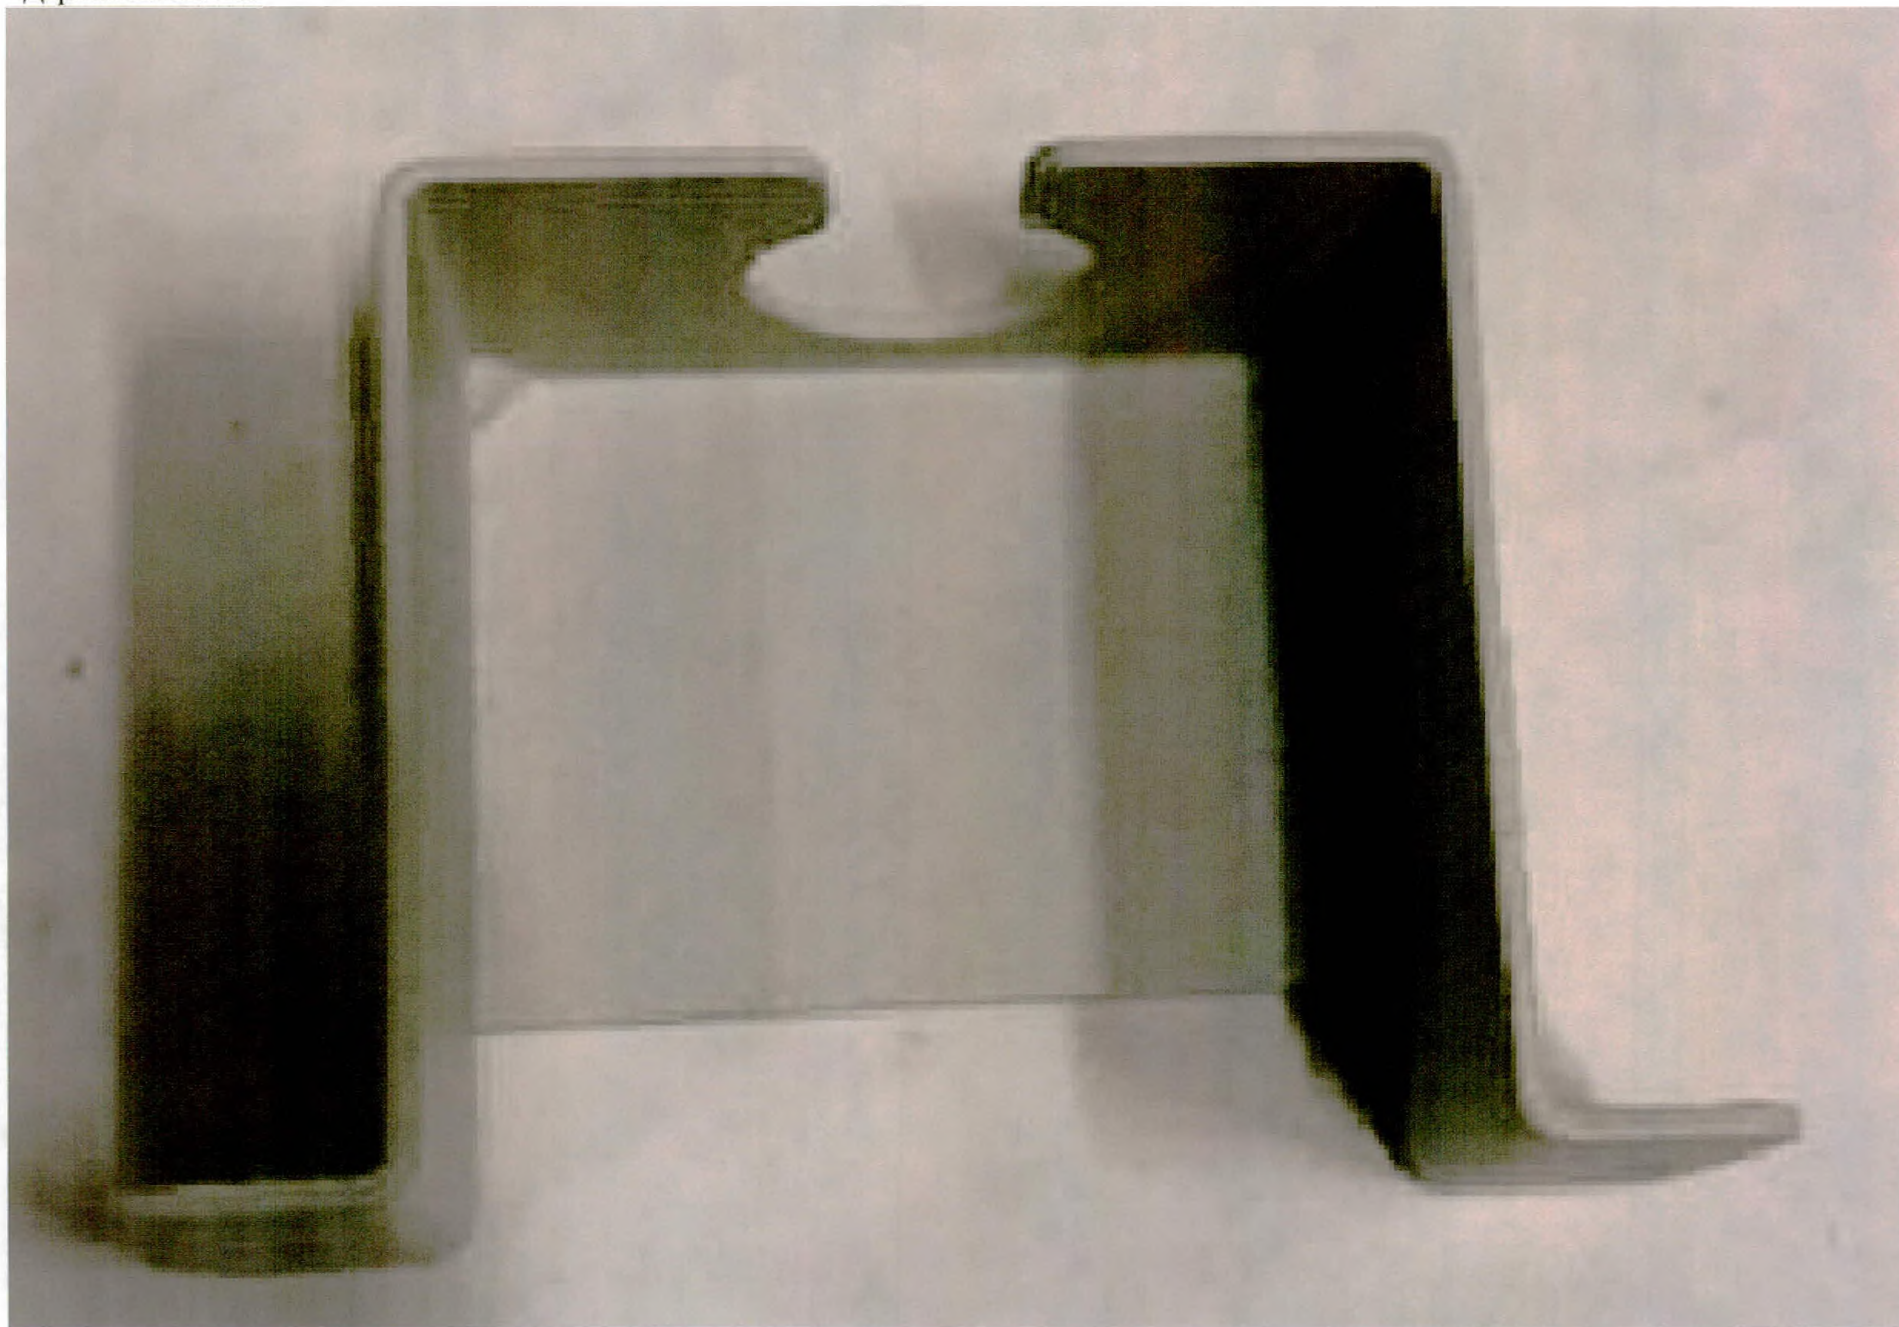

Дренажная игла



Предохранитель



Папка





Диск с ПО (при необходимости)



Линейка



Болт М5*20 мм



Инструмент для вынимания планшетов





Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (оригинальная маркировка производителя на анализаторе)



OBELIS S.A
Bd.Général Wahis, 53
1030 Brussels,
Belgium



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone,
Zhengzhou 450016, China

Automated Microorganism Identification and Antimicrobial
Susceptibility Testing Analyzer

AutoMic-i600

SN 5021001084

REF 05021

Voltage Rating: 100-240 V AC
Power Rating: 1200VA
Frequency: 50/60 Hz

UDI



(01)06973049096119
(11)220819
(21)5021001084



2022-08-19

Tel: +86-371-67985313



IVD



Макет дополнительной маркировки на русском языке

Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, 450016 Zhengzhou, China

Тел.: + 86-371-67985313

Напряжение - 200-240 В переменного тока

Мощность – 1200 ВА

Частота – 50/60 Гц



РУ № РЗН 2023/20981 от _____

Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884; Факс: +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации

Дата производства, серийный номер прибора и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке

Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (транспортная упаковка)



Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600 (транспортная маркировка)

Анализатор автоматический микробиологический для идентификации микроорганизмов
и определения их чувствительности к антимикробным препаратам AutoMic-i600





Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.

No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China

Тел.: + 86-371-67985313

SN

502 100 1084



IVD



Напряжение - 200-240 В переменного тока

Мощность - 1200 ВА

Частота - 50/60 Гц



2022-08-19

РУ № РЗН 2023/20981 от 23.08.2023 г

Габариты: 1800 x 1050 x 1909 мм

Масса 345 кг + (32) кг



Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884; Факс: +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью 37 лист (а/ов)
Руководитель департамента регистрации
ООО «ИЛС»



И.А. Стариковская