

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ФНК Медицина»


« 01 » 04 2022 Г.А. Стихеев



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
(редакция №01 от 30.11.2021)

**«Сканер цифровой патологоанатомический
микропрепаратов KF-PRO (Digital Pathology Slide Scanner), в
вариантах исполнения»**

Варианты исполнения:

- KF-PRO-002
- KF-PRO-005
- KF-PRO-005-EX
- KF-PRO-005-HI
- KF-PRO-020
- KF-PRO-020-HI
- KF-PRO-040
- KF-PRO-040-HI
- KF-PRO-120
- KF-PRO-400
- KF-PRO-400-HI



Фотографическое изображение 1 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-002, общий вид



Фотографическое изображение 2 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-002, вид слева



Фотографическое изображение 3 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-002, вид справа




Фотографическое изображение 4 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-002, вид сзади




Фотографическое изображение 5 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-002, переключатель масштаба




Фотографическое изображение 6 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005, общий вид

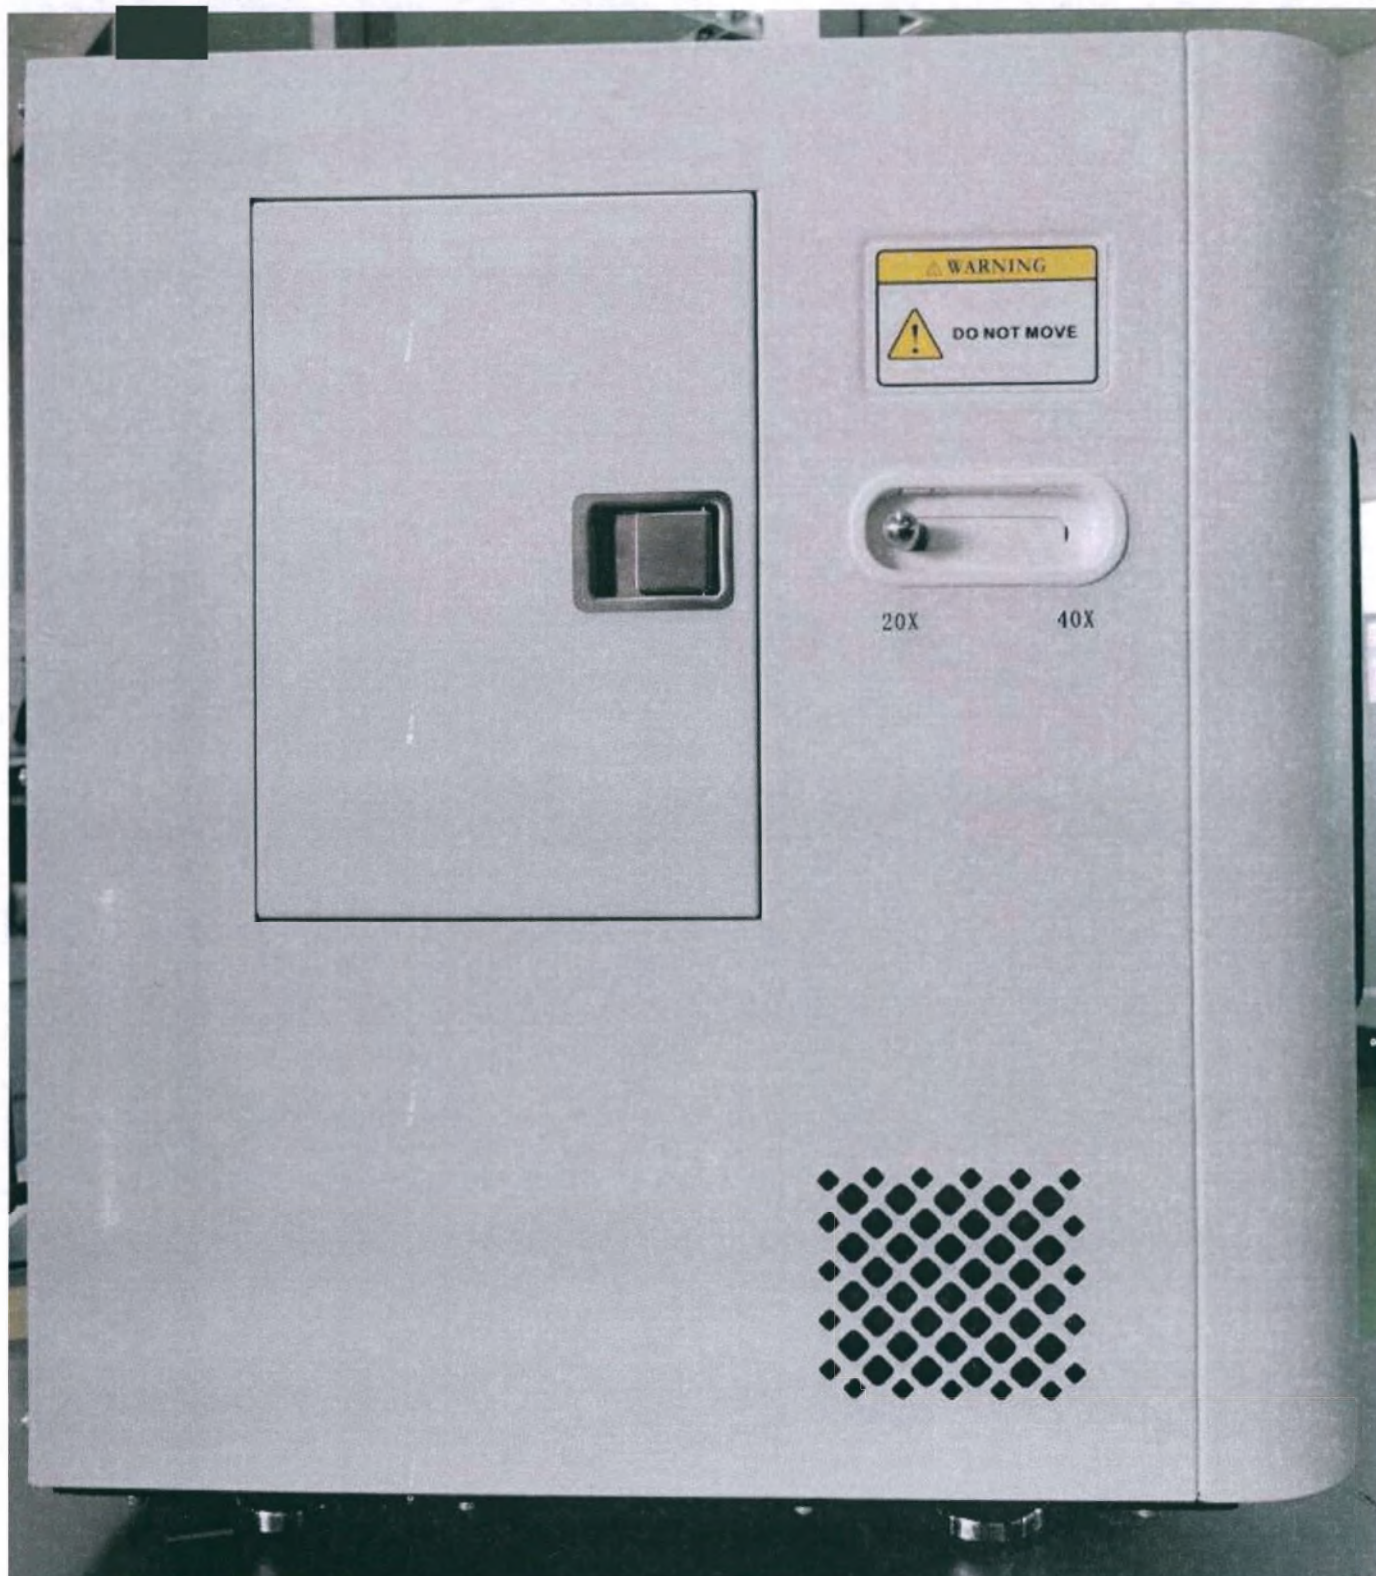

Фотографическое изображение 7 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005, вид слева

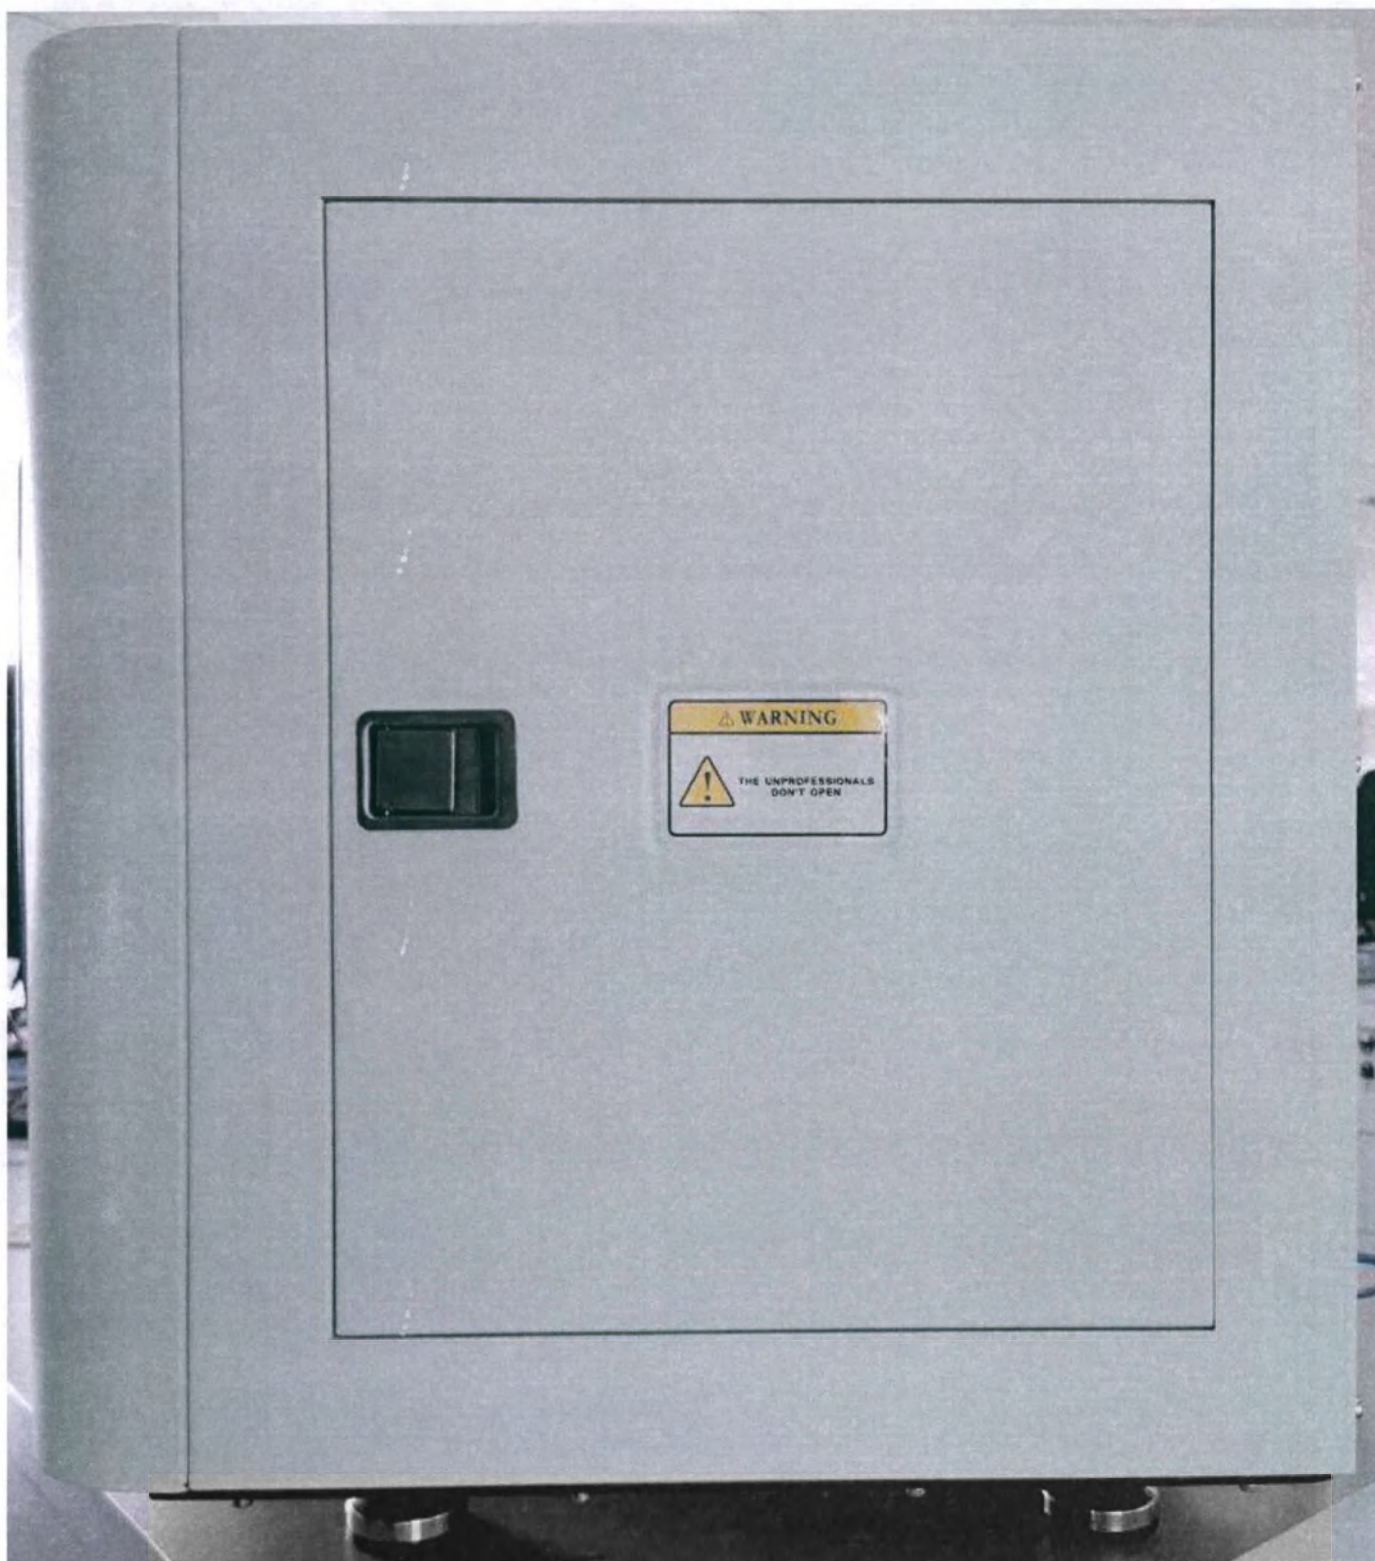


Фотографическое изображение 8 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005, вид справа

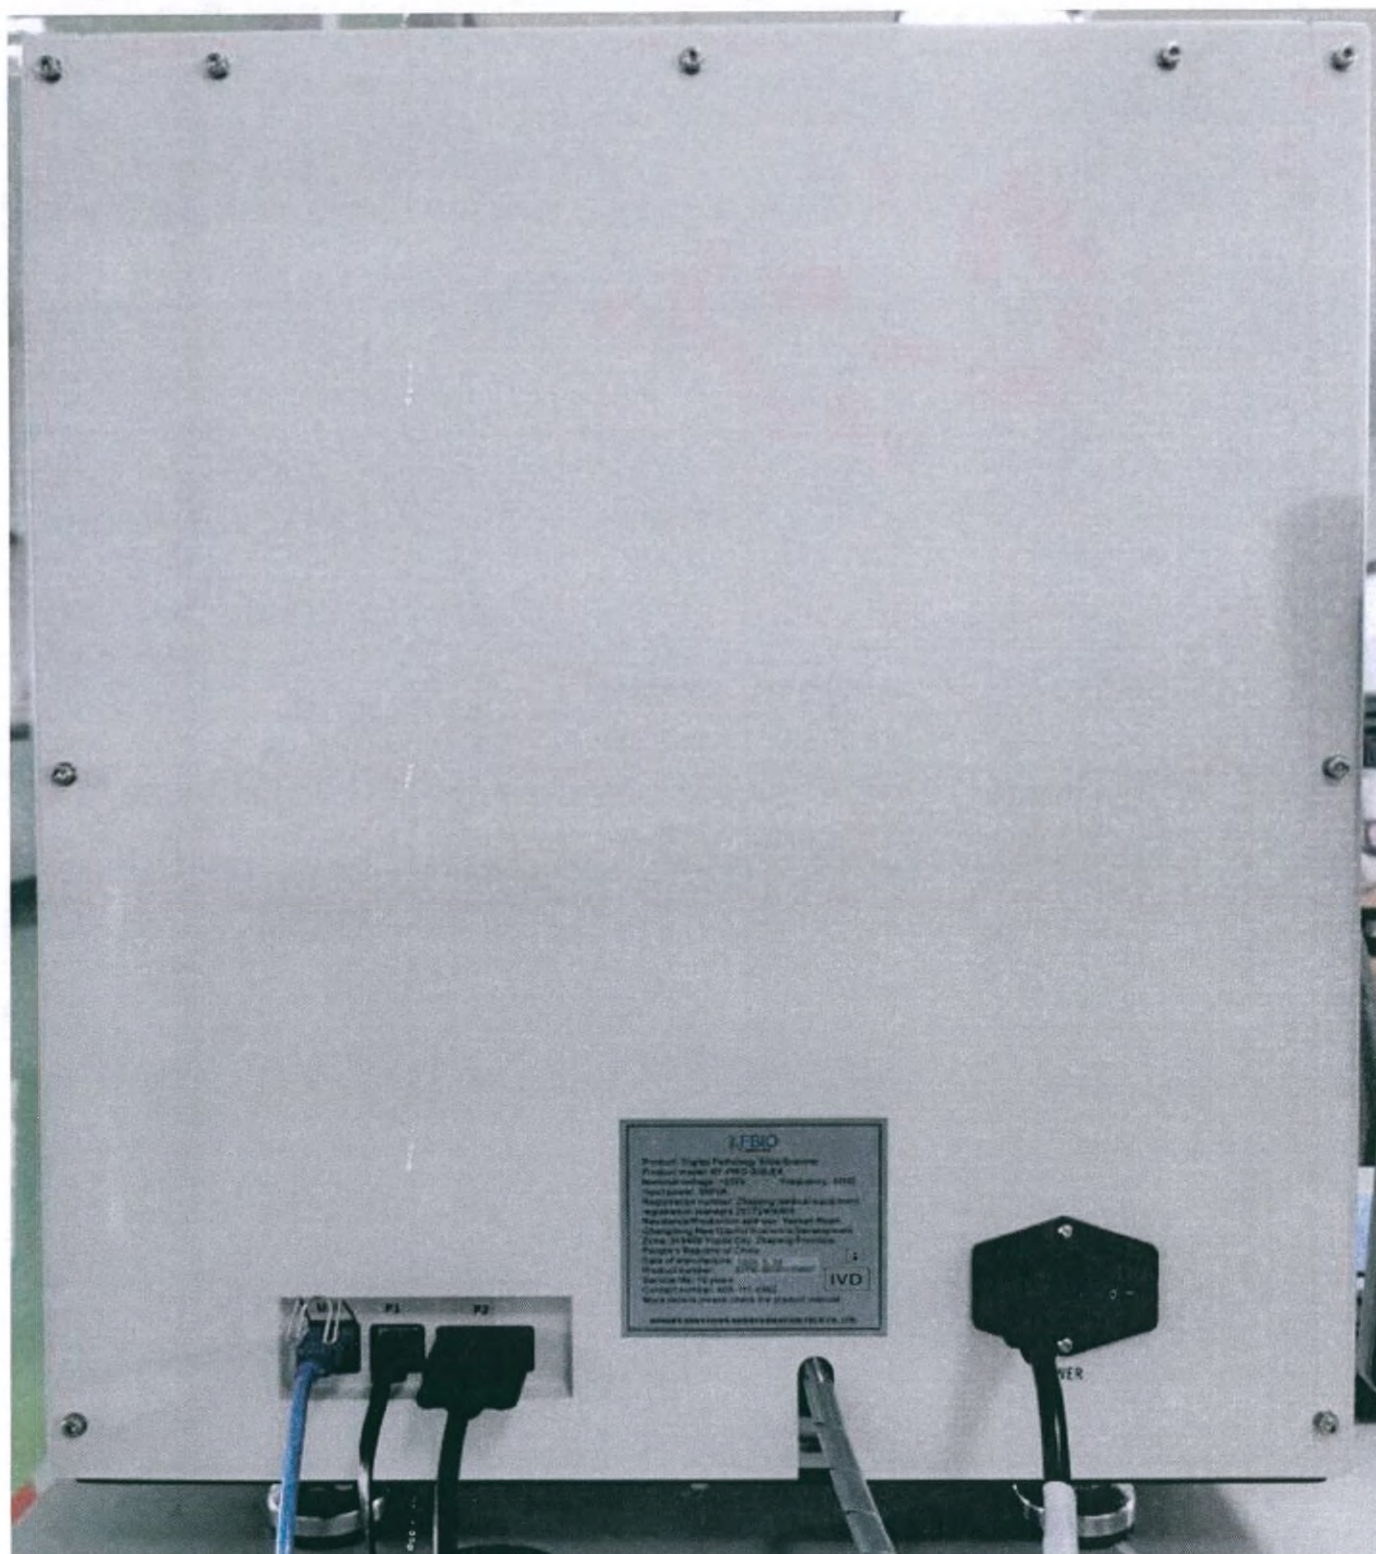


Фотографическое изображение 9 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005, вид сзади




Фотографическое изображение 10 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005, переключатель масштаба

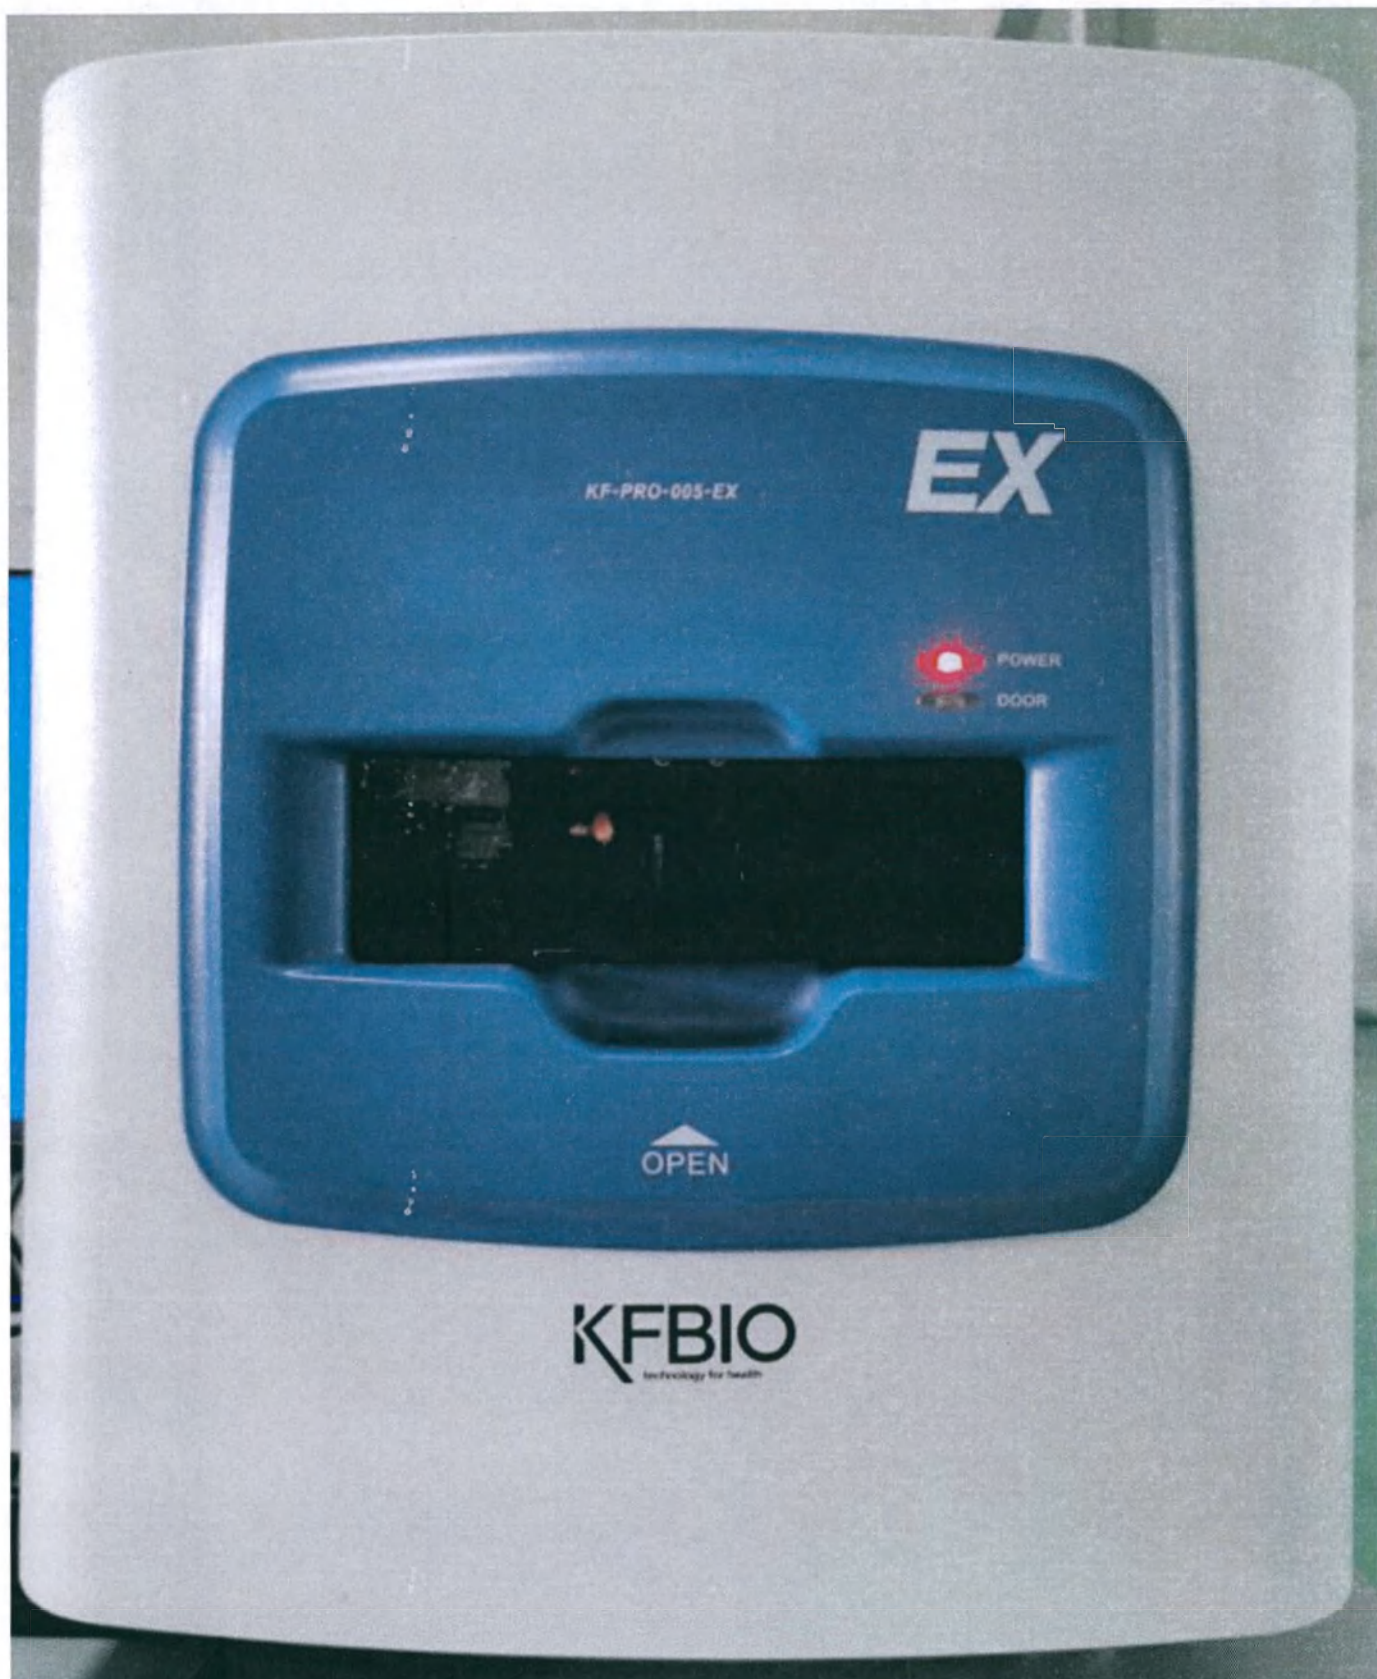


Фотографическое изображение 11 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов KF-PRO-005-EX, общий вид

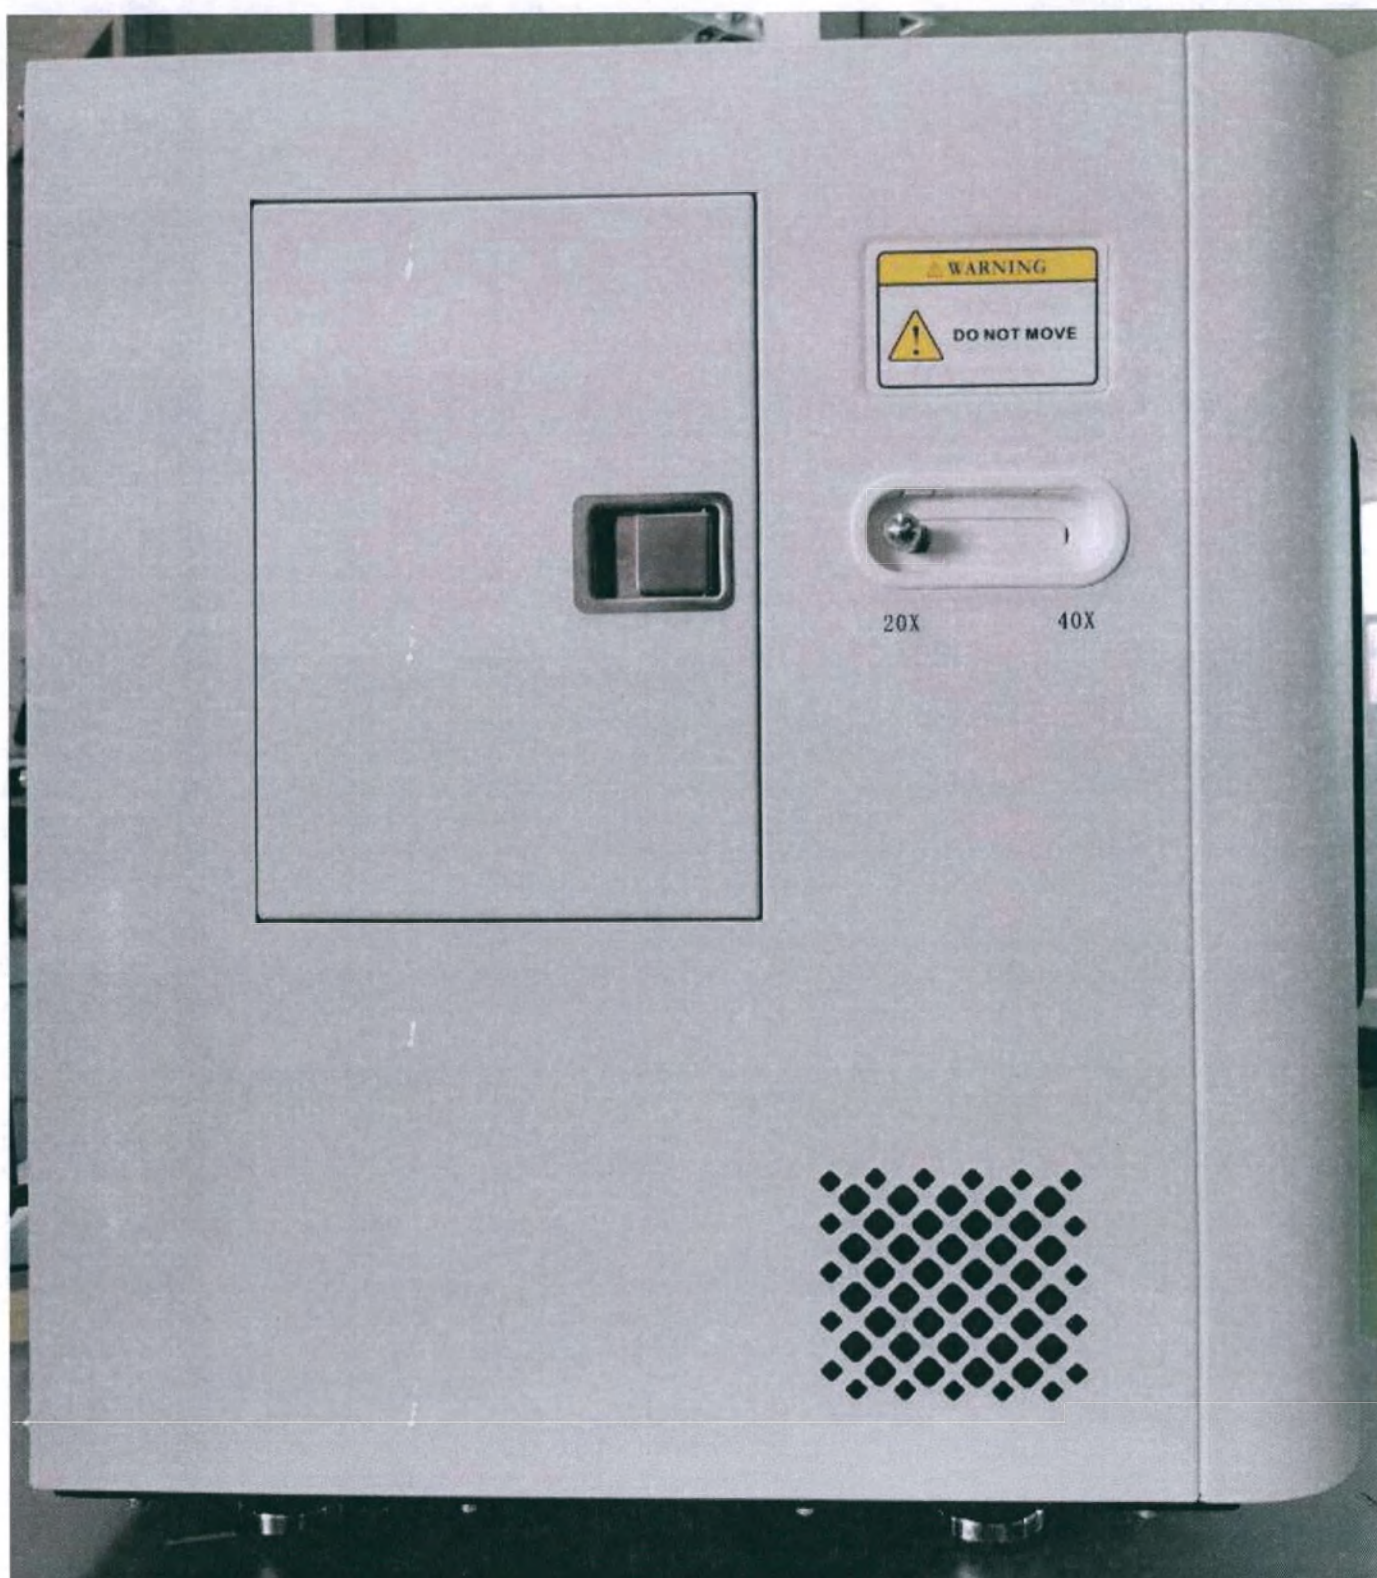

Фотографическое изображение 12 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов KF-PRO-005-EX, вид слева

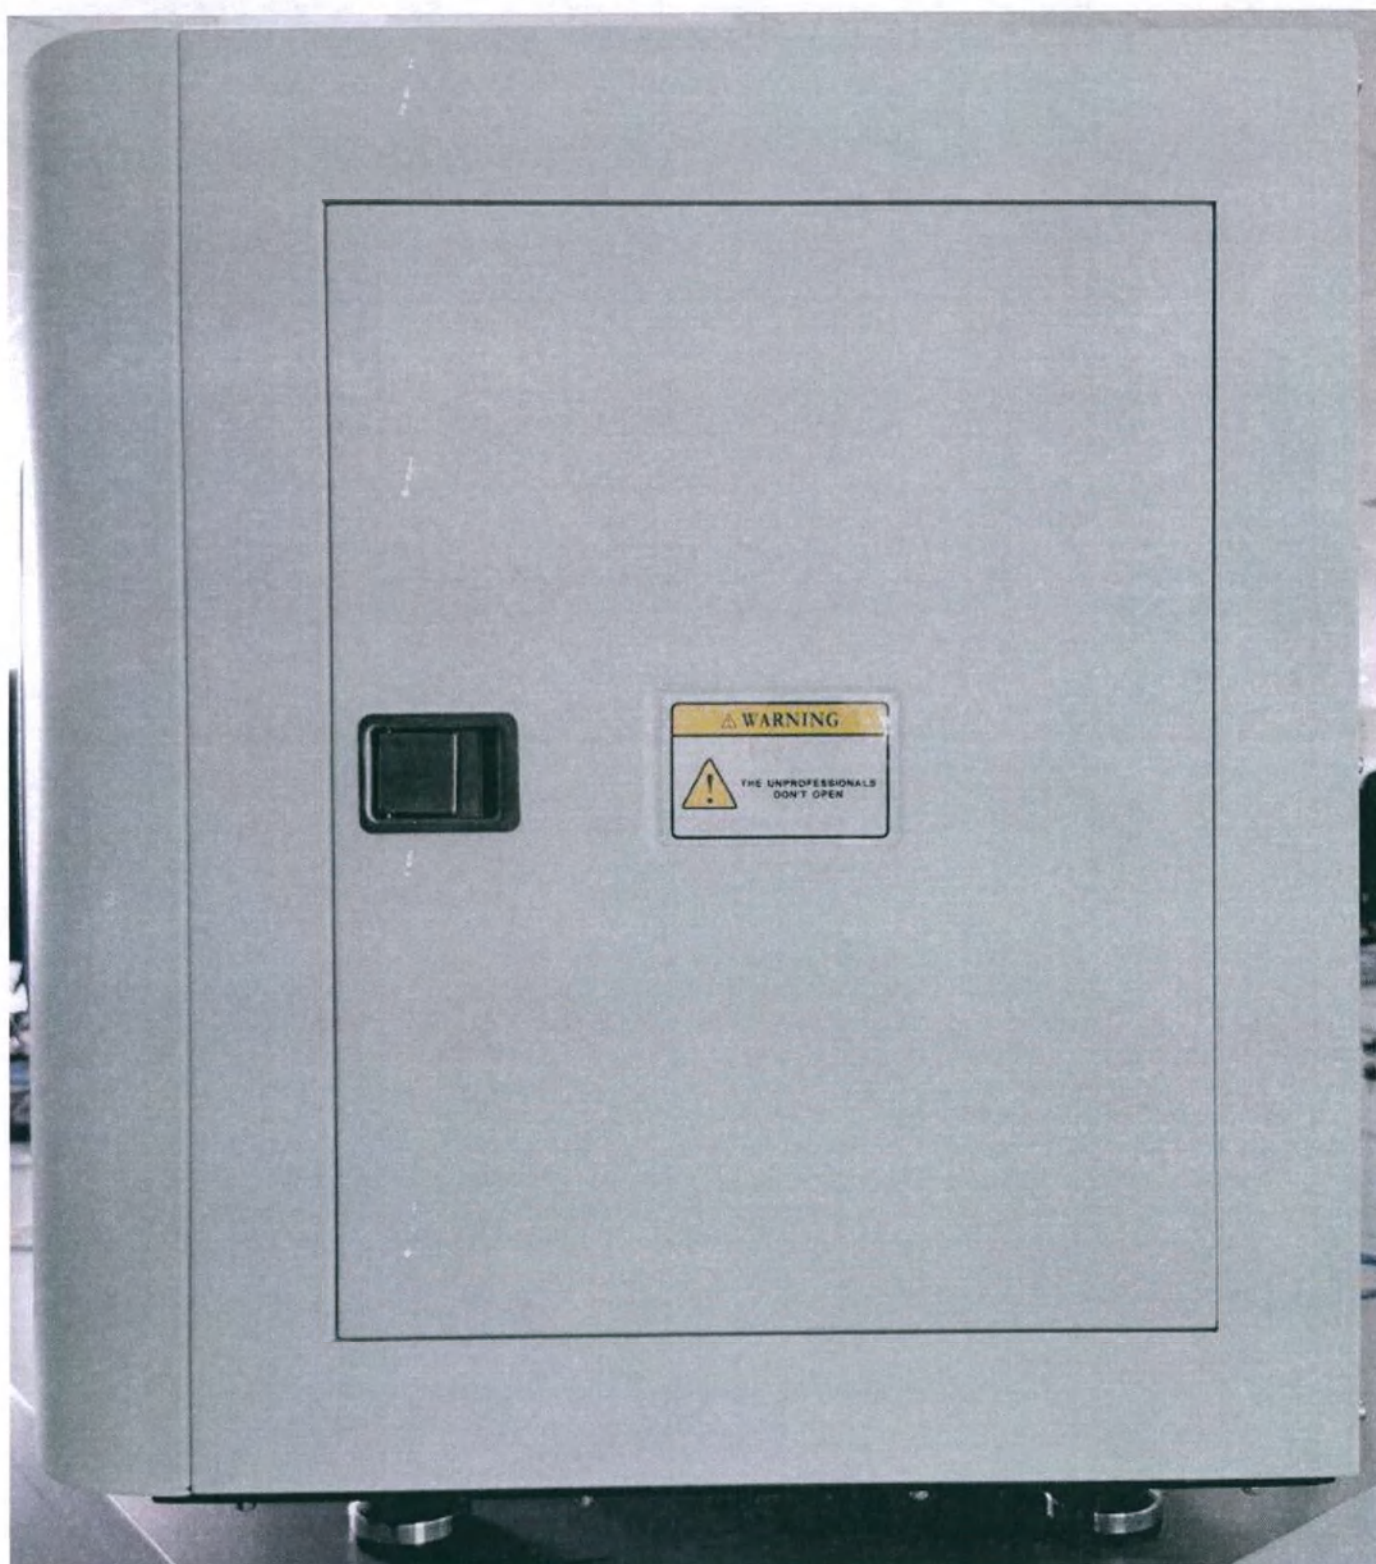

Фотографическое изображение 13 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов KF-PRO-005-EX, вид справа

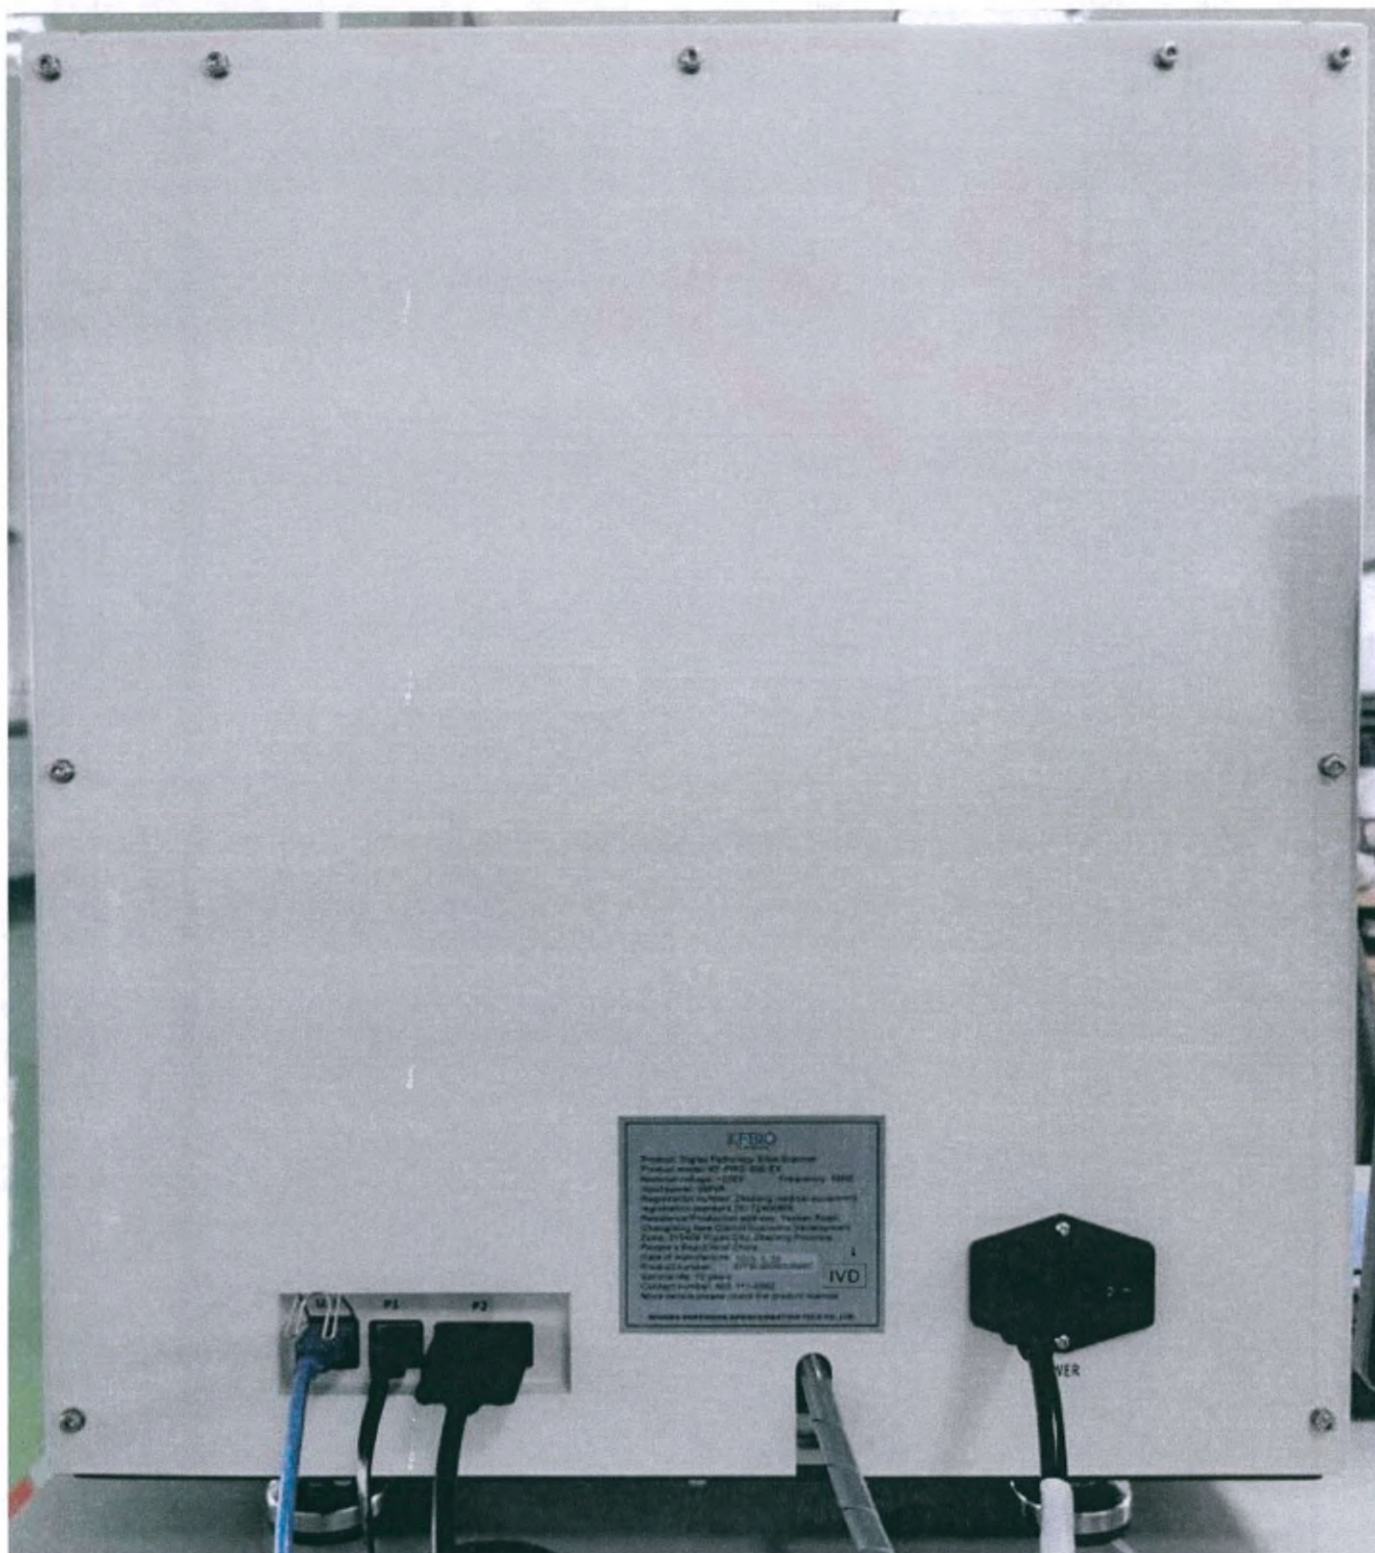


Фотографическое изображение 14 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов KF-PRO-005-EX, вид сзади




Фотографическое изображение 15 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-EX, переключатель масштаба




Фотографическое изображение 16 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-HI, общий вид

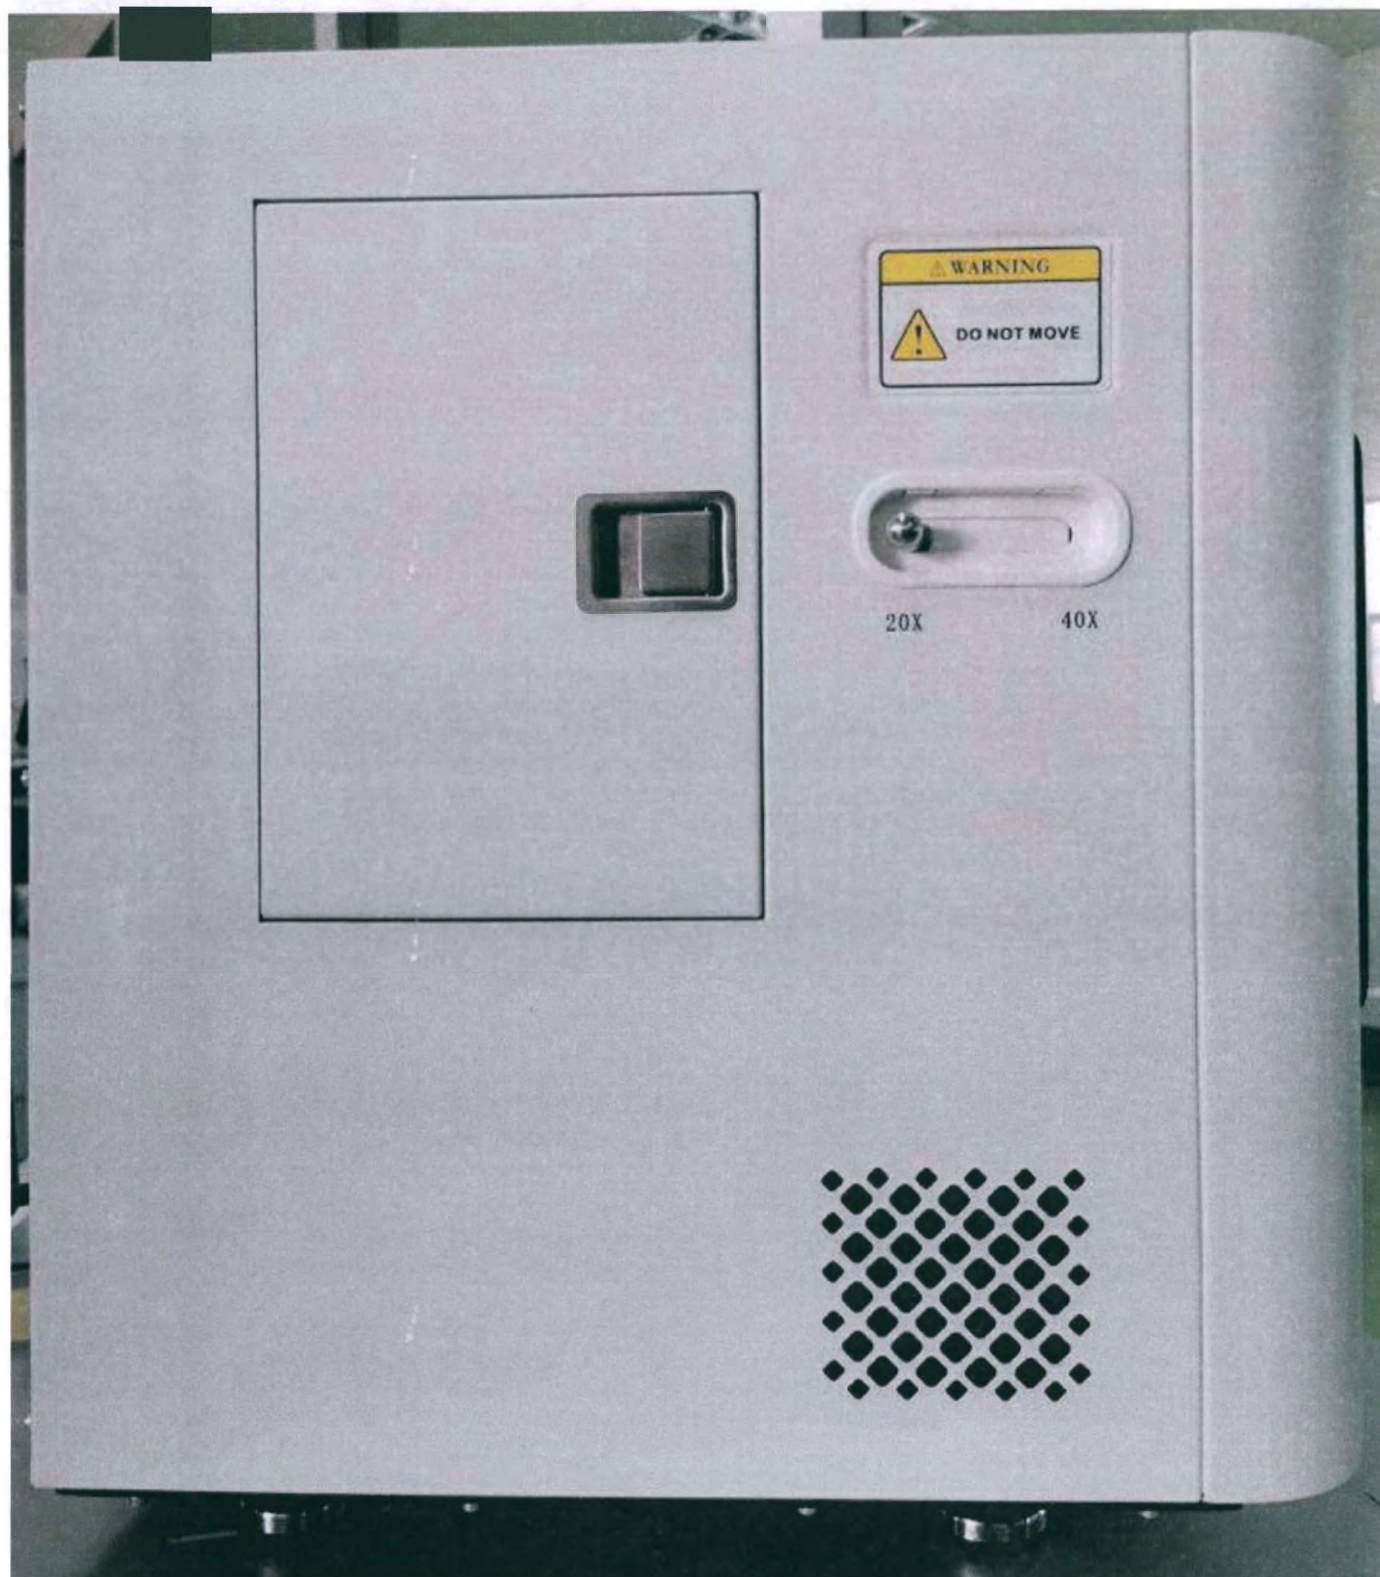

Фотографическое изображение 17 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-HI, вид слева

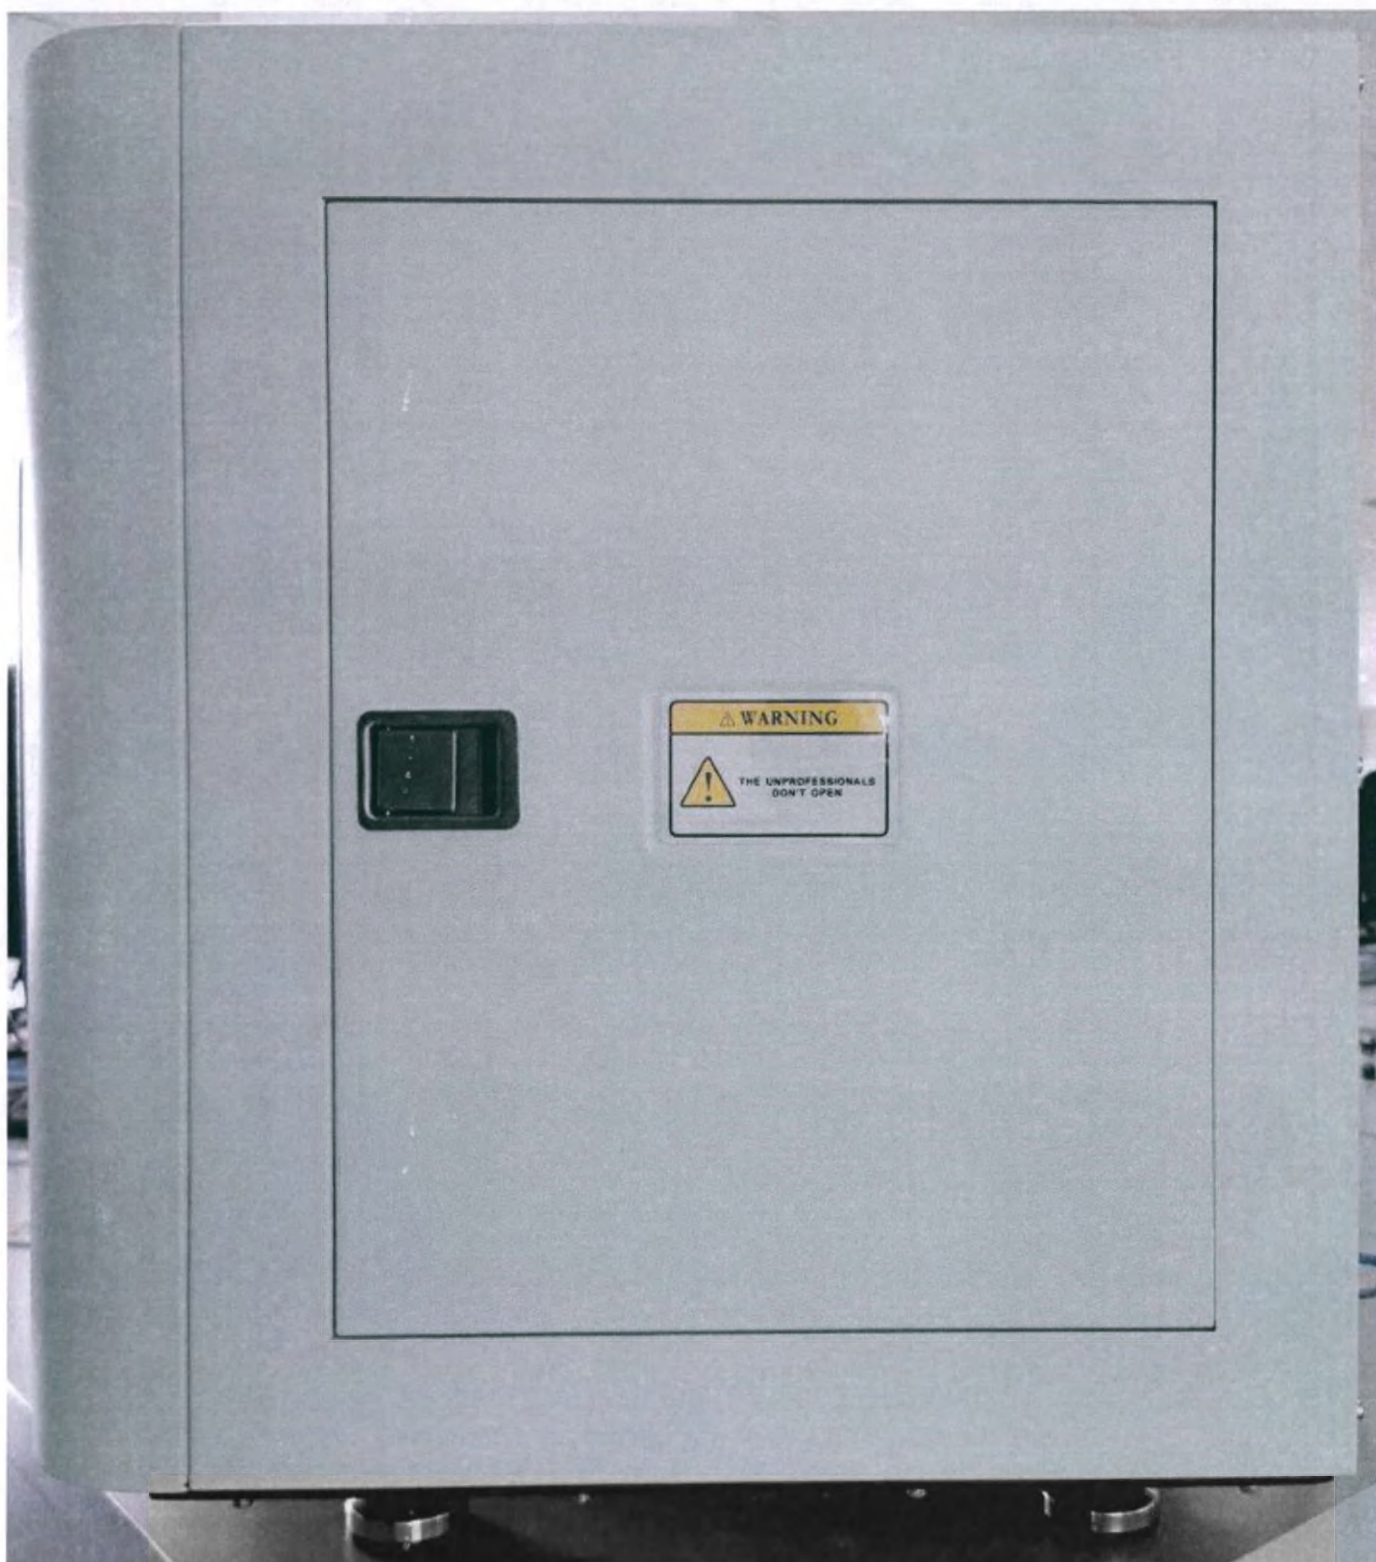

Фотографическое изображение 18 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-HI, вид справа

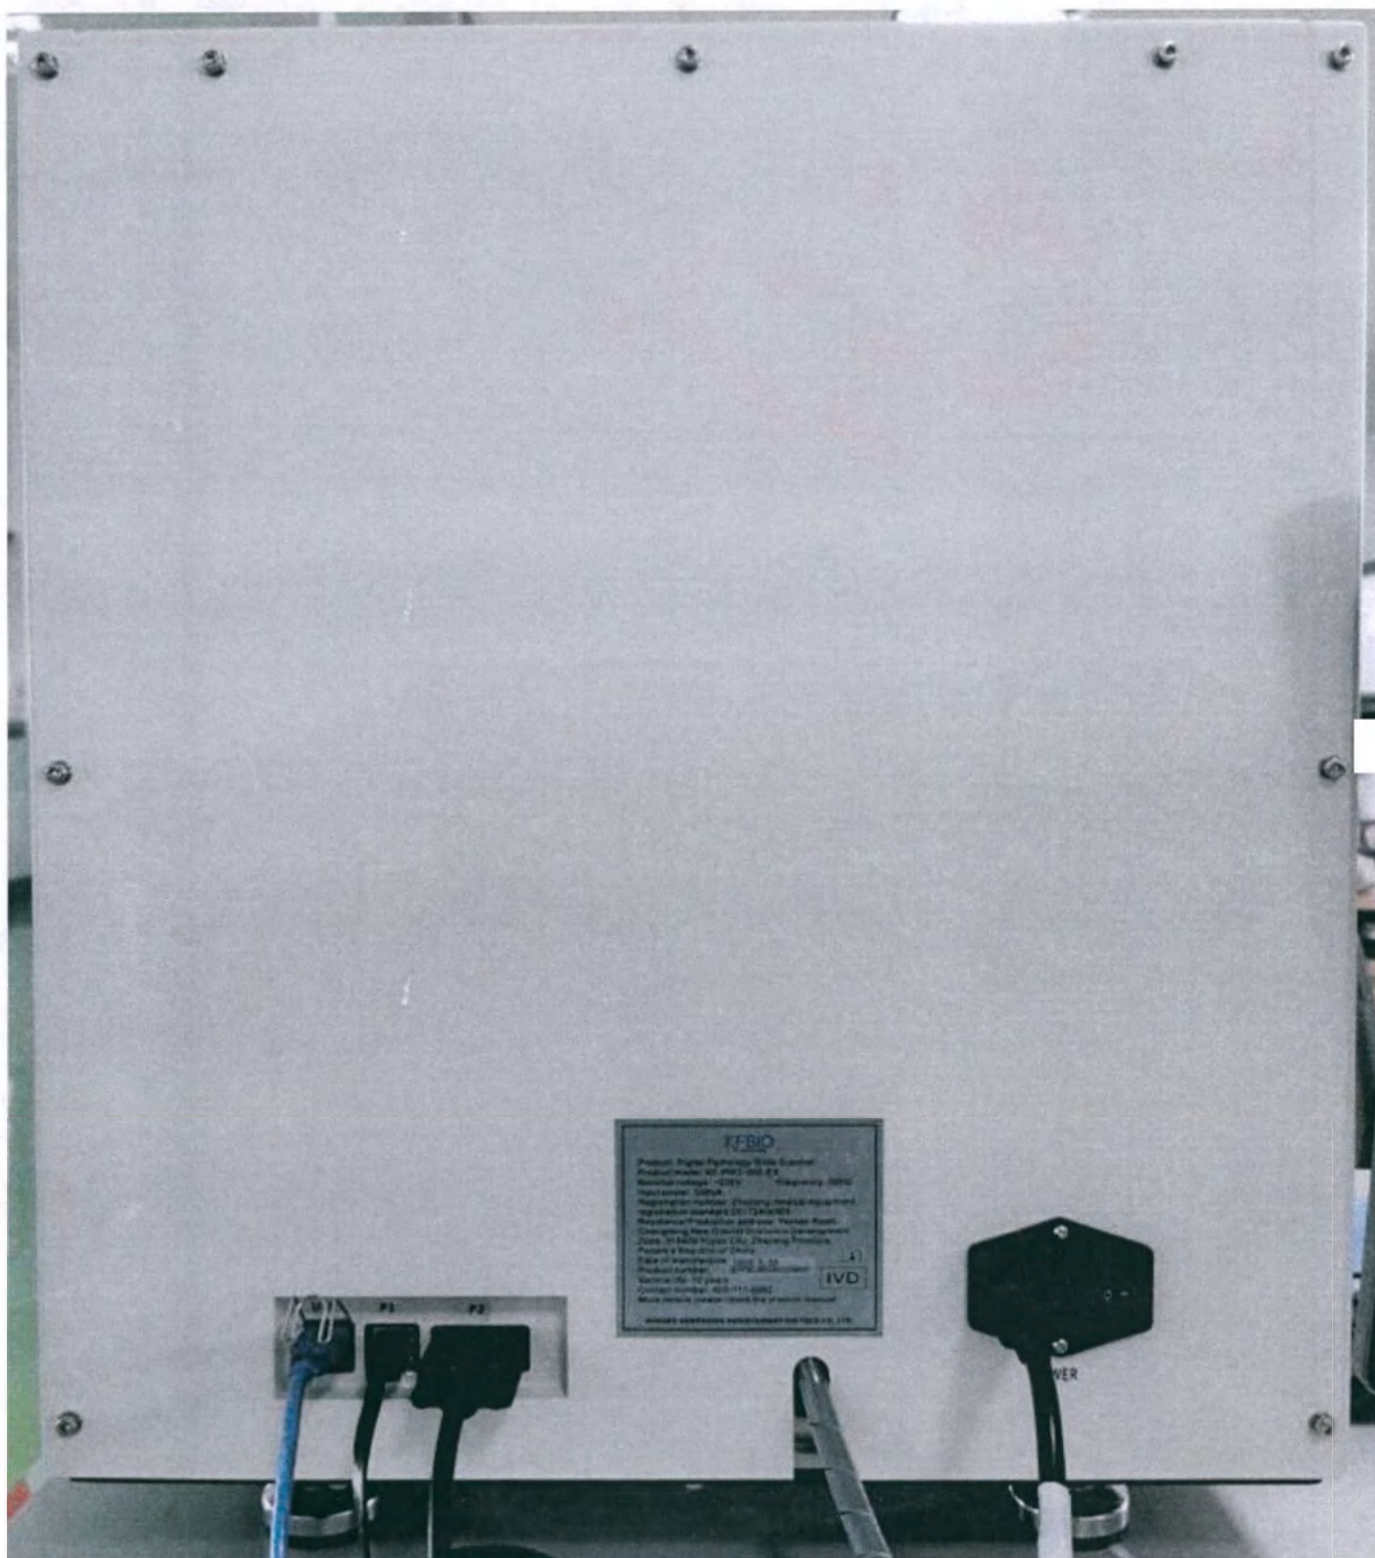

Фотографическое изображение 19 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-HI, вид сзади




Фотографическое изображение 20 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-005-III, переключатель масштаба




Фотографическое изображение 21 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020, общий вид



Фотографическое изображение 22 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020, вид слева

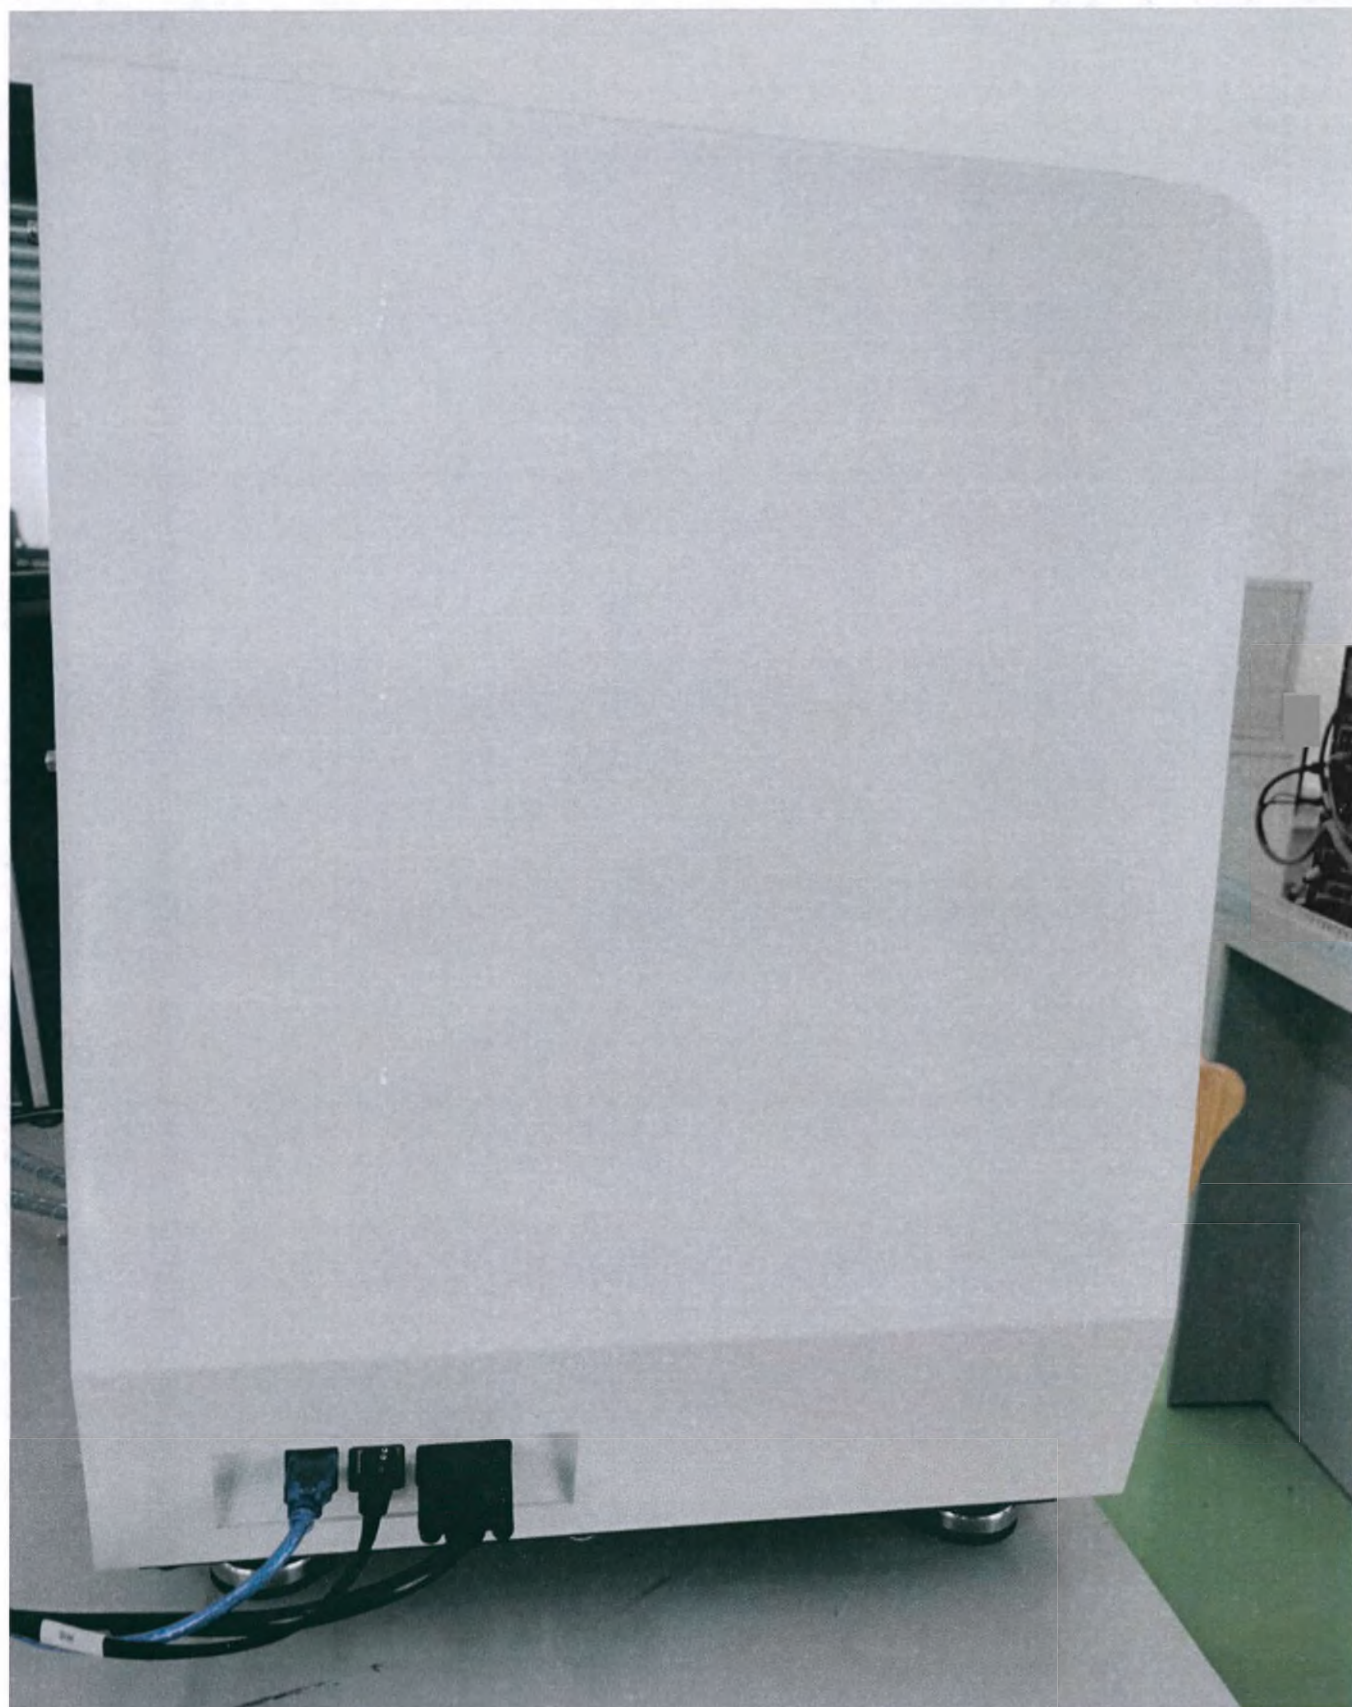

Фотографическое изображение 23 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020, вид справа

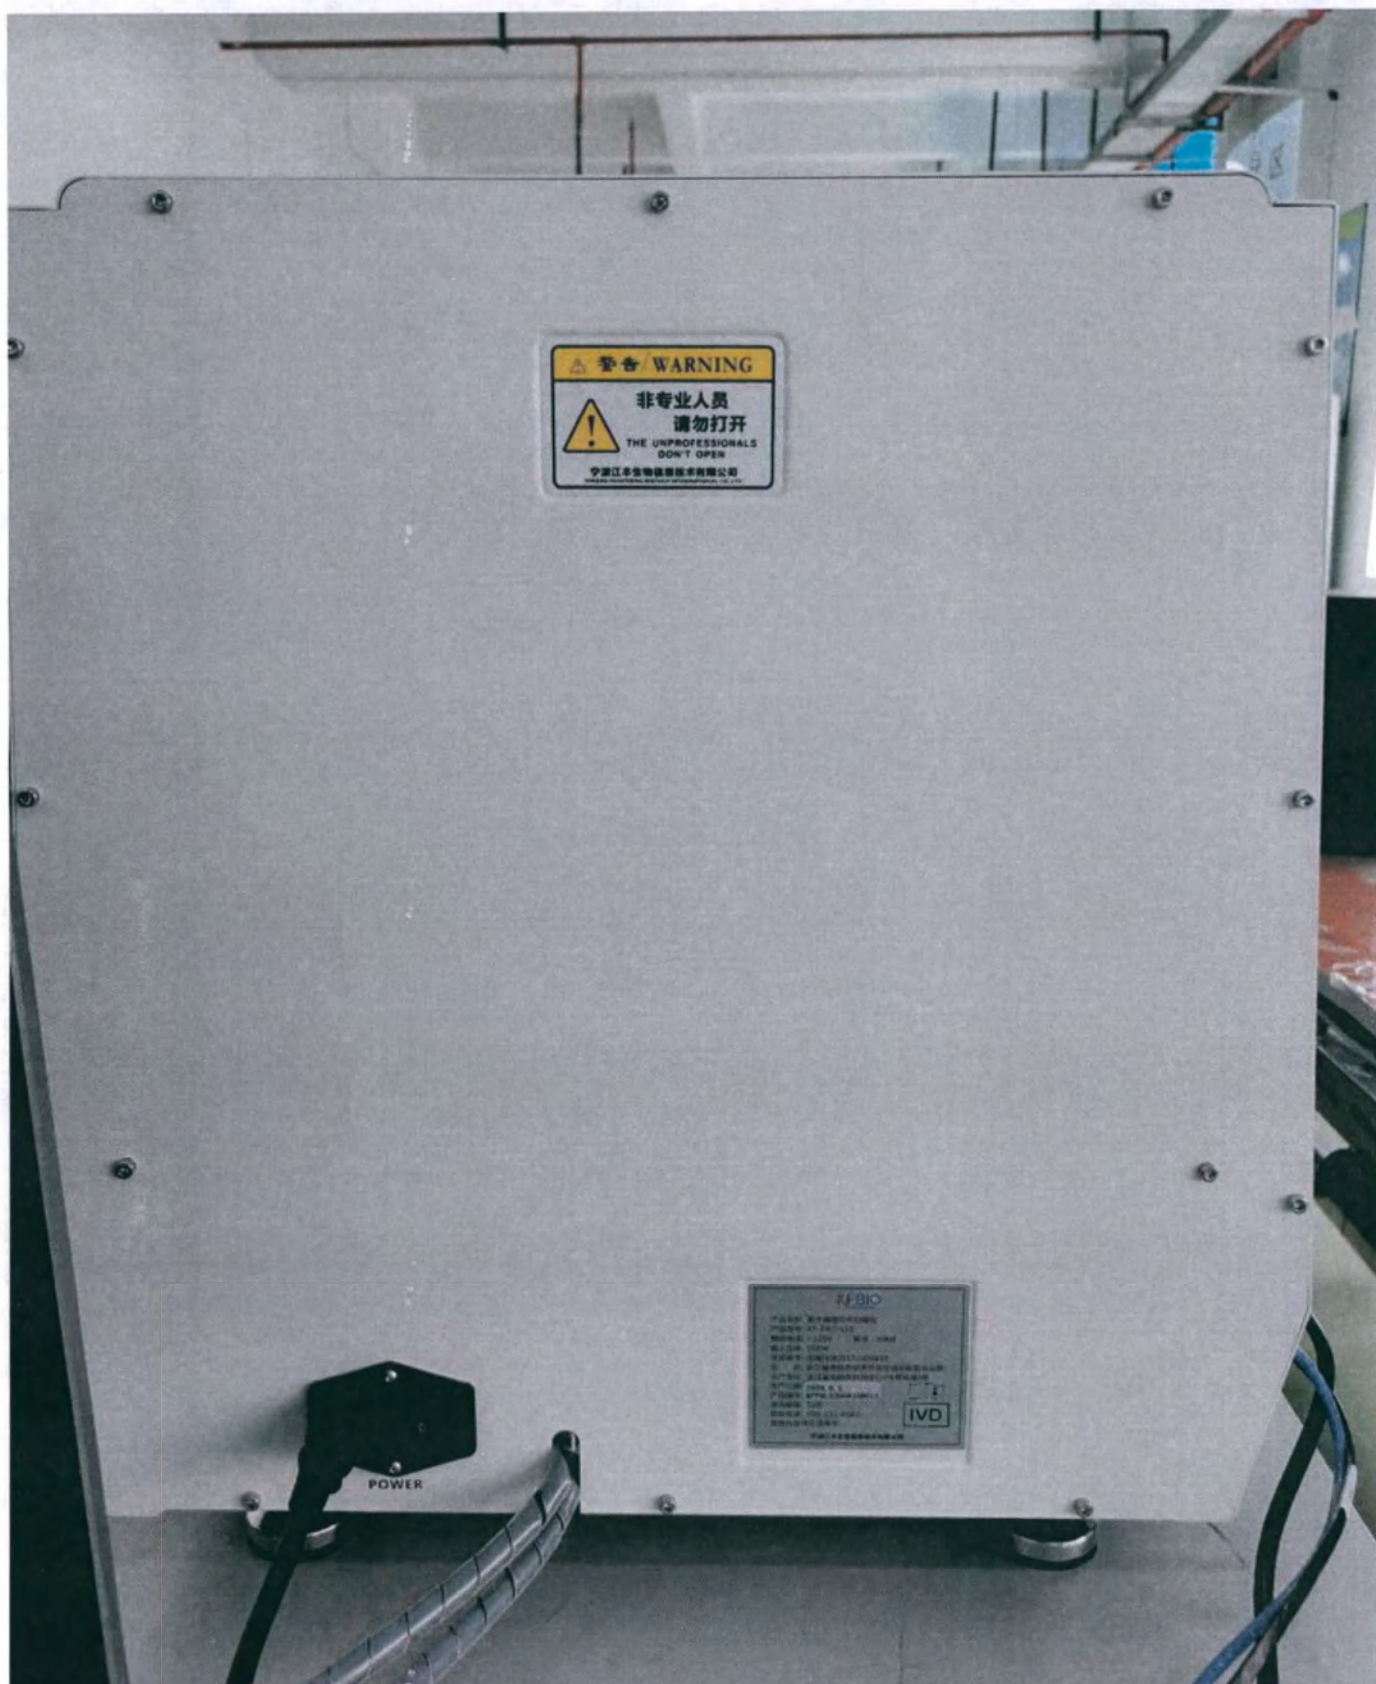

Фотографическое изображение 24 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020, вид сзади




Фотографическое изображение 25 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020, переключатель масштаба




Фотографическое изображение 26 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020-HI, общий вид




Фотографическое изображение 27 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020-HI, вид слева

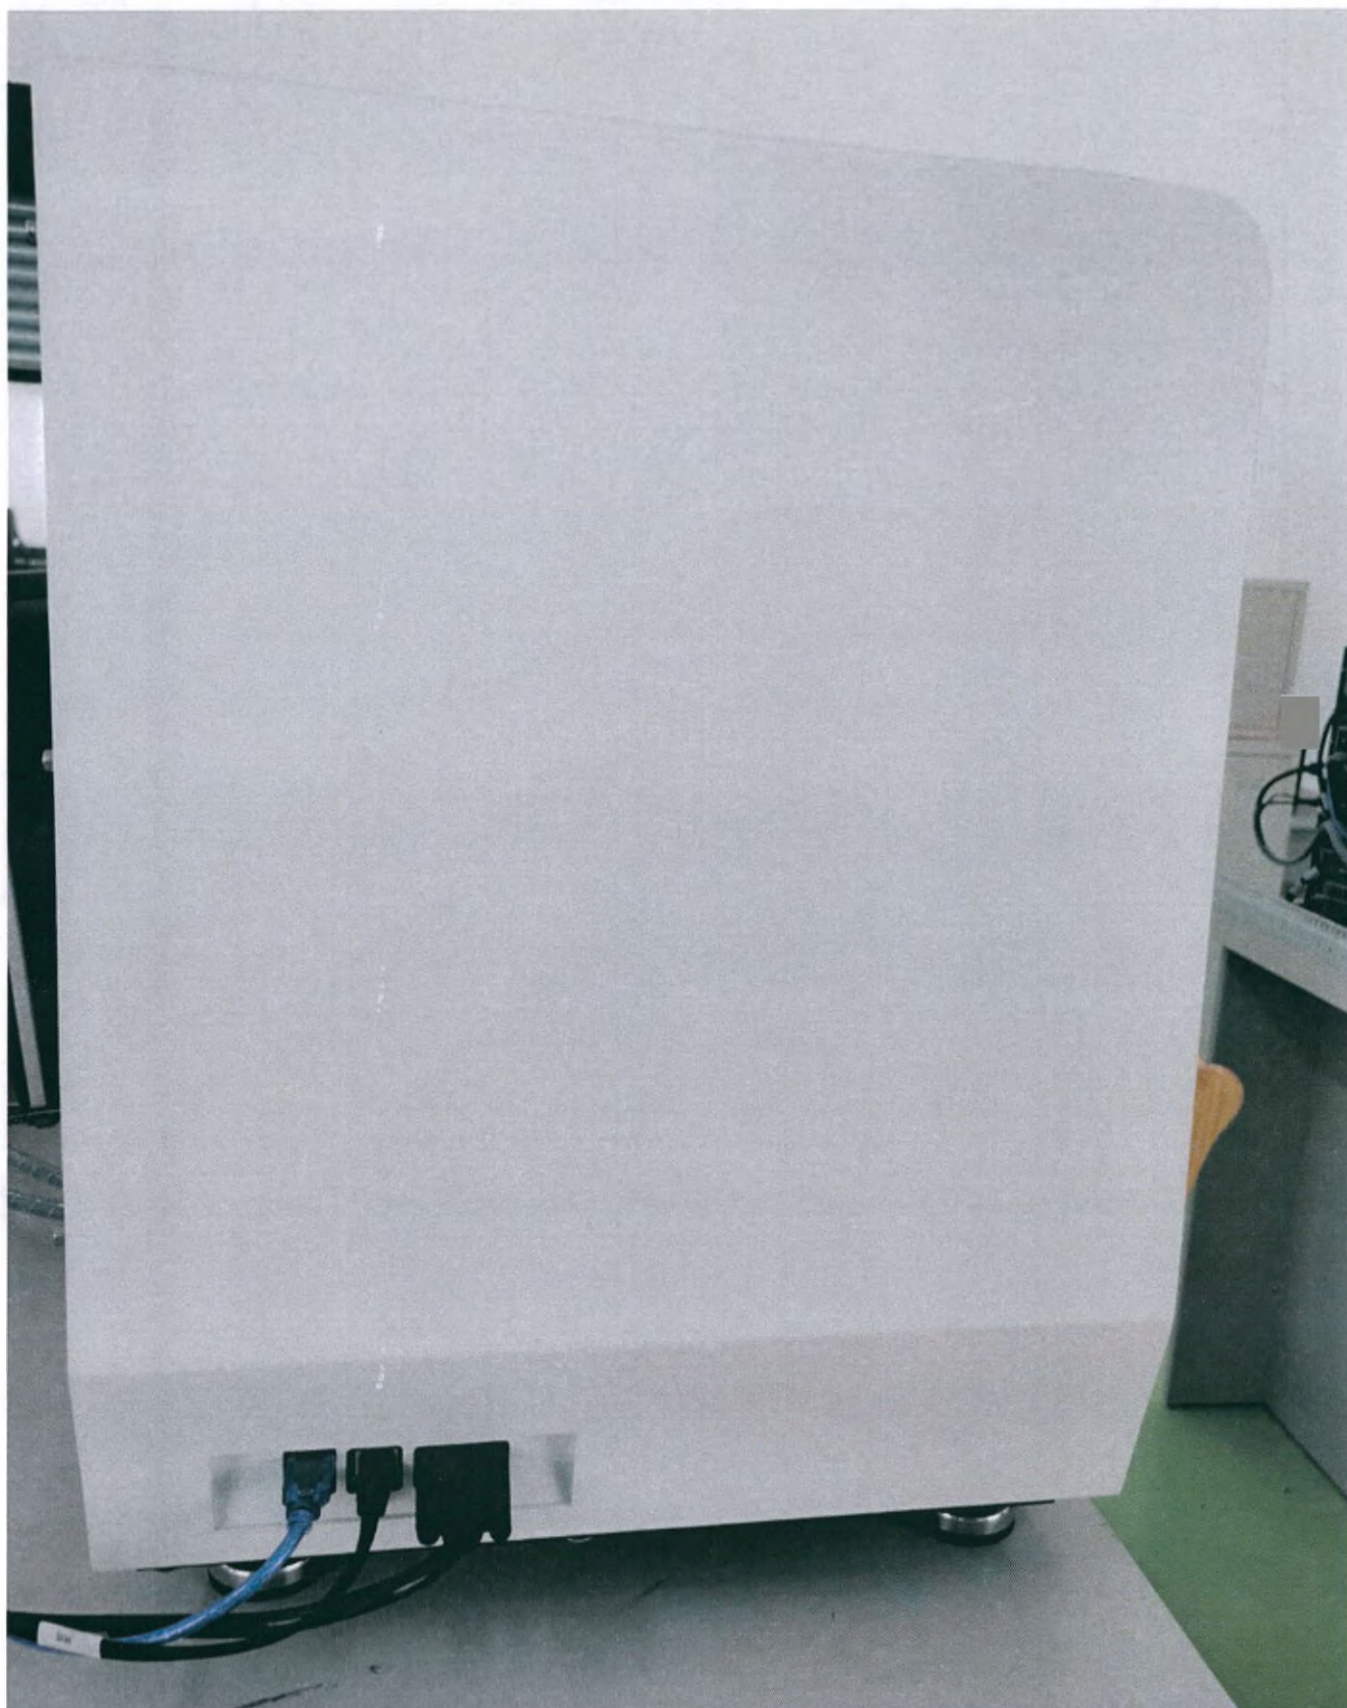

Фотографическое изображение 28 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020-HI, вид справа

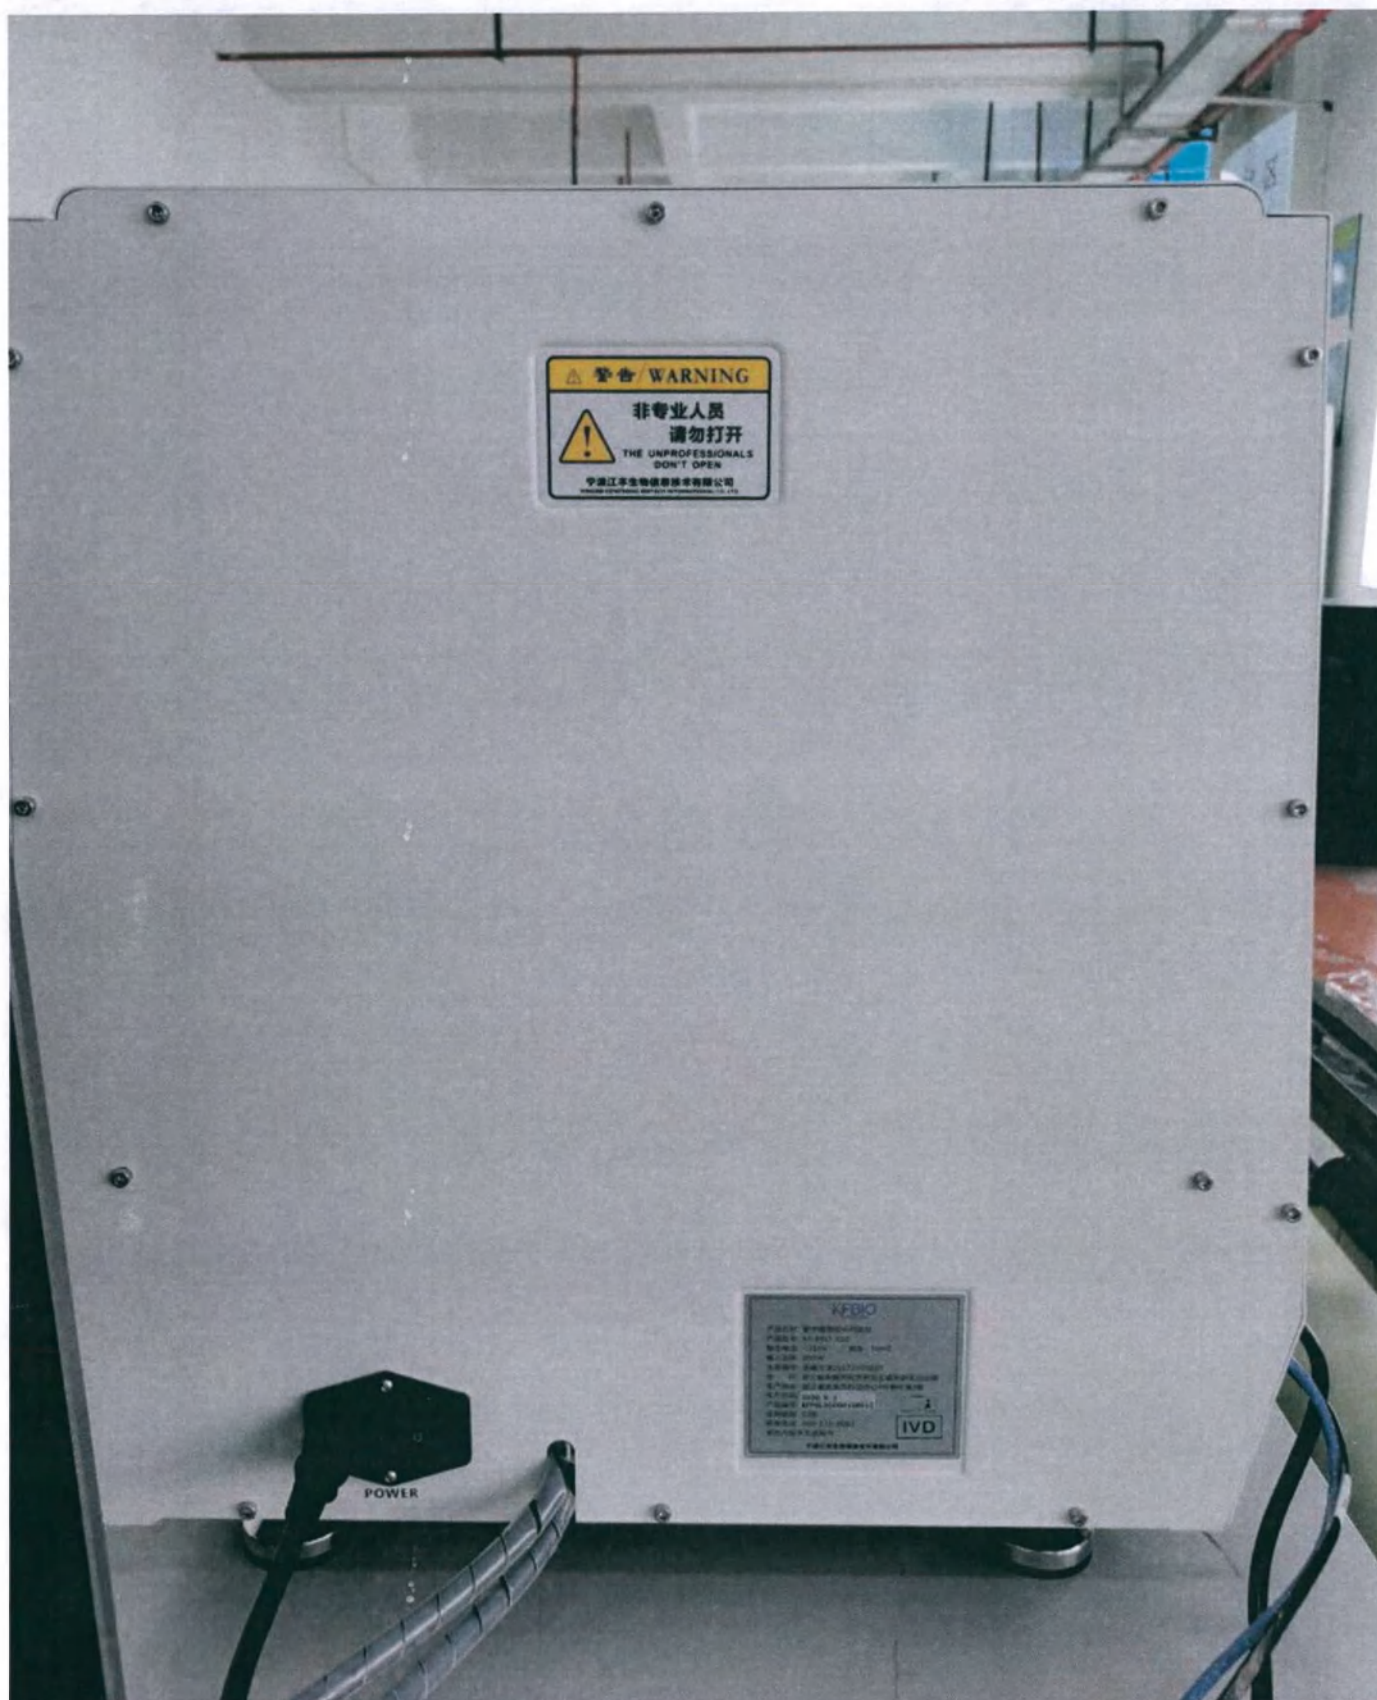

Фотографическое изображение 29 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-020-HI, вид сзади

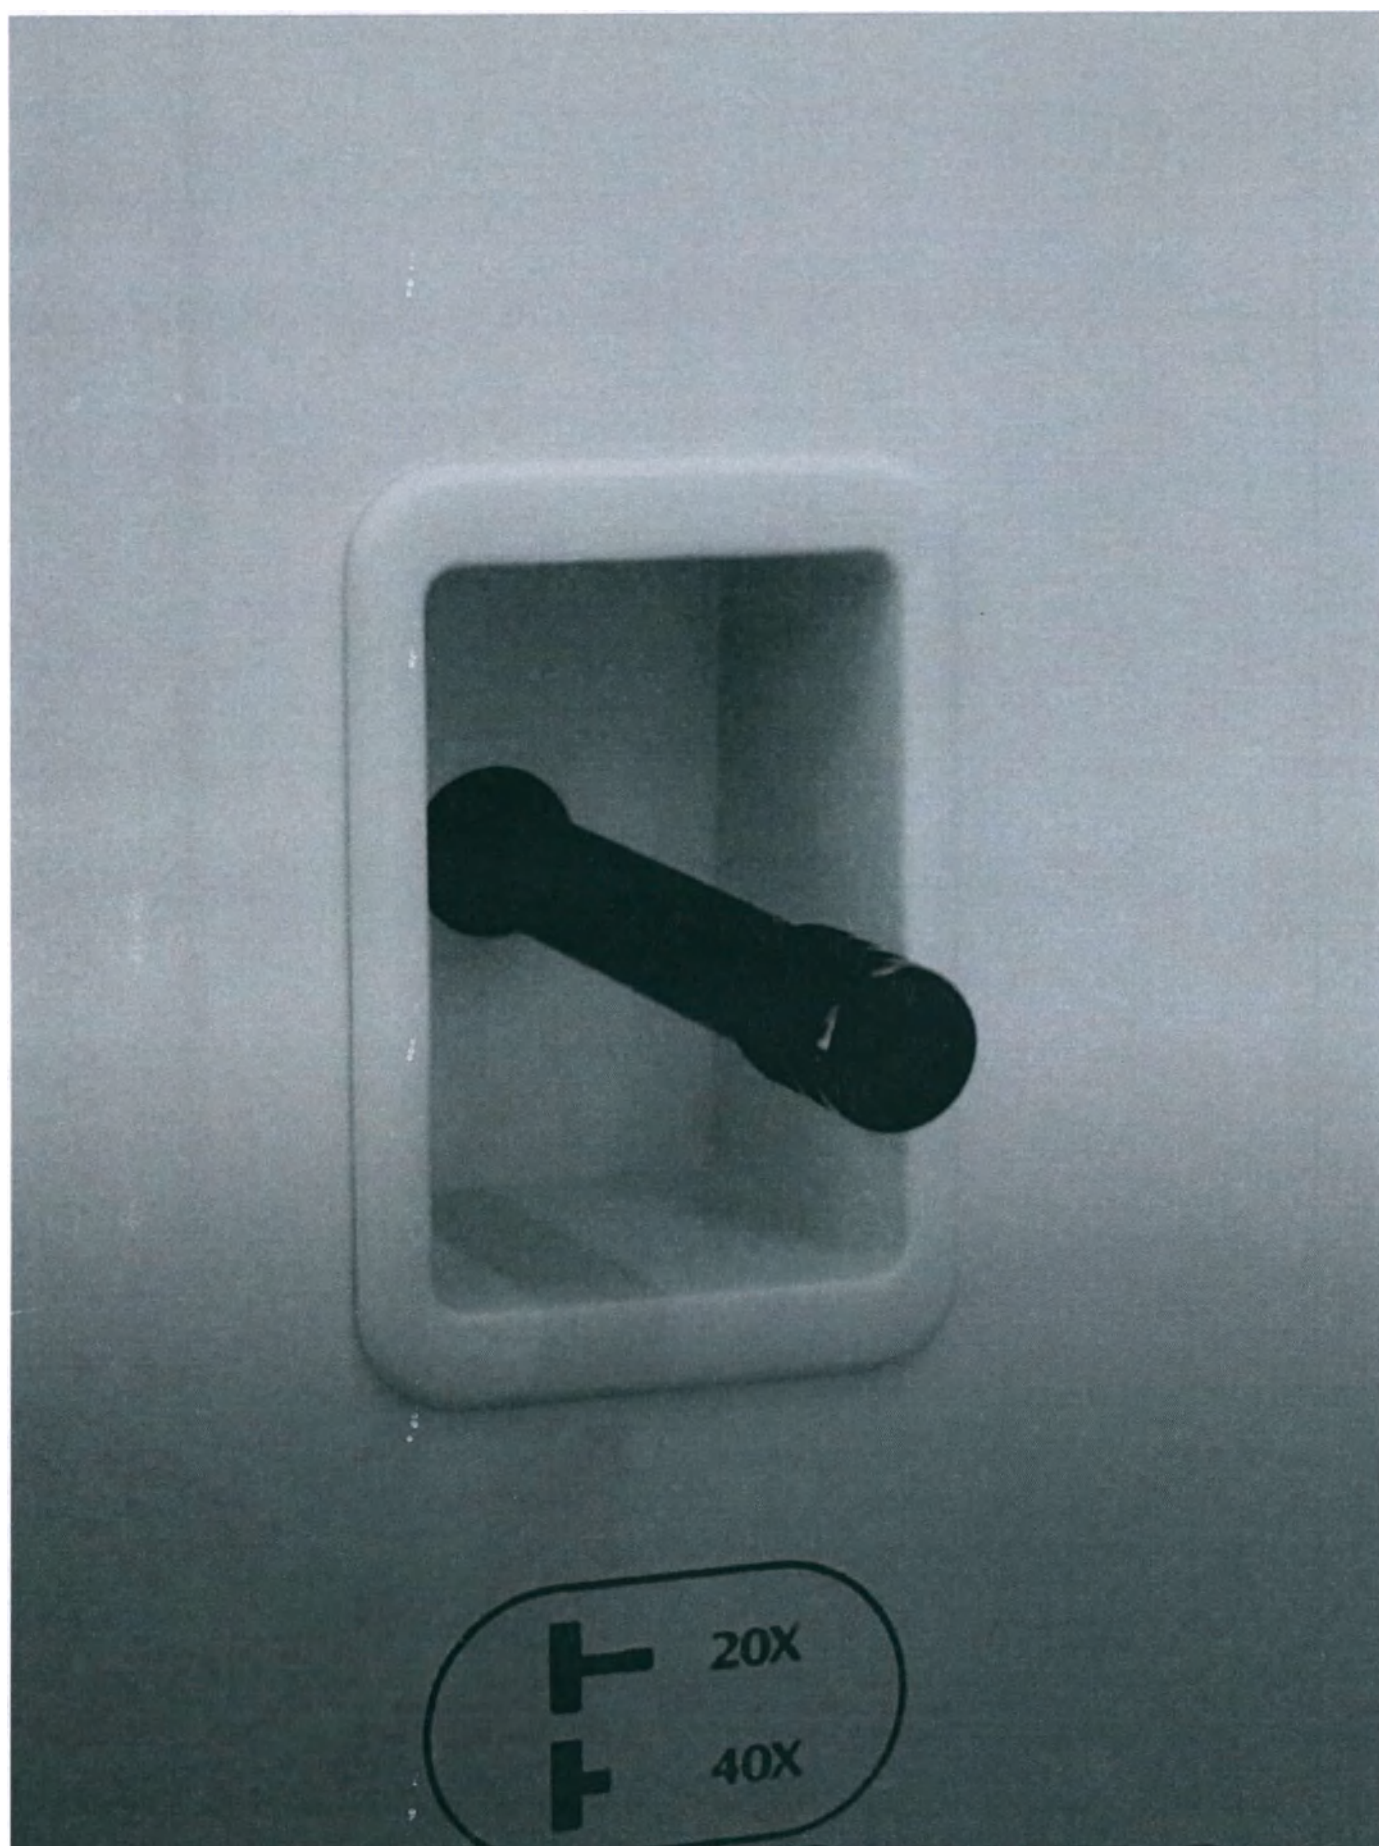


Фотографическое изображение 30 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PR(-)020-III, переключатель масштаба



Фотографическое изображение 31 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040, общий вид




Фотографическое изображение 32 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040, вид слева

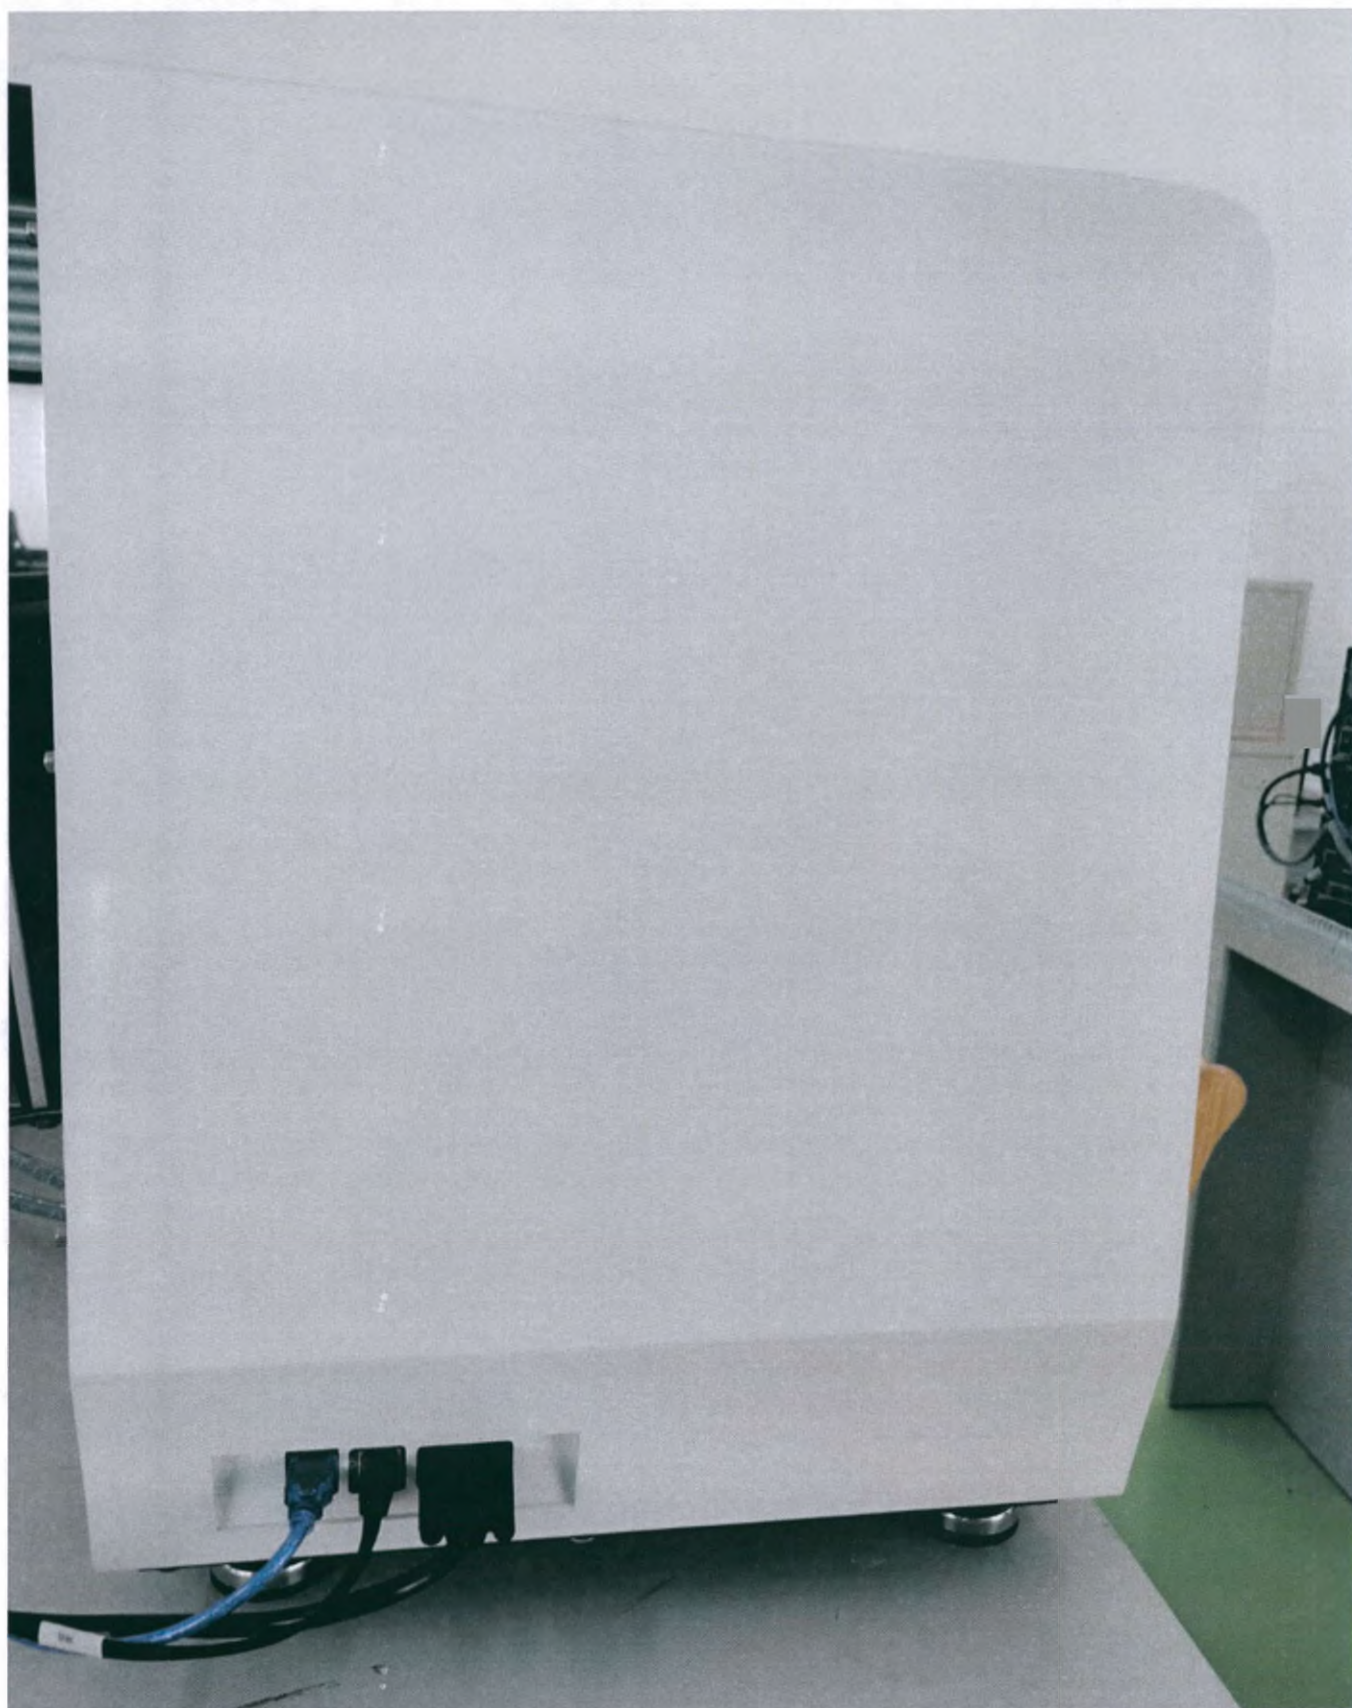

Фотографическое изображение 33 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040, вид справа



Фотографическое изображение 34 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040, вид сзади

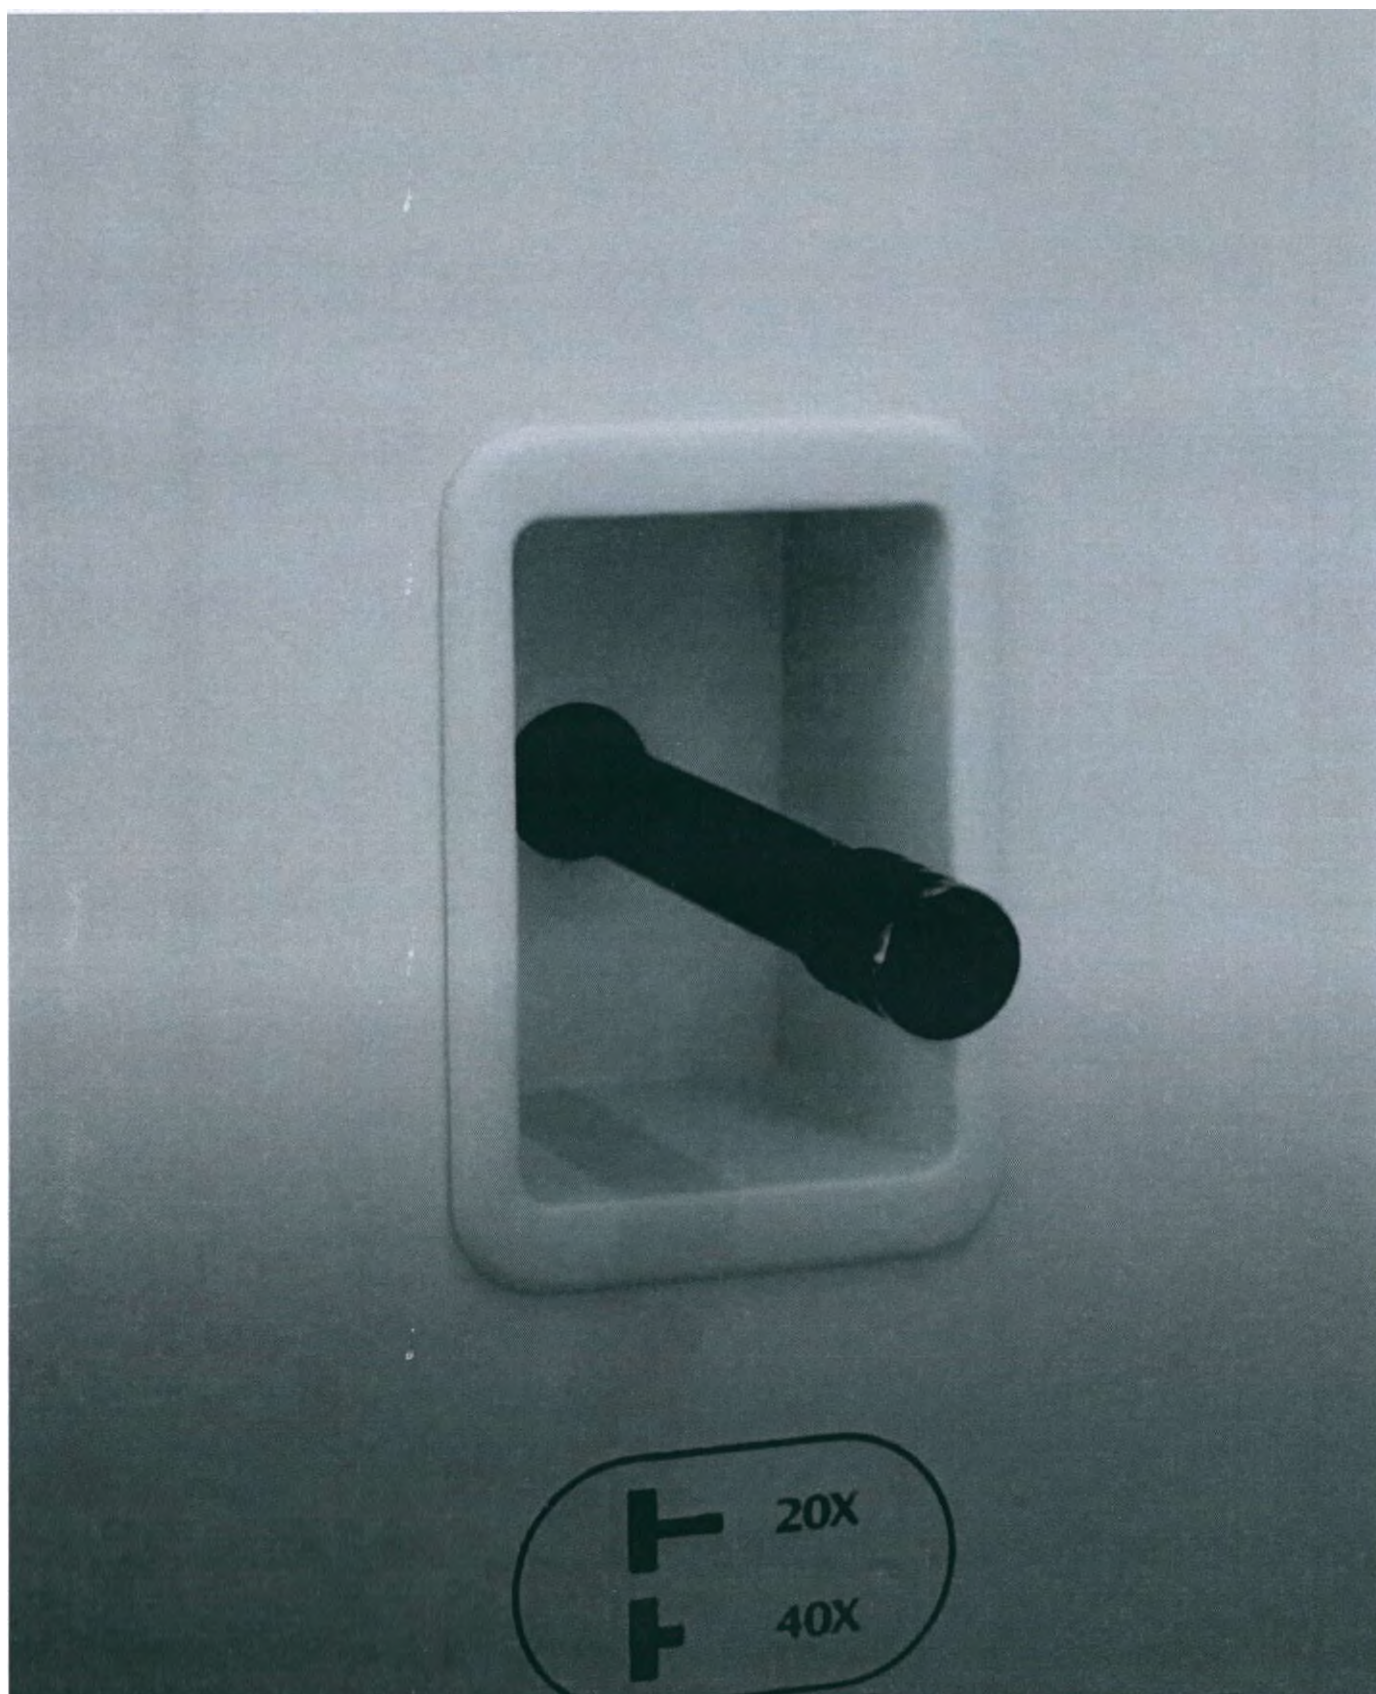


Фотографическое изображение 35 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PR(-)-040, переключатель масштаба




Фотографическое изображение 36 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040-HI, общий вид




Фотографическое изображение 37 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040-HI, вид слева

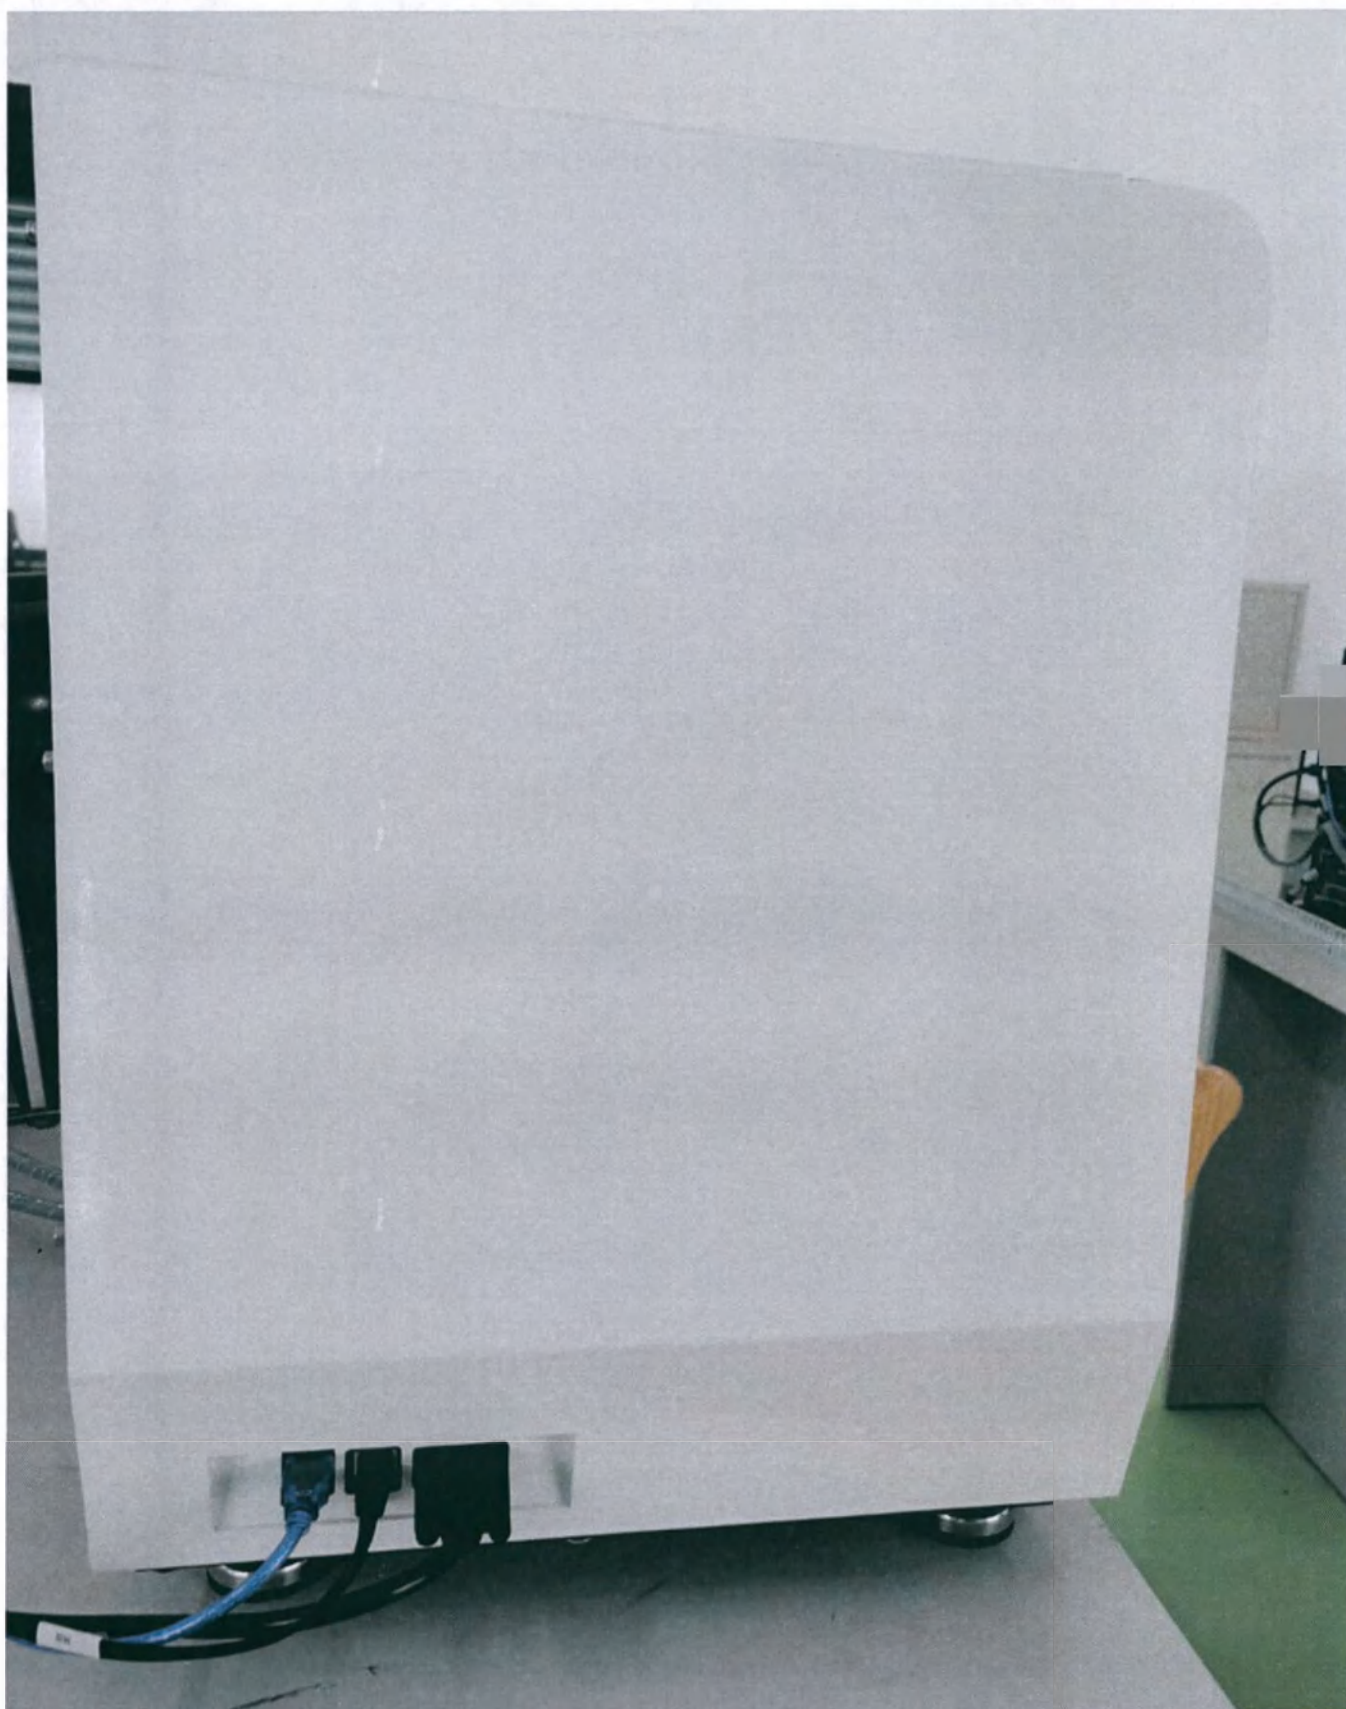

Фотографическое изображение 38 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040-HI, вид справа

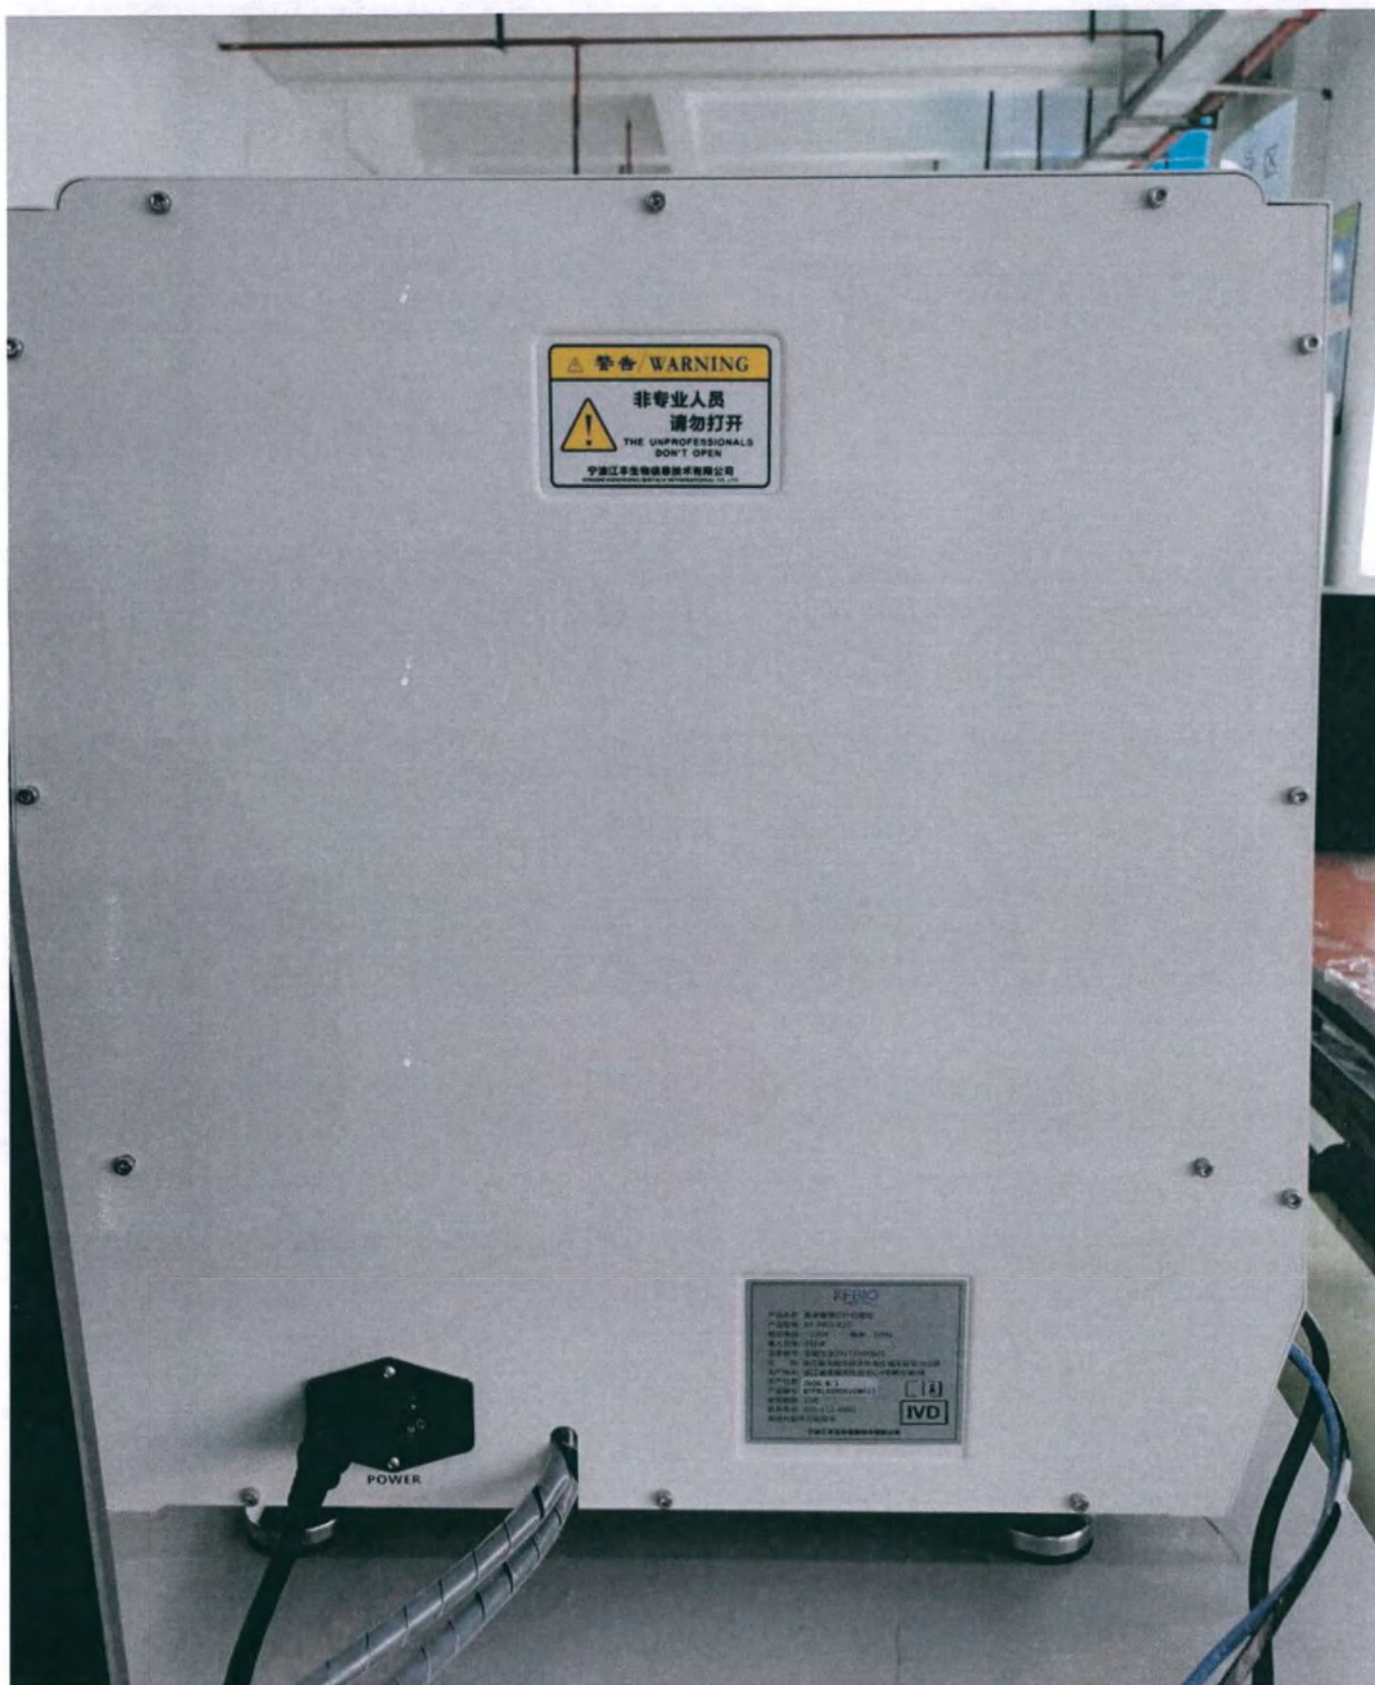

Фотографическое изображение 39 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-040-HI, вид сзади

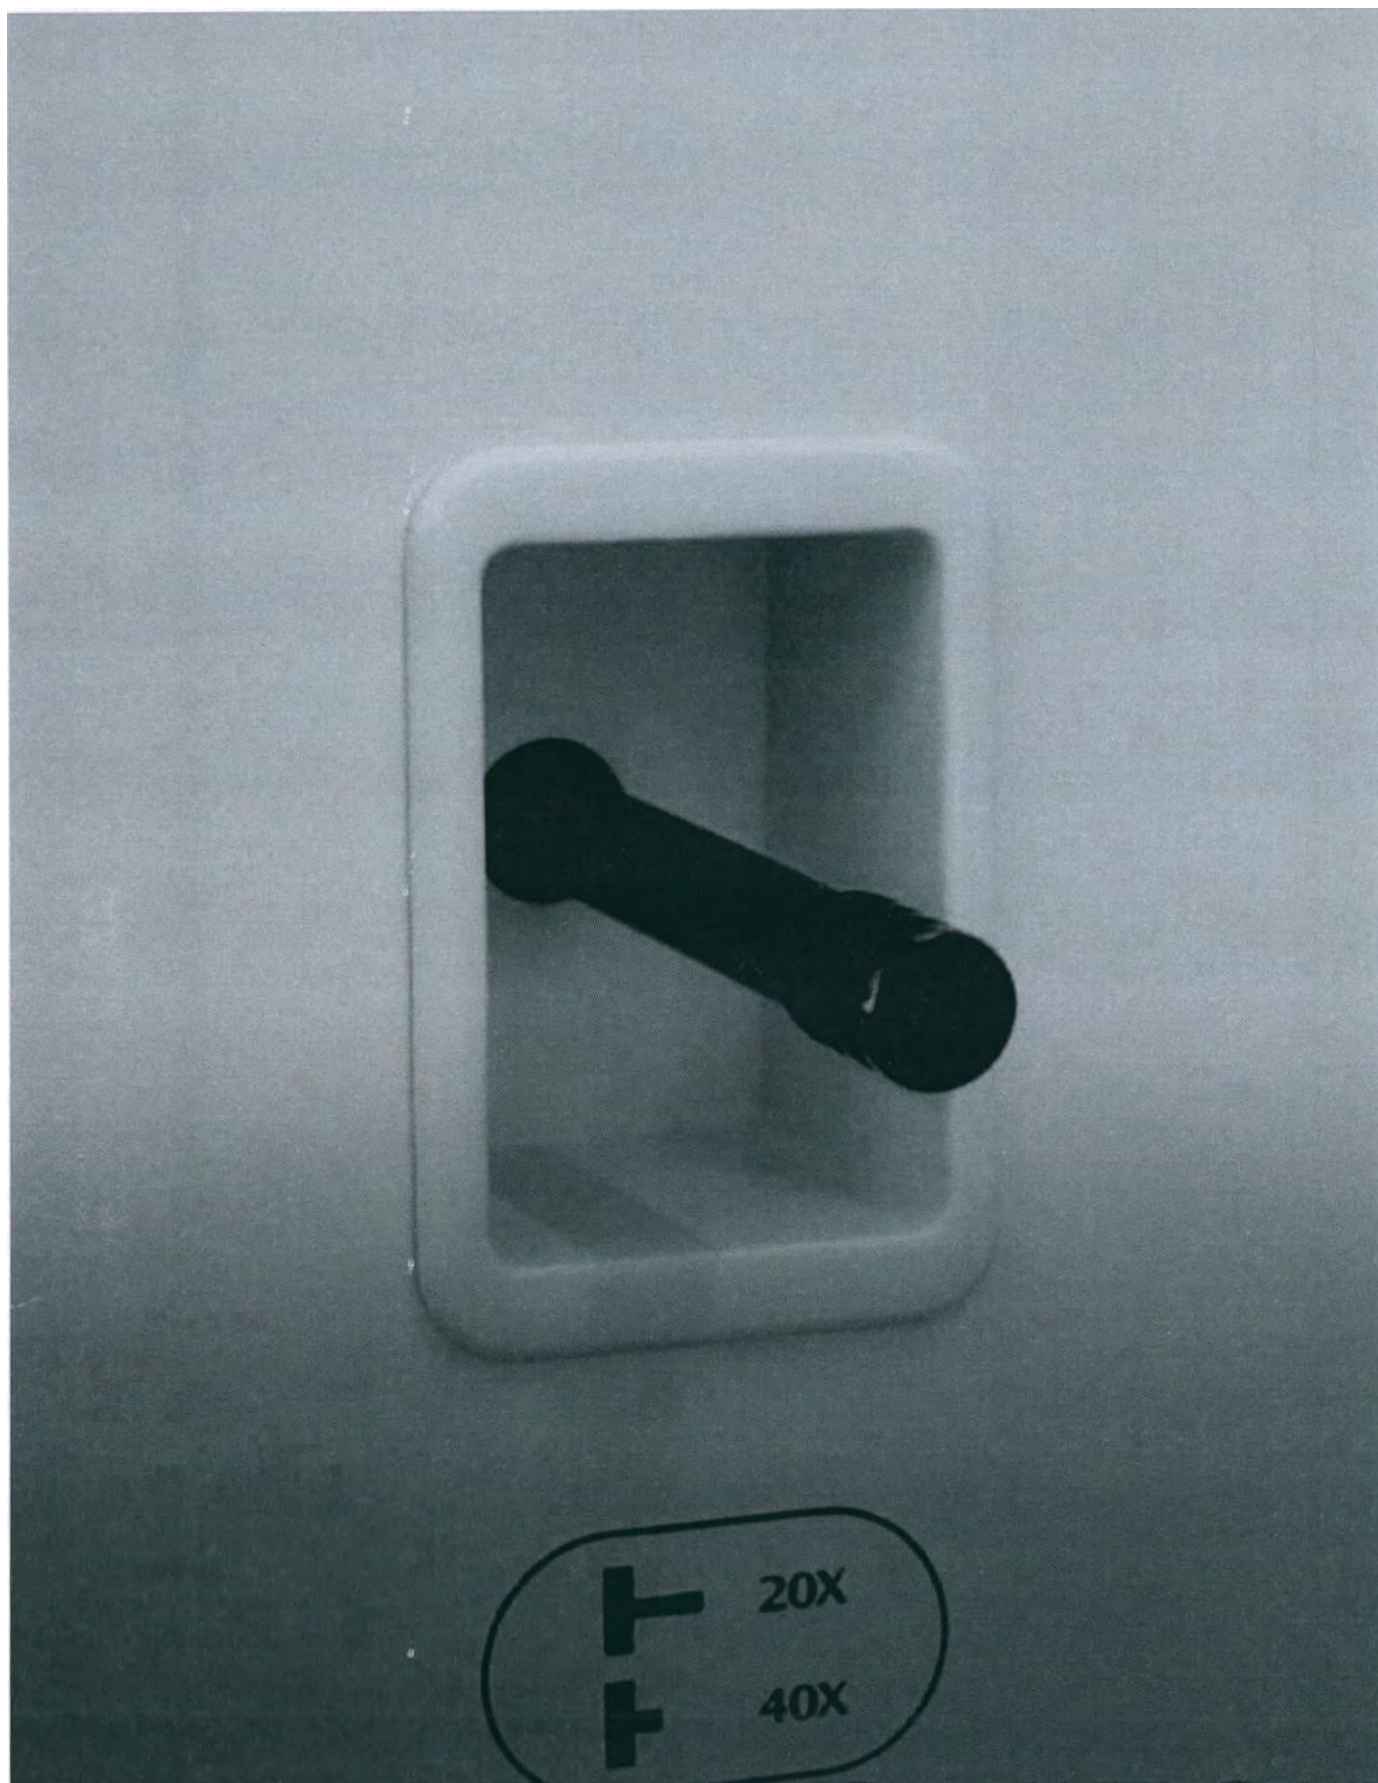

Фотографическое изображение 40 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PR(-)040-III, переключатель масштаба



Фотографическое изображение 41 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-120, общий вид




Фотографическое изображение 42 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-120, вид слева



Фотографическое изображение 43 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-120, вид справа



Фотографическое изображение 44 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов(Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-120, вид сзади

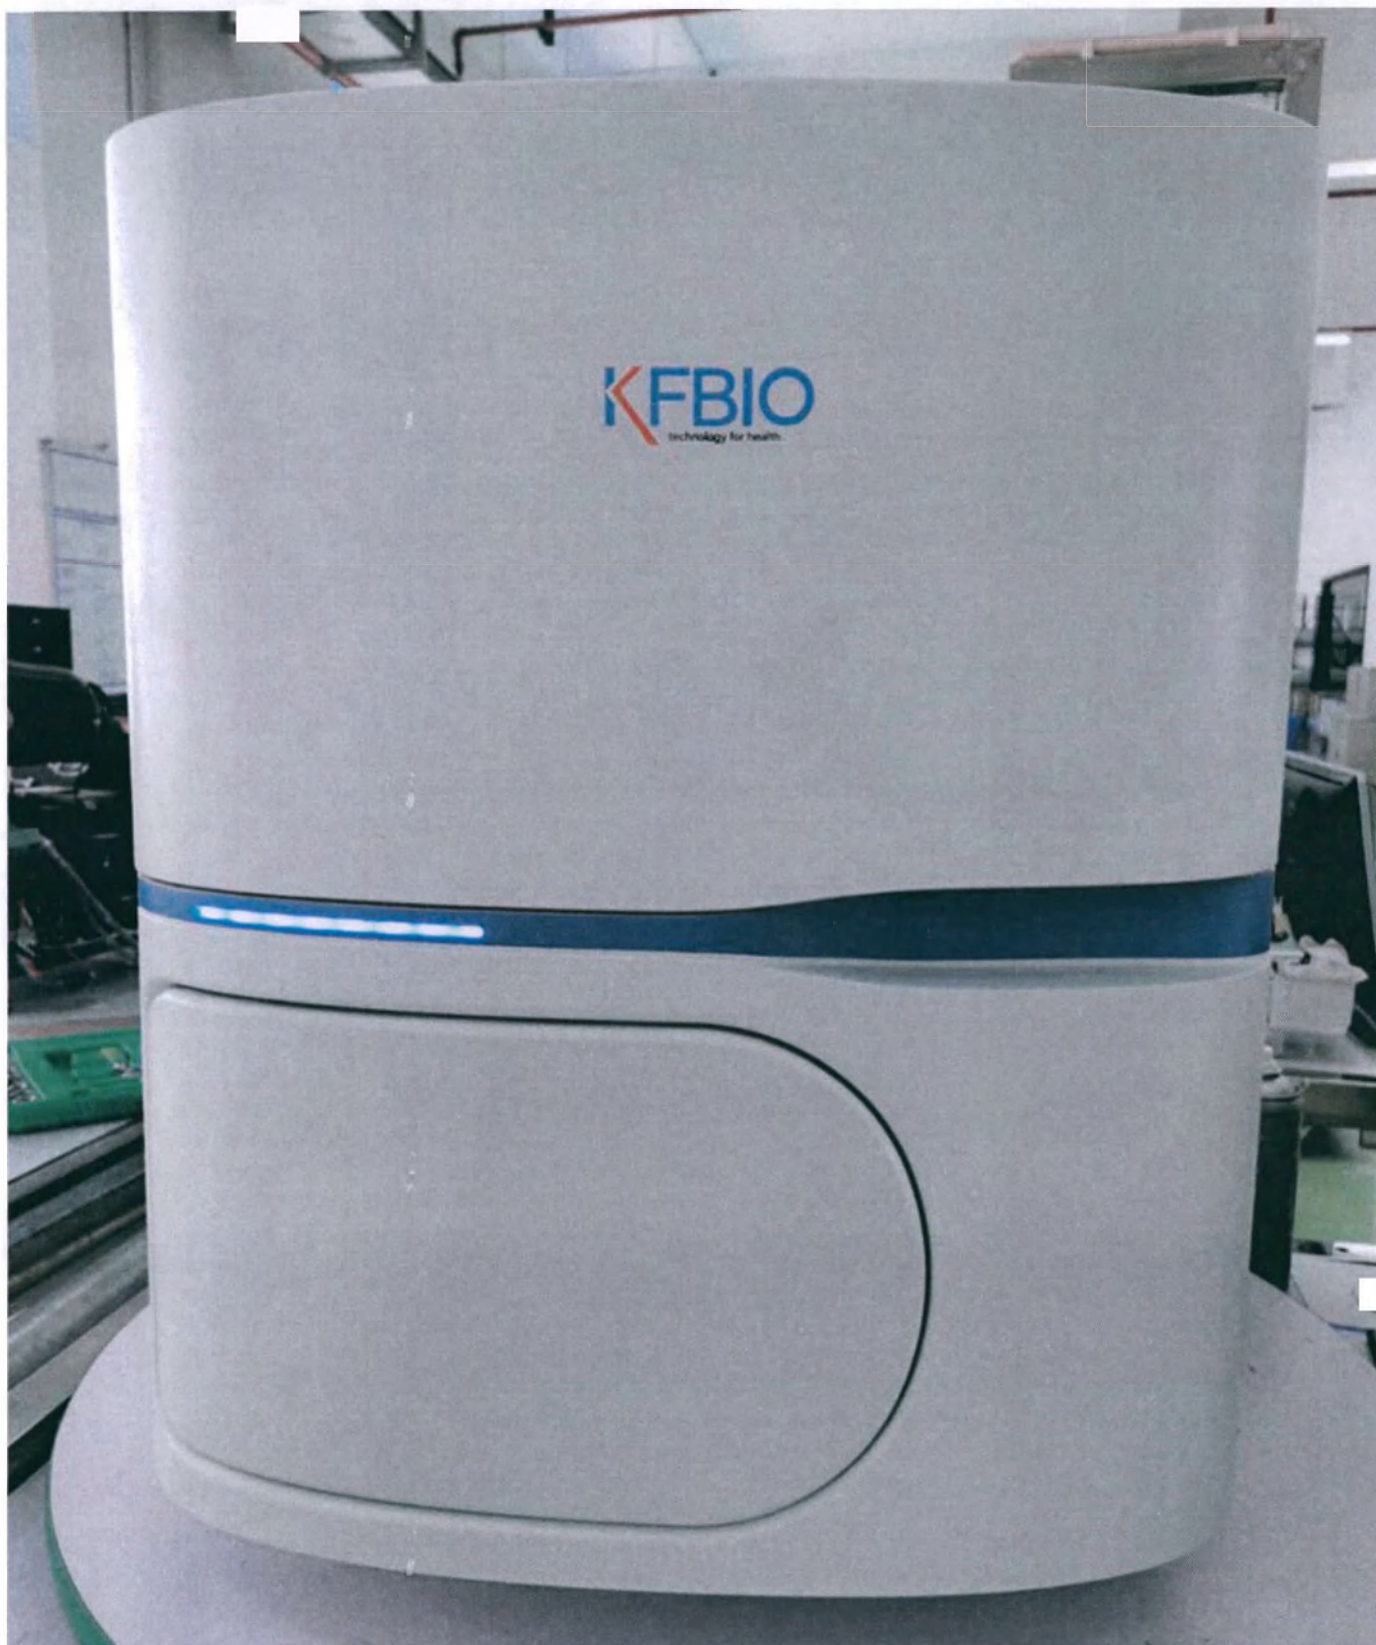


Фотографическое изображение 45 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400, общий вид




Фотографическое изображение 46 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400, вид слева



Фотографическое изображение 47 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400, вид справа

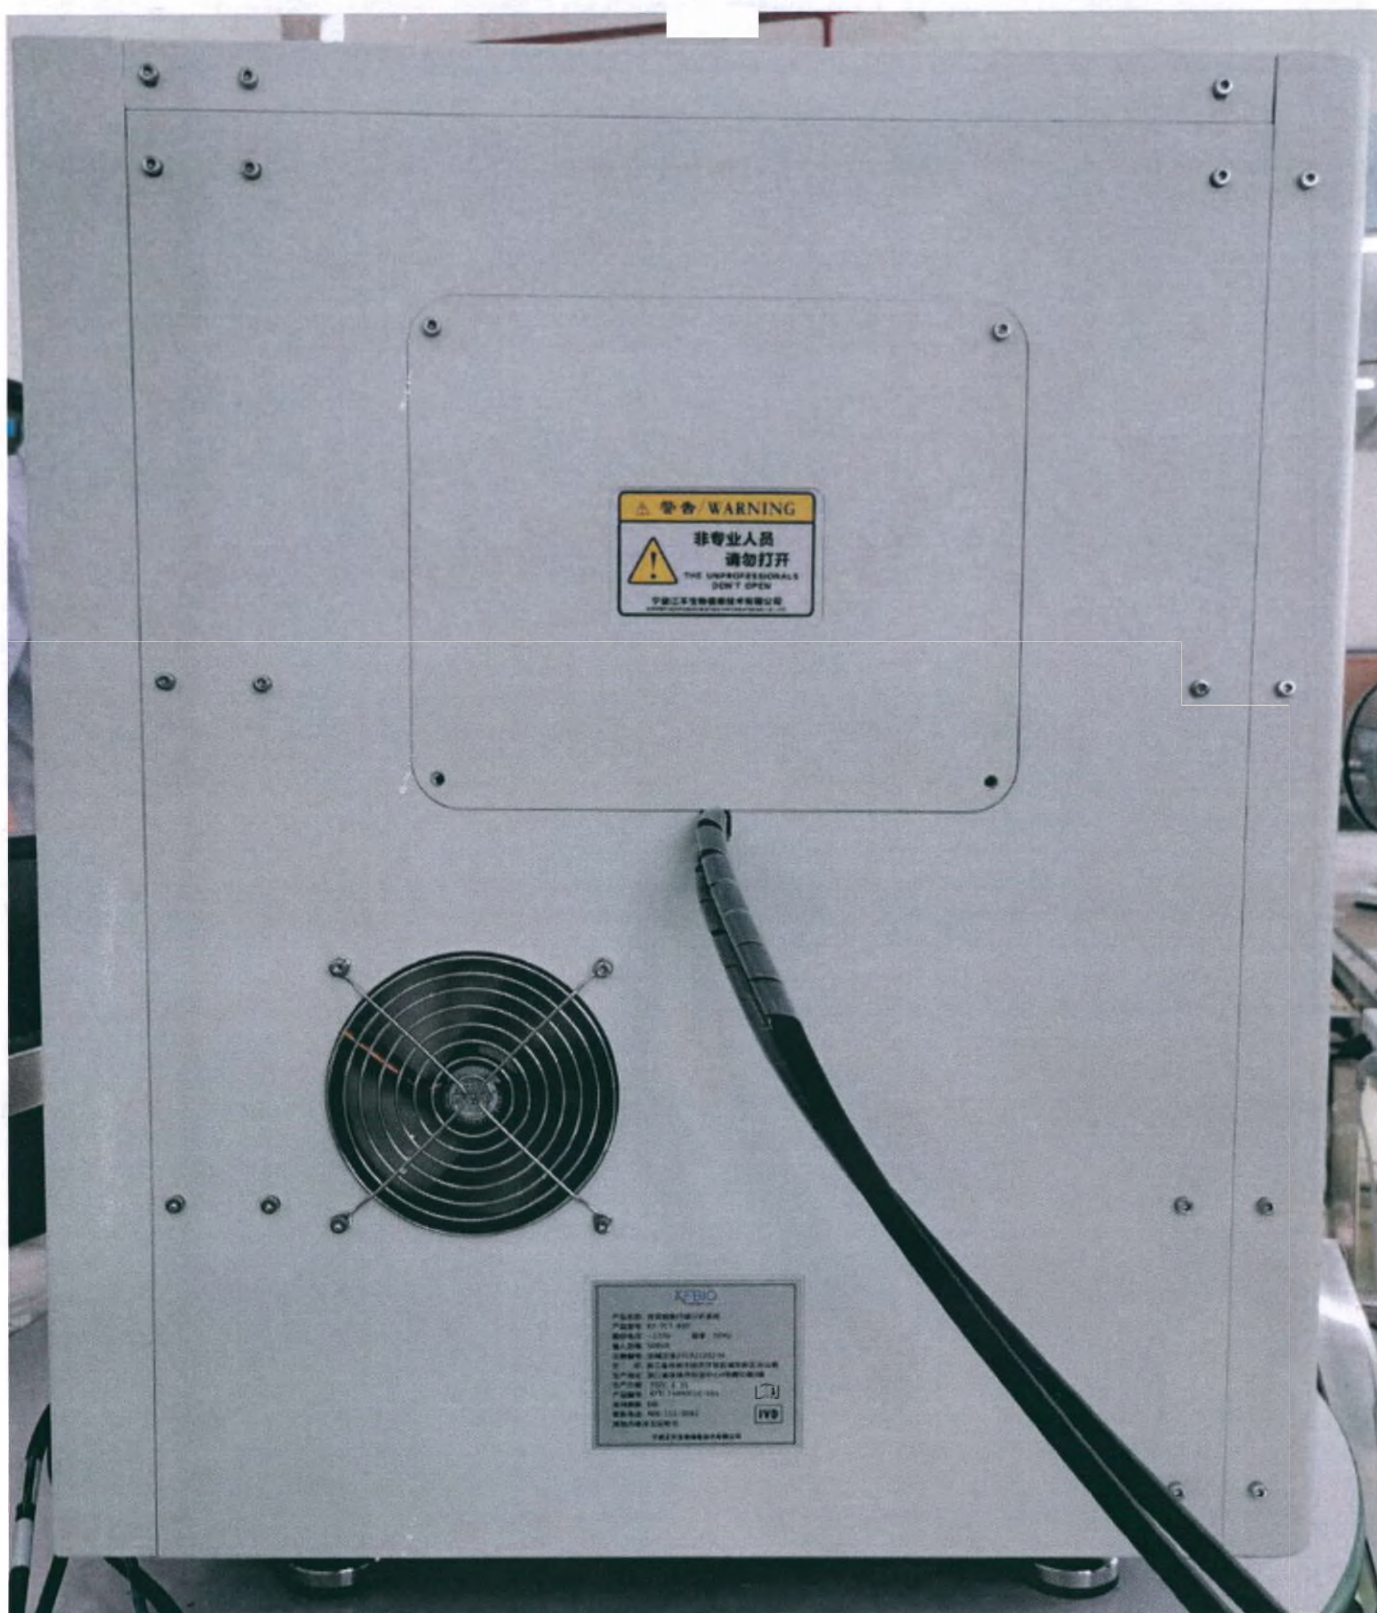

Фотографическое изображение 48 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400, вид сзади

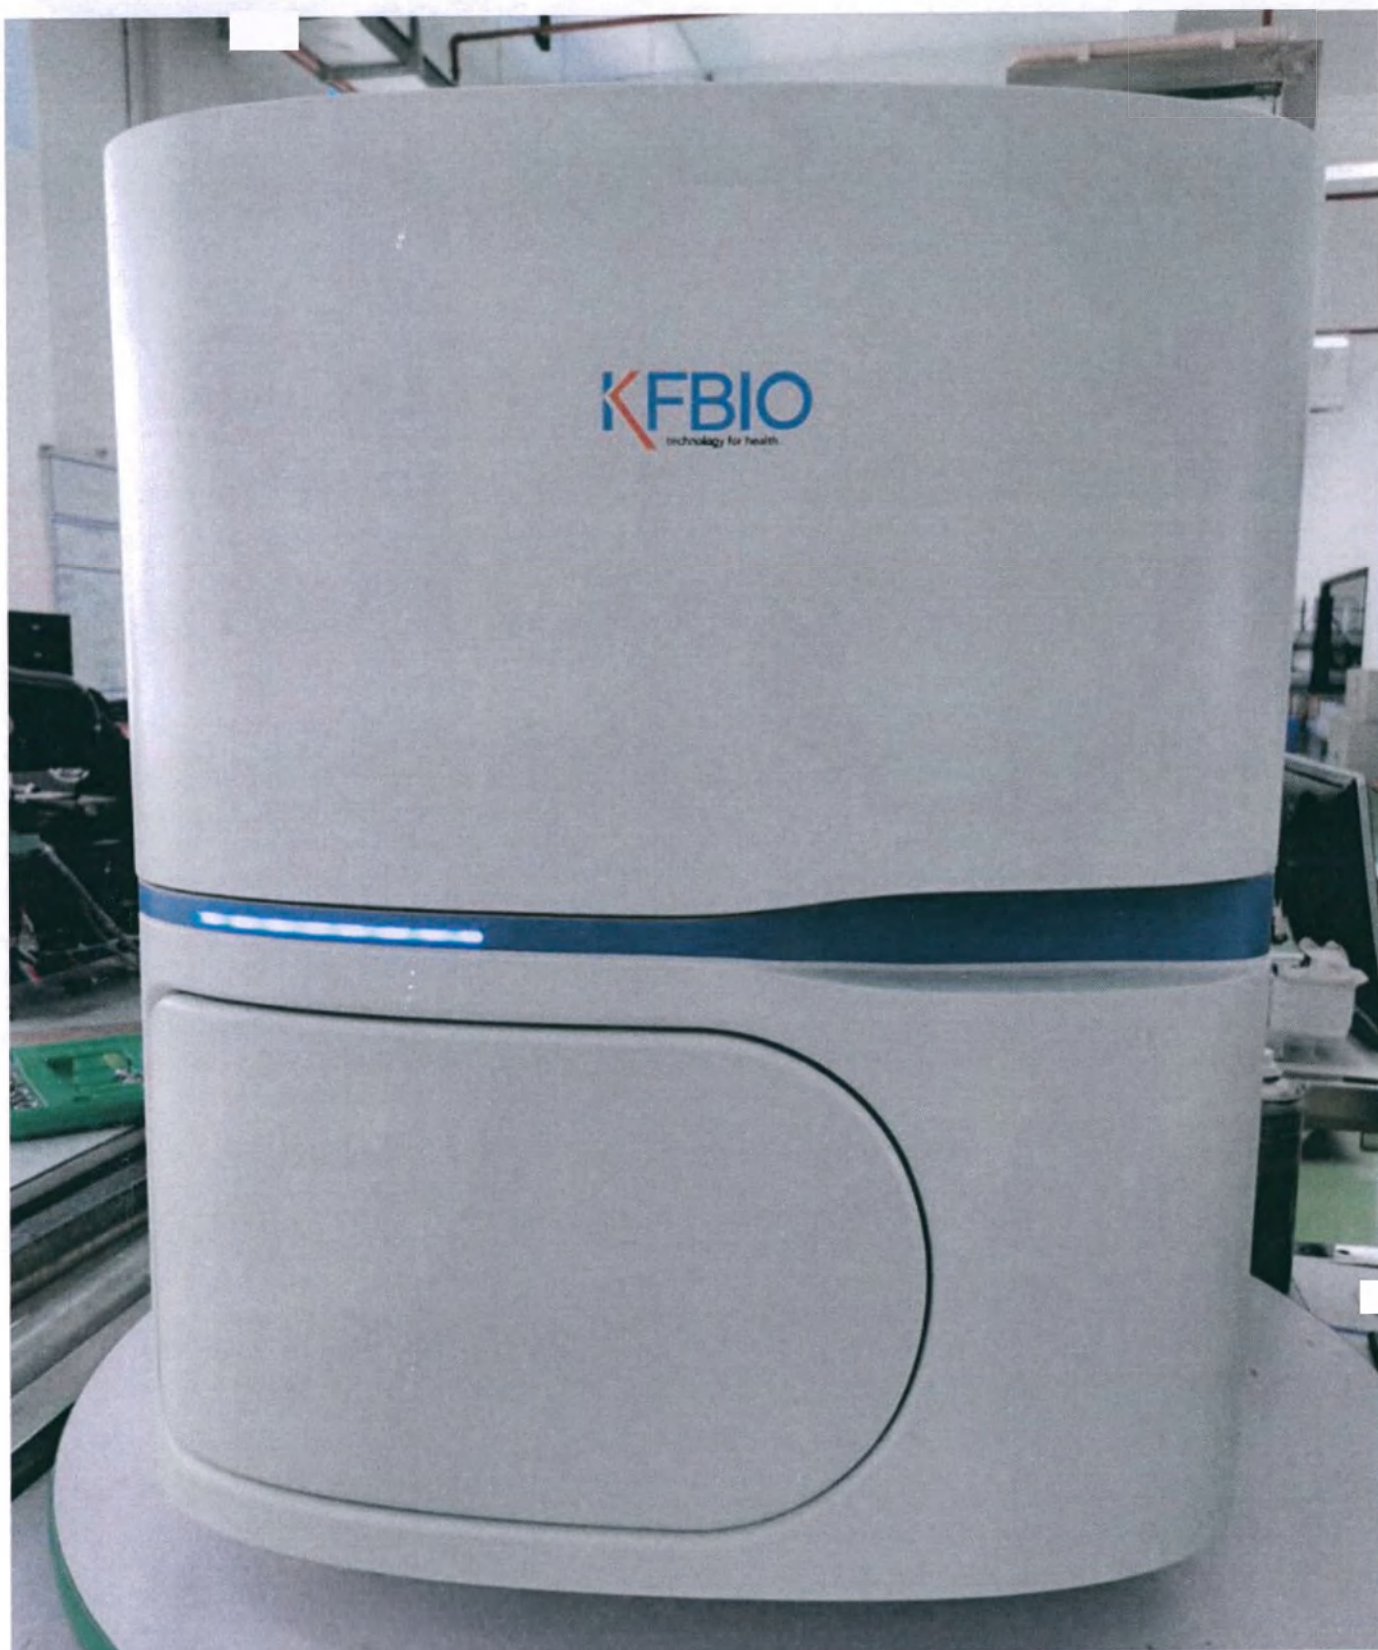


Фотографическое изображение 49 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400-HI, общий вид




Фотографическое изображение 50 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400-HI, вид слева



Фотографическое изображение 51 – Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400-II, вид справа

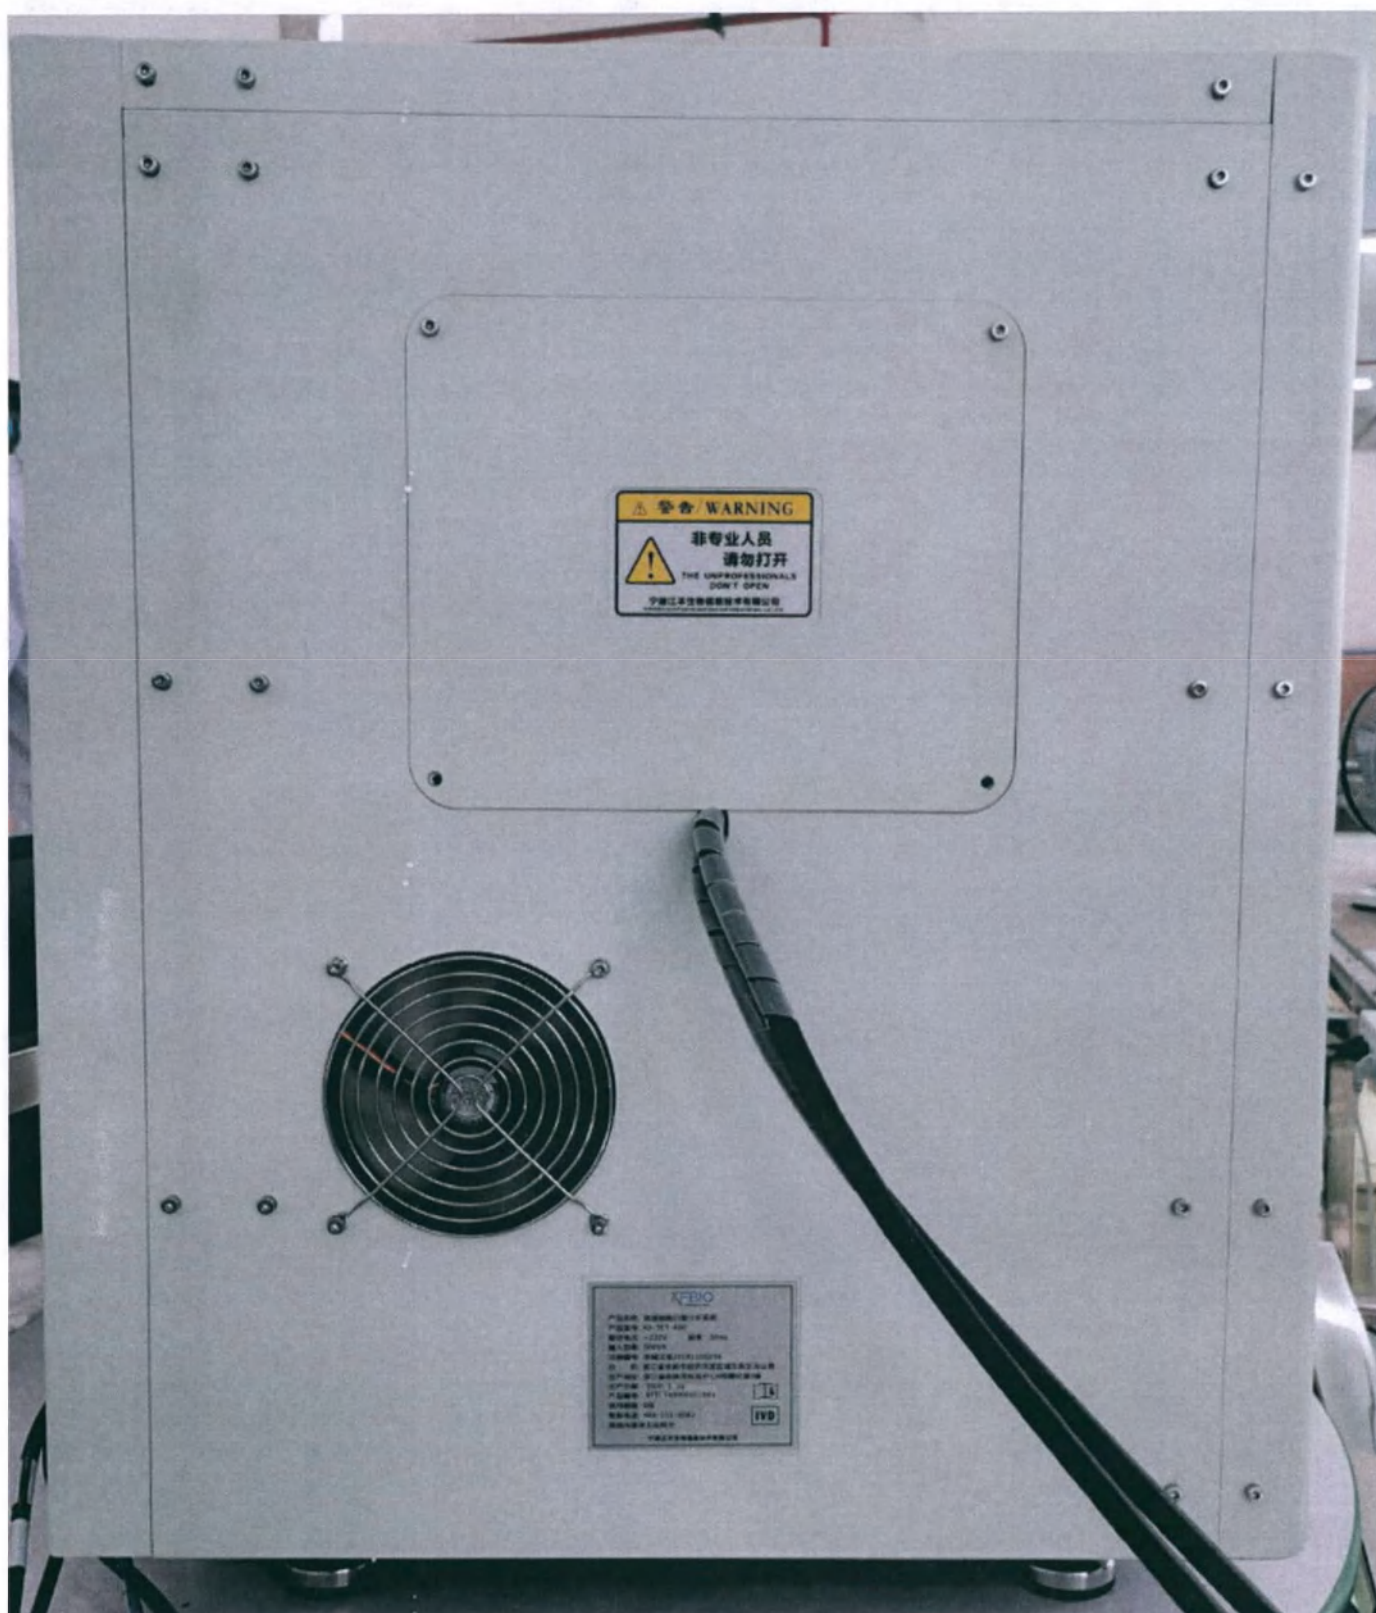

Фотографическое изображение 52 – Сканиер цифровой патологоанатомический микропрепаратов (Digital Pathology Slide Scanner), вариант исполнения KF-PRO-400-HI, вид сзади

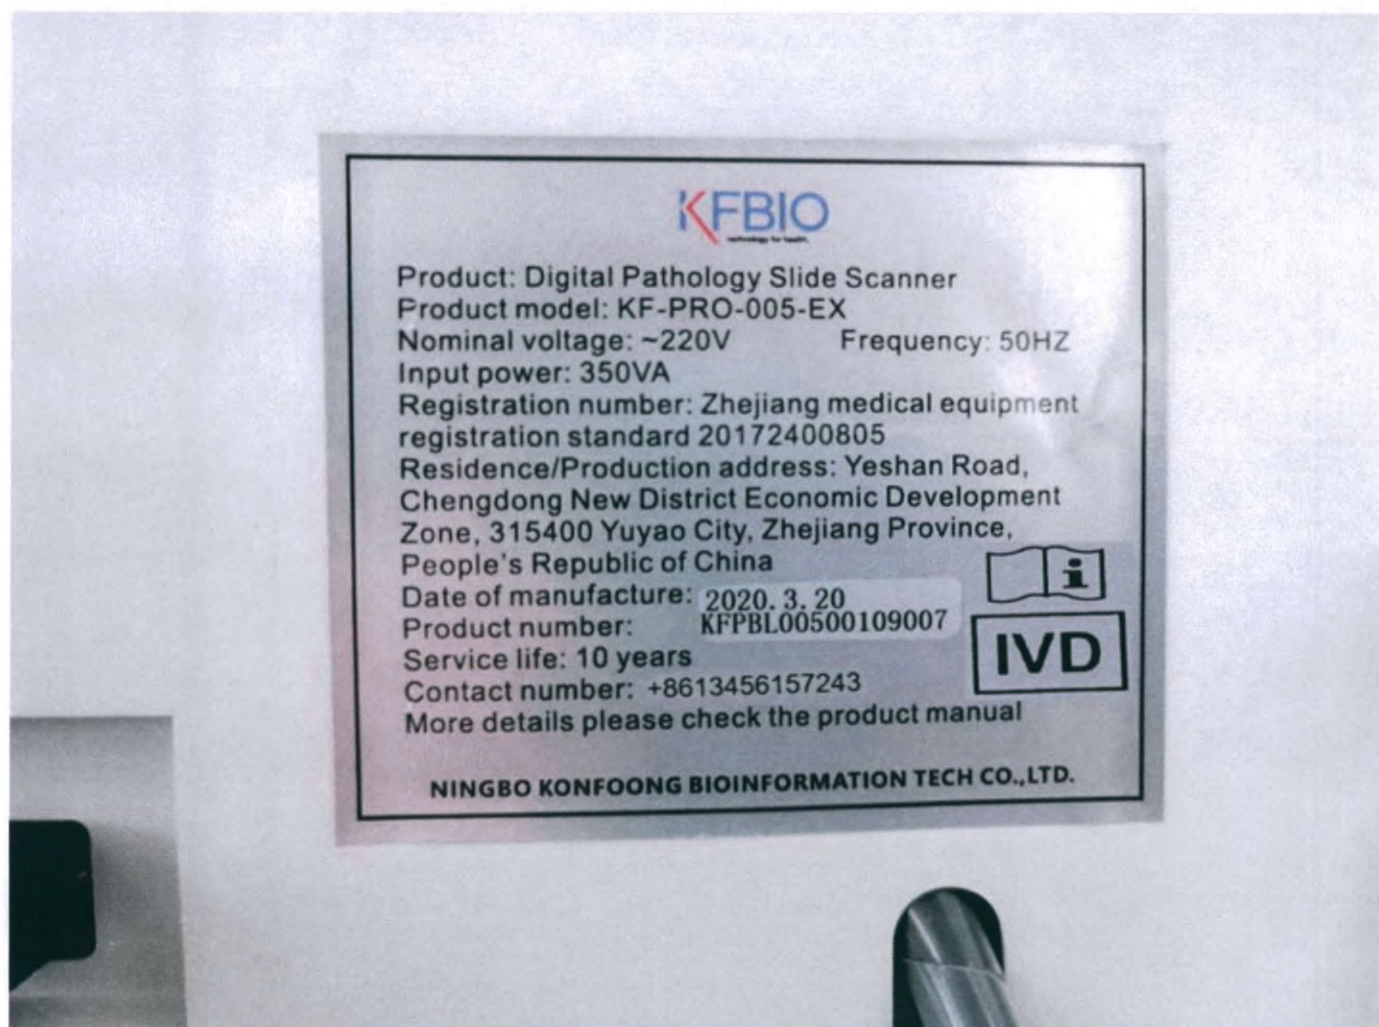

Фотографическое изображение 53 – Маркировка, размещённая на изделии



Product: Digital Pathology Slide Scanner
Product model: KF-PRO-005-EX
Normal voltage: ~ 220 V **Frequency:** 50 HZ
Input power: 350 V·A
Registration Number: Zhejiang medical equipment
 registration standard 20172400805
Residence/Production address: Yeshan Road,
 Chengdong New District Economic Development
 Zone, 315400 Yuyao City, Zhejiang Province,
 Peoples's Republic Of China
Date of manufacture:
Product number:
Service life: 10 years
Contact number: +8613456157243
 More details please check the product manual



NINGBO KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD.

Фотографическое изображение 54 – Этикетка изделия

Product	Изделие
Digital Pathology Slide Scanner	Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов
Product model	Модель изделия
Normal voltage	Нормальное напряжение
Frequency	Частота
Input power	Входная мощность
Registration Number	Регистрационный номер
Zhejiang medical equipment registration standard 20172400805	Чжэцзян Регистрация медицинского оборудования стандарта 20172400805
Residence /Production address	Адрес места нахождения/производства
Yeshan Road, Chengdong New District Economic Development Zone, 315400 Yuyao City, Zhejiang Province, Peoples's Republic Of China	Йешан Роуд, Ченгдонг Нью Дистрикт Экономическая зона развития 315400 город Юяо, провинция Шейчжен, Китайская Народная Республика
Date of manufacture:	Дата производства
Product number:	Номер изделия
Service life	Срок службы
Contact number	Контактный номер
More details please check the product manual	Для подробностей обратитесь к руководству по эксплуатации
NINGBO KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD.	НИНГБО КОНФУНГ БИОИНФОРМЭЙШН ТЕХ КО., ЛТД.



Изделие: Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов

Модель изделия: KF-PRO-005-EX

Нормальное напряжение: ~ 220 В Частота: 50 Гц

Входная мощность: 350 В·А

Регистрационное удостоверение: № АБВ 0000/0000

Адрес места нахождения/производства: Ул. Ешань, Новый район
Чэндун, зона экономического и технологического развития, город Юйяо,
провинция Чжэцзян, Китайская Народная Республика

Уполномоченный представитель в РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «ФНК Медицина»
(ООО « ФНК Медицина»)

Москва, ул. Бутлерова, дом 17Б, эт. 2, пом. XI, комн.
47-49

Дата производства:

Номер изделия:

Срок службы:

Контактный номер:

10 лет

+8613456157243



Фотографическое изображение 55 – Этикетка изделия для потребителей РФ



Фотографическое изображение 56 – Транспортная упаковка изделия



Product: Digital Pathology Slide Scanner
Product model: KF-PRO-005-EX
Normal voltage: ~ 220 V **Frequency:** 50 HZ
Input power: 350 V·A
Registration Number: Zhejiang medical equipment
 registration standard 20172400805
Residence/Production address: Yeshan Road,
 Chengdong New District Economic Development
 Zone, 315400 Yuyao City, Zhejiang Province,
 Peoples's Republic Of China
Date of manufacture:
Product number:
Service life: 10 years
Contact number: +8613456157243
More details please check the product manual



NINGBO KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD.

Фотографическое изображение 57 – Маркировка транспортной упаковки изделия

Product	Изделие
Digital Pathology Slide Scanner	Сканер цифровой патологоанатомический микропрепаратов
Product model	Модель изделия
Normal voltage	Нормальное напряжение
Frequency	Частота
Input power	Входная мощность
Registration Number	Регистрационный номер
Zhejiang medical equipment registration standard 20172400805	Чжэцзян Регистрация медицинского оборудования стандарта 20172400805
Residence /Production address	Адрес места нахождения/производства
Yeshan Road, Chengdong New District Economic Development Zone, 315400 Yuyao City, Zhejiang Province, Peoples's Republic Of China	Йешан Роуд, Ченгдонг Нью Дистрикт Экономическая зона развития 315400 город Юяо, провинция Шейчжен, Китайская Народная Республика
Date of manufacture:	Дата производства
Product number:	Номер изделия
Service life	Срок службы
Contact number	Контактный номер
More details please check the product manual	Для подробностей обратитесь к руководству по эксплуатации
NINGBO KONFOONG BIOINFORMATION TECH CO., LTD.	НИНГБО КОНФУНГ БИОИНФОРМЭЙШН ТЕХ КО., ЛТД.

	Беречь от влаги Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно Указывает, что медицинское изделие может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно
	Верх Указывает правильное вертикальное положение груза
	Штабелировать запрещается Не допускается штабелировать груз. На груз с этим знаком при транспортировании и хранении не допускается класть другие грузы
	Не допускать воздействия солнечного света Указывает, что медицинское изделие необходимо защищать от воздействия солнечного света


Фотографическое изображение 58 – Манипуляционные знаки транспортной упаковки изделия



Фотографическое изображение 59 – Силовой кабель сканера



Фотографическое изображение 60 – Кассета на 2 слайда для сканера варианта исполнения KF-PRO-002

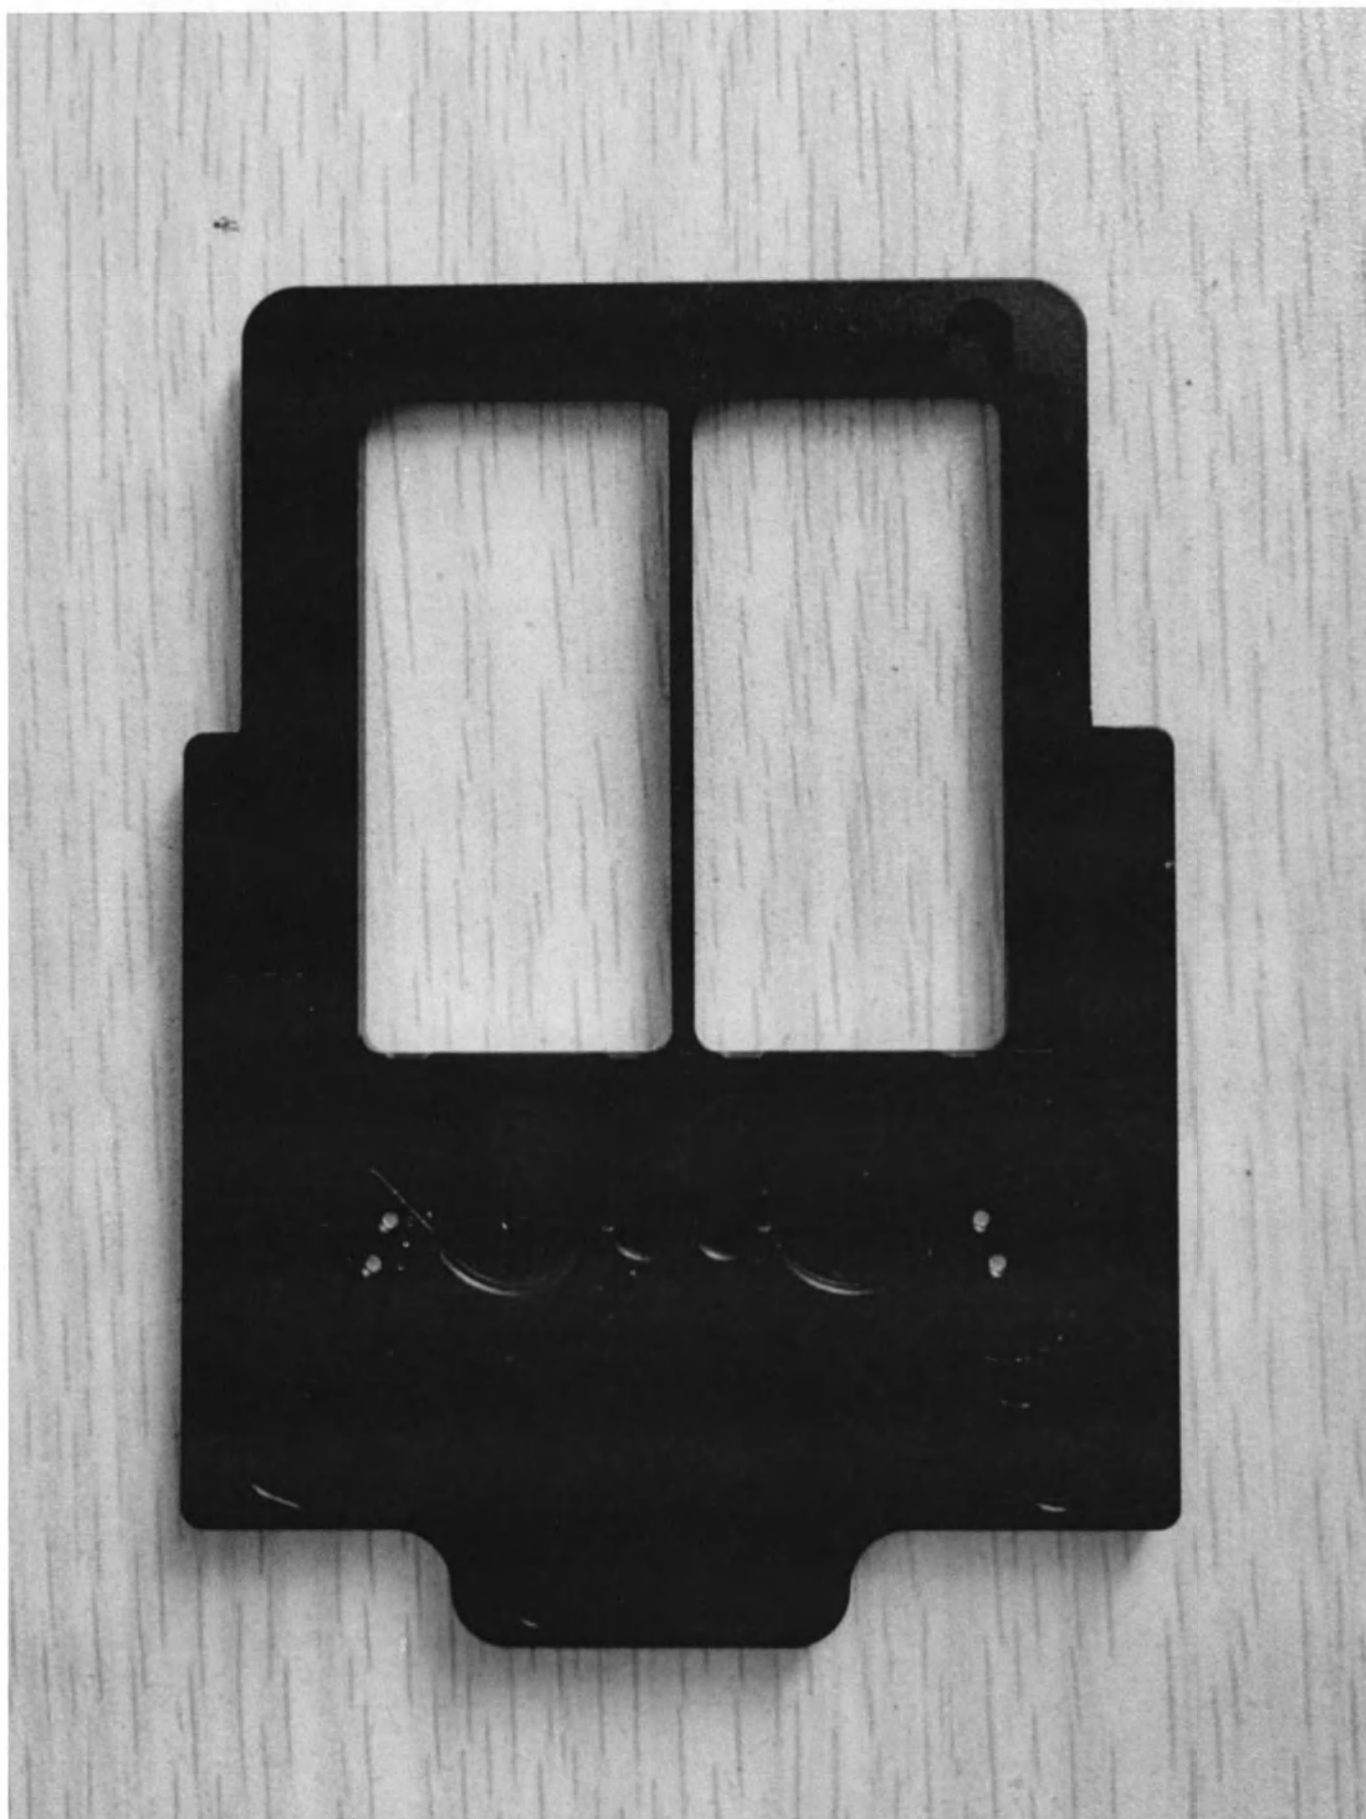


Фотографическое изображение 61 – Кассета на 2 слайда, для сканера варианта исполнения KF-PRO-020, KF-PRO-020-HI



Фотографическое изображение 62 – Кассета на 5 слайдов (1×3 дюйма), для сканера вариантов исполнения KF-PRO-005, KF-PRO-005-EX, KF-PRO-005-HI



Фотографическое изображение 63 – Кассета на 4 слайда (1×3 дюйма, 2×3 дюйма), для сканера варианта исполнения KF-PRO-005-II

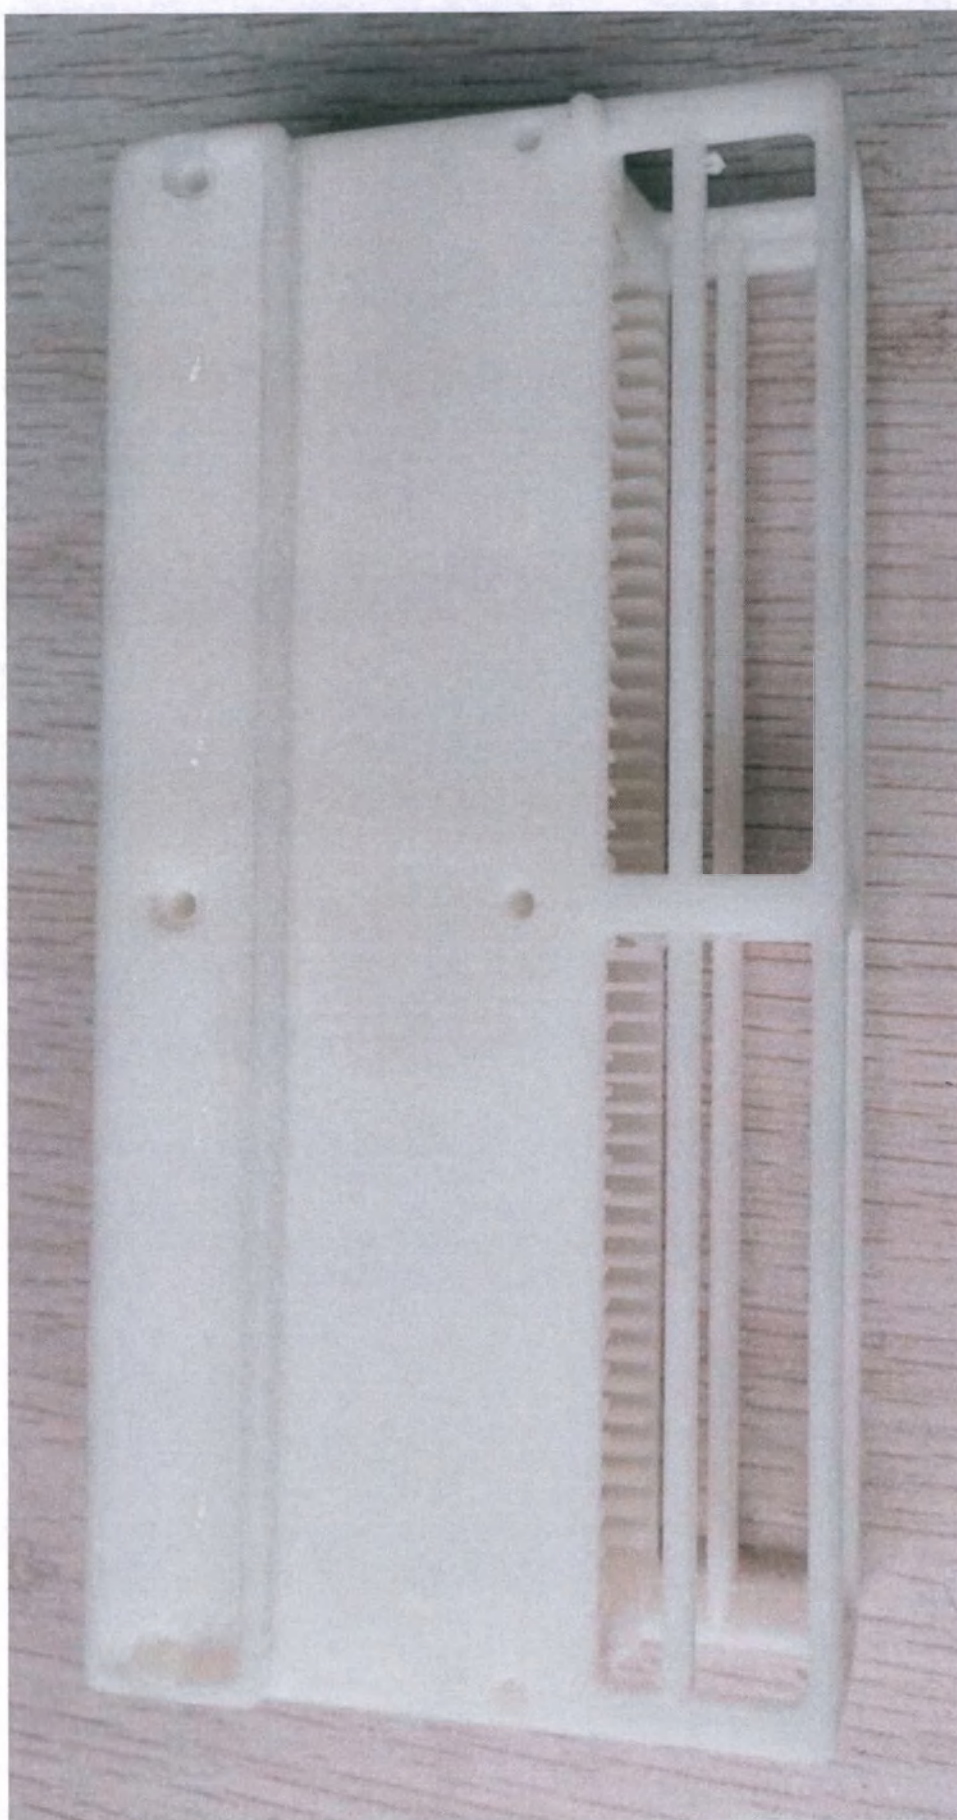

Фотографическое изображение 64 – Кассета на 40 слайдов, для сканера вариантов исполнения KF-PRO-040, KF-PRO-040-HI



Рисунок 1 – Кассета на 40 слайдов, для сканера вариантов исполнения KF-PRO-120, KF-PRO-400, KF-PRO-400-HI



Фотографическое изображение 65 – Линза объектива

Программное обеспечение KScanner		
Назначение: получение, анализ, обработка, просмотр и хранение цифровых изображений слайдов с высоким разрешением, полученных от сканера цифрового патологоанатомического микропрепаратов KF-PRO-005.		
Условия хранения: в чистом, сухом, тёмном месте в упаковке производителя, при температуре от + 10 °С до + 30 °С относительной влажности ≤ 70 %, атмосферном давлении ≥ 795 гПа		
Минимальные требования к используемой технике:		
Требования к	компьютеру	мобильному оборудованию связи
Операционная система	Windows 7; Mac OS X 10.9; Ubuntu 14.04 (64-разрядная версия); Debian 8; OpenSUSE 13.3; Fedora Linux 24	Android версия 7 iOS 7.1.2
Процессор	Intel Core I7	Нет требований
Оперативная память	16 Гбайт	Нет требований
Жёсткий диск	1 Тбайт	Нет требований
Разрешение монитора	24"	Нет требований
Устройство ввода	Мышь, клавиатура. Оптический дисковод, совместимый с CD-дисками	Сенсорный экран
Интернет-браузер:	Chrome версии 50, Opera версии 37	Chrome 75, Microsoft Edge 40
Дополнительное ПО	Программа просмотра изображений форматов: JPEG/JPEG2000/BMP/Tiff	
Тип входных и выходных соединений	USB, WLAN Терминал подключения	—
Скорость сетевого соединения	Не менее 100 Мбит/с	
Правообладатель программы для ЭВМ «KScanner»: НИНГБО КОНФУНГ БИОИНФОРМЭЙШН ТЕХ КО., ЛТД.		
Поставляемые элементы: CD диск в фирменной упаковке – 1 шт.		
Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации сканера!		



НИНГБО КОНФУНГ БИОИНФОРМЭЙШН ТЕХ КО., ЛТД.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ФНК МЕДИЦИНА»

ООО «ФНК Медицина»

Программное обеспечение KScanner

Краткая инструкция по входу

1. Достаньте носитель из упаковки.
2. Вставьте носитель в оптический дисковод, совместимый с CD-дисками вашего компьютера.
3. Следуйте подсказкам, появляющимся в открывшемся окне на экране компьютера.
4. Более подробные инструкции находится в Руководстве по эксплуатации сканера.

Программное обеспечение KScanner		
		
Производитель: НИНГБО КОНФУНГ БИОИНФОРМЭЙШН ТЕХ КО., ЛТД. Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ФНК Медицина»		
Количество CD дисков – 1 шт.	Дата выпуска: 3/13/2020	Версия V1.7.4.32
РУ № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.		

Фотографическое изображение 66 – МАРКИРОВКА (ЭТИКЕТКА) ДИСКА

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

68 () листов
цифрами прописью

Должность: Генеральный директор

Подпись Стихеев Г.А.

«01» 04 2022 г. МП

