

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов in vitro для количественного определения миоглобина (MAGLUMI[®] Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI[®], в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

« 30 »

10

2024 г.

Набор реагентов in vitro для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:


Вариант исполнения 1

Набор реагентов in vitro для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов, в составе:


Картридж с реагентами



Контроль 1

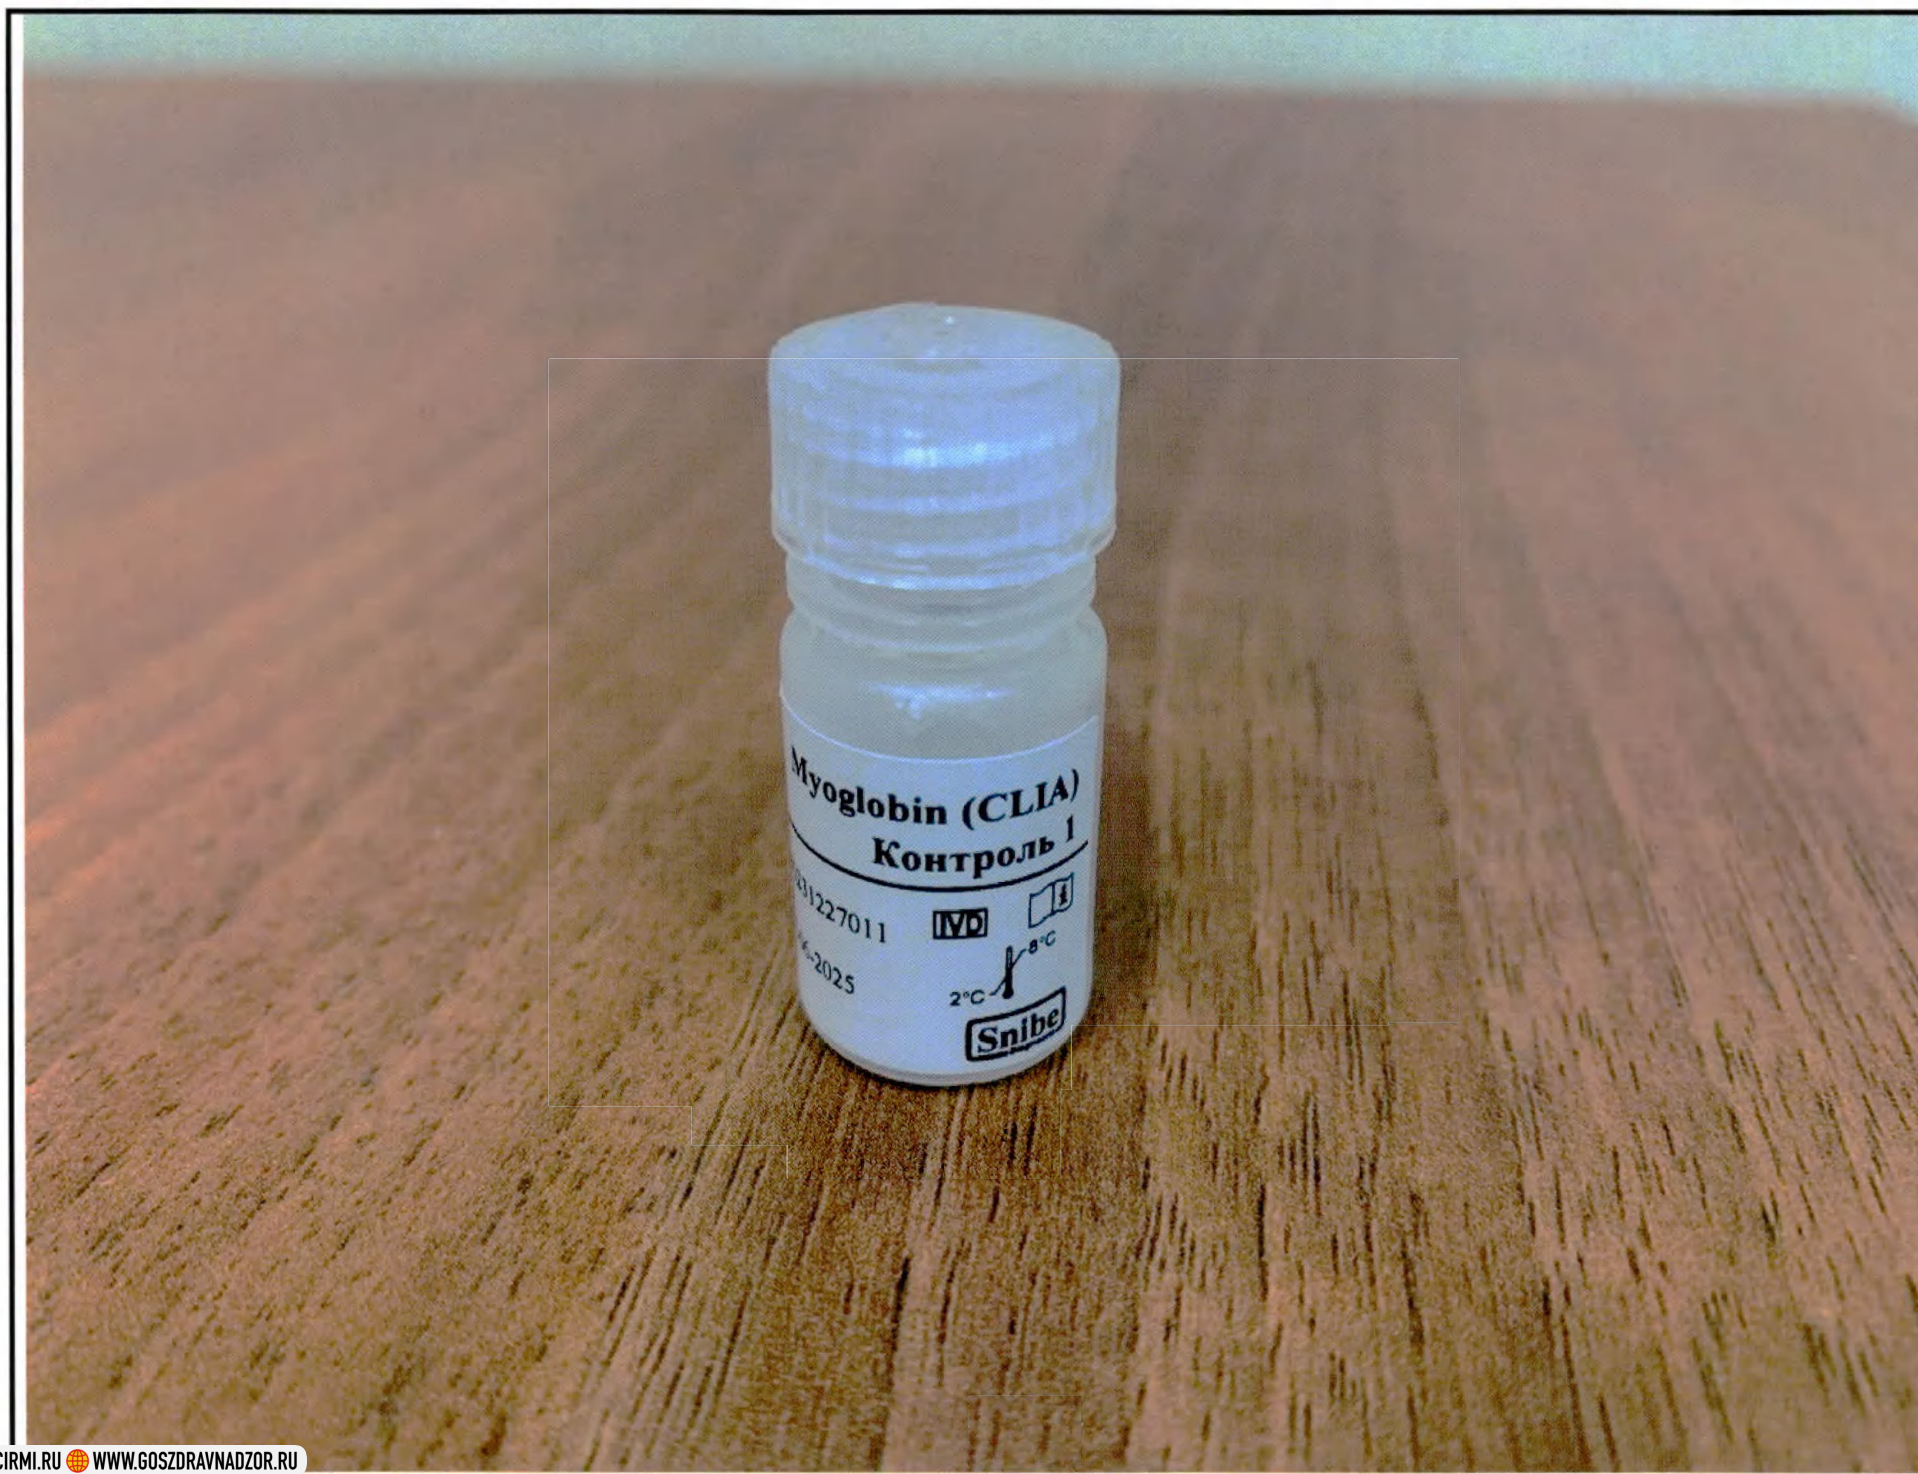

Контроль 2

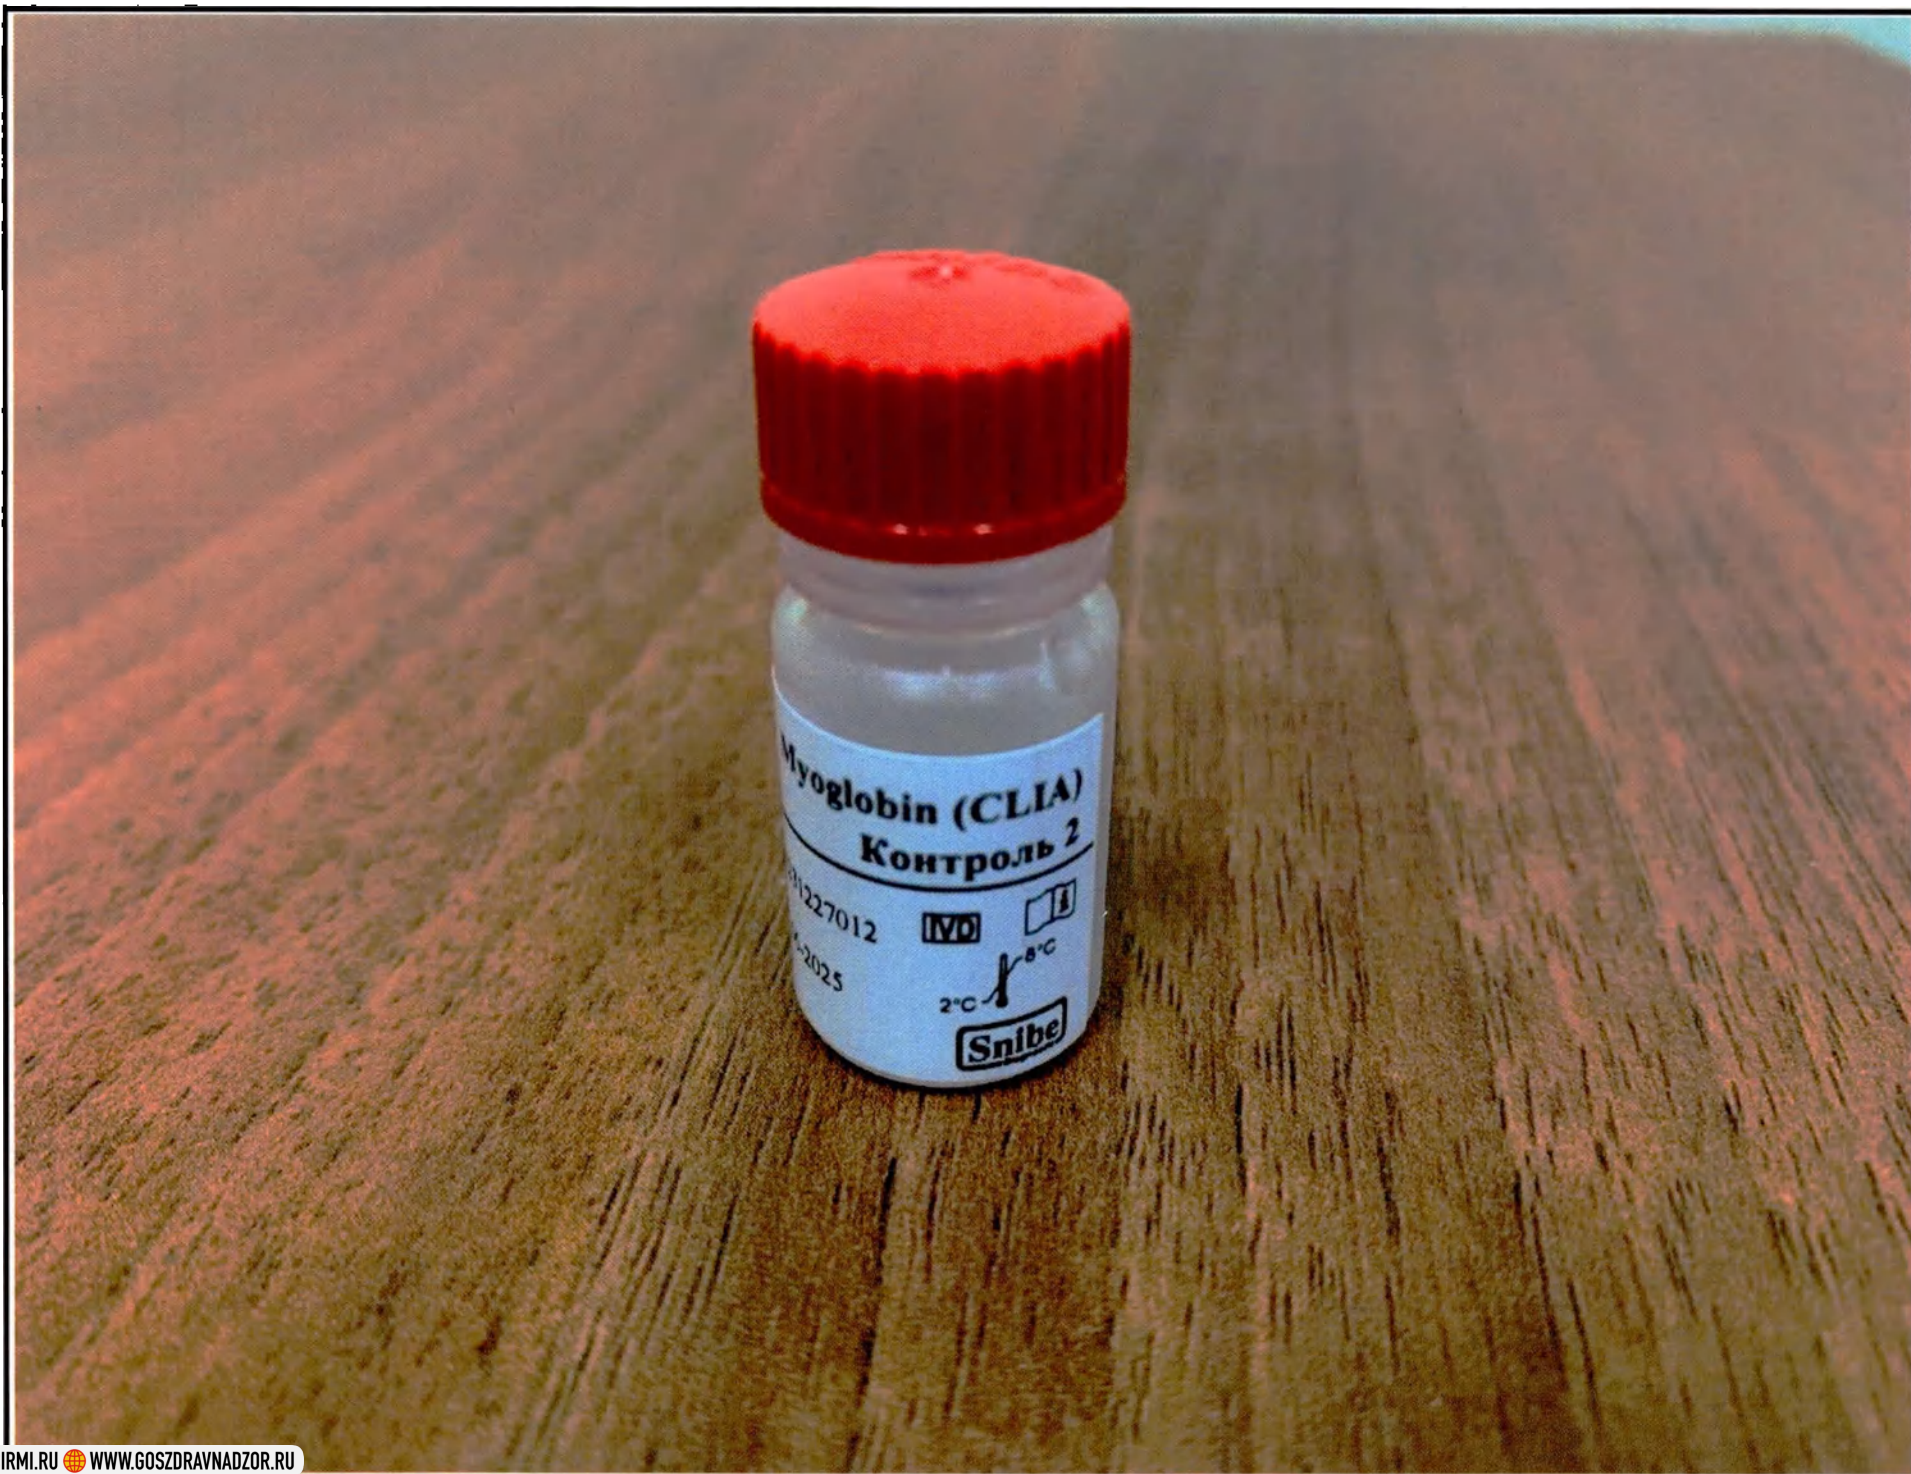

Лента для запечатывания картриджа с реагентами



Наклейки со штрих-кодами для контроля 1 и контроля 2





CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

Inspection Qualified & Approved
For Release

Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.



130256003M: 100 тестов
130656003M: 50 тестов
130756003M: 30 тестов


Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (Myoglobin) в сыворотке и плазме человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики лиц с подозрением или подтвержденный инфарктом миокарды, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Потребительская упаковка Вариант исполнения 1 (30 тестов)

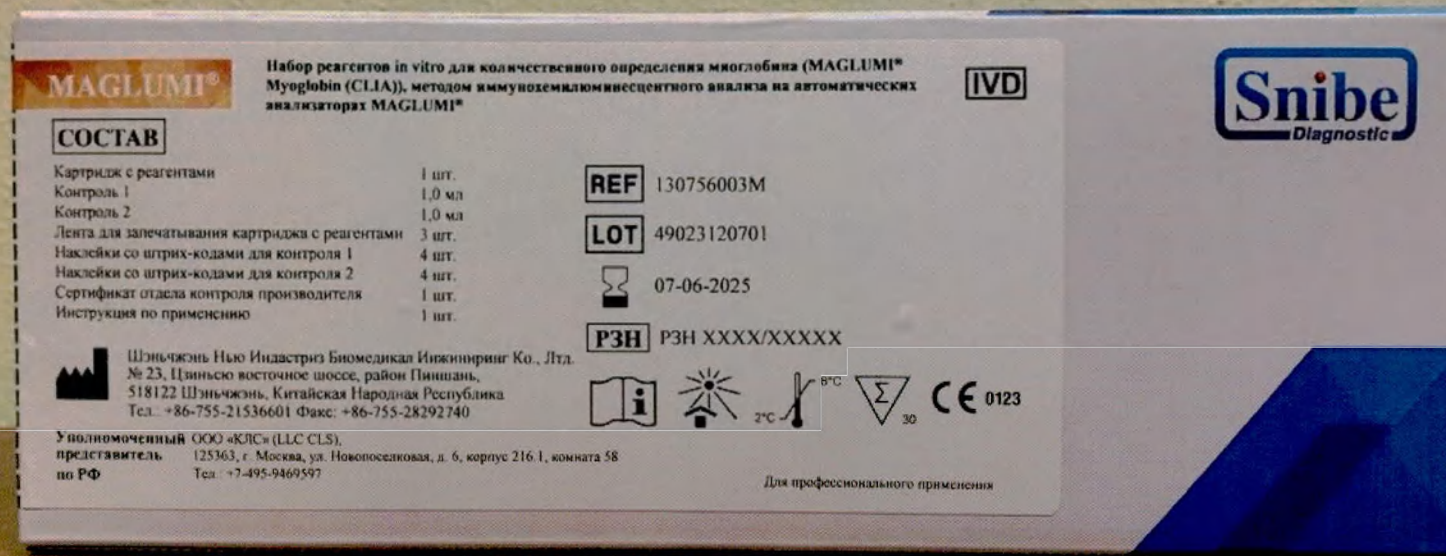

Маркировка потребительской упаковки Вариант исполнения 1 (30 тестов)

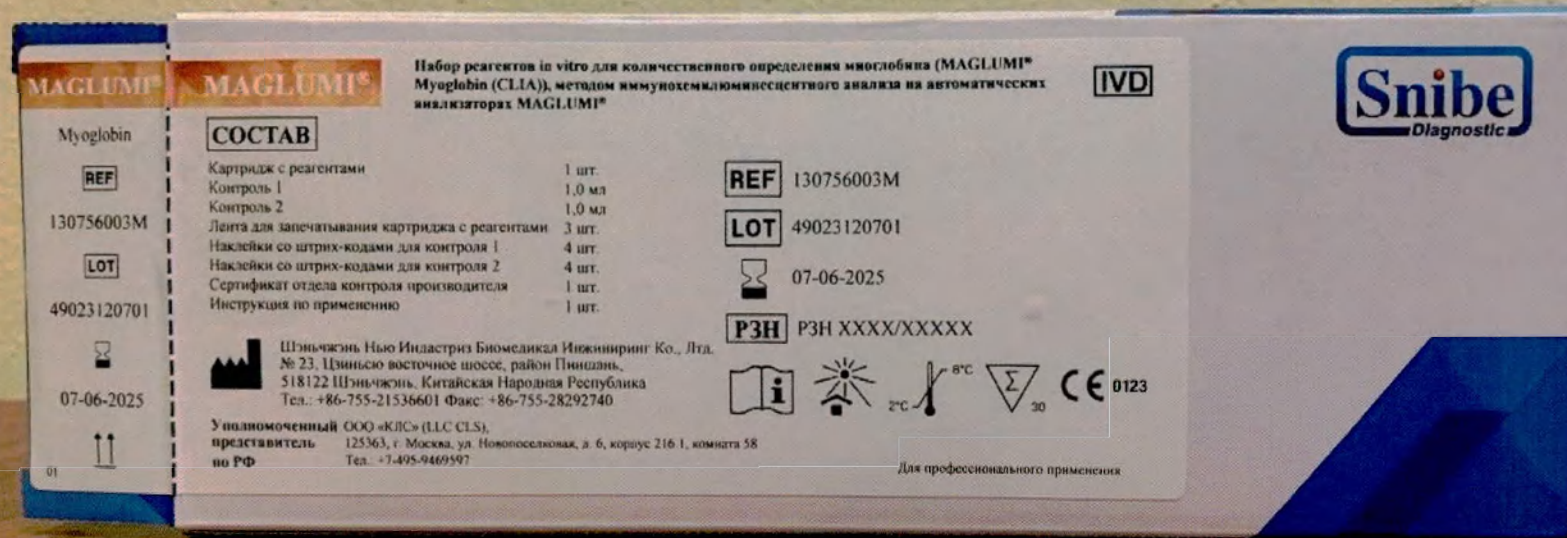

Вариант исполнения 2

Набор реагентов in vitro для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 50 тестов, в составе:

Картридж с реагентами



Контроль 1




Контроль 2



Лента для запечатывания картриджа с реагентами



Наклейки со штрих-кодами для контроля 1 и контроля 2

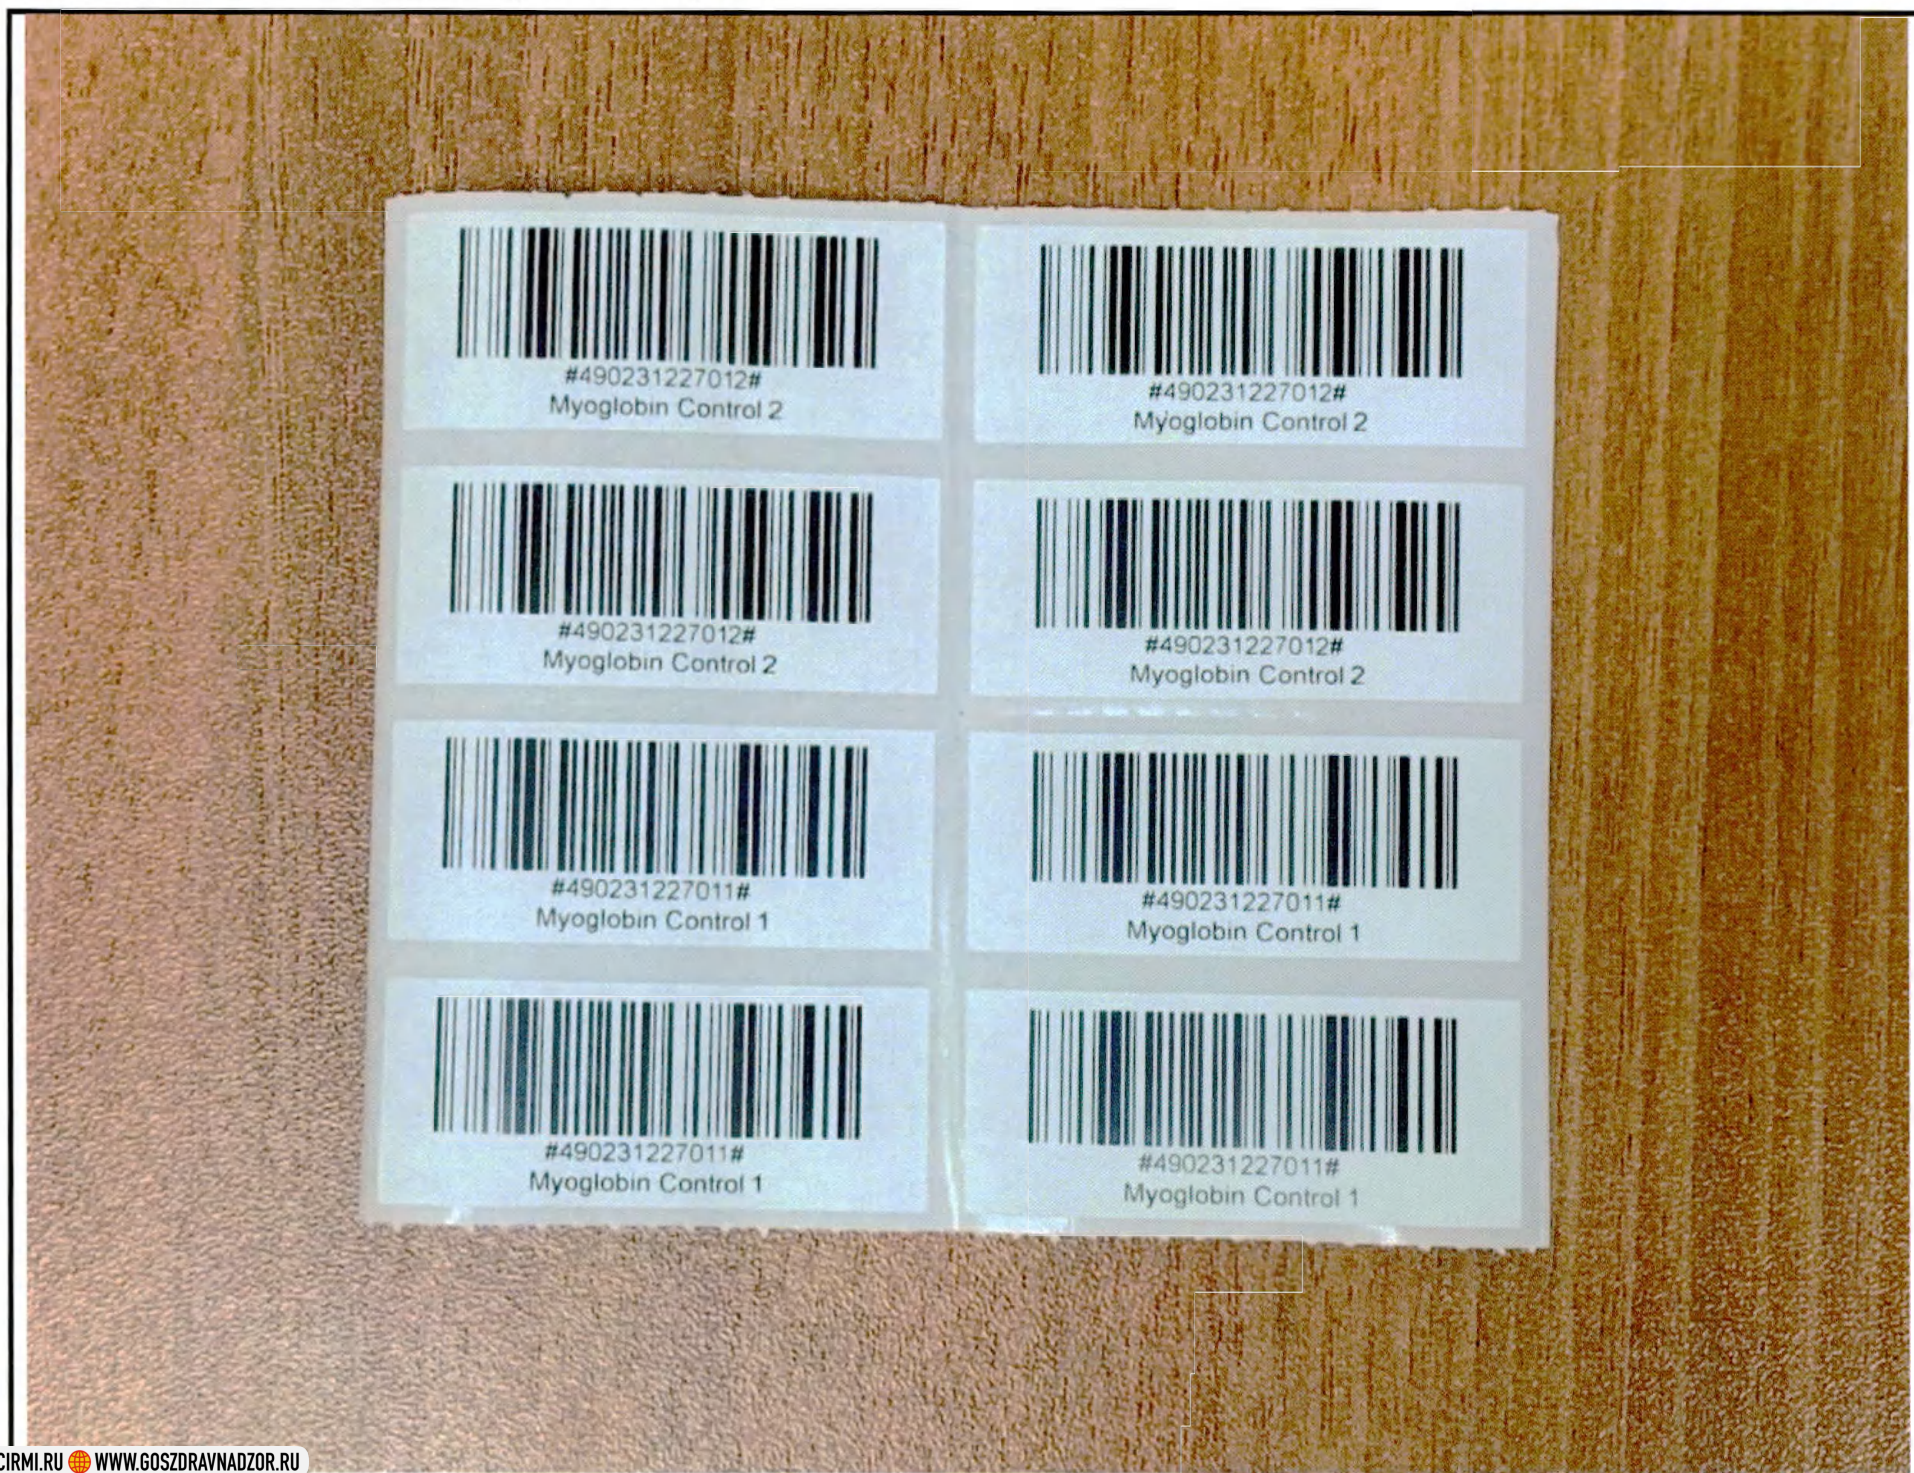


CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**




130256003M: 100 тестов
130656003M: 50 тестов
130756003M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (Myoglobin) в сыворотке и плазме человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики лиц с подозрением или подтвержденный инфарктом миокарды, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

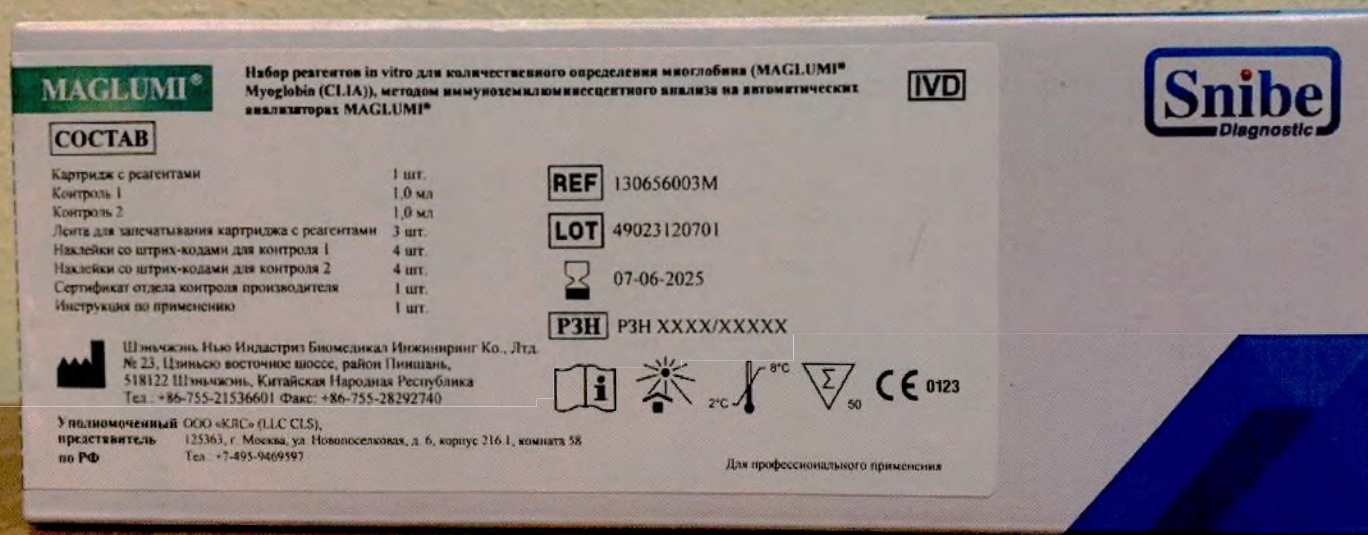


Маркировка потребительской упаковки Вариант исполнения 2 (50 тестов)

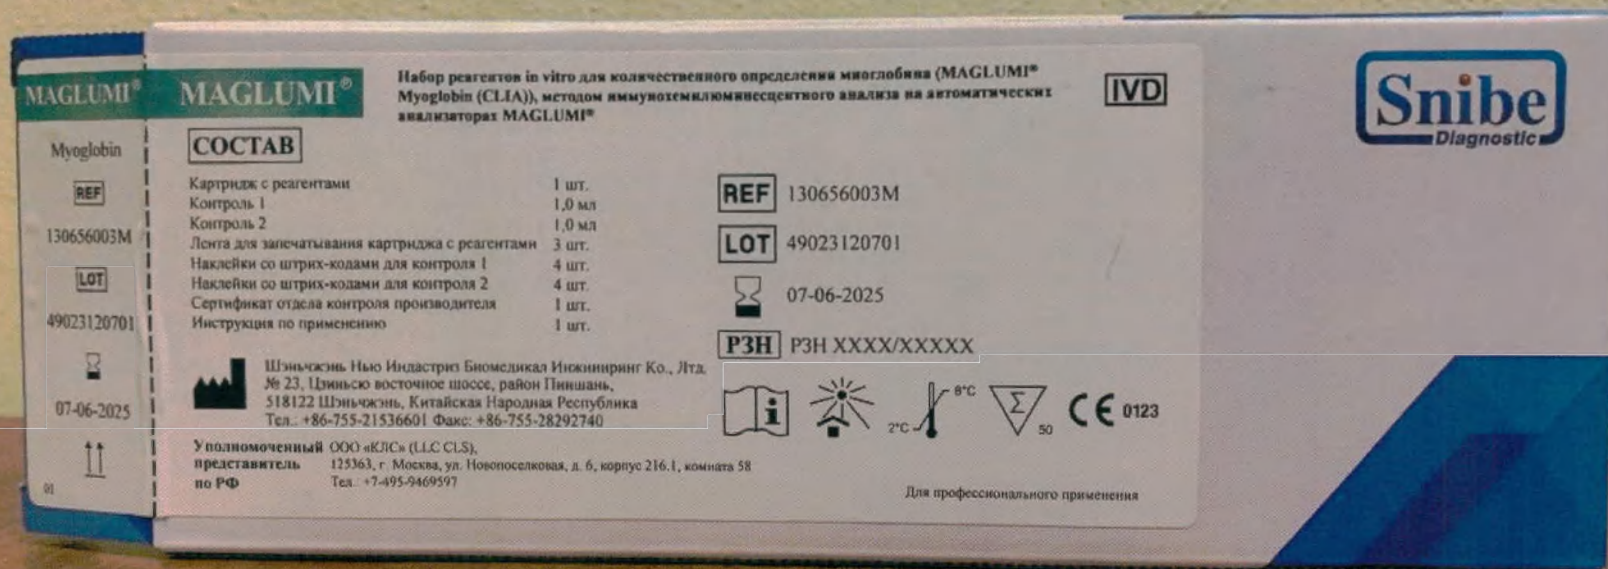


Вариант исполнения 3

Набор реагентов in vitro для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 100 тестов, в составе:


Картридж с реагентами

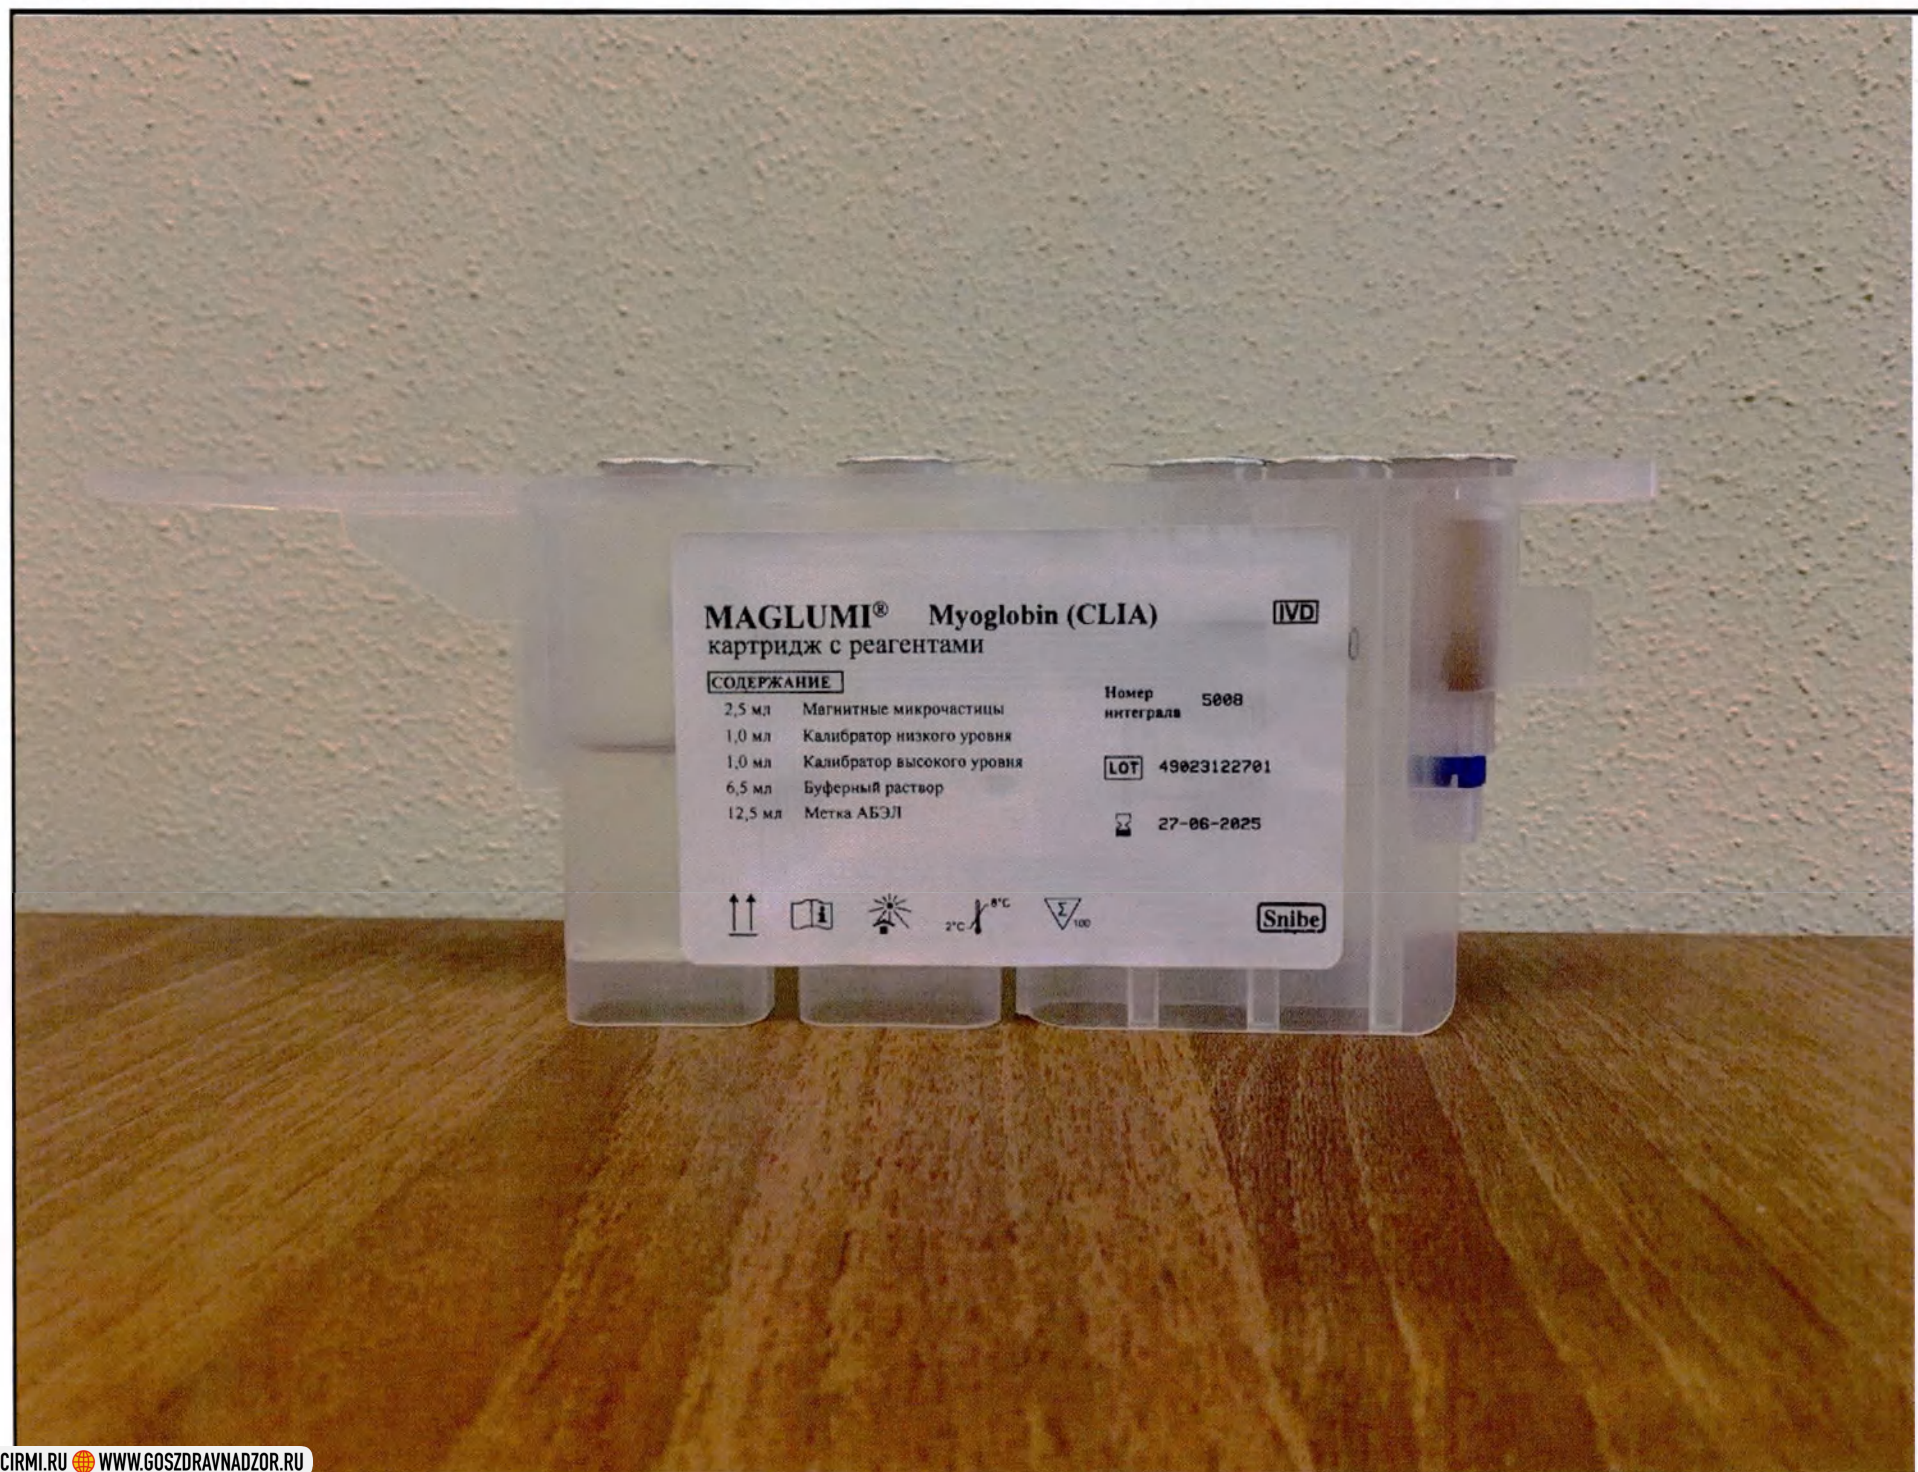


Контроль 1

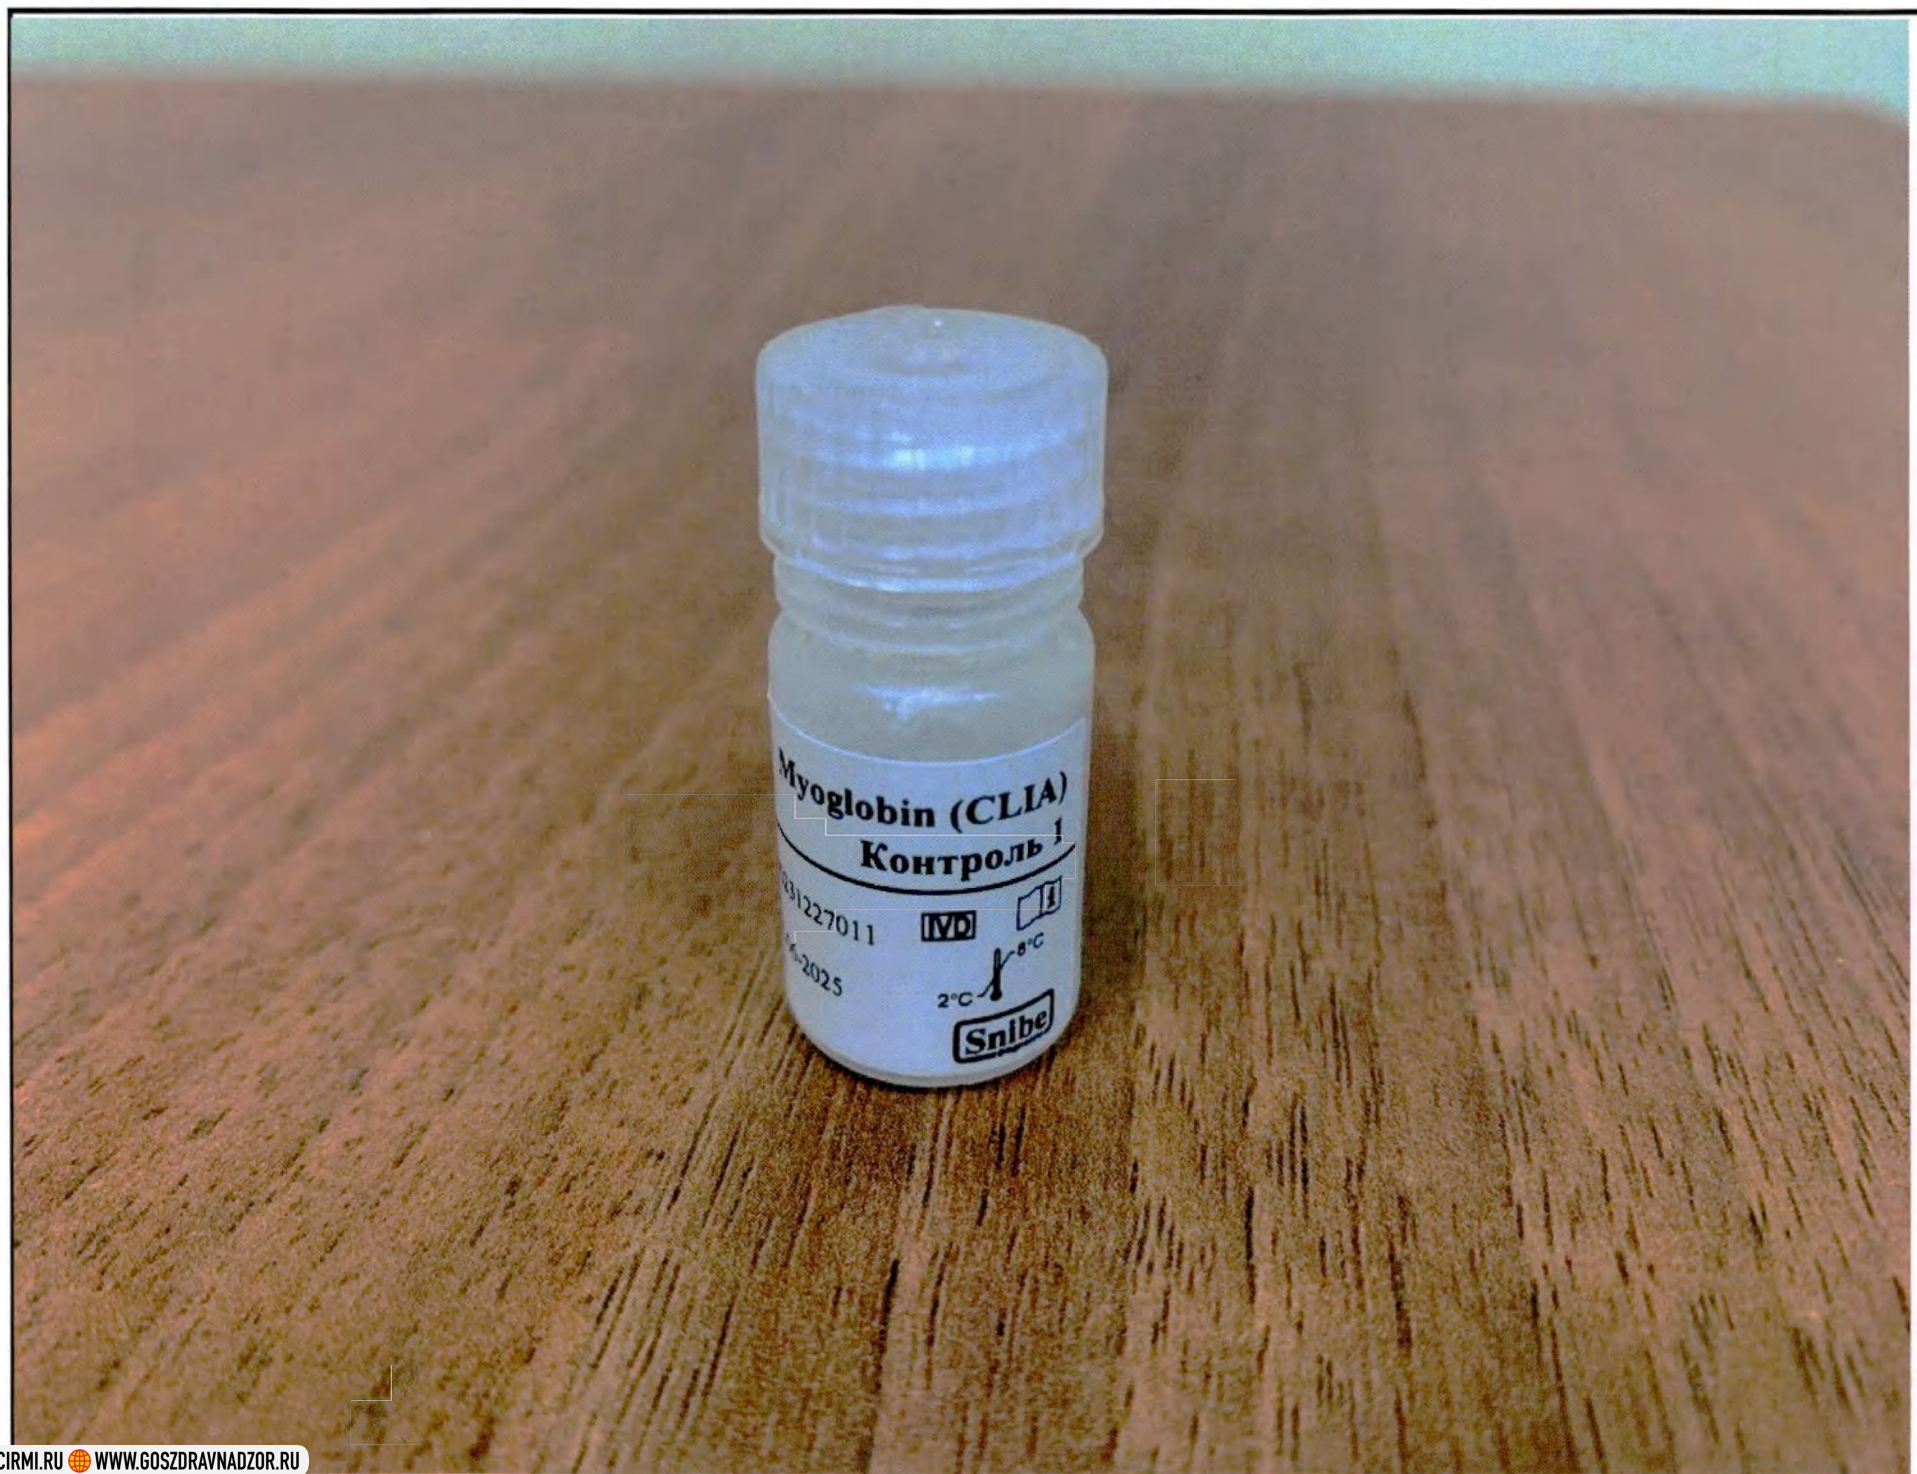


Контроль 2

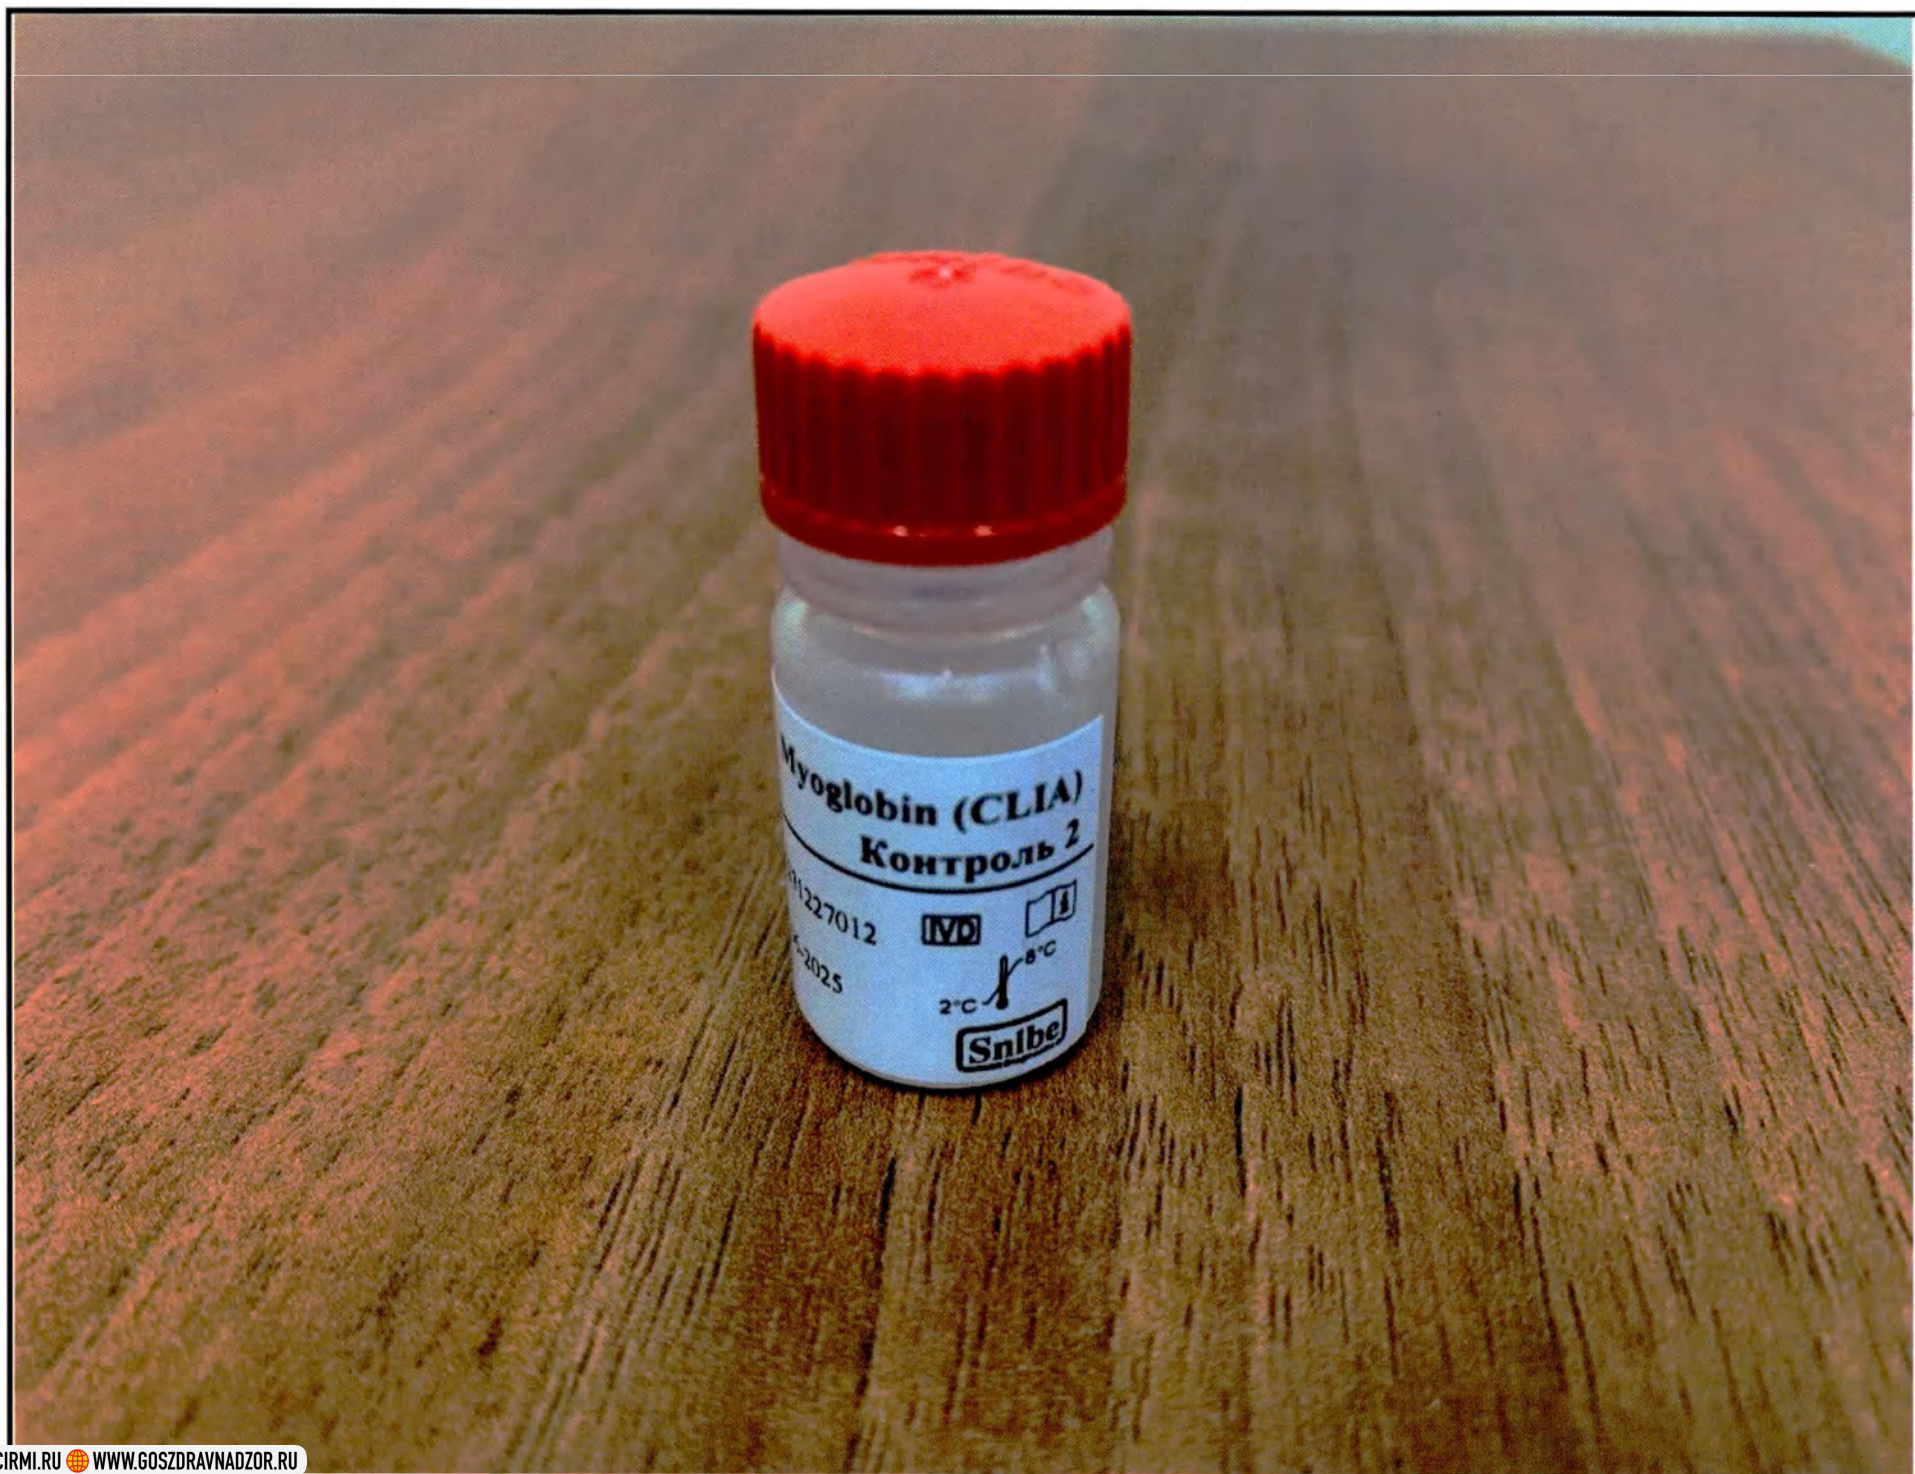

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

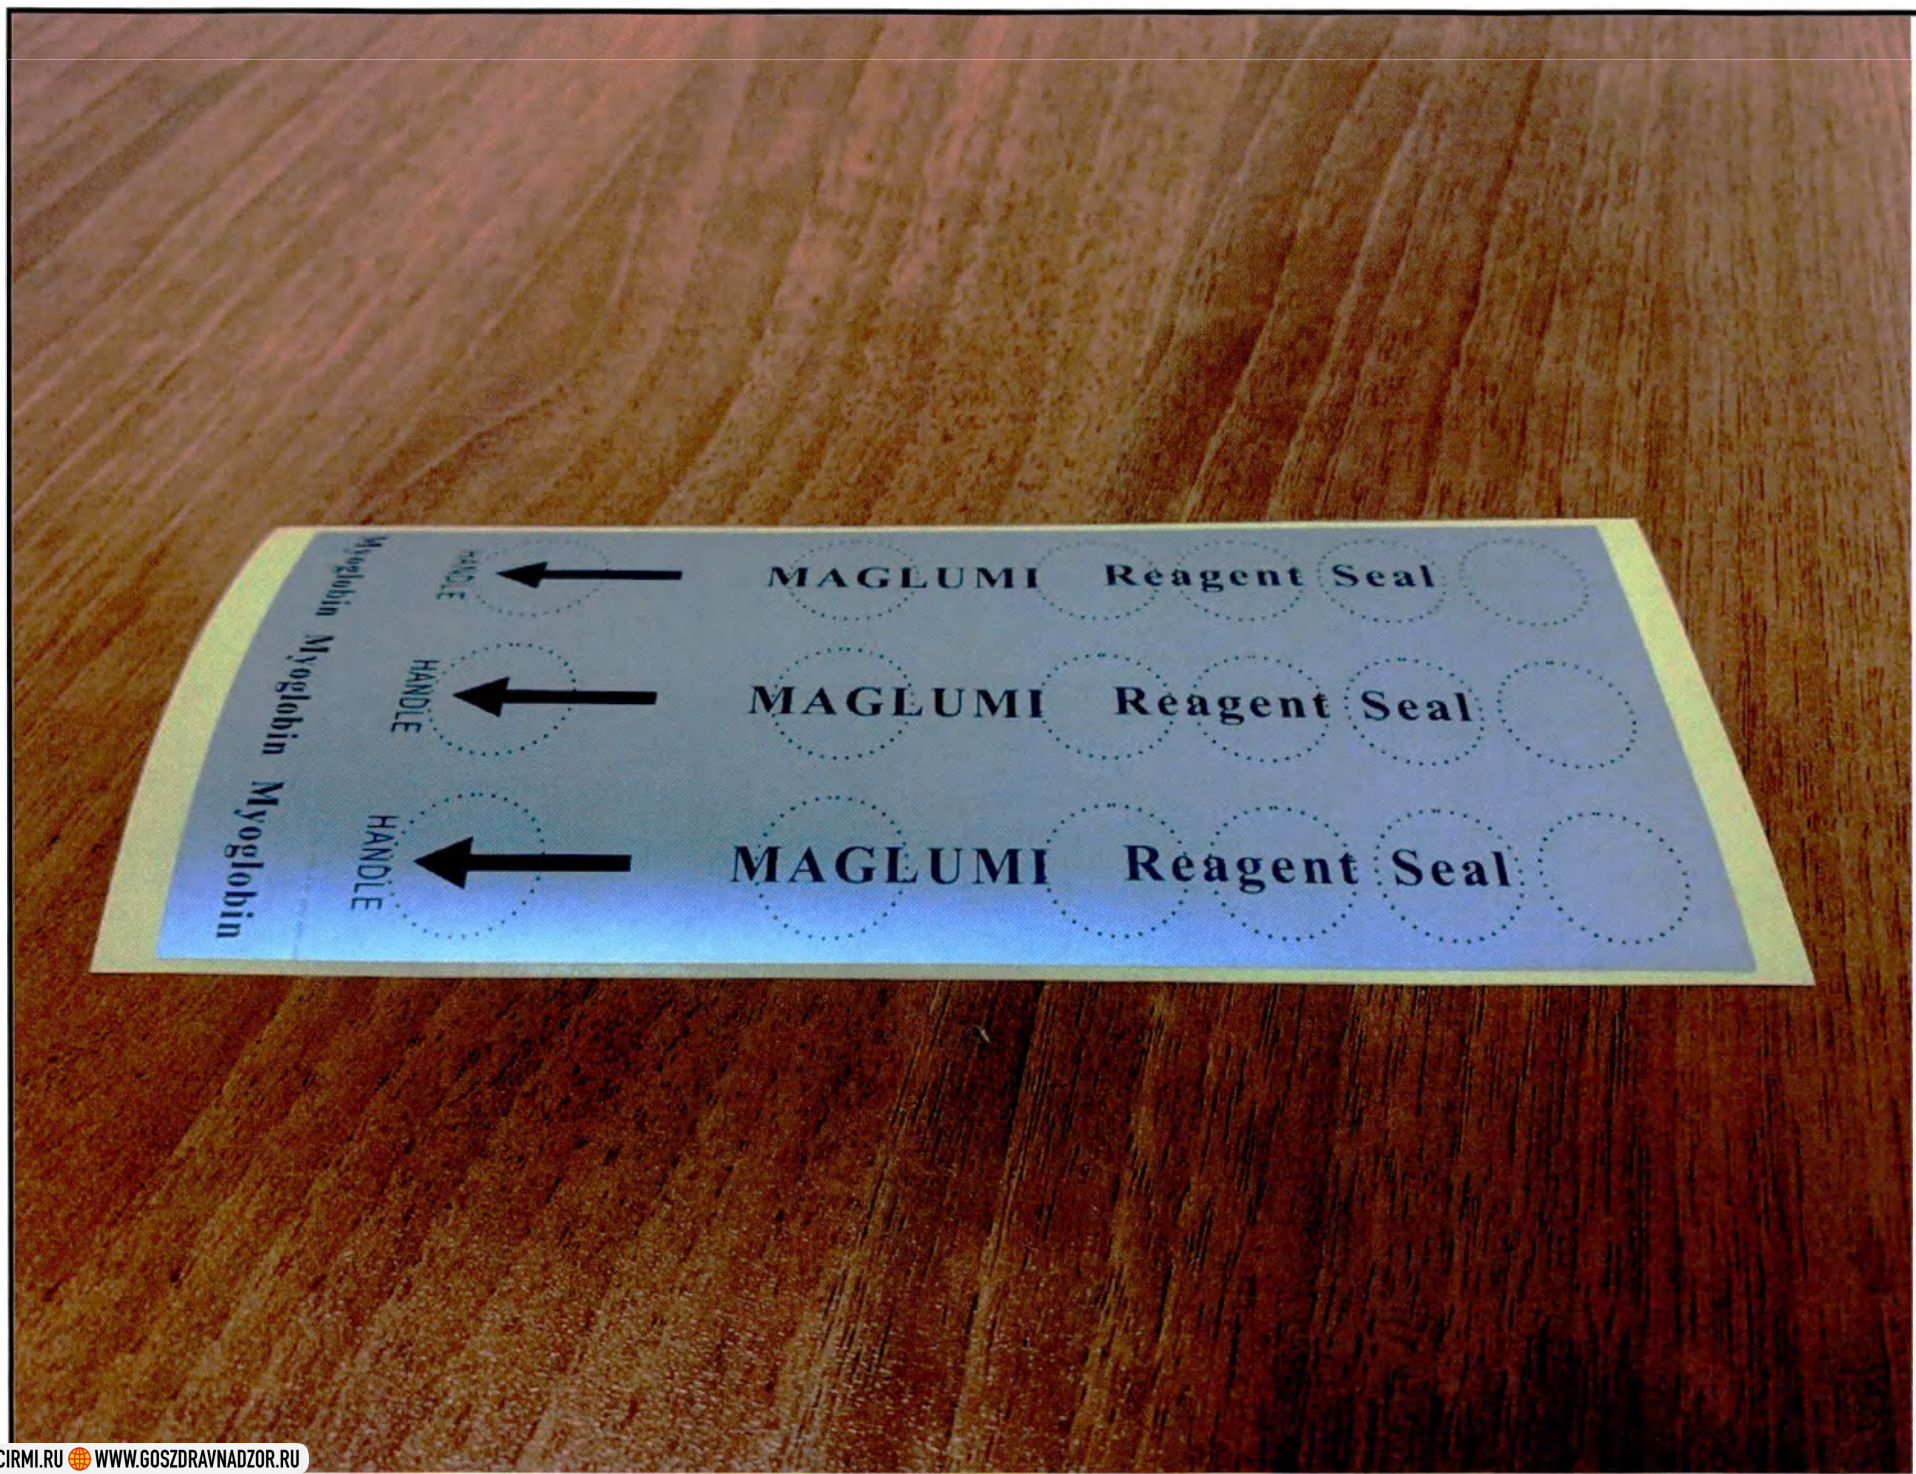

Наклейки со штрих-кодами для контроля 1 и контроля 2


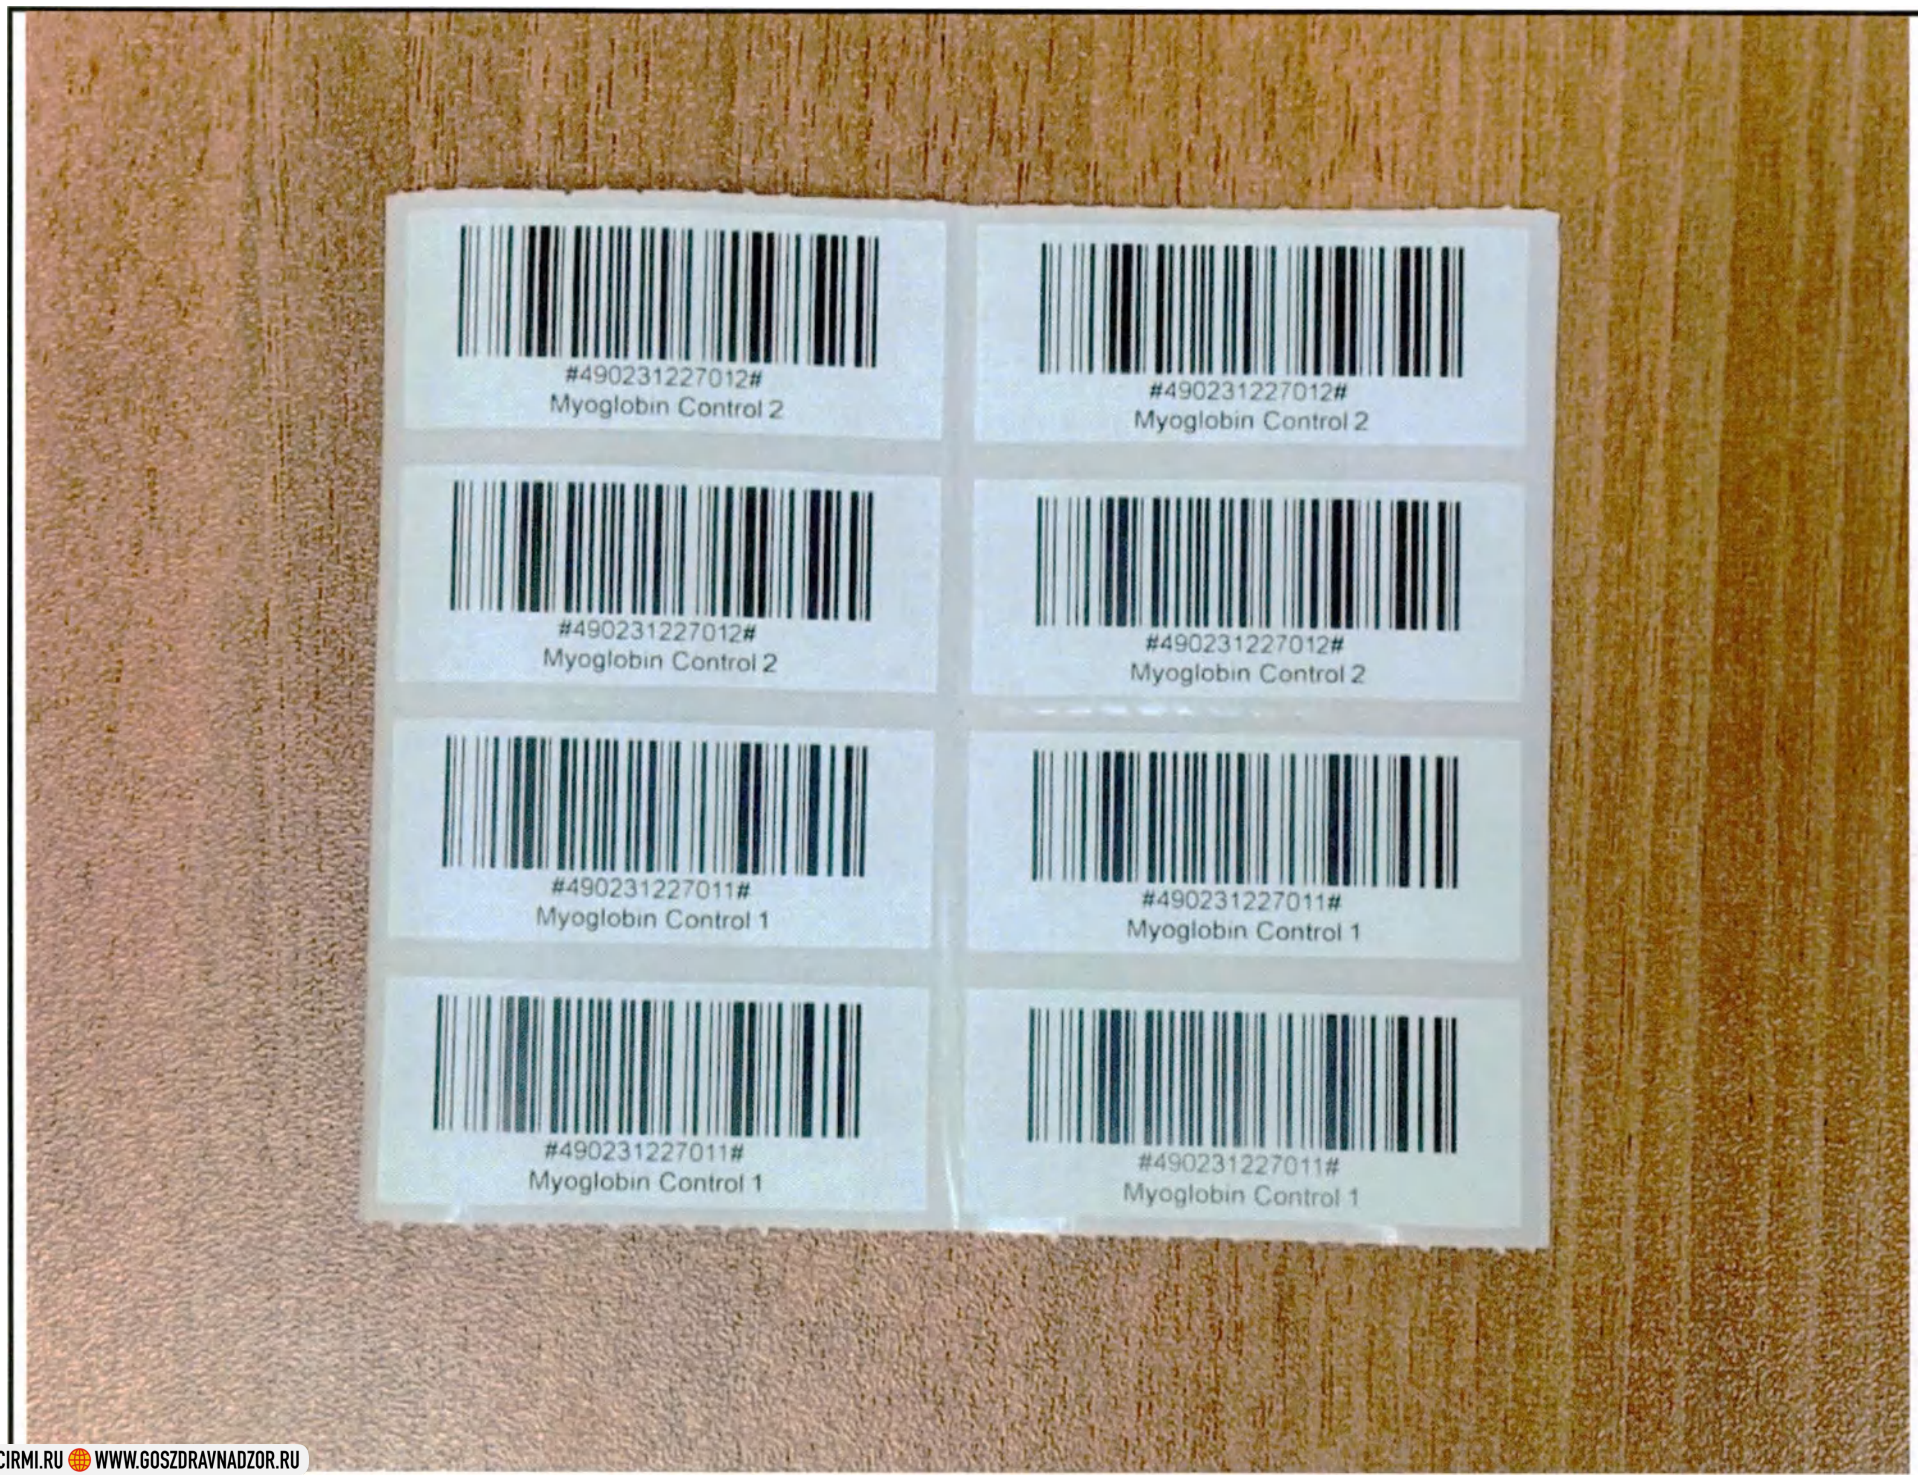


CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**




130256003M: 100 тестов
130656003M: 50 тестов
130756003M: 30 тестов


Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (MAGLUMI® Myoglobin (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для количественного определения миоглобина (Myoglobin) в сыворотке и плазме человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики лиц с подозрением или подтвержденный инфарктом миокарды, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

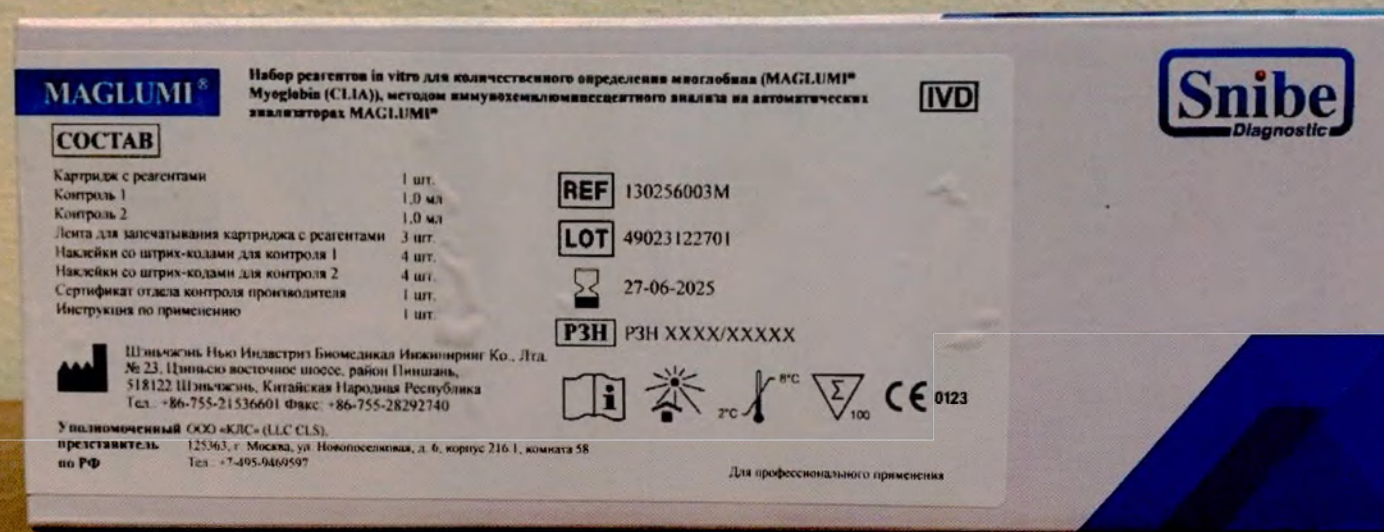

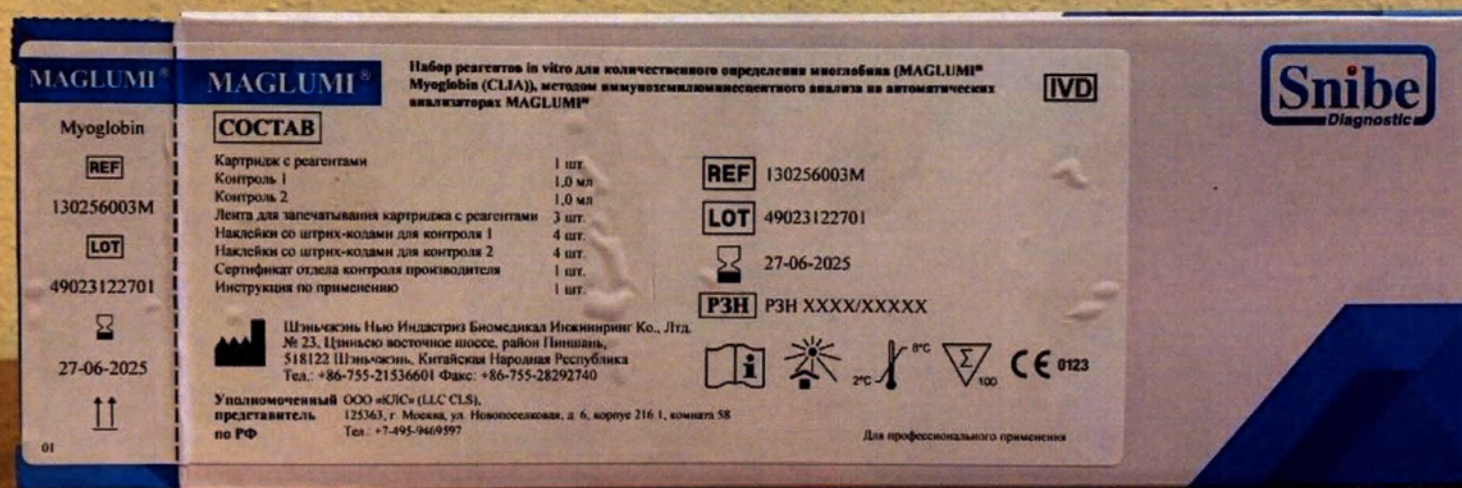

Всего прошнуровано и
скреплено 32 листков»

