

Фотографические изображения медицинского изделия

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»

 Смирнов Э.А.

« 30 »

10

2024 г.



Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов, в составе:


Картридж с реагентами




Отрицательный контроль



Положительный контроль

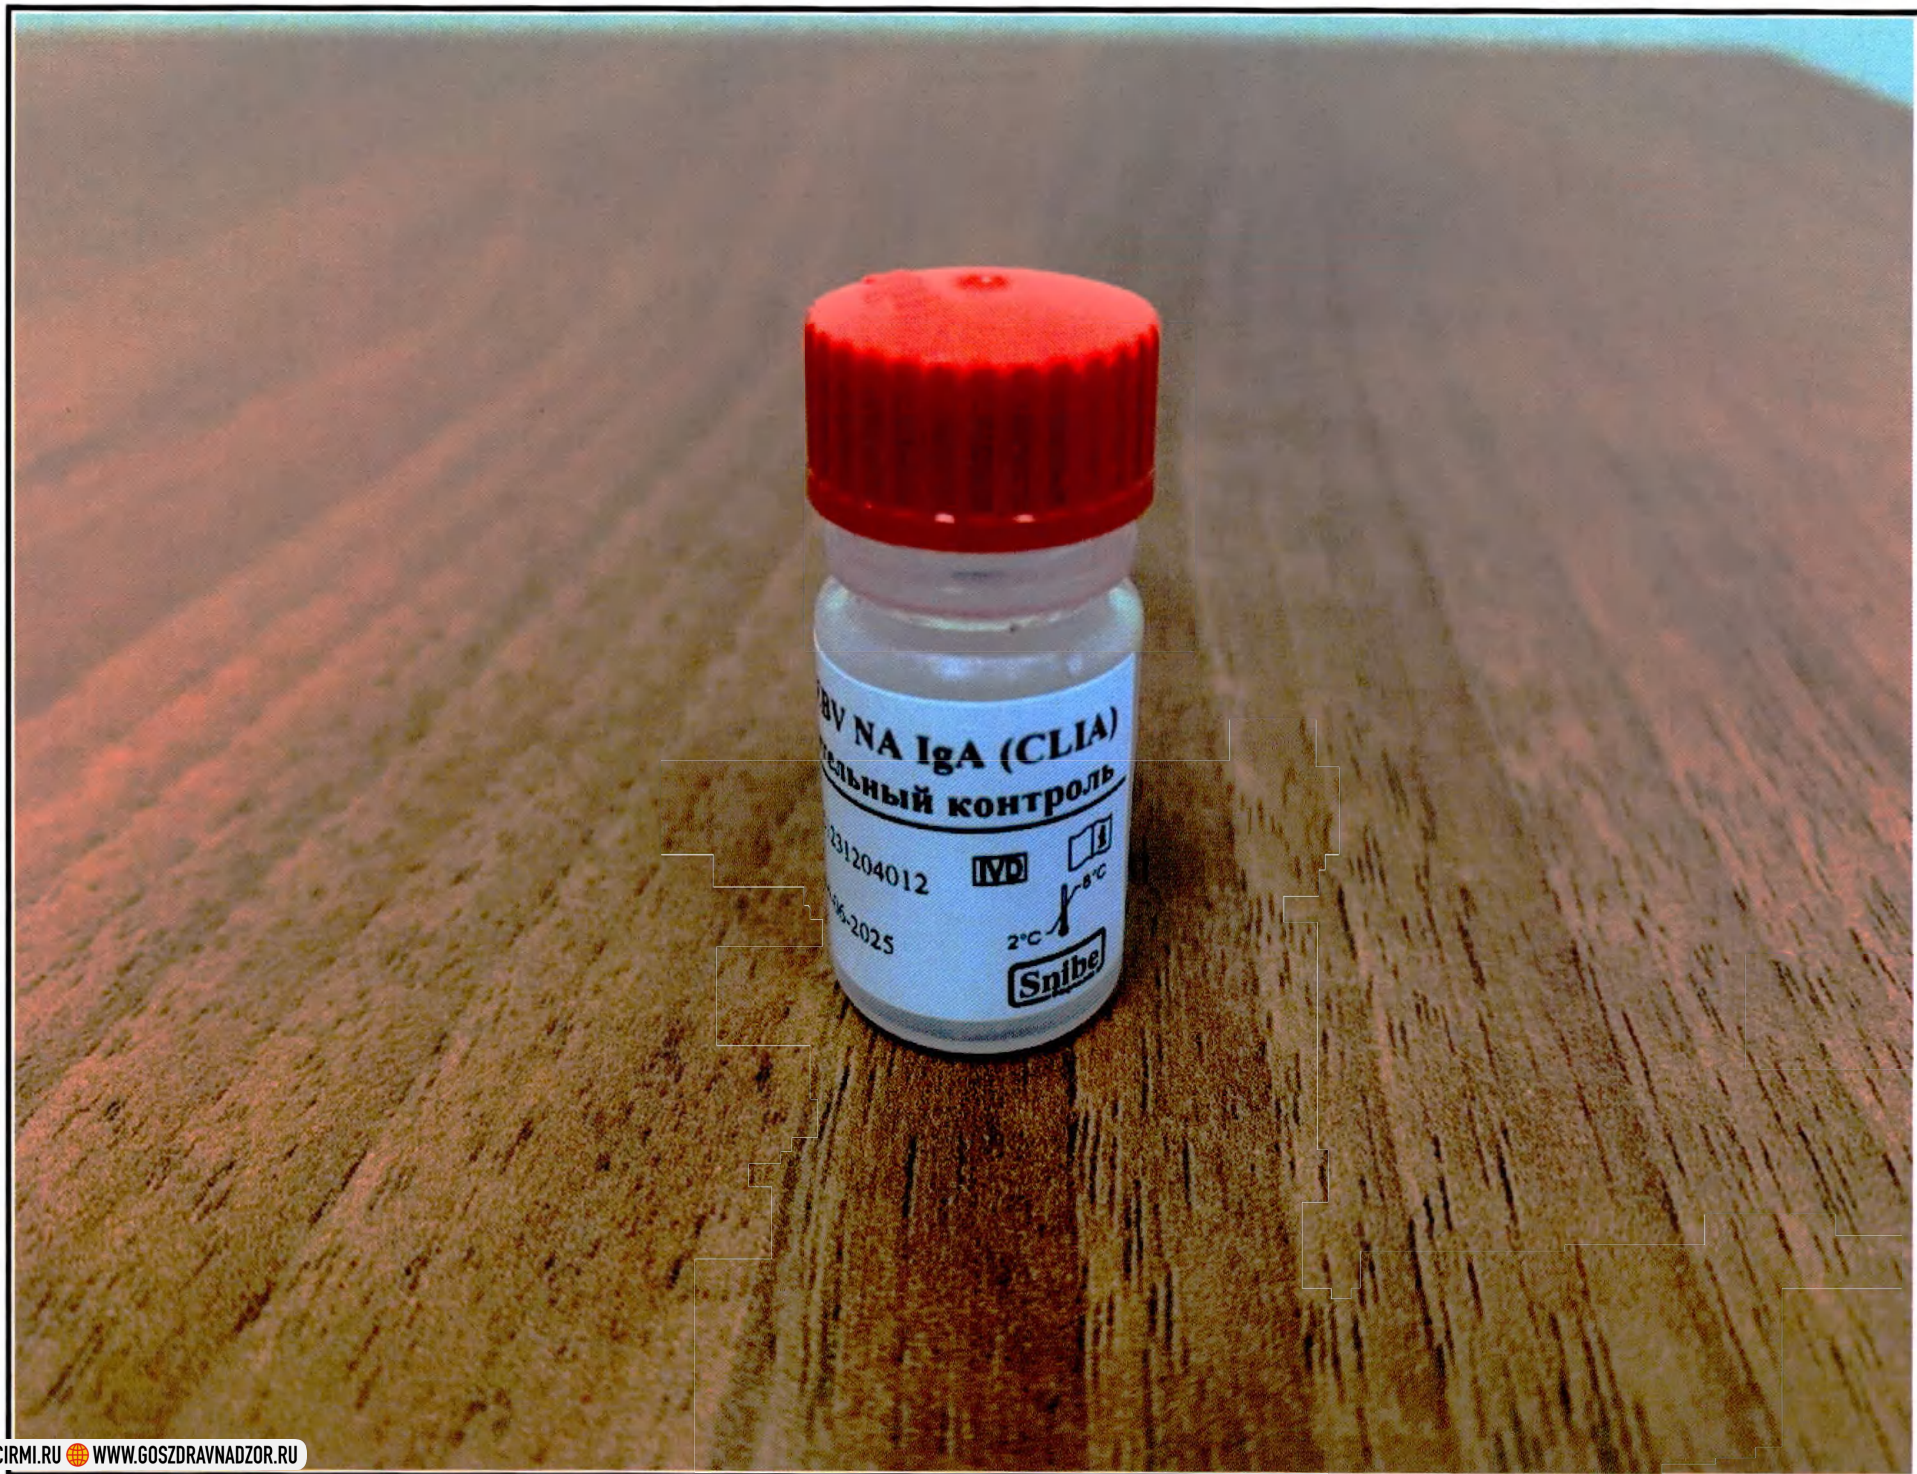

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

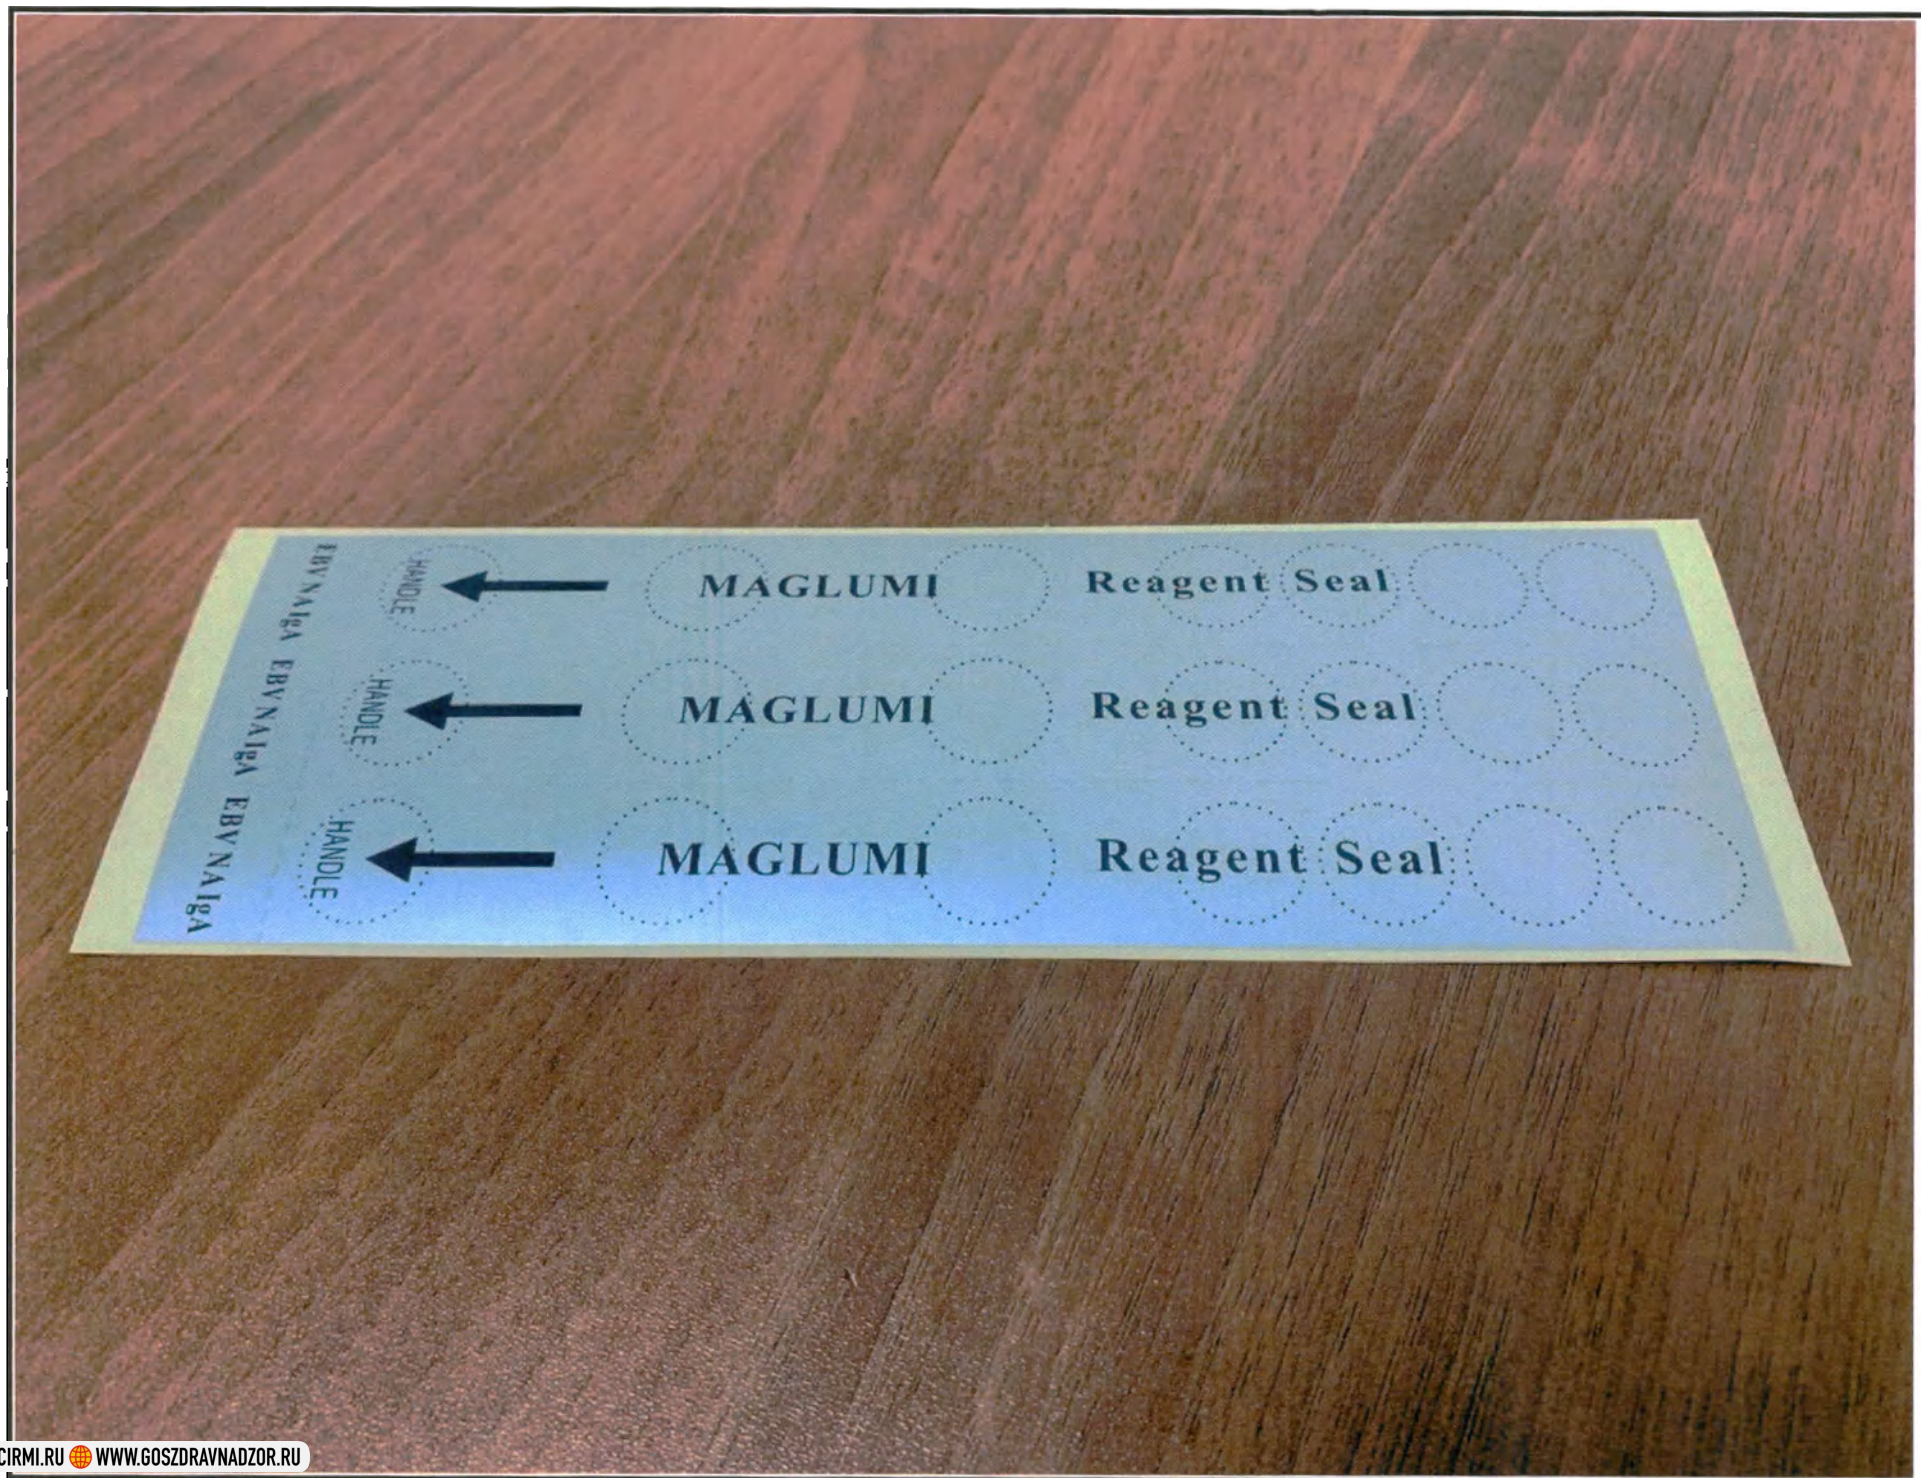

Наклейки со штрих-кодами для Отрицательного и Положительного контроля




CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130265006M: 100 тестов


130665006M: 50 тестов


130765006M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

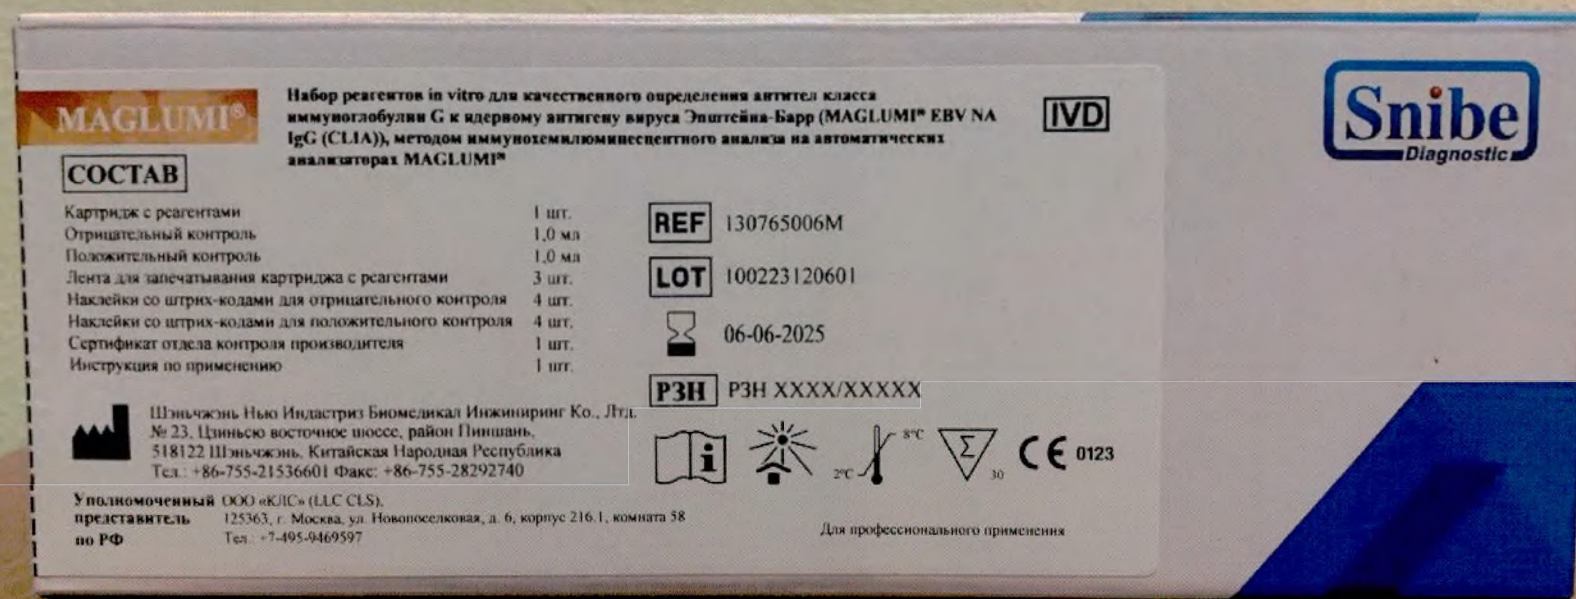

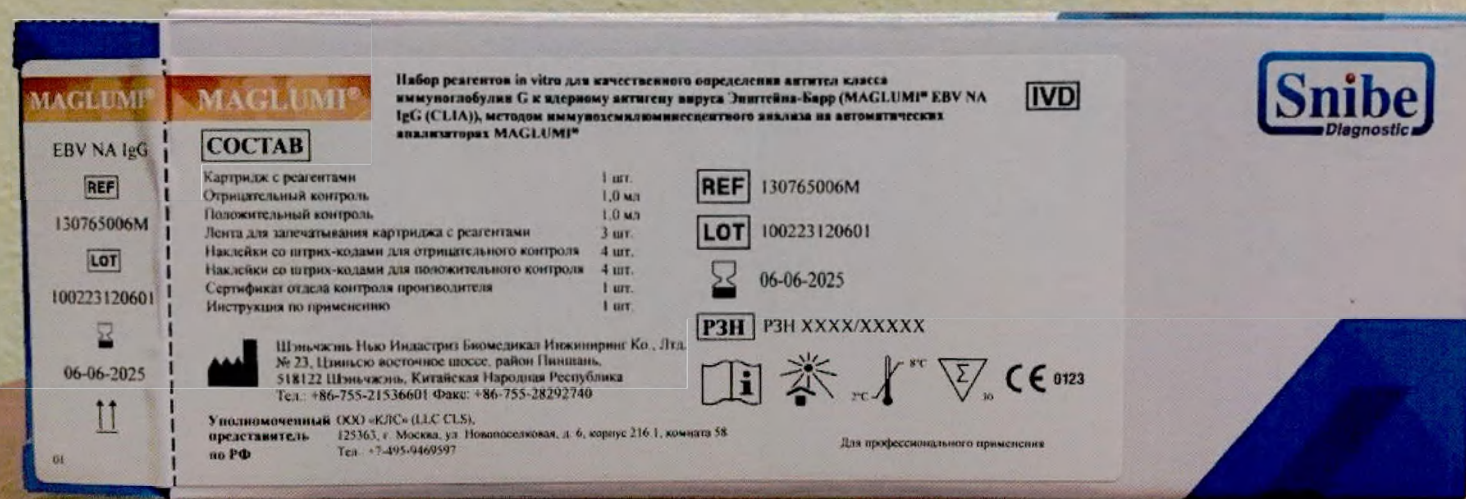


Вариант исполнения 2

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 50 тестов, в составе:


Картридж с реагентами




Отрицательный контроль

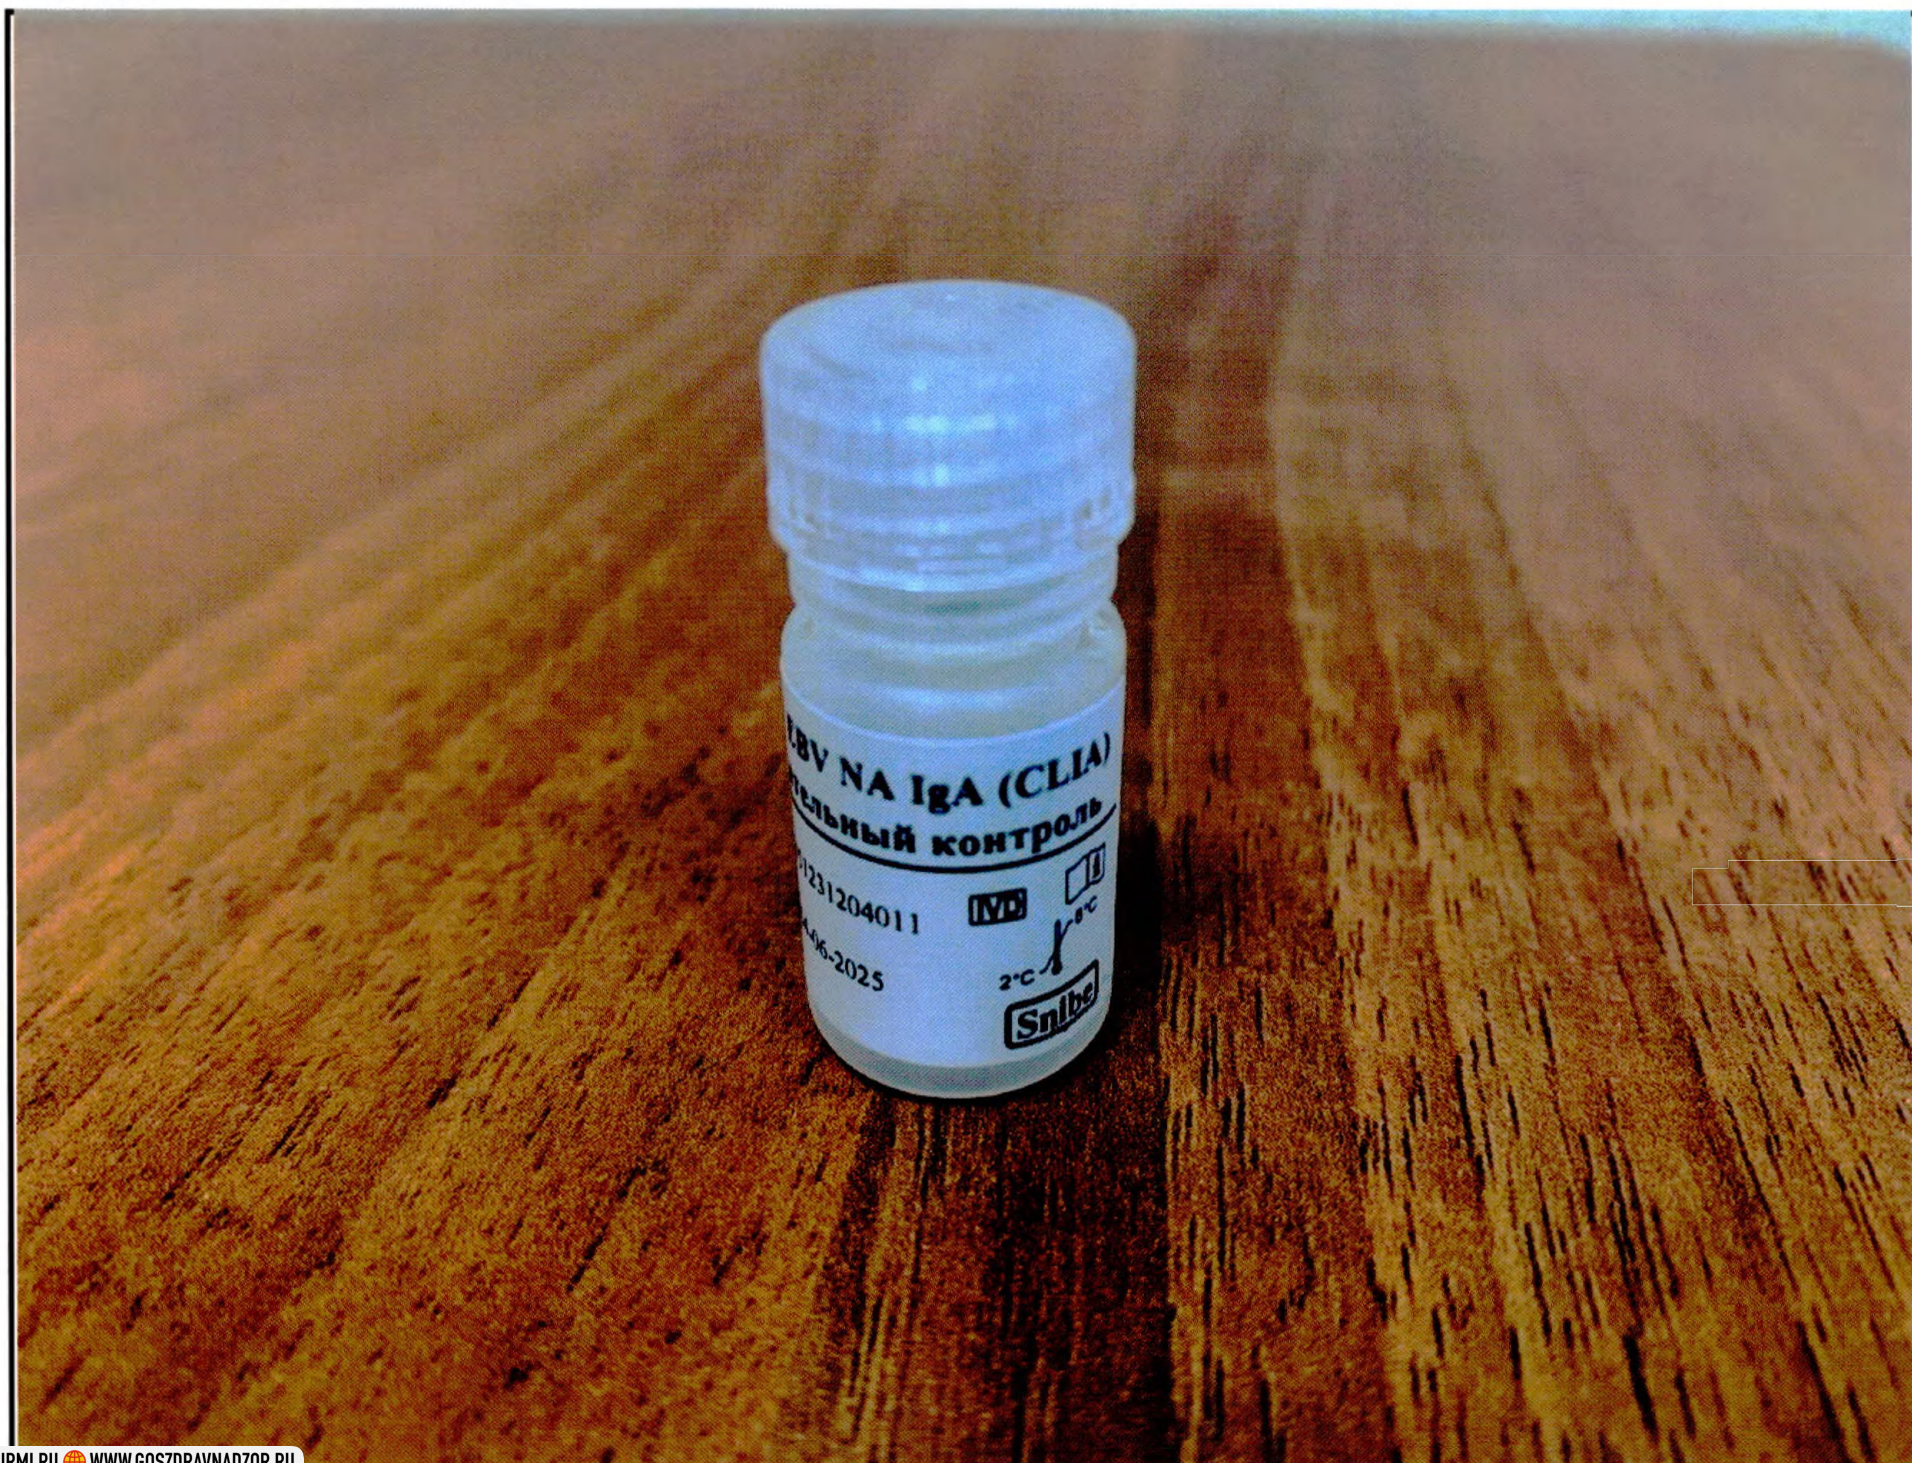

Положительный контроль

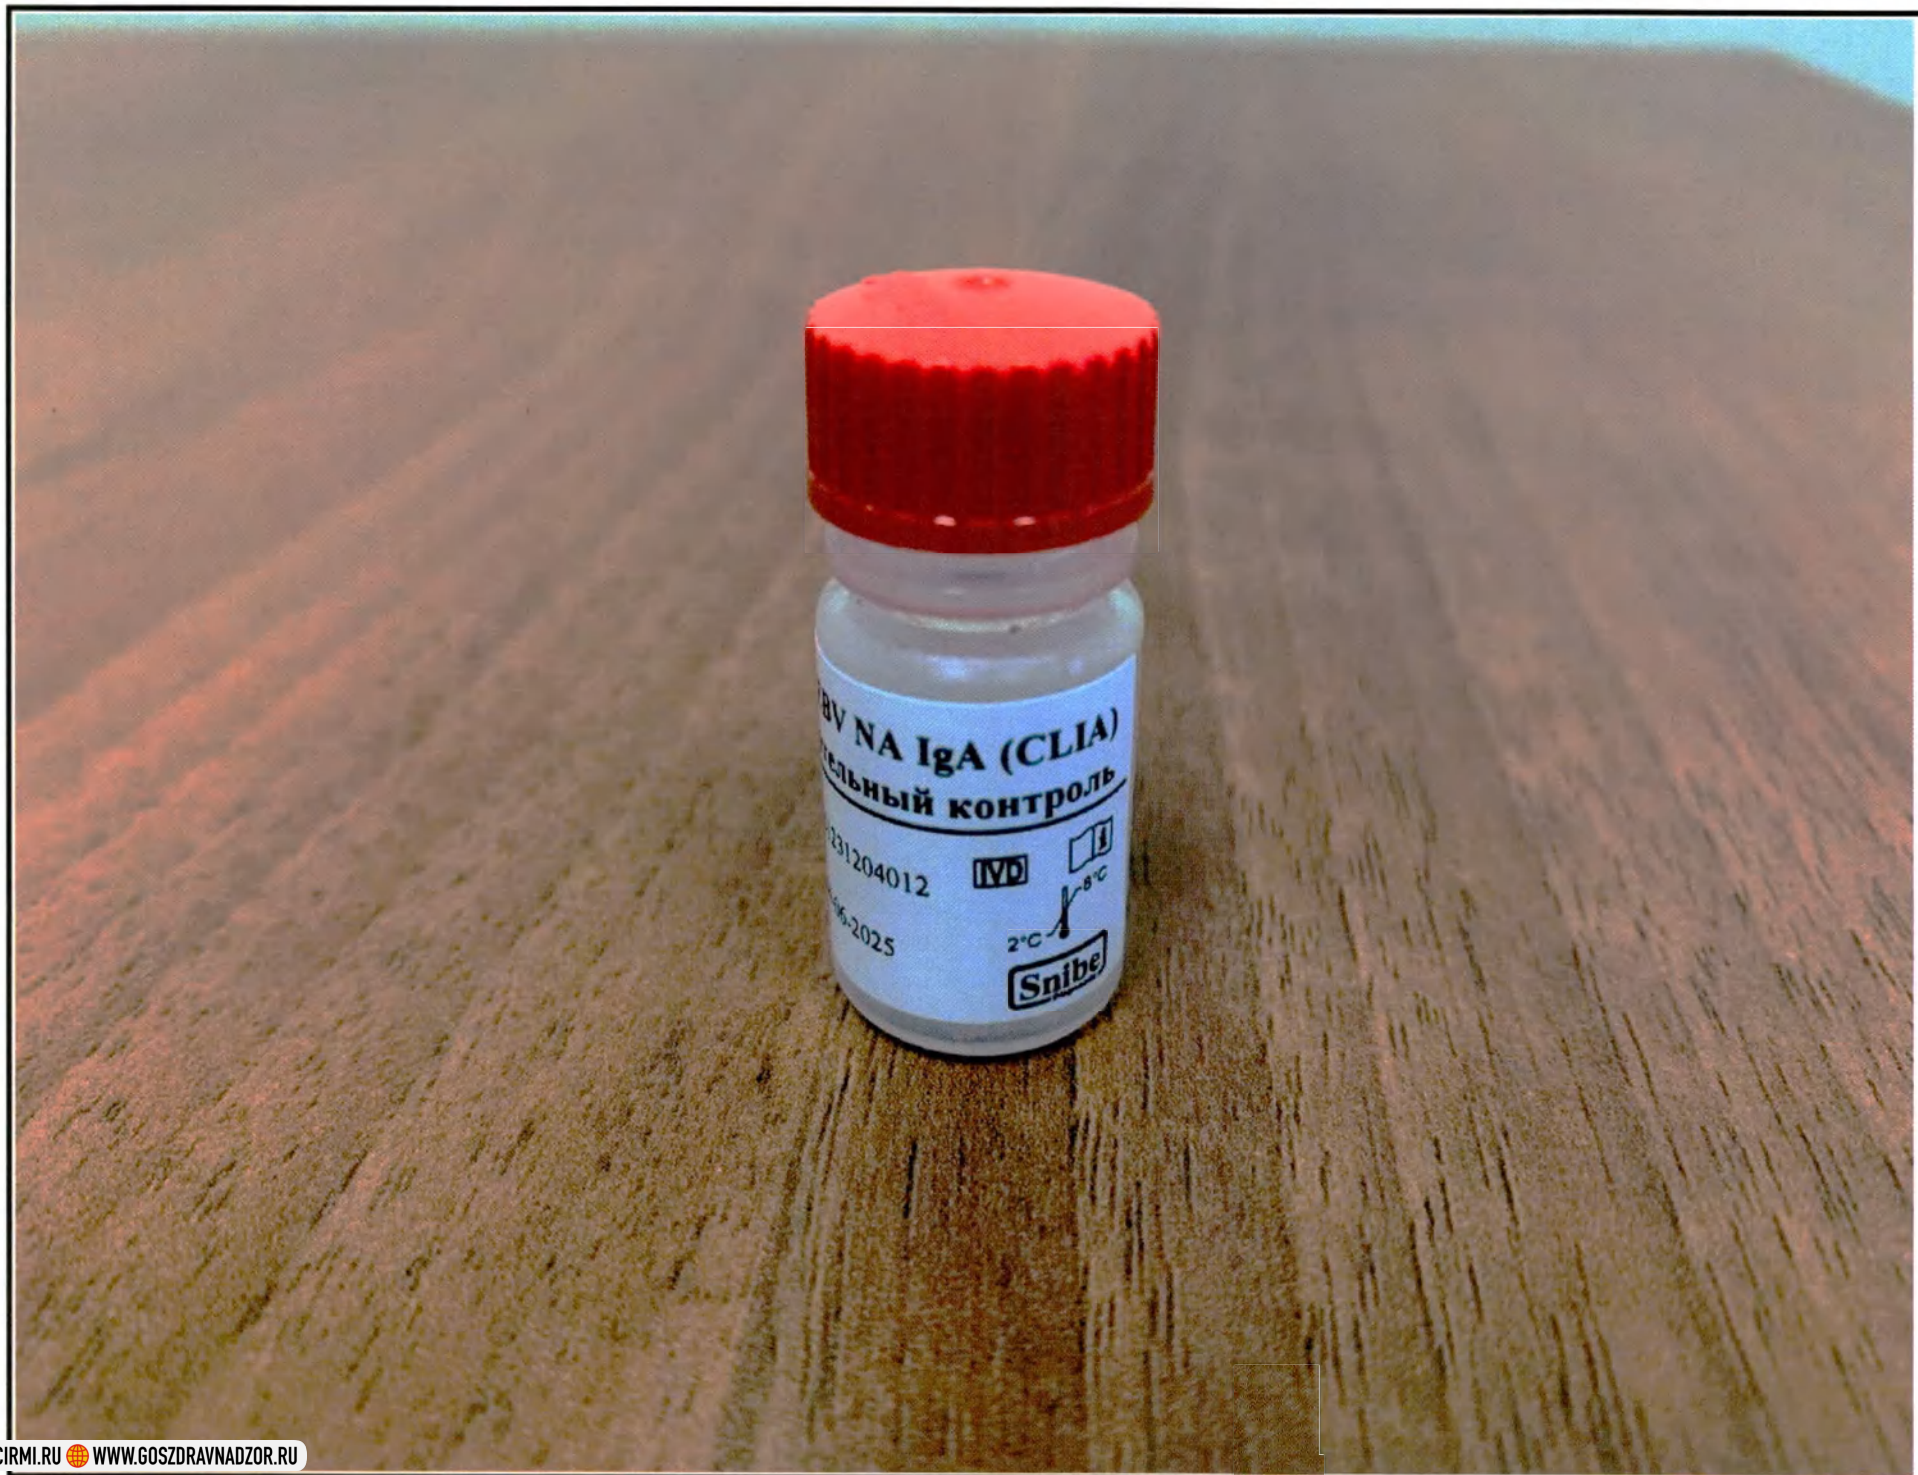

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

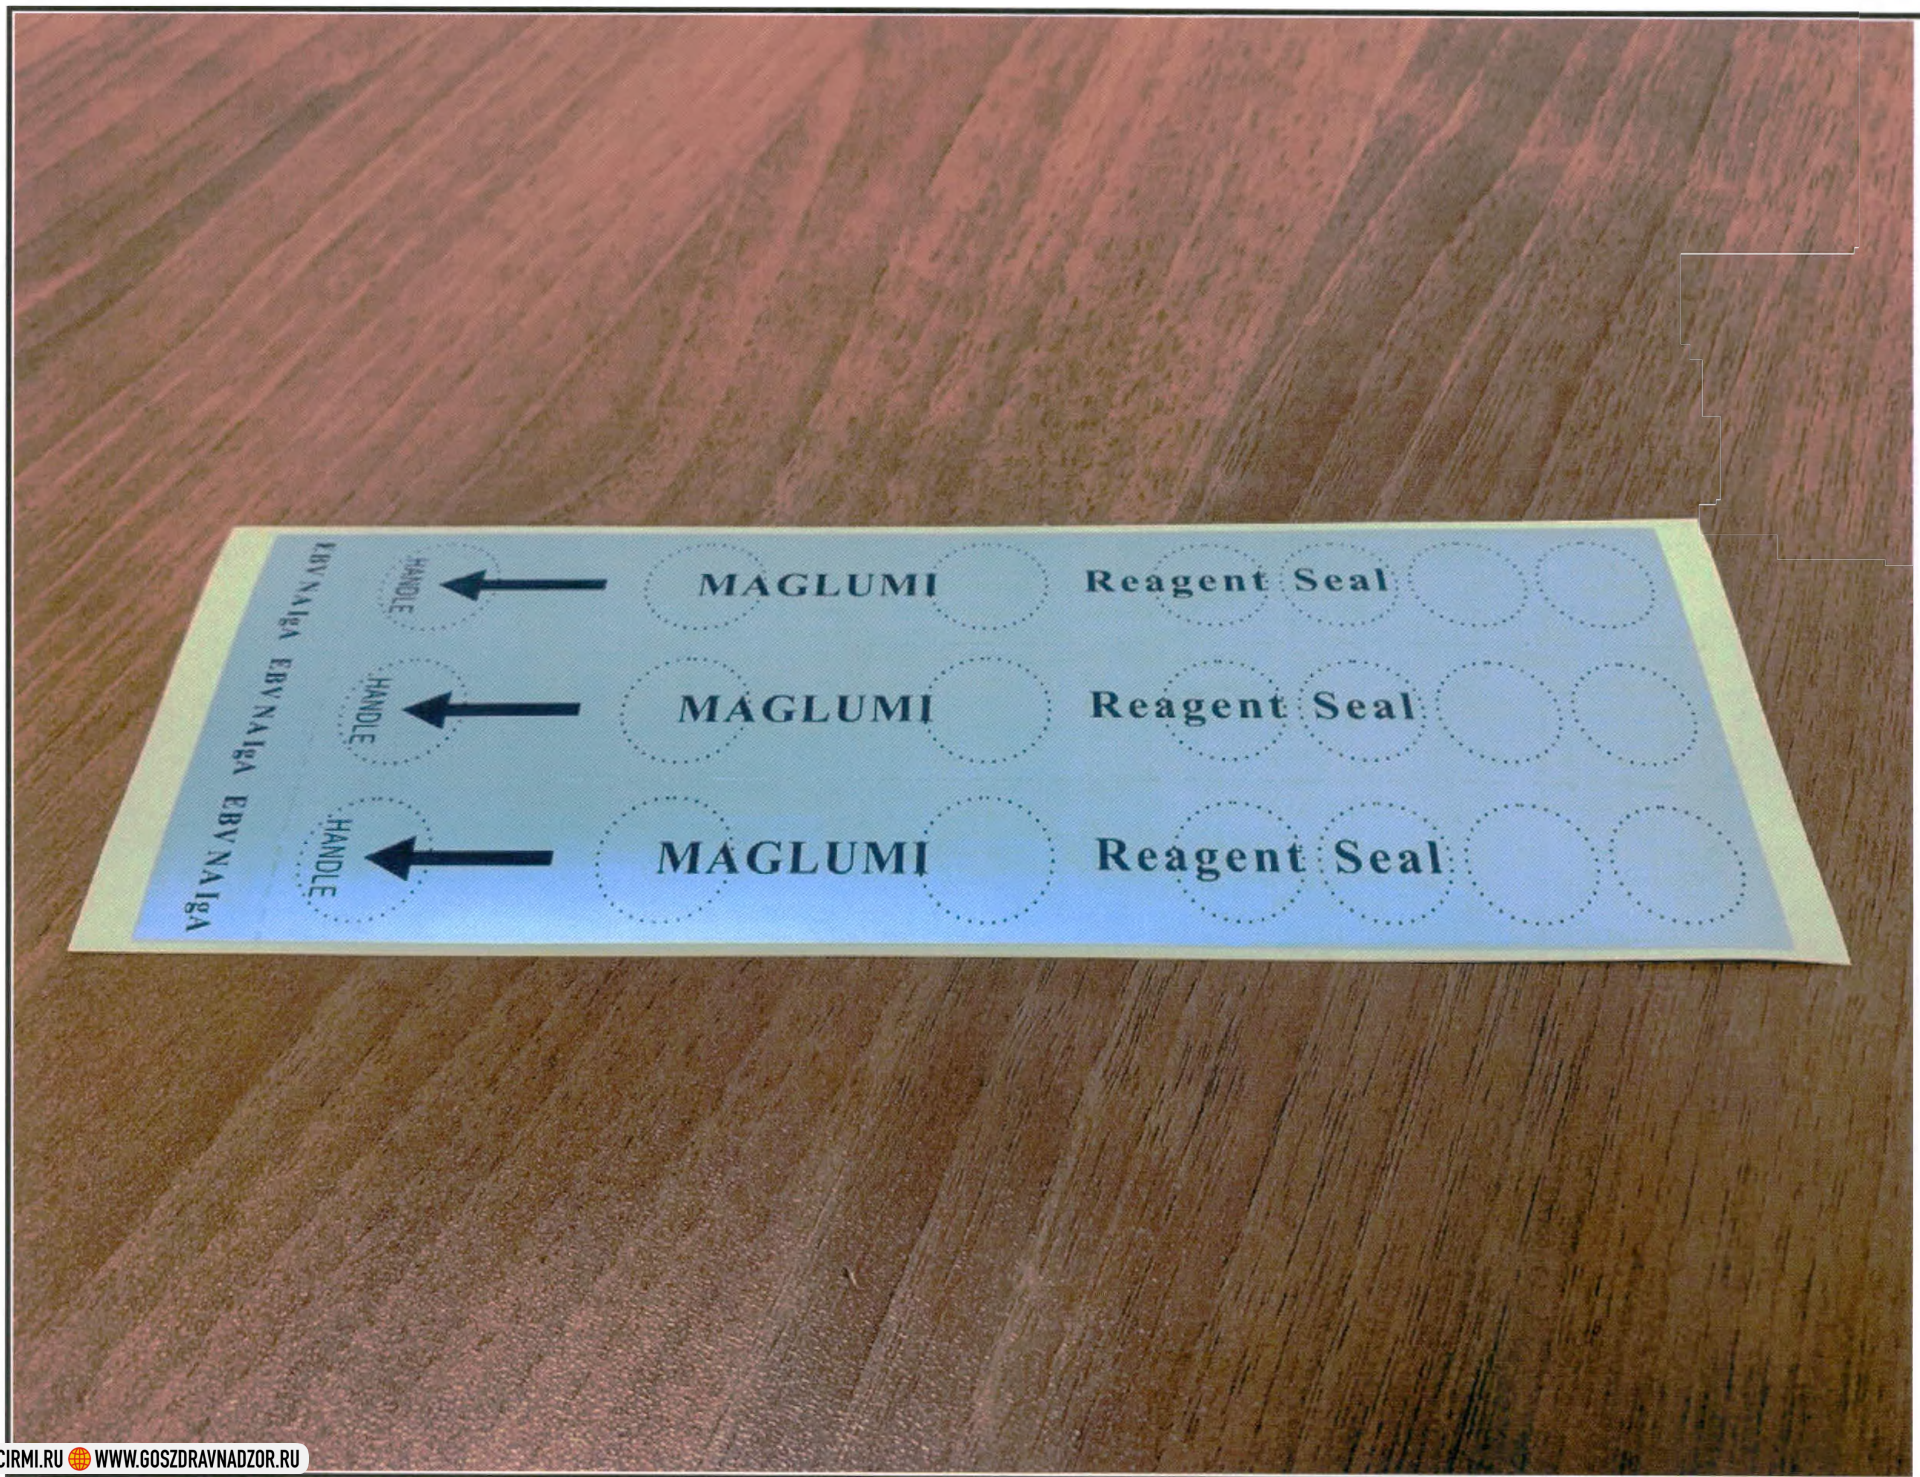

Наклейки со штрих-кодами для Отрицательного и Положительного контроля



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control




#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**




130265006M: 100 тестов
130665006M: 50 тестов
130765006M: 30 тестов


Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

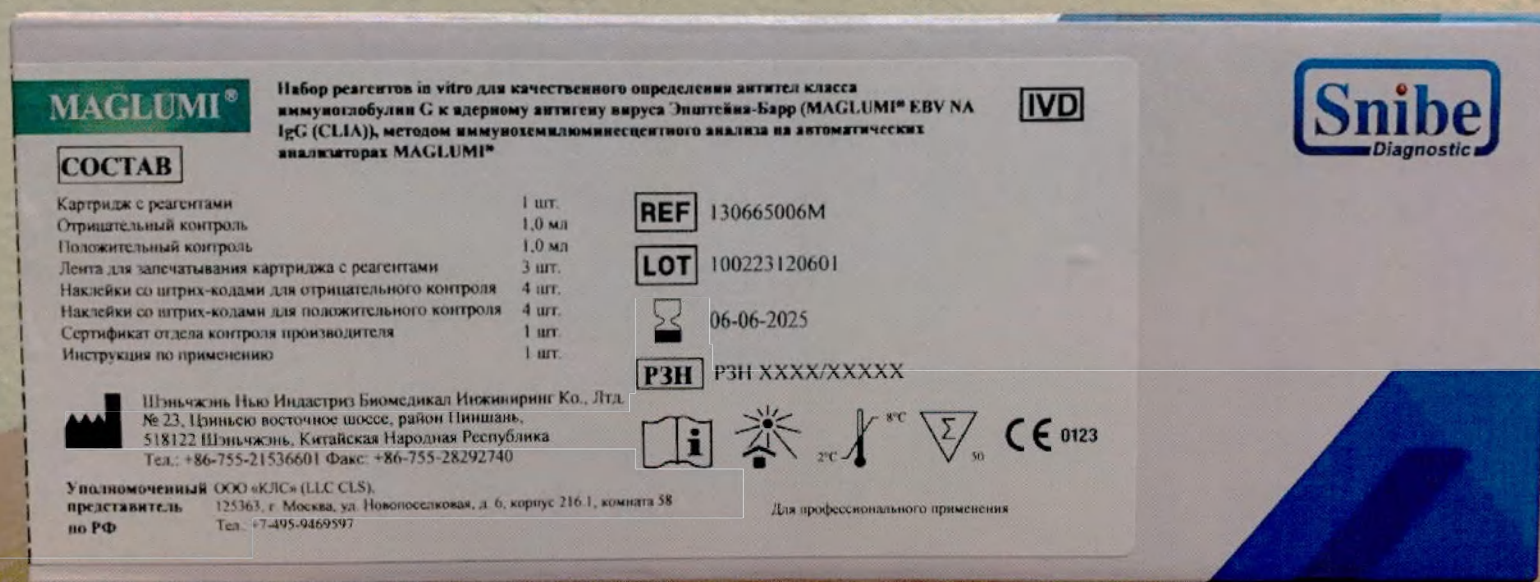

Маркировка потребительской упаковки Вариант исполнения 2 (50 тестов)

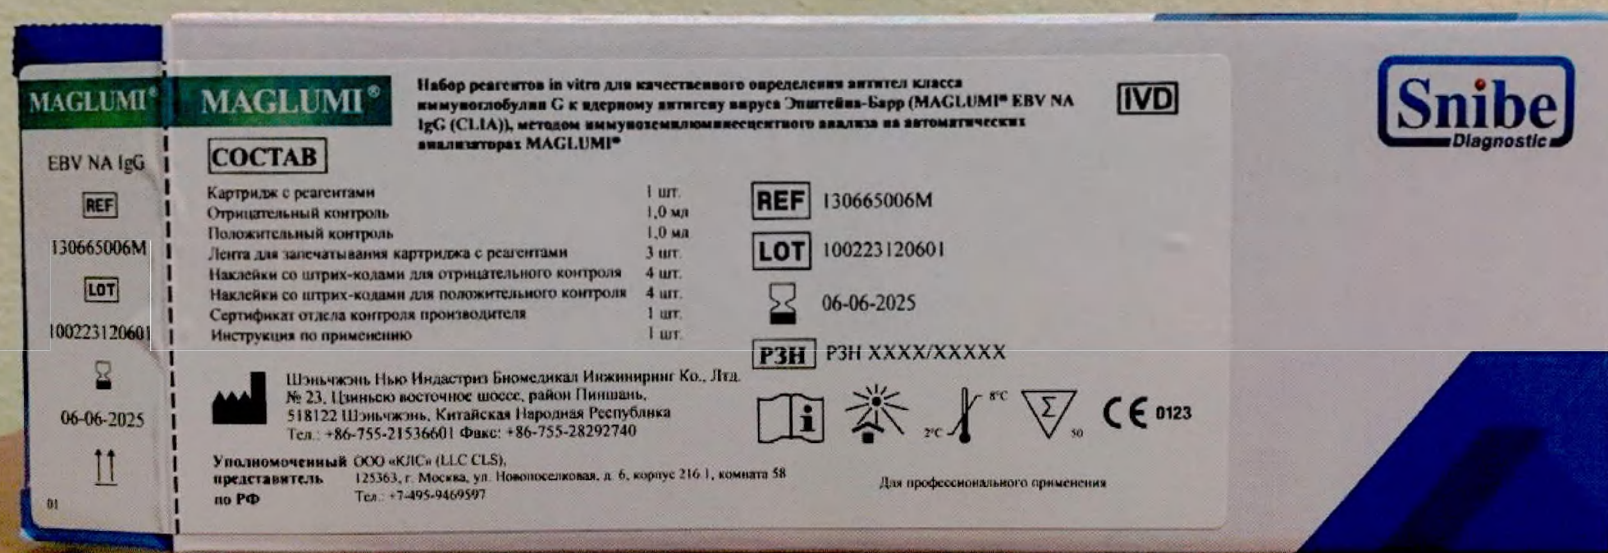

Вариант исполнения 3

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 100 тестов, в составе:


Картридж с реагентами




Отрицательный контроль



Положительный контроль

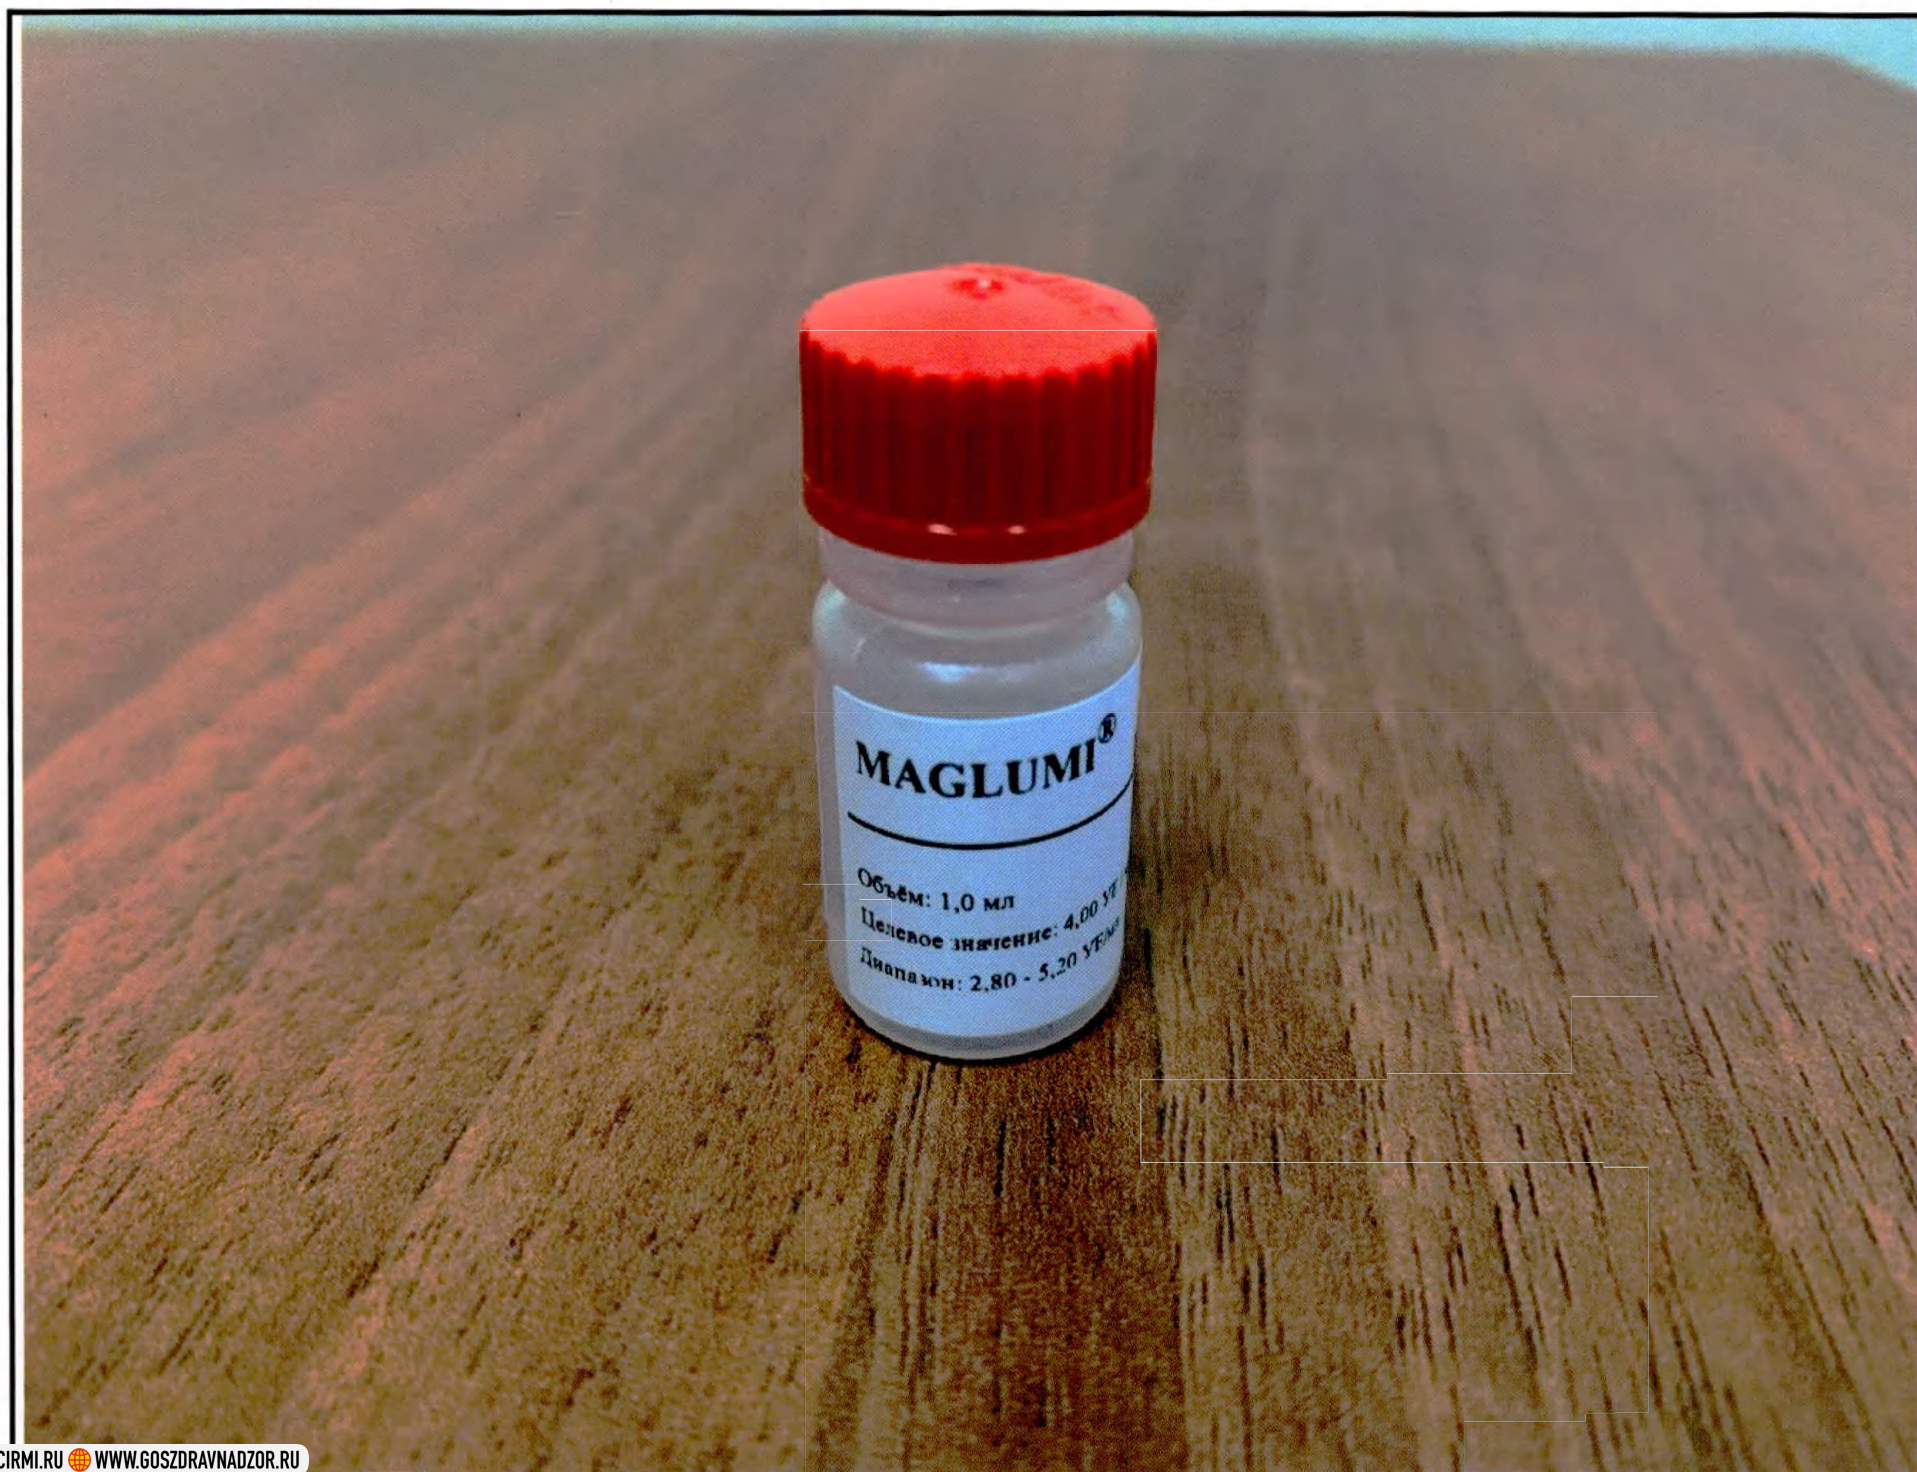

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

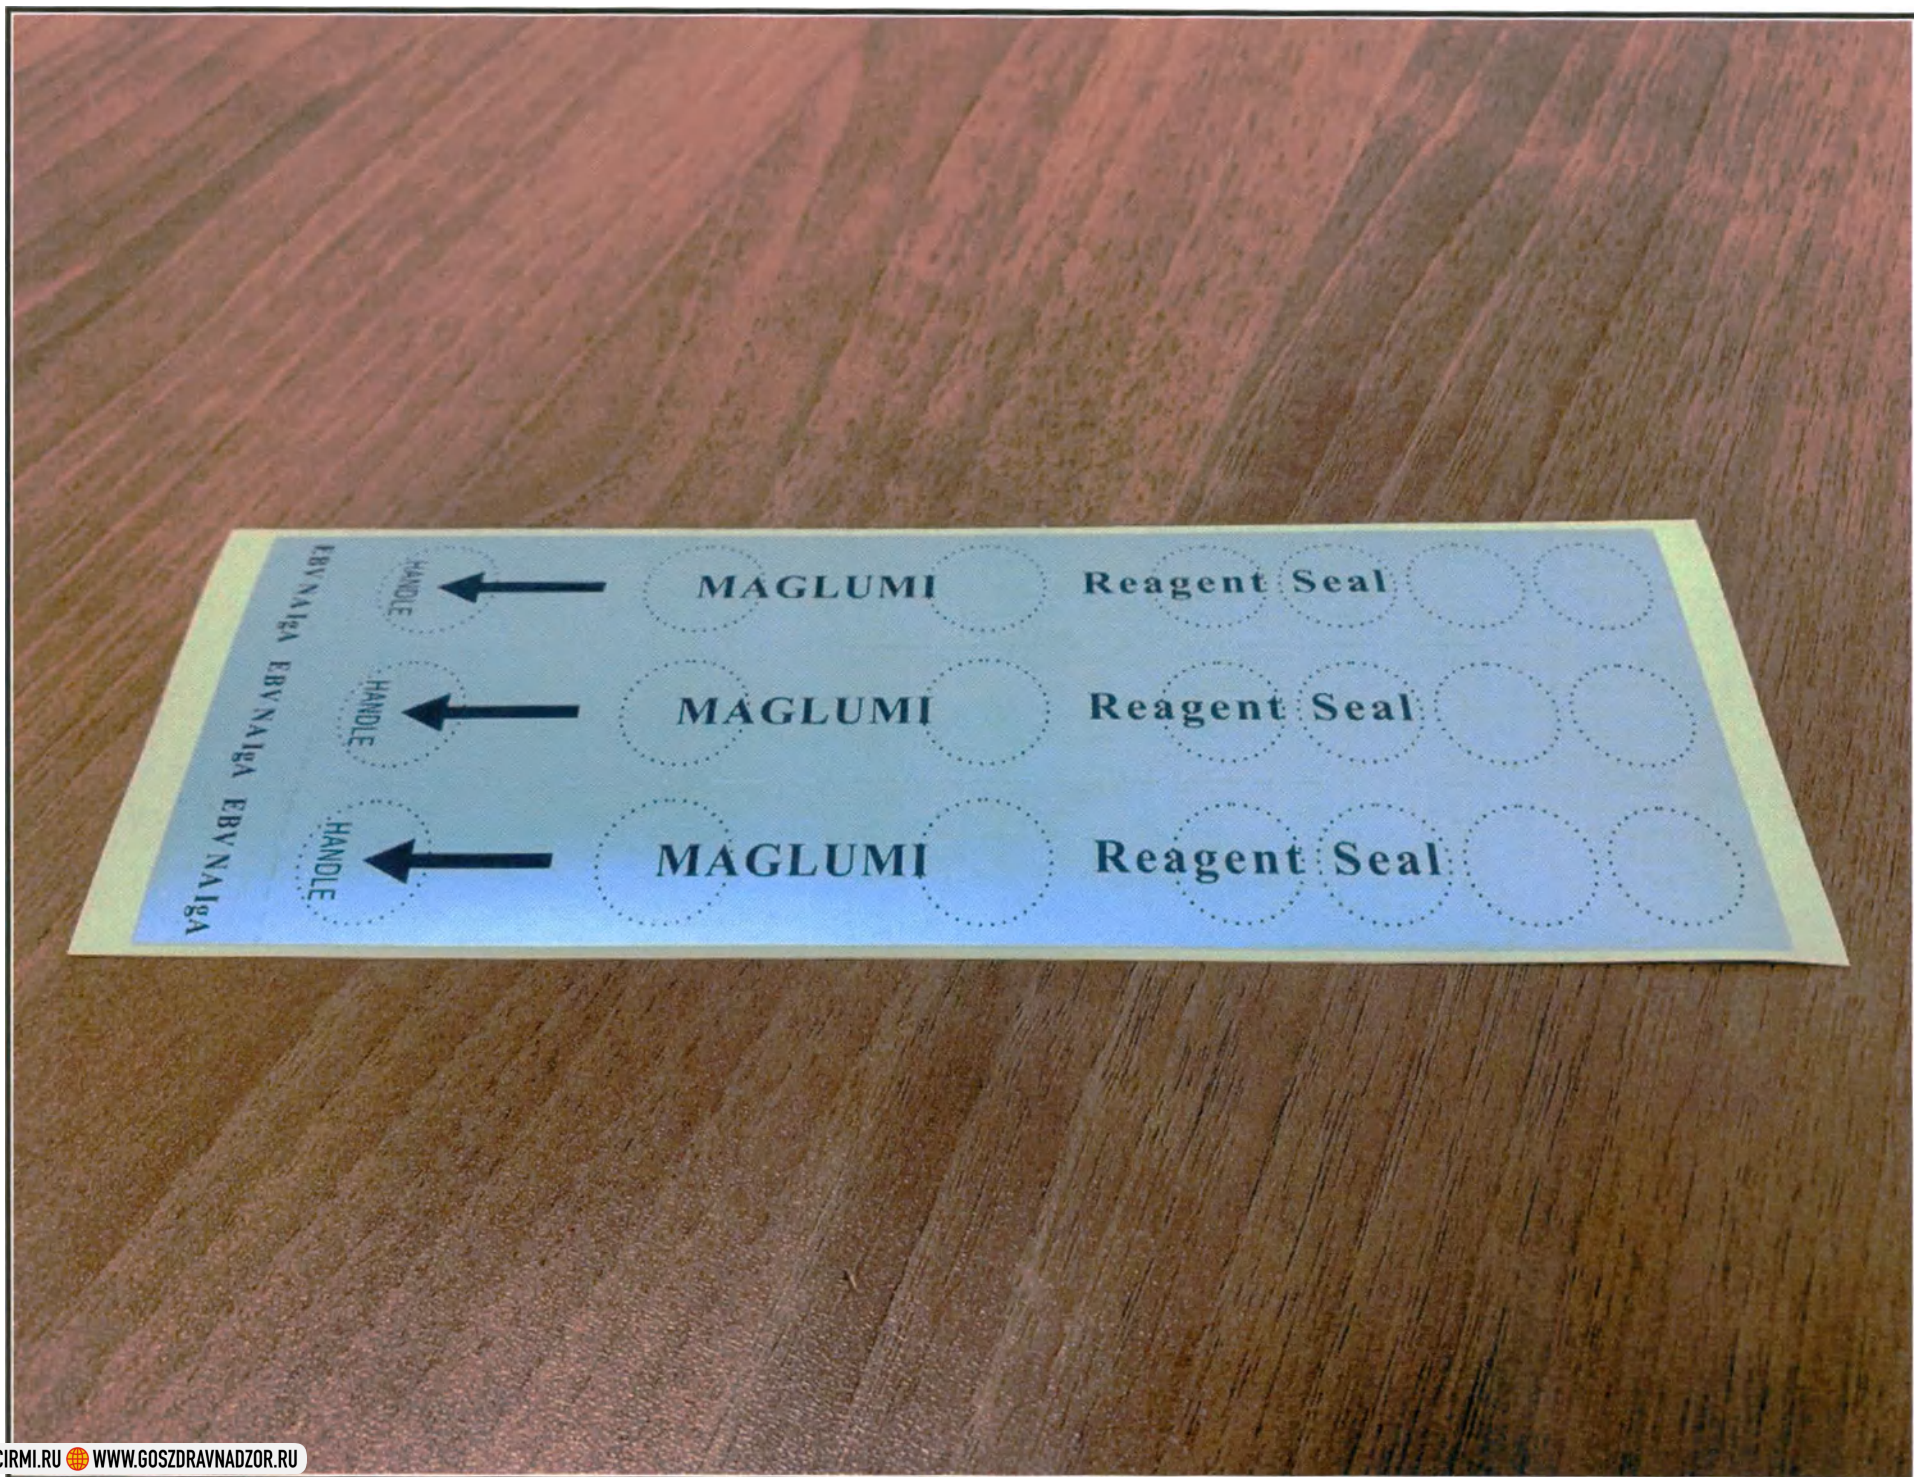

Наклейки со штрих-кодами для Отрицательного и Положительного контроля



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204012#
EBV NA IgA Positive Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control



#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control




#451231204011#
EBV NA IgA Negative Control

CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**





130265006M: 100 тестов
130665006M: 50 тестов
130765006M: 30 тестов

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (MAGLUMI® EBV NA IgG (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса иммуноглобулин G к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (EBV NA IgG) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики вирусной инфекции Эпштейна-Барр, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

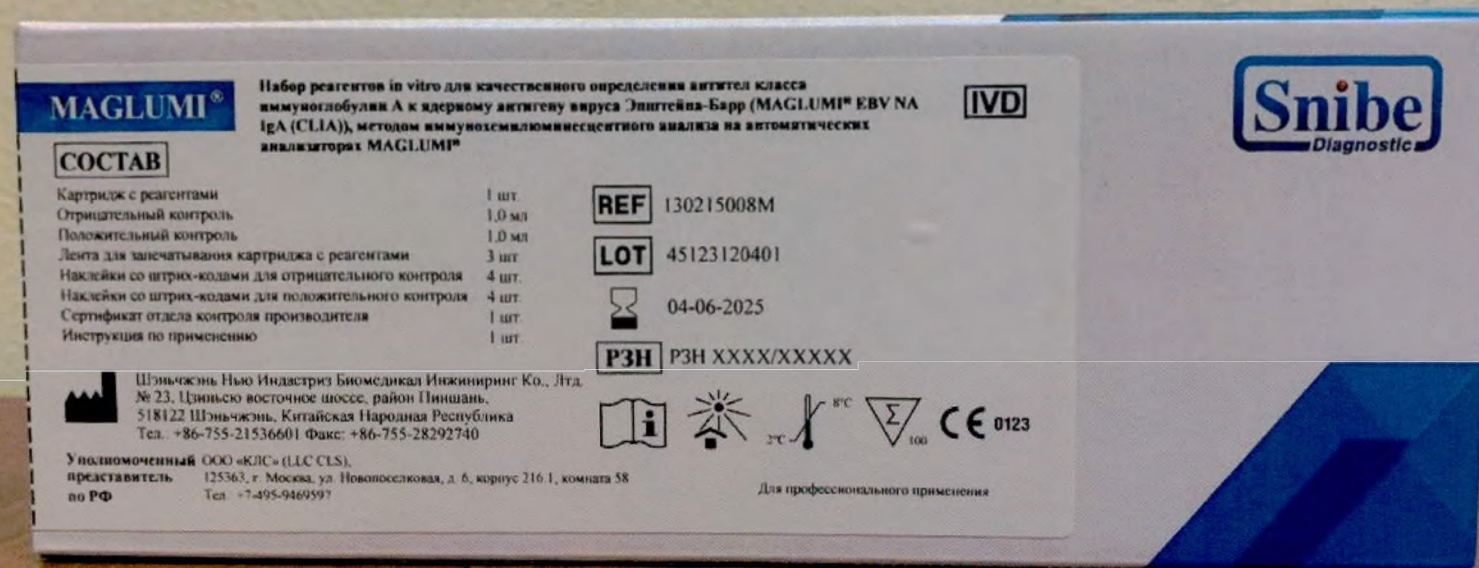

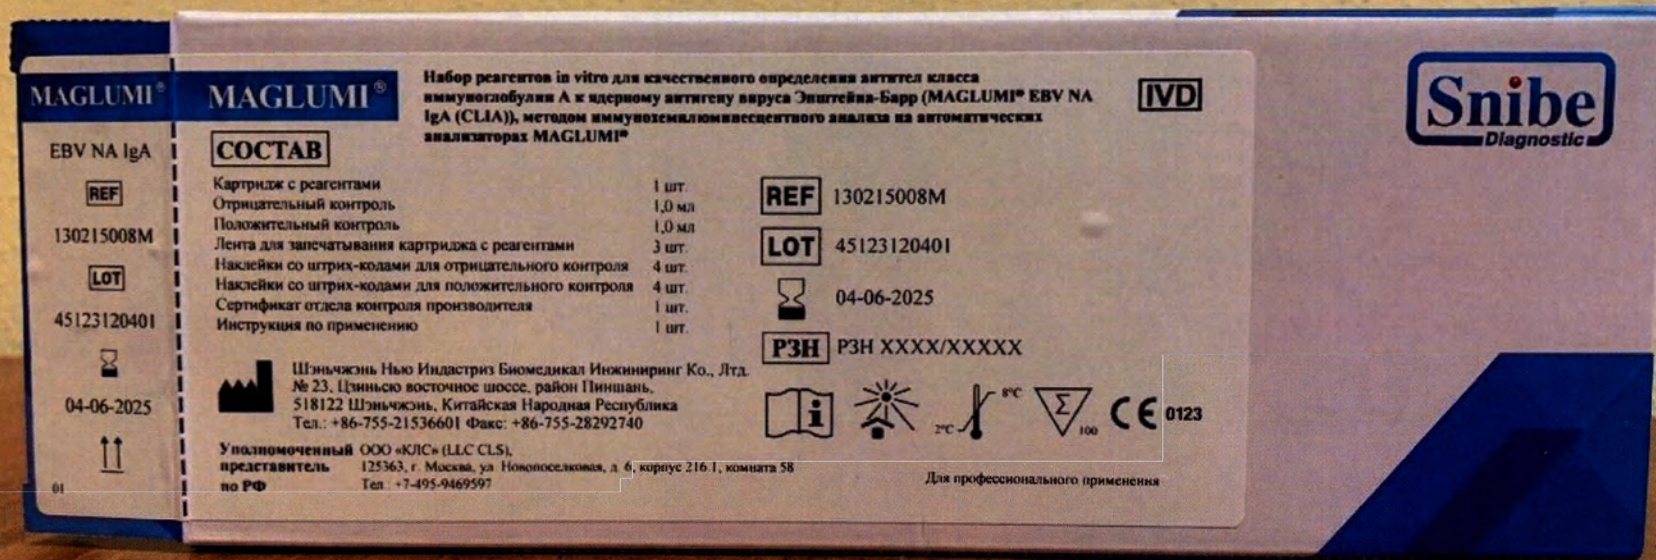

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО «
СКРЕПЛЕНО 32 ЛИСТ«ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

