

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ Синтол»

А.В. Кузубов

«11» ноября 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2,
вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*) методом
полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»
LOT 070824, LOT 080824

Содержание

Наименование фото	Стр.
1. Форма выпуска 1, LOT 070824	
1.1 Общий вид набора в форме выпуска 1	3-5
1.2 Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях, использующих метод магнитной сепарации «М-Сорб-НК» (общий вид)	6-7
1.2.1 Реагенты комплекта «М-Сорб-НК»	8-18
1.3 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (общий вид)	19-21
1.3.1 Реагенты комплекта «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»	22-34
2. Форма выпуска 2, LOT 080824	
2.1 Общий вид набора в форме выпуска 2	35-37
2.2 Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях, использующих метод магнитной сепарации «М-Сорб-НК» (общий вид)	38-39
2.2.1 Реагенты комплекта «М-Сорб-НК»	40-50
2.3 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (общий вид)	51-53
2.3.1 Компоненты (реагенты и оптическая пленка) комплекта «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»	54-67
3. Форма выпуска 3, LOT 070824	
3.1 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (общий вид)	68-69
3.2 Реагенты комплекта «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»	22-34
4. Форма выпуска 4, LOT 080824	
4.1 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (общий вид)	70-71
4.2 Компоненты (реагенты и оптическая пленка) комплекта «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»	54-67

SCINTOL

REF OOM-505-140

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

ФОРМА ВЫПУСКА 1

Комплект реагентов для выделения РНК рутинным способом и на автоматизированных станциях, использующих метод капиллярной системы «M-CapB-100»

	1 шт
Лизирующий раствор, ЛОР	50 мл 1 флакон
Сорбирующий раствор, СР	4 мл 1 флакон
Промывочный раствор, ПР	65 мл 1 флакон
Элюирующий раствор, ЭР	18 мл 1 флакон
Отрицательный контрольный образец, ОК0	1 мл 1 пробирка

Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

	1 шт
Реакционная смесь, РС-CoV-2-FluA/B	96 микропробирок
Разбавитель, РБ	1,6 мл 1 пробирка
Положительный контрольный образец ПКО-CoV-FluA/B	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения, ВПК-РВ	1 мл 1 пробирка
Отрицательный контрольный образец, ОК0	1 мл 1 пробирка
Инструкция по применению	1 штука
Паспорт качества	1 штука

070824
 08.2024
 08.2026

ООО «НПФ Синтол»
 Российская Федерация, 125499, г. Москва,
 Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом.1 кон.43/РМ 12-3
 e-mail: syntol@syntol.ru www.syntol.ru Для профессионального применения
 № РЗН от

070824
 08.2024
 08.2026

ООО «НПФ Синтол»
 Российская Федерация, 125499, г. Москва,
 Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом.1 кон.43/РМ 12-3
 e-mail: syntol@syntol.ru www.syntol.ru Для профессионального применения
 № РЗН от

СИНТОЛ

00100M-505-140

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусы гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (форма выпуска 1)

Наименование компонента	Единица измерения	Количество	Наименование компонента	Единица измерения	Количество
Буферный раствор, БР	мл	10	Примесионы, ПР	мл	10
Смесь праймеров, СР	мл	1	Смесь праймеров, СР	мл	1
Смесь праймеров, СР	мл	1	Смесь праймеров, СР	мл	1
Смесь праймеров, СР	мл	1	Смесь праймеров, СР	мл	1
Смесь праймеров, СР	мл	1	Смесь праймеров, СР	мл	1

Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С
Срок годности: 12 месяцев
Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С

«СОСЛАВОВАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЦИРМИ»
А.В. Кузнецов
2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ФБУ «48 ЦОБ»
Минздрава России
С.В. Борисов
2024 г.

Медицинское изделие для диагностики in vitro
Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусы гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» LOT 070824, LOT 080824

ИНСТРУКЦИЯ по применению

СИНТОЛ
00100M-140

CoV-2-FluA/B-RT-PCR
PC-CoV-2-FluA/B
96 микропробирок

Таблица для диагностики in vitro




2. Технические характеристики

Наименование показателя	Норма	Результаты контроля
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует
Продолжительность хранения	12 месяцев при температуре от +2 до +8 °С	соответствует

Условия транспортировки: краткий транспорт (автоблочно), холодоцепом, либо воздушным при температуре от +2 до +8 °С. Длительный транспорт (авиатранспорт) при температуре от +2 до +8 °С. Длительный транспорт (авиатранспорт) при температуре от +2 до +8 °С.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С. Срок годности: 12 месяцев. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +2 до +8 °С. Срок годности: 12 месяцев.

Начальник отдела ОТК
С.В. Борисов

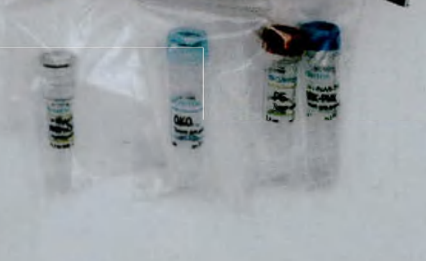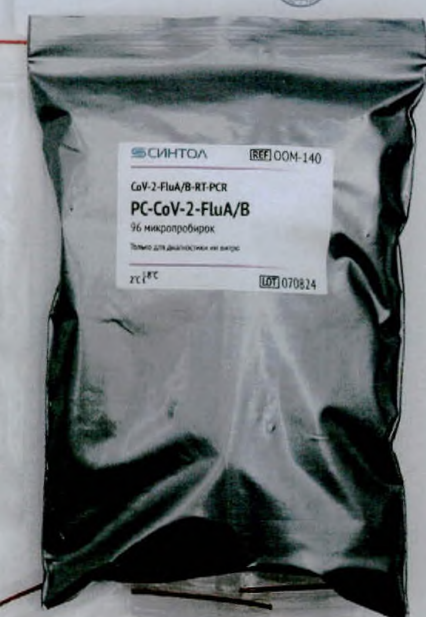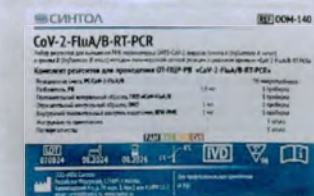












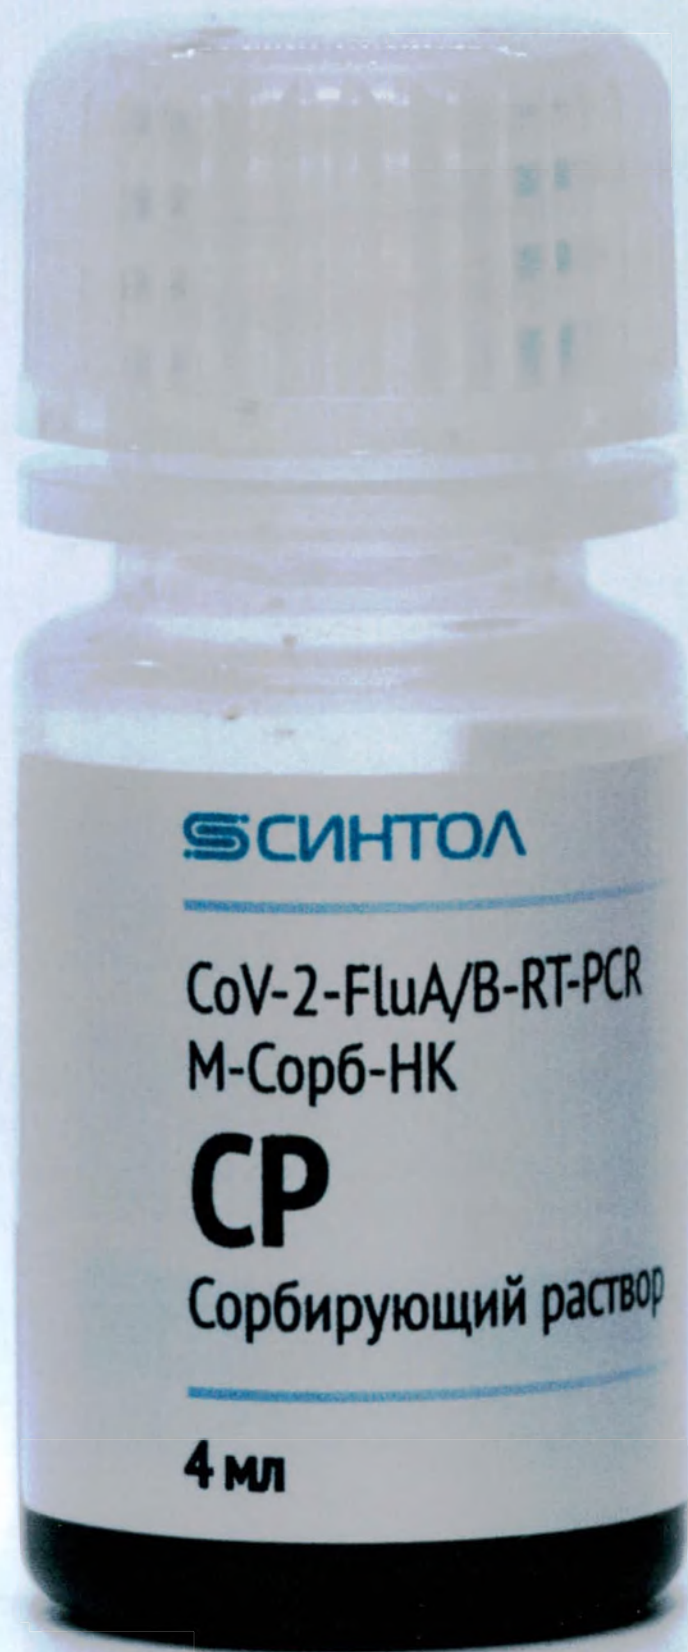





18

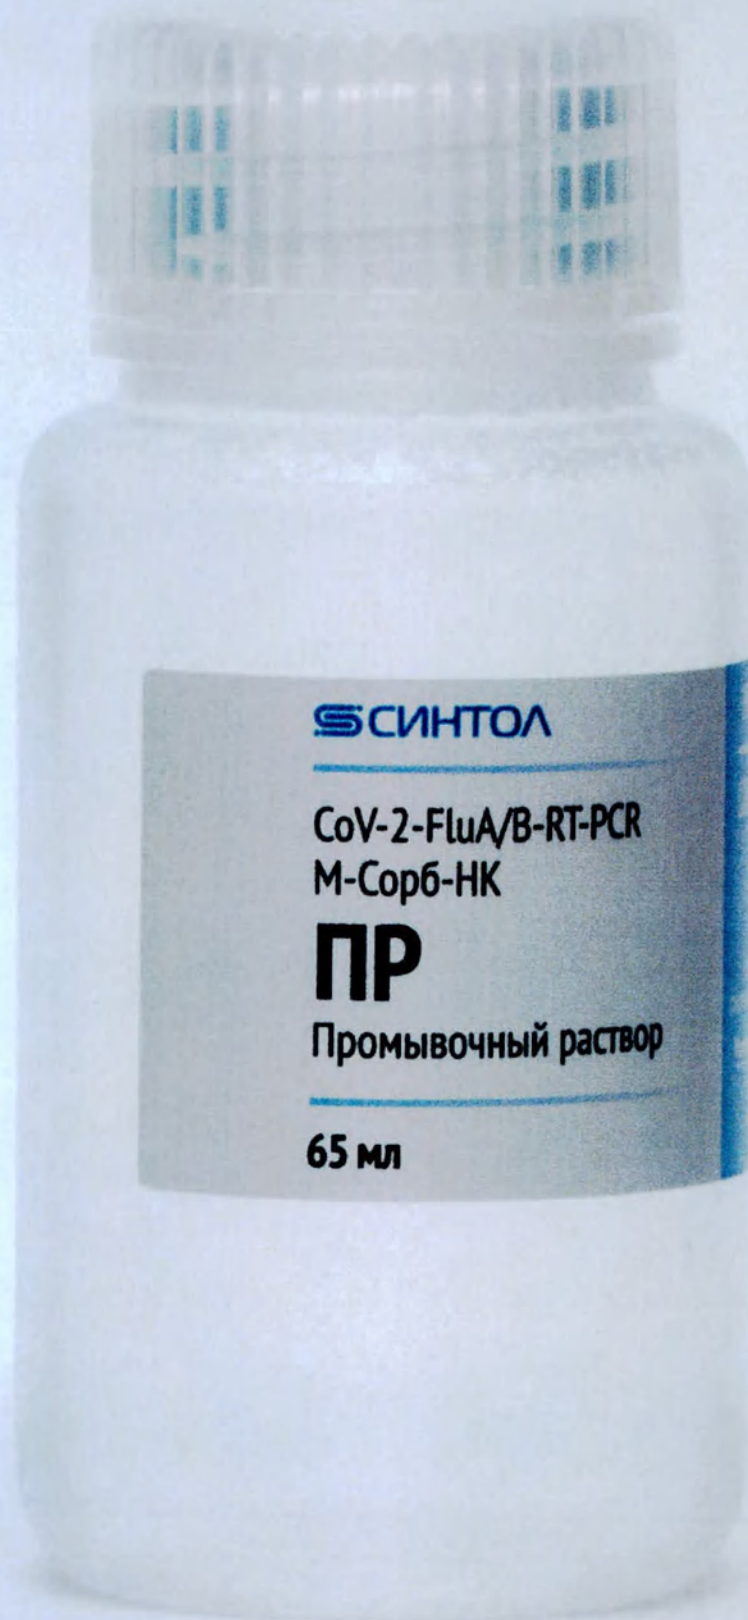

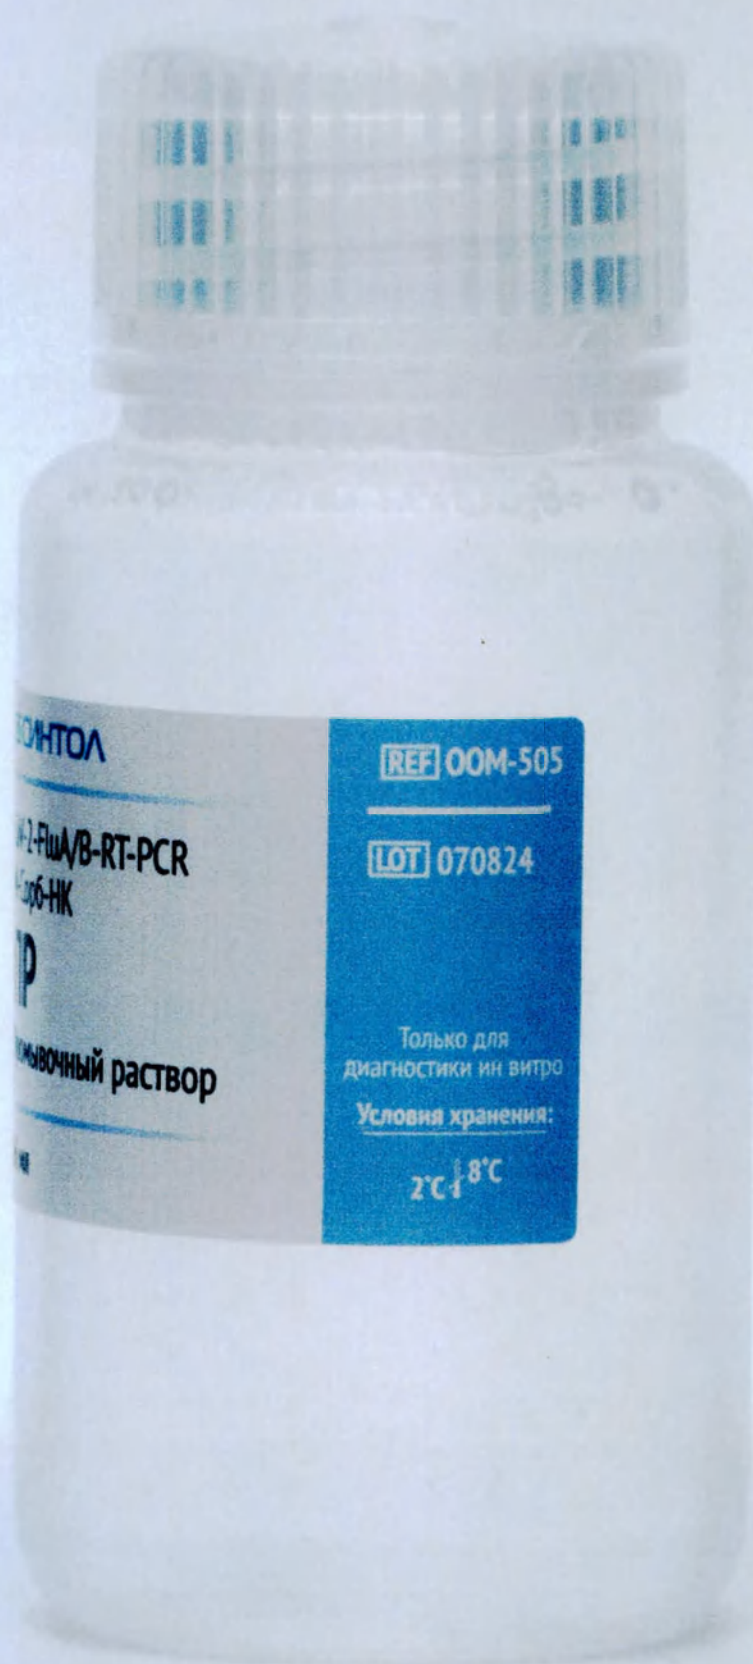

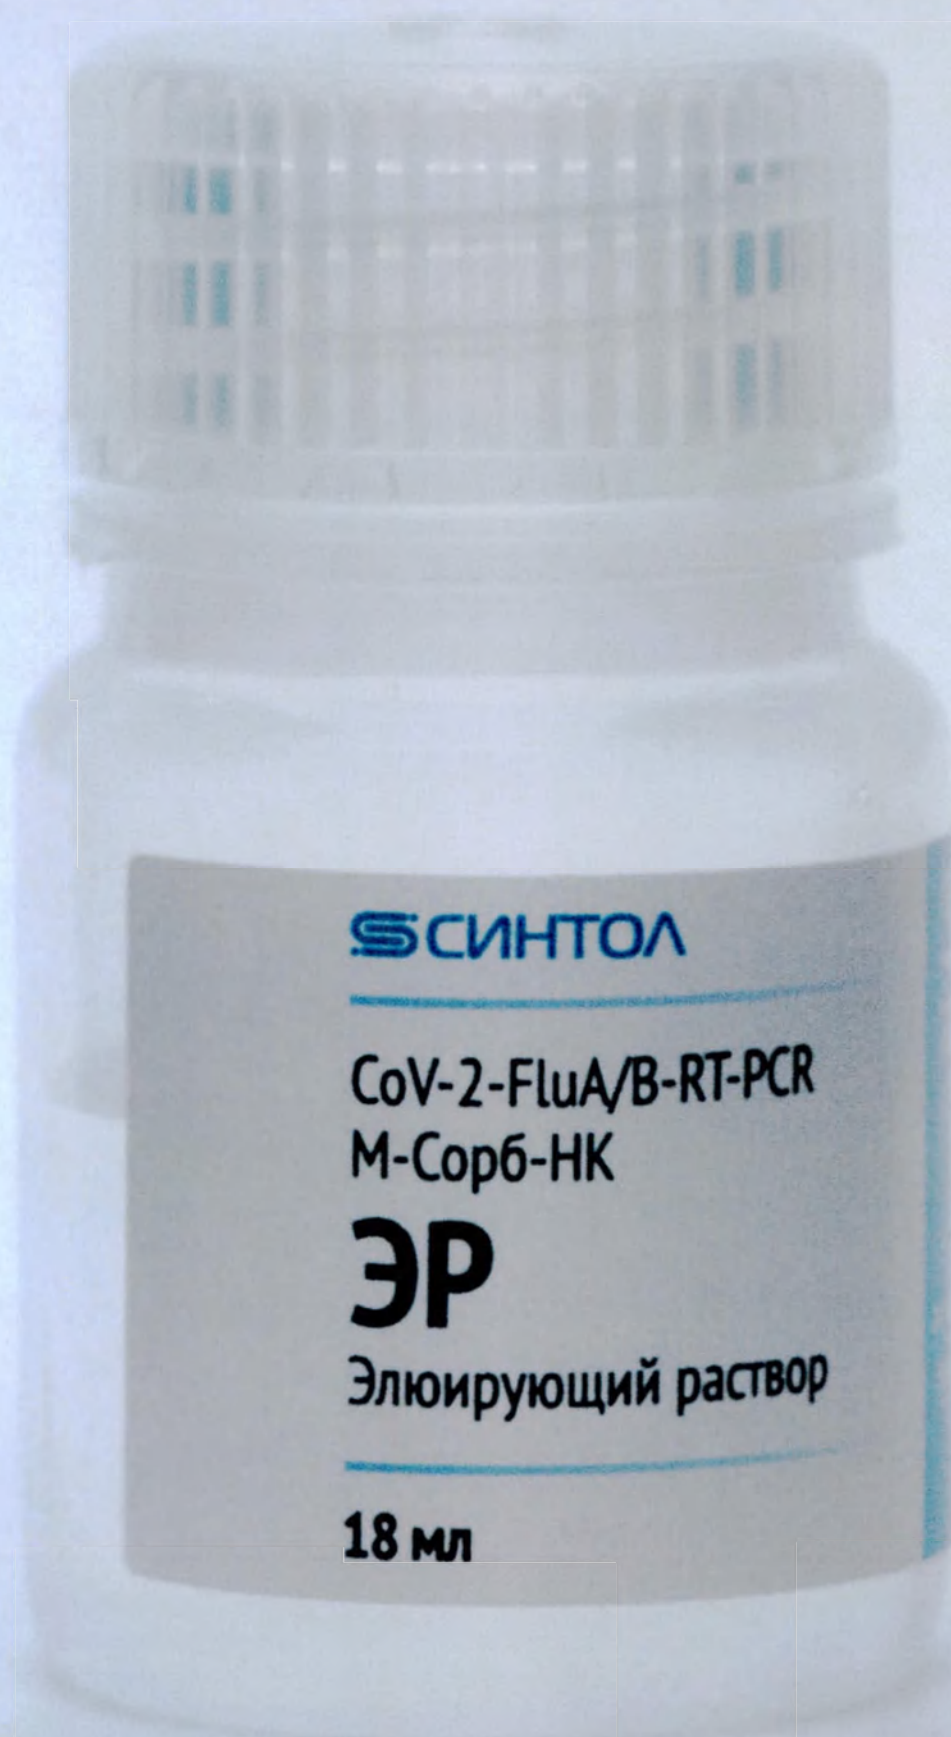

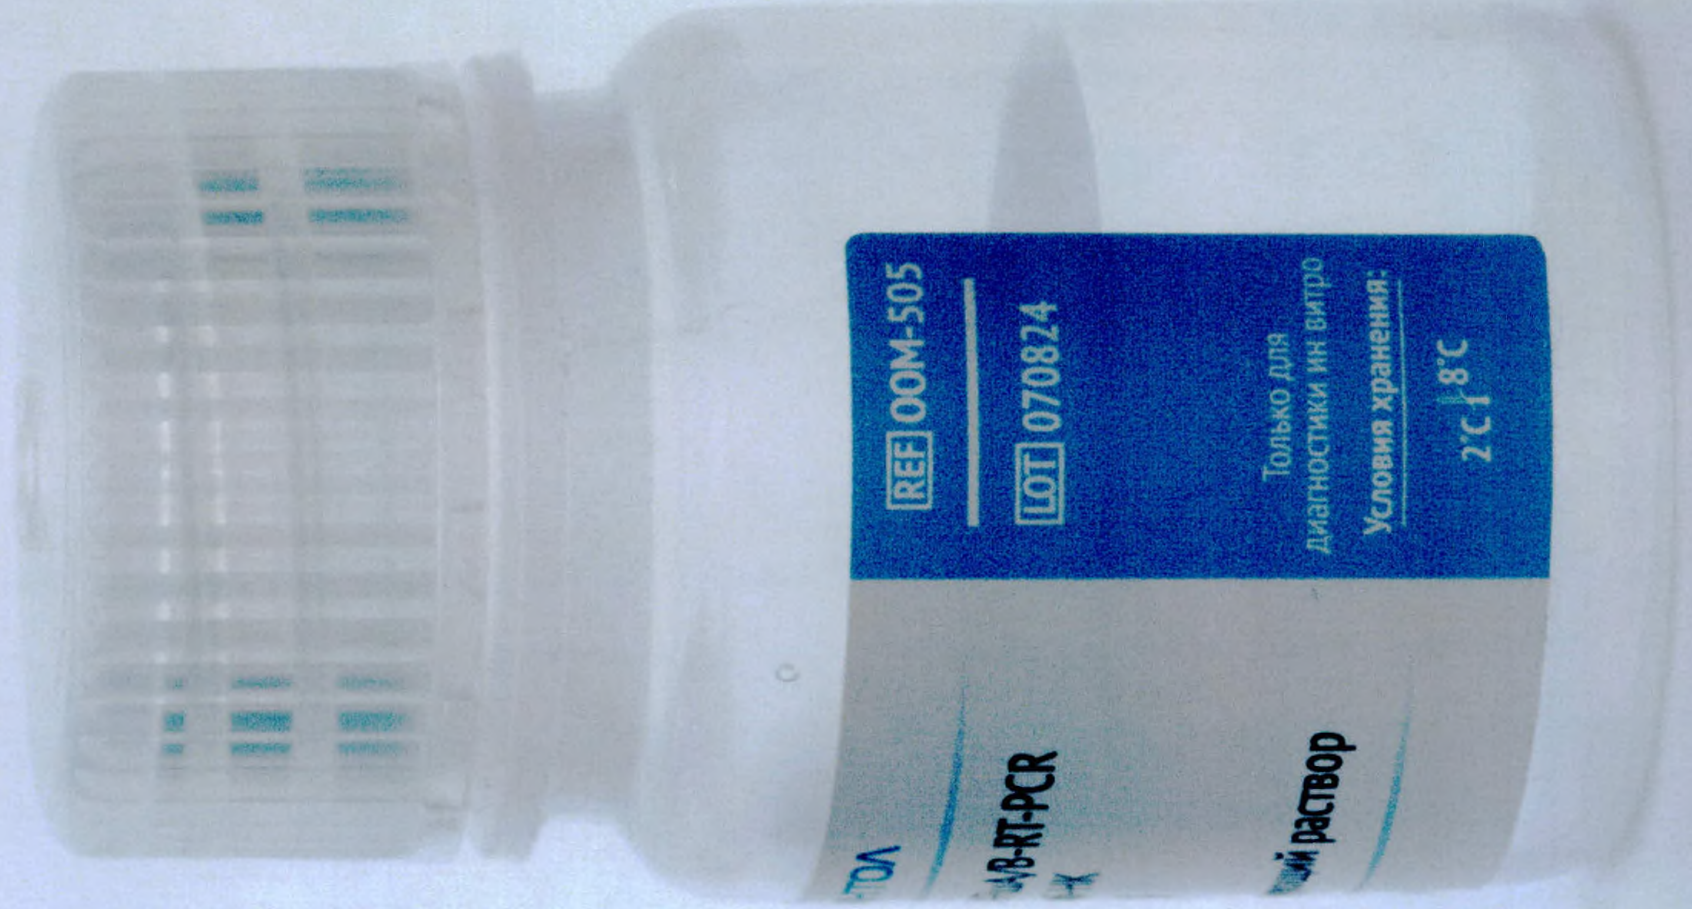

15





17



«СТІЛІСКОБІД»
 Топівський завод
 ООО «ДІП»
 Чумаки
 А. В. Крюков
 2024 г.

«СТІЛІСКОБІД»
 Топівський завод
 ООО «ДІП»
 Чумаки
 А. В. Крюков
 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ ПО ЗАПРОСУ ОТ АВТОРА


Набор препаратов для исследования ПИД: коронавирус SARS-CoV-2, андротс группа А (*Influenza A virus*) и группа В (*Influenza B virus*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA-BT-PCR LOT 070824, LOT 080824

ИНСТРУКЦИЯ по применению

2024

[illegible]



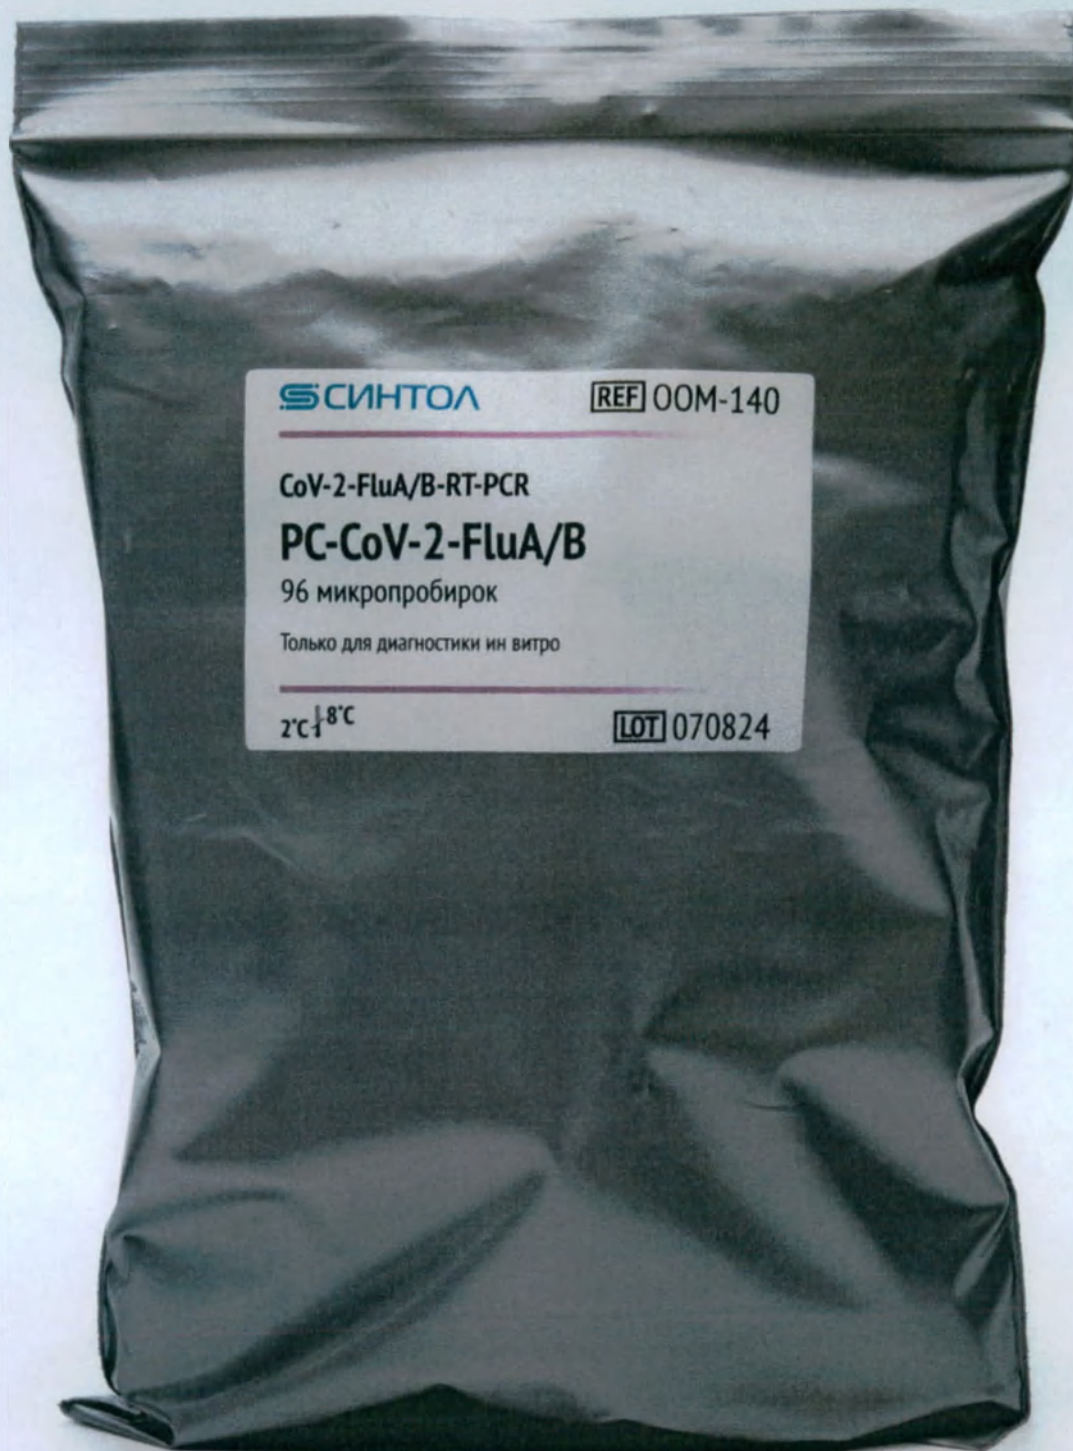

SCINTOL

REF OOM-140

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

PC-CoV-2-FluA/B

96 микропробирок


Только для диагностики ин витро

2°C → 8°C


LOT 070824

23



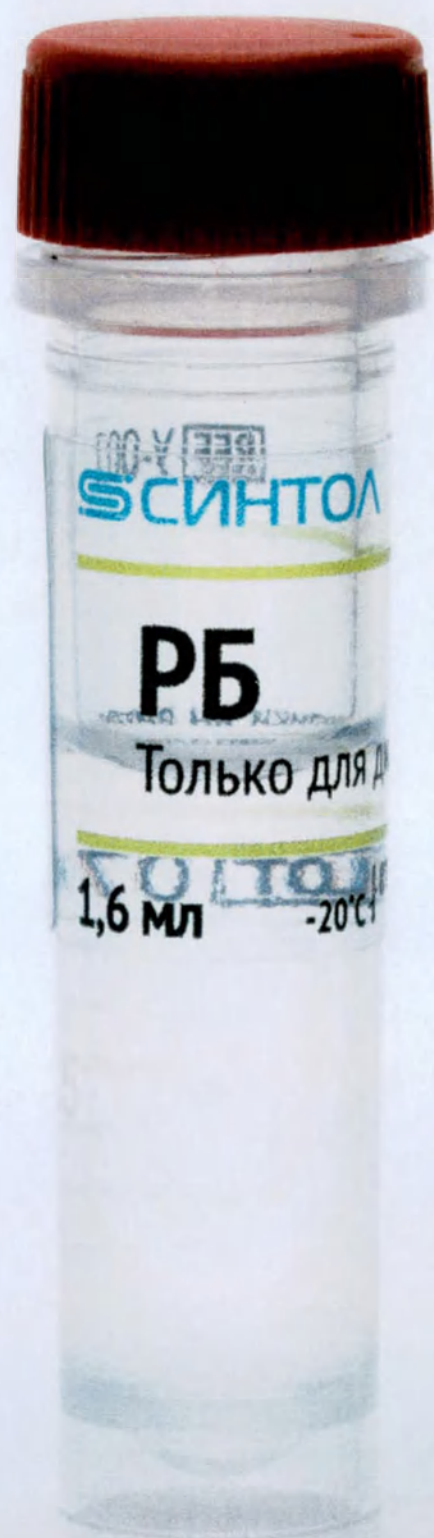





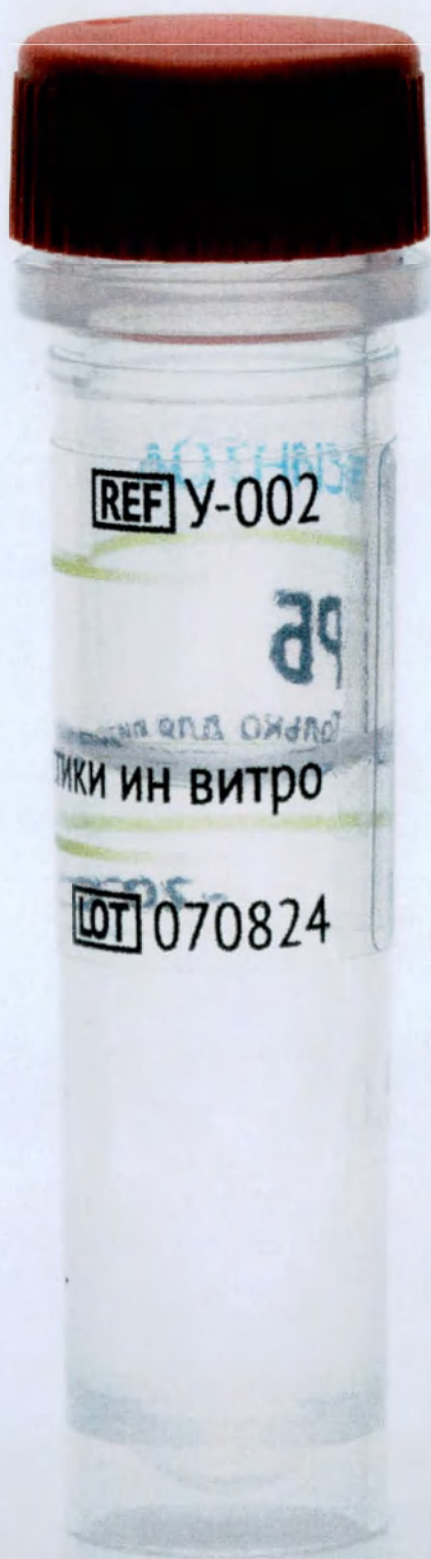




27

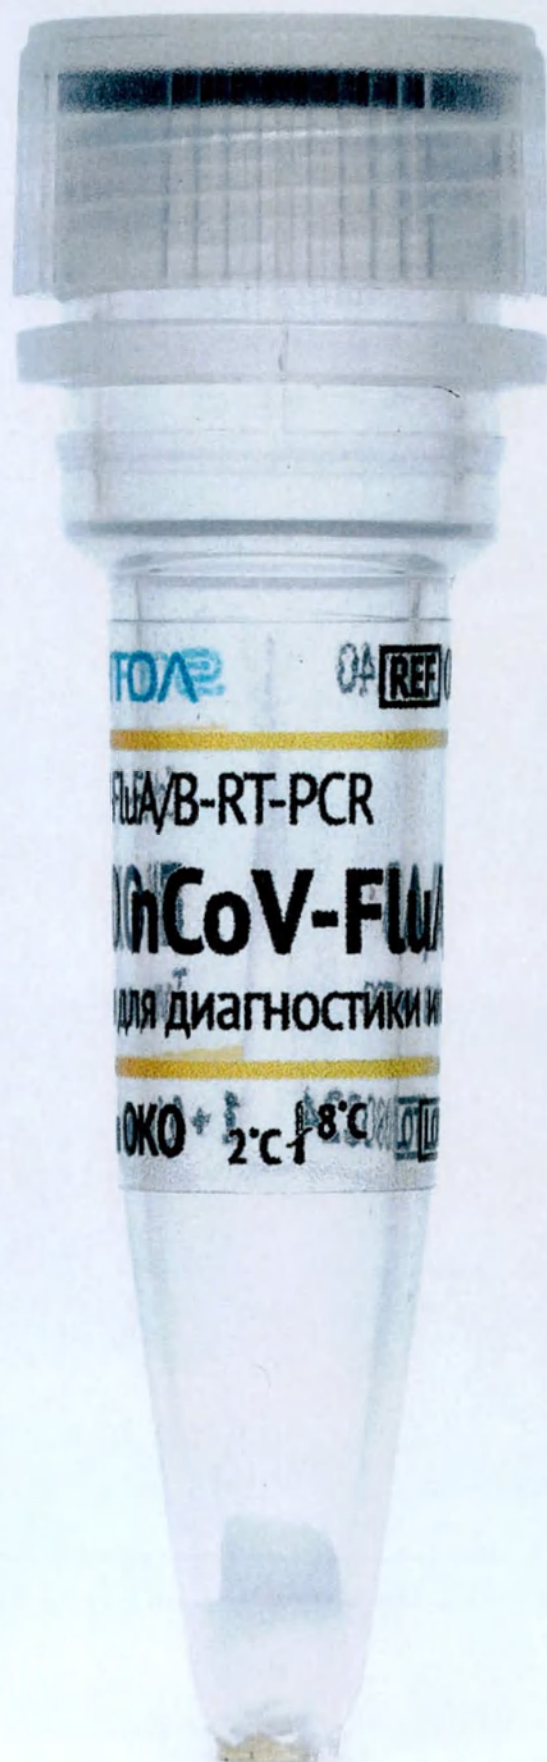

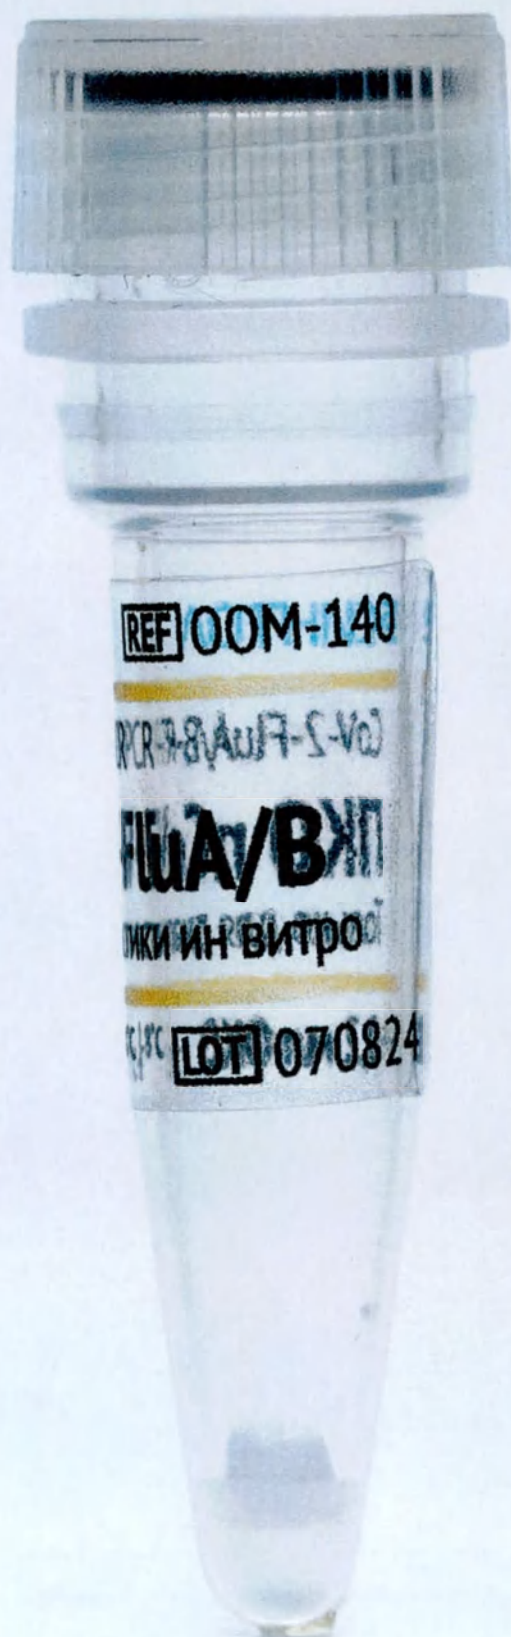

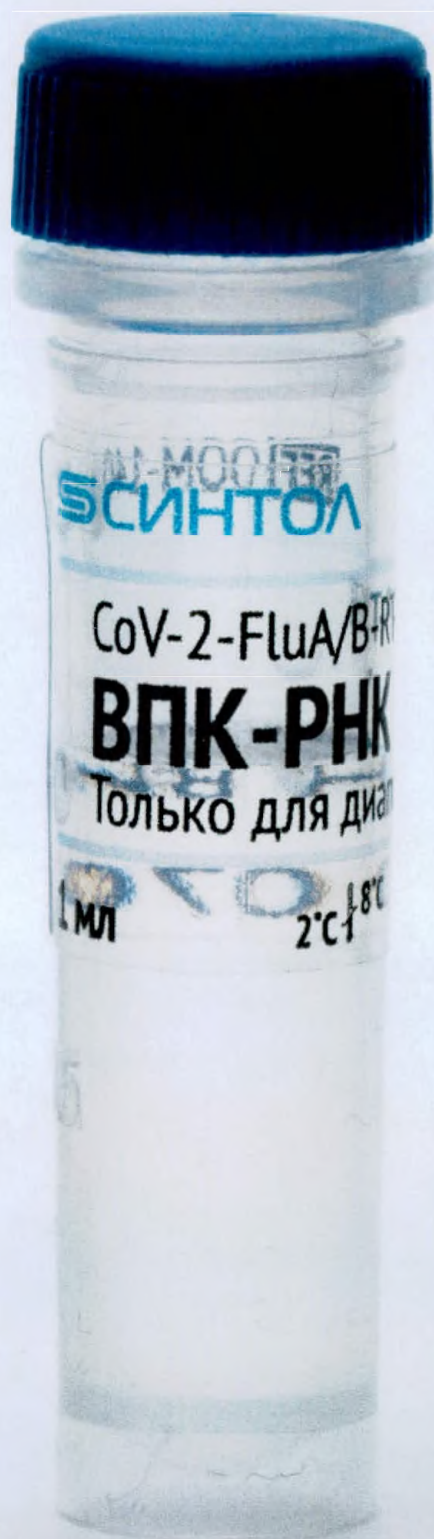





32





СИНТОЛ

REF OOM-505-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

ФОРМА ВЫПУСКА 2

Комплект реагентов для выявления РНК, ручным способом и на автоматизированном оборудовании, методиками метода микротитровой обработки «М-Сарт-НК»				1 шт
Лизирующий раствор, ЛОР		50 мл	1 флакон	
Сорбирующий раствор, СР		4 мл	1 флакон	
Промывочный раствор, ПР		65 мл	1 флакон	
Экстракционный раствор, ЭР		18 мл	1 флакон	
Отрицательный контрольный образец, ОКО		1 мл	1 пробирка	
Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РФ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»				1 шт
Реакционная смесь, РС-CoV-2-FluA/B		-	96-лучевый ПЦР-пламчат	
Разбавитель, РБ		1,6 мл	1 пробирка	
Положительный контрольный образец, ПКО «CoV-2-FluA/B»		-	1 пробирка	
Внутренний положительный контроль выделения, ВПК-РНК		1 мл	1 пробирка	
Отрицательный контрольный образец, ОКО		1 мл	1 пробирка	
Оптическая ПЦР-плена		-	1 штука	
Инструкция по применению		-	1 штука	
Паспорт качества		-	3 штука	

LOT
080824

08.2024

08.2026

25-8°C

IVD

96

i

ООО «НПФ Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 59, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-3

e-mail: syntol@syntol.ru

www.syntol.ru

Для профессионального применения
№ РЗН от

LOT
080824

08.2024

08.2026

25-8°C

IVD

96

i

ООО «НПФ Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 59, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-3
сайт: syntol.ru

Для профессионального применения
№ РЗН от

СИНТОА

000-505-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (формы выпуска 1)

Наименование компонента	Единица измерения	Количество	Наименование компонента	Единица измерения	Количество
Амплификатор	1 шт.	1 шт.	Реагентная смесь	1 шт.	1 шт.
Субстратный раствор	1 шт.	1 шт.	Реагентная смесь	1 шт.	1 шт.
Примечание: субстратный раствор	1 шт.	1 шт.	Реагентная смесь	1 шт.	1 шт.
Экстракционный раствор	1 шт.	1 шт.	Реагентная смесь	1 шт.	1 шт.
Экстракционный раствор	1 шт.	1 шт.	Реагентная смесь	1 шт.	1 шт.

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «ИПС»

Синтоа

А.В. Куров

2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ФБУ «48 ИДНН»

Министерства России

С.В. Борисевич

2024 г.

Медицинское изделие для диагностики in vitro

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» LOT 070824, LOT 080824

ИНСТРУКЦИЯ по применению

2024

СИНТОА

000-505

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR» (формы выпуска 1)

Комплект реагентов для выявления РНК, вирусных геномов и их детектирования с помощью амплификации в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Амплификатор 1 шт.
Субстратный раствор 1 шт.
Примечание: субстратный раствор 1 шт.
Экстракционный раствор 1 шт.
Экстракционный раствор 1 шт.

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА
000-505-140P
08.2024

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)

СИНТОА 000-505-140P (формы выпуска 1)



СИНТОЛ

REF OOM-505

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях, использующих метод магнитной сепарации «М-Сорб-НК»

Лизирующий раствор, ЛОР	50 мл	1 флакон
Сорбирующий раствор, СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор, ПР	65 мл	1 флакон
Экстракционный раствор, ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец, ОКД	1 мл	1 пробирка

LOT
080824

08.2024

08.2026

2°C

IVD

96

i

ООО «СИНТОЛ Системы»
Рязанская Федерация, 12/1490, г. Москва,
Космодромный 5-й д. 19, корп. 1, пом. 1 ком. 41/ФН 12-1
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
ИРПН - 09

СИНТОЛ

REF OOM-505

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выделения РНК коронавируса SARS-CoV-2, вируса гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях, использующих метод магнитной сепарации «М-Сорб-НК»

Лизирующий раствор, ЛОР	50 мл	1 флакон
Сорбирующий раствор, СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор, ПР	65 мл	1 флакон
Экстракционный раствор, ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец, ОКО	1 мл	1 пробирка

LOT
080624

08.2024

08.2026

TC

IVD

96

i

ООО «ИПО СИНТОЛ»
Российская Федерация, 125480, г. Москва,
Кузнецкий м-р д. 14, стр. 1, этаж 3, комн. 410 РН № 12-3
ИНН, ОГРН/ОГРНИП № 5050000000000000000

Для профессионального применения
№ 7701



СИНТОЛ

CoV-2-FluA/B-RT-PCR
М-Сорб-НК

ЛОР

Лизирующий раствор

50 мл



48



42




43





45

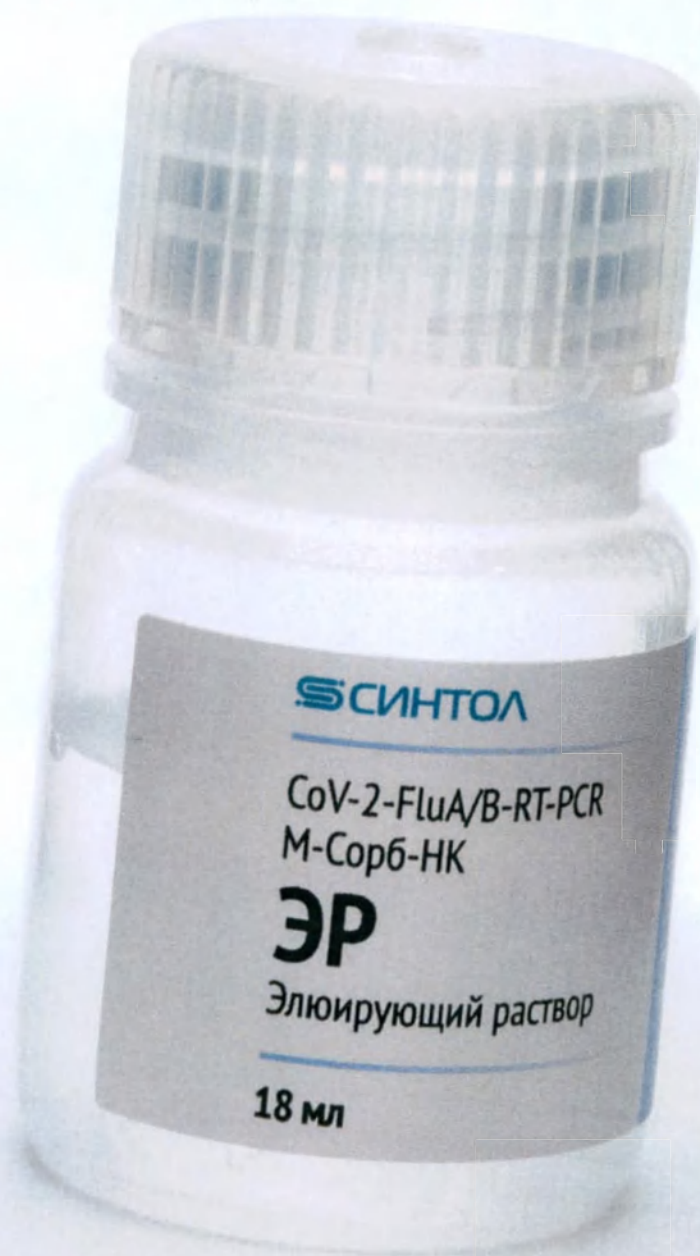

46







64



СИНТОЛ

REF OOM-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вируса гриппа А (Influenza A virus) и гриппа В (Influenza B virus) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Реакционная смесь, PC-CoV-2-FluA/B
 Разбавитель, РБ
 Положительный контрольный образец, ПКО nCoV-FluA/B
 Отрицательный контрольный образец, ОКО
 Внутренний положительный контроль выделения, ВПК-РНК
 Оптическая ПЦР-пленка
 Инструкция по применению
 Паспорт качества

1,6 мл

1 мл

1 мл

96-луночный ПЦР-планшет

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 пробирка

1 штука

1 штука

1 штука

FAM R66 ROK GCS

LOT 080824

08.2024

08.2026

2°C - 8°C

IVD

96

i

ООО «НПО Синтол»
 Российская Федерация, 125499, г. Москва,
 Коммунальный 6-й д. 39, корпус 1, пом. 1 этаж 45/PM 12-3
 email: synтол@synтол.ru www.synтол.ru

Для профессионального применения
 № РЭН

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

PC-CoV-2-FluA/B

96-луночный ПЦР-планшет

Только для диагностики ин витро

2°C - 8°C

LOT 080824



С.В. Борисевич
2024

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2,
вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*)
методом полимеразной цепной реакции в реальном времени
«CoV-2-FtuA/B-RT-PCR» LOT 070824.1 LOT 080824

2024

[illegible]

50

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ФГБУ «48 ЦРНИ»
Министерства России
С.В. Борисенко
2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

© 1999 Blackwell Science Ltd

2024





SCINTOL

REF OOM-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

PC-CoV-2-FluA/B



96-луночный ПЦР-планшет


Только для диагностики ин витро

2°C - 8°C

LOT 080824

54

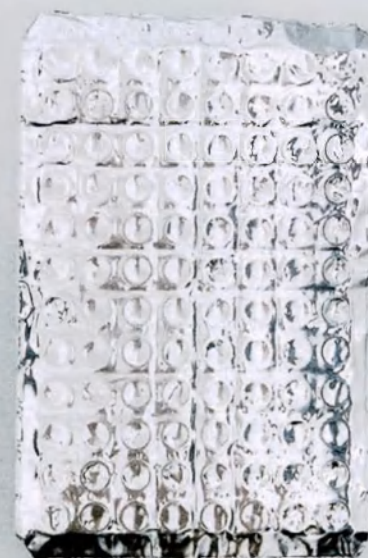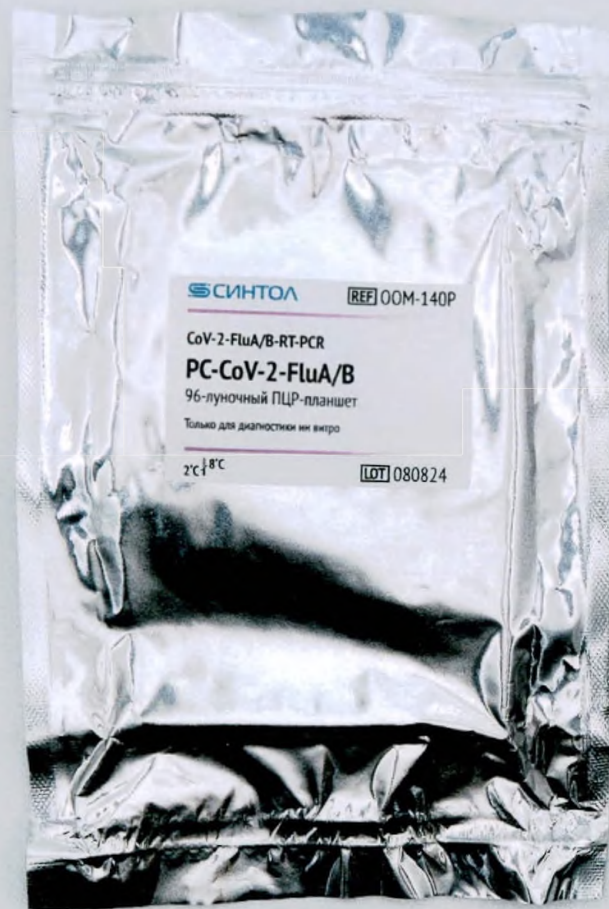

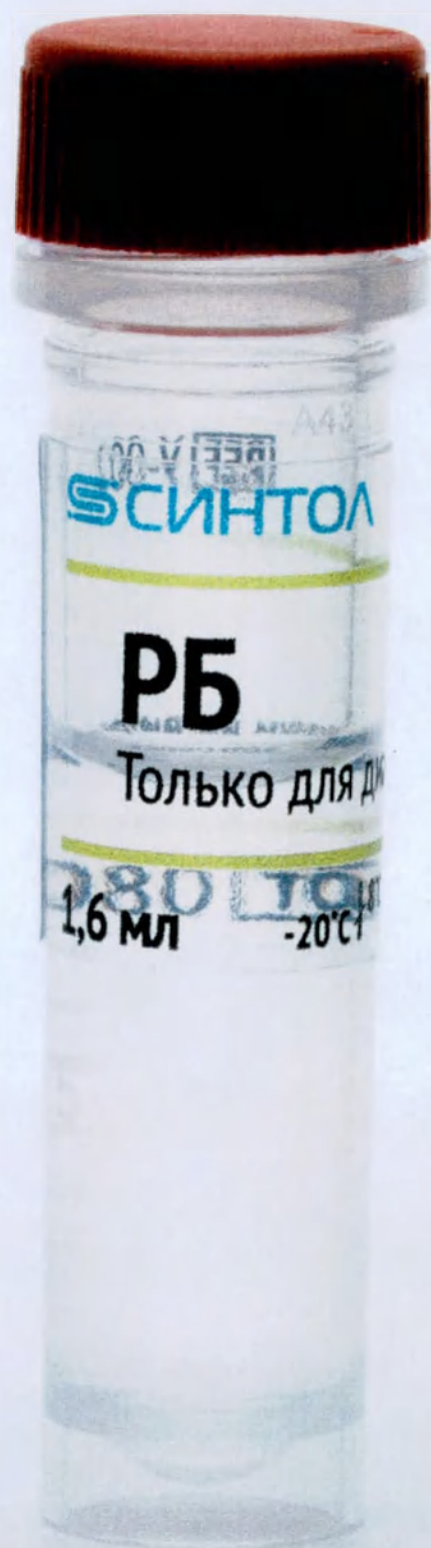




57





59

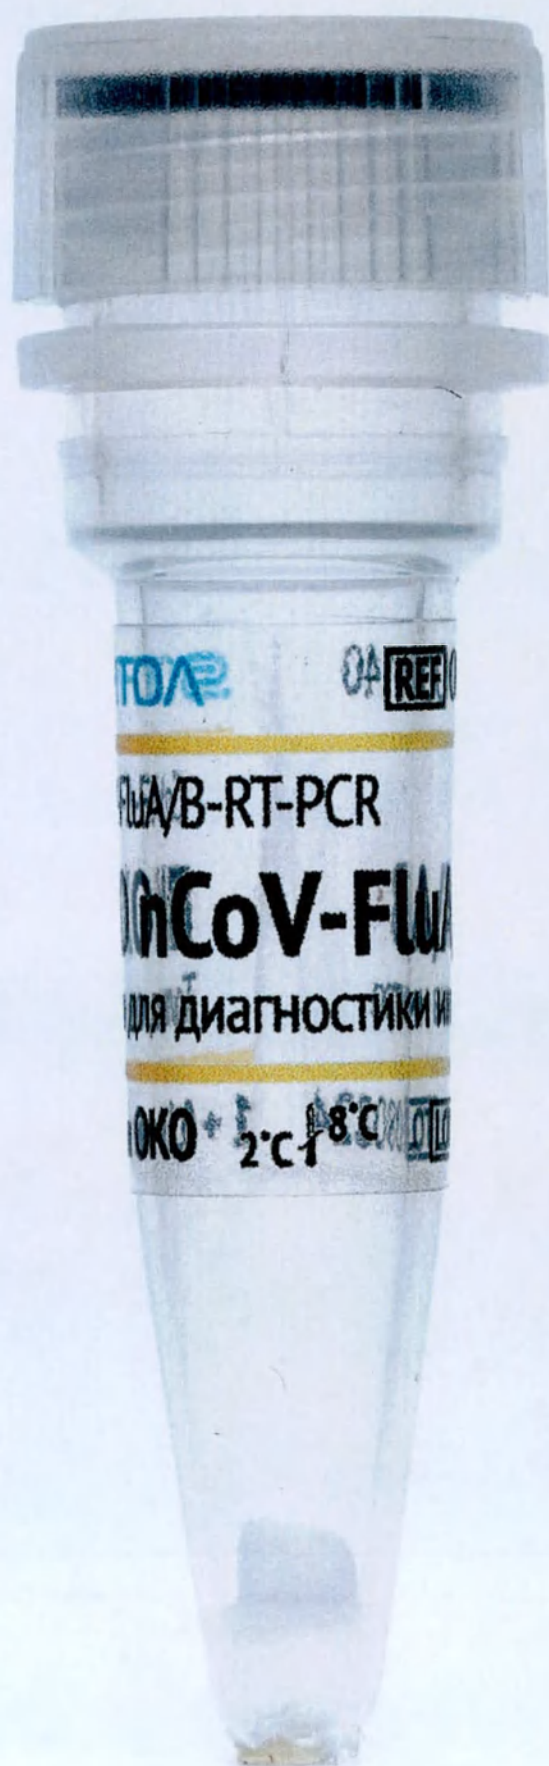




61



62



63

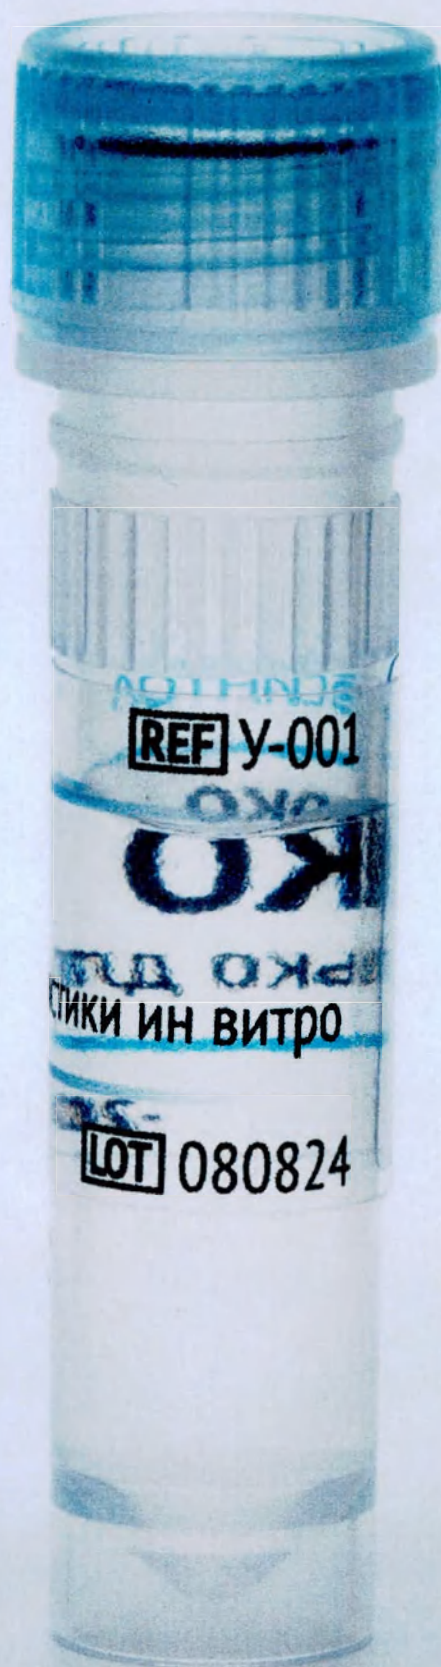



6-5



66

67

СИНТОЛ

REF OOM-140

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

ФОРМА ВЫПУСКА 3

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Реакционная смесь, РС-CoV-2-FluA/B	-	96 микропробирок
Разбавитель, РБ	1,6 мл	1 пробирка
Положительный контрольный образец, ПКО nCoV-FluA/B	-	1 пробирка
Отрицательный контрольный образец, ОКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения, ВПК-РНК	1 мл	1 пробирка
Инструкция по применению	-	1 штука
Паспорт качества	-	1 штука

FAM R6G ROX Cy5

LOT

070824

08.2024

08.2026

2°C-8°C

IVD

96

i



ООО «ИПФ Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-3
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
№ РЭН

2024

СИНТОЛ

REF OOM-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2, вирусов гриппа А (*Influenza A virus*) и гриппа В (*Influenza B virus*) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

ФОРМА ВЫПУСКА 4

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «CoV-2-FluA/B-RT-PCR»

Реакционная смесь, РС-CoV-2-FluA/B	-	96-луночный ПЦР-планшет
Разбавитель, РБ	1,6 мл	1 пробирка
Положительный контрольный образец, ПКО nCoV-FluA/B	-	1 пробирка
Отрицательный контрольный образец, ОКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения, ВПК-РНК	1 мл	1 пробирка
Оптическая ПЦР-пленка	-	1 штука
Инструкция по применению	-	1 штука
Паспорт качества	-	1 штука

FAM R6G ROX Cy5

LOT 080824

08.2024

08.2026

2°C 8°C

IVD

96

i

ООО «НПО Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-5
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
№ РЗН

96-луночный ПЦР-планшет

Только для диагностики ин витро

2°C 8°C

LOT 080824



«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник ФГБУ «48 ЦББФ»
Министерства России

С.В. Борисевич
2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

SYNTOL LOT 00M-140P

CoV-2-FluA/B-RT-PCR

PC-CoV-2-FluA/B

96-порционный ПЦР-реагент

Только для диагностики in vitro

18°C 2x1 LOT 080824

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 71 листа(-ов)

Генеральный директор
ООО «НПФ Синтол»

А.В. Кузубов

Подпись

