

«Утверждаю»

Директор

ООО «Медика Продакт»



Михалева Е.М.

«18» 12 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований, в различных вариантах исполнения»


производства «ДИЕССЕ Диагностика Сенезе С.п.А.», Италия

(«DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.», VIALE DECUMANO 36 MILANO (MI) CAP 20157 ITALY;

Тел.: +39 02 48 59 121, Факс: +39 02 48 00 85 30, E-mail: diessemilano@pec.diesse.it).



Контрольный материал Уровень I - (9 мл) – 1 шт.

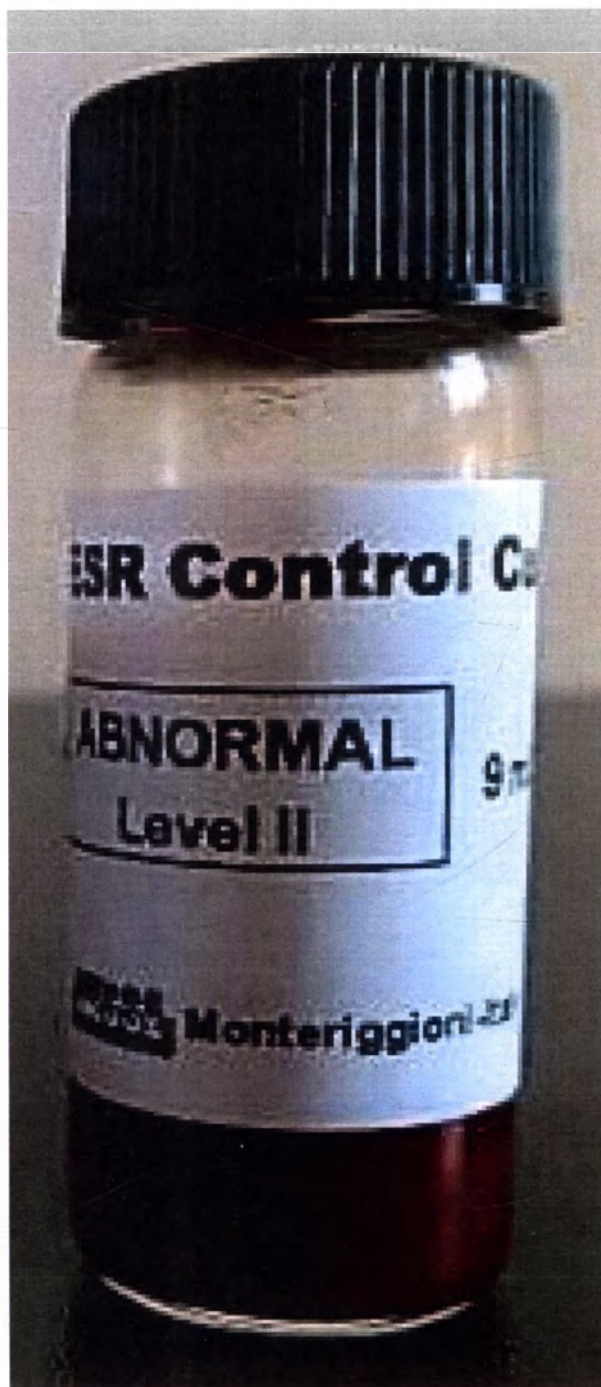

Контрольный материал Уровень II - (9 мл) – 1 шт.



Этикетки со штрих-кодом

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED
Коммерческий директор/
Commercial Director
(должность/position)
«DIESSE Diagnostica Senese SpA»
Luigi Nava
(ФИО/name)

(подпись/ signature)
М.П./Stamp _____ 20__

Инструкция по применению
(User manual)
**«Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE
«Скорость оседания эритроцитов» для
автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и
Cube для мониторинга качества клинических и
лабораторных исследований, в различных вариантах
исполнения»**

DIESSE

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.p.A.
VIALE DECUMANO 36 MILANO (MI)
CAP 20157 ITALY
Тел. +39 02 48 59 121
Факс +39 02 48 00 85 30, www.diesse.it
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Коммерческий директор
Luigi Nava

Инструкция по применению

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA
 53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
 Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020



CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE

PRODOTTO/PRODUCT ESR CONTROL CUBE

REF: 10435 (4x9 ml)
 10436 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	952	952	952
	2023-12	2023-12	2023-12
	2025-06	2025-06	2025-06

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
VES-Matic Cube 30	7	1-15	67	42-92	OFF
VES-Matic Cube 80/VES-Matic Cube 200/Ves-Matic Cube Track	7	1-15	50	25-75	OFF
MINI-CUBE/Cube 30 touch/ Ves Matic 5	5	1-14	44	19-69	ON

Data/Date

06/02/2024


Testato da/Tested by:

Francesco Bisconti


Approvato da/Approved by:

Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)

Пример сертификата контроля качества

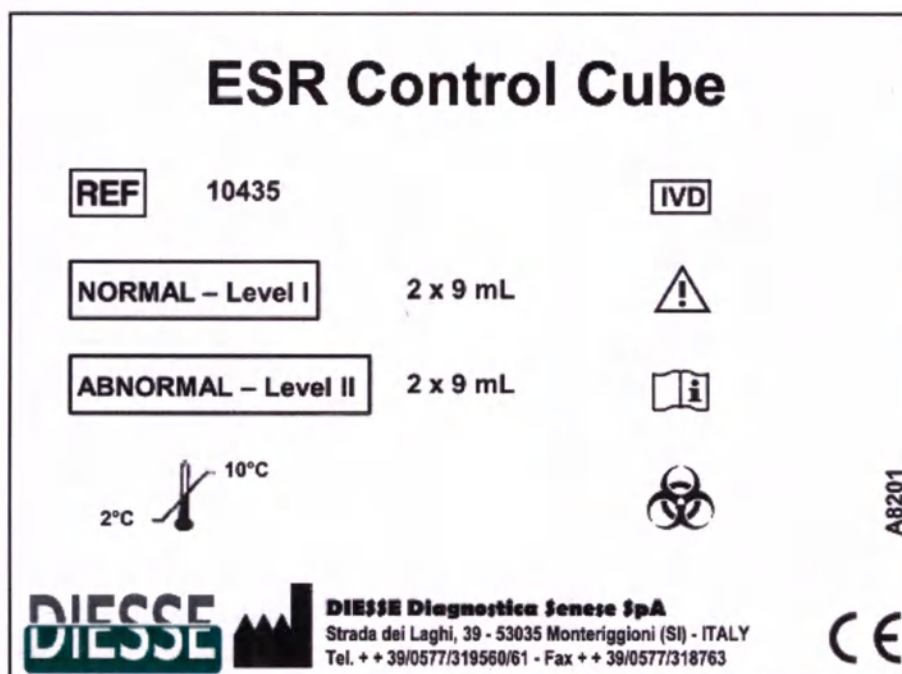


Пример маркировки упаковки на английском языке варианта исполнения
 Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10435 «Скорость оседания
 эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для
 мониторинга качества клинических и лабораторных исследований

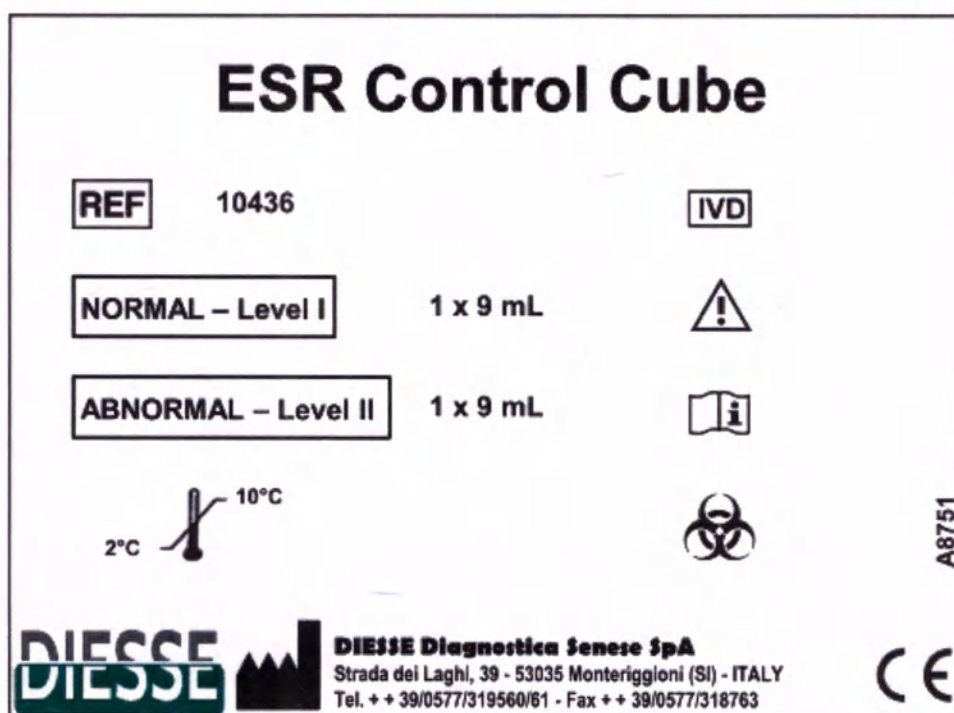


Пример маркировки упаковки на английском языке варианта исполнения
 Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10436 «Скорость оседания


эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований

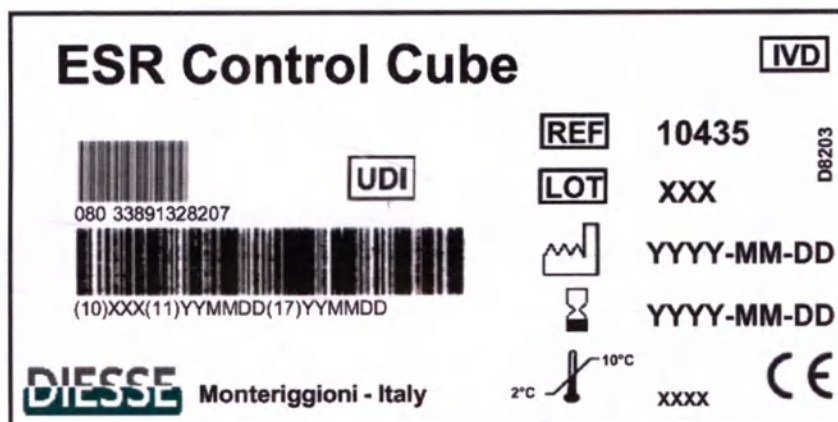


Пример маркировки упаковки на английском языке варианта исполнения Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10435 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований

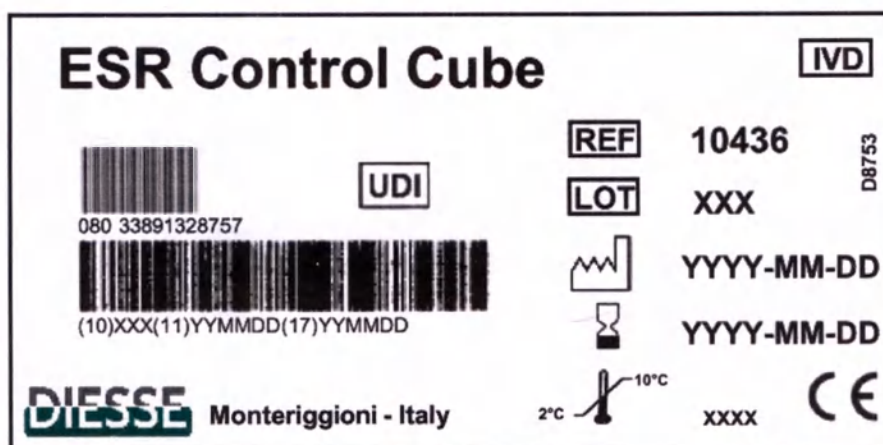

Пример маркировки упаковки на английском языке варианта исполнения Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10436 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований

Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10435 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований		QR
REF _____		
Состав: Инструкция по применению - 1 шт. Контрольный материал Уровень I - (9 мл) - 2 шт. Контрольный материал Уровень II - (9 мл) - 2 шт. Сертификат контроля качества - 1 шт. Этикетки со штрих-кодом - 1 уп.		
 DIESSE Diagnostica Senese SpA Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy		
Официальный представитель в России: ООО "Медика Продакт" 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02, perm@westmedica.com		Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
МАССА НЕТТО _____ КГ МАССА БРУТТО _____ КГ	  	  
		  № PY

Пример маркировки упаковки на русском языке варианта исполнения Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10435 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований

Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10436 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований		QR
REF _____		
Состав: Инструкция по применению - 1 шт. Контрольный материал Уровень I - (9 мл) - 1 шт. Контрольный материал Уровень II - (9 мл) - 1 шт. Сертификат контроля качества - 1 шт. Этикетки со штрих-кодом - 1 уп.		
 DIESSE Diagnostica Senese SpA Strada dei Laghi 39, 53035 Monteriggioni (SI), Italy		
Официальный представитель в России: ООО "Медика Продакт" 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 27 +7 342 270-08-02, perm@westmedica.com		Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
МАССА НЕТТО _____ КГ МАССА БРУТТО _____ КГ	  	  
		  № PY

Пример маркировки упаковки на русском языке варианта исполнения Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE 10436 «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований



Фото общего вида упаковки МИ «Контрольные материалы ESR CONTROL CUBE «Скорость оседания эритроцитов» для автоматических анализаторов СОЭ серии Ves-Matic и Cube для мониторинга качества клинических и лабораторных исследований, в различных вариантах исполнения»

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
10 лист(-ах/-е) бумаги



Михалева Е. М., Директор