

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО фирмы


«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

2022 г.



**Внешний вид медицинского изделия для ин витро диагностики
«Набор калибровочных плазм для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ калибратор)»
по ТУ 21.20.23-118-42349142-2021**

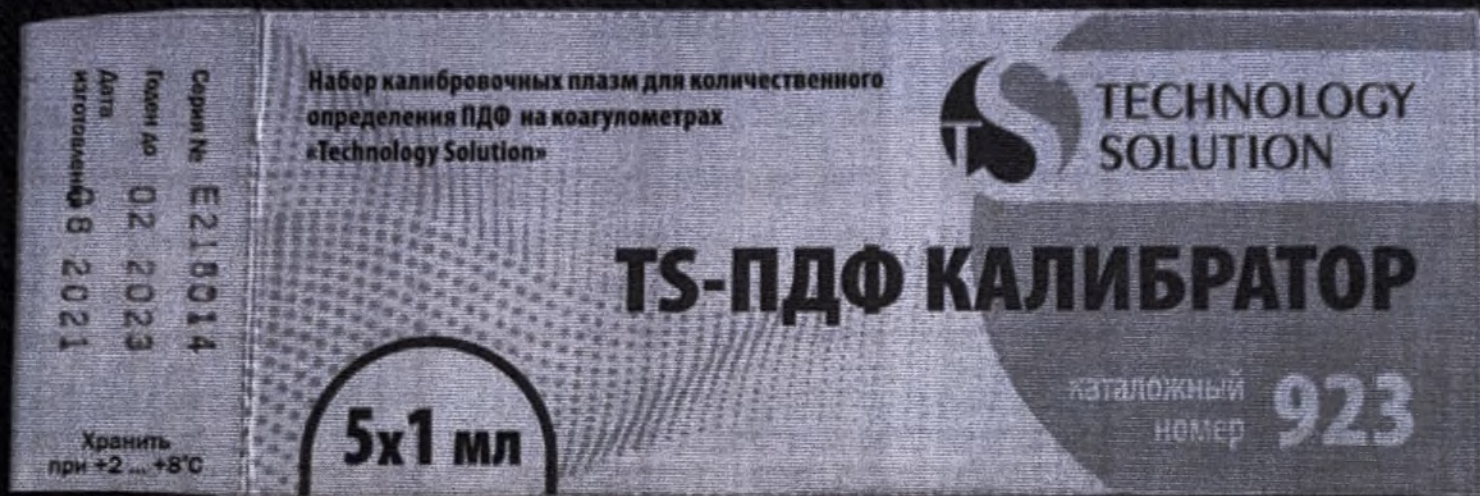


ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 923
Набор калибровочных плазм для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution»
(TS-ПДФ калибратор)
ТУ 21.20.23-118-42349142-2021

Серия E218014

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------

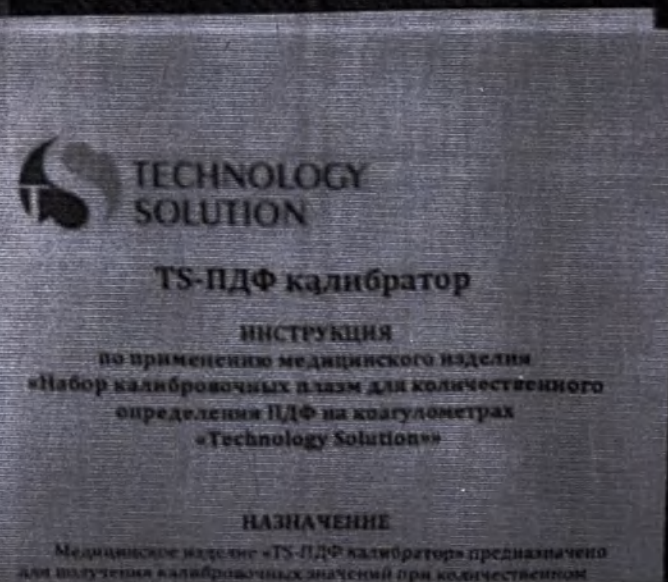

TS-ПДФ КАЛИБРАТОР

Только для линейки коагулометров «Technology Solution»

TS-ПДФ КАЛИБРАТОР

Состав набора:

1. ПДФ-калибратор № 1, на 1 мл - 1 фл.
2. ПДФ-калибратор № 2, на 1 мл - 1 фл.
3. ПДФ-калибратор № 3, на 1 мл - 1 фл.
4. ПДФ-калибратор № 4, на 1 мл - 1 фл.
5. ПДФ-калибратор № 5, на 1 мл - 1 фл.

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

ТУ 21.20.23-118-42349142-2021

РУ №

Произведено ООО фирмой
«Технология-Стандарт»
по заказу
ООО «Лабораторные решения»

ТЕХНОЛОГИЯ **ТЕ** СТАНДАРТ

656037, г. Барнаул,

а/я 1351,

тел.: (3852) 22-99-37

каталожный номер

923



TECHNOLOGY
SOLUTION

656037, г. Барнаул,

а/я 3333

sales@lab-solution.ru

8-800-551-61-71



ООО фирма «Технология-Стандарт»

ПАСПОРТ № 923

Набор калибровочных плазм для количественного определения ПДФ
на коагулометрах «Technology Solution»

(TS-ПДФ калибратор)

ТУ 21.20.23-118-42349142-2021

Серия E218014

Годен до 02.2023

Наименование показателя	Должное значение по ТУ	Фактическое значение
-------------------------	------------------------	----------------------



TECHNOLOGY
SOLUTION

TS-ПДФ калибратор

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия
«Набор калибровочных плазм для количественного
определения ПДФ на коагулометрах
«Technology Solution»»

НАЗНАЧЕНИЕ

Медицинское изделие «TS-ПДФ калибратор» предназначено
для получения калибровочных значений при количественном

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 3

три) листов

18 2022 г.

Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот



Макет упаковки медицинского изделия «Набор калибровочных плазм для количественного определения ПДФ на коагулометрах «Technology Solution» (TS-ПДФ калибратор)» по ТУ 21.20.23-118-42349142-2021



Директор ООО фирма
«Технология-Стандарт»

А.П. Момот

